

Фотографическое изображение

**Тест-система для выявления хорионического гонадотропина человека в моче иммунохроматографическим методом «Тест для определения беременности»,
производства компании «Ханчжоу Биотест Биотех Ко, Лтд» (Hangzhou Biotest Biotech Co., Ltd.), КНР**




Директор ООО «КМС-КРЫМ»


Петренко Э. М.

« 10 » 06 2017 г


*Тест-система для выявления хорионического гонадотропина человека в моче
иммунохроматографическим методом «Тест-полоска для определения беременности SECRET
(hCG Rapid Test Strip SECRET)»*

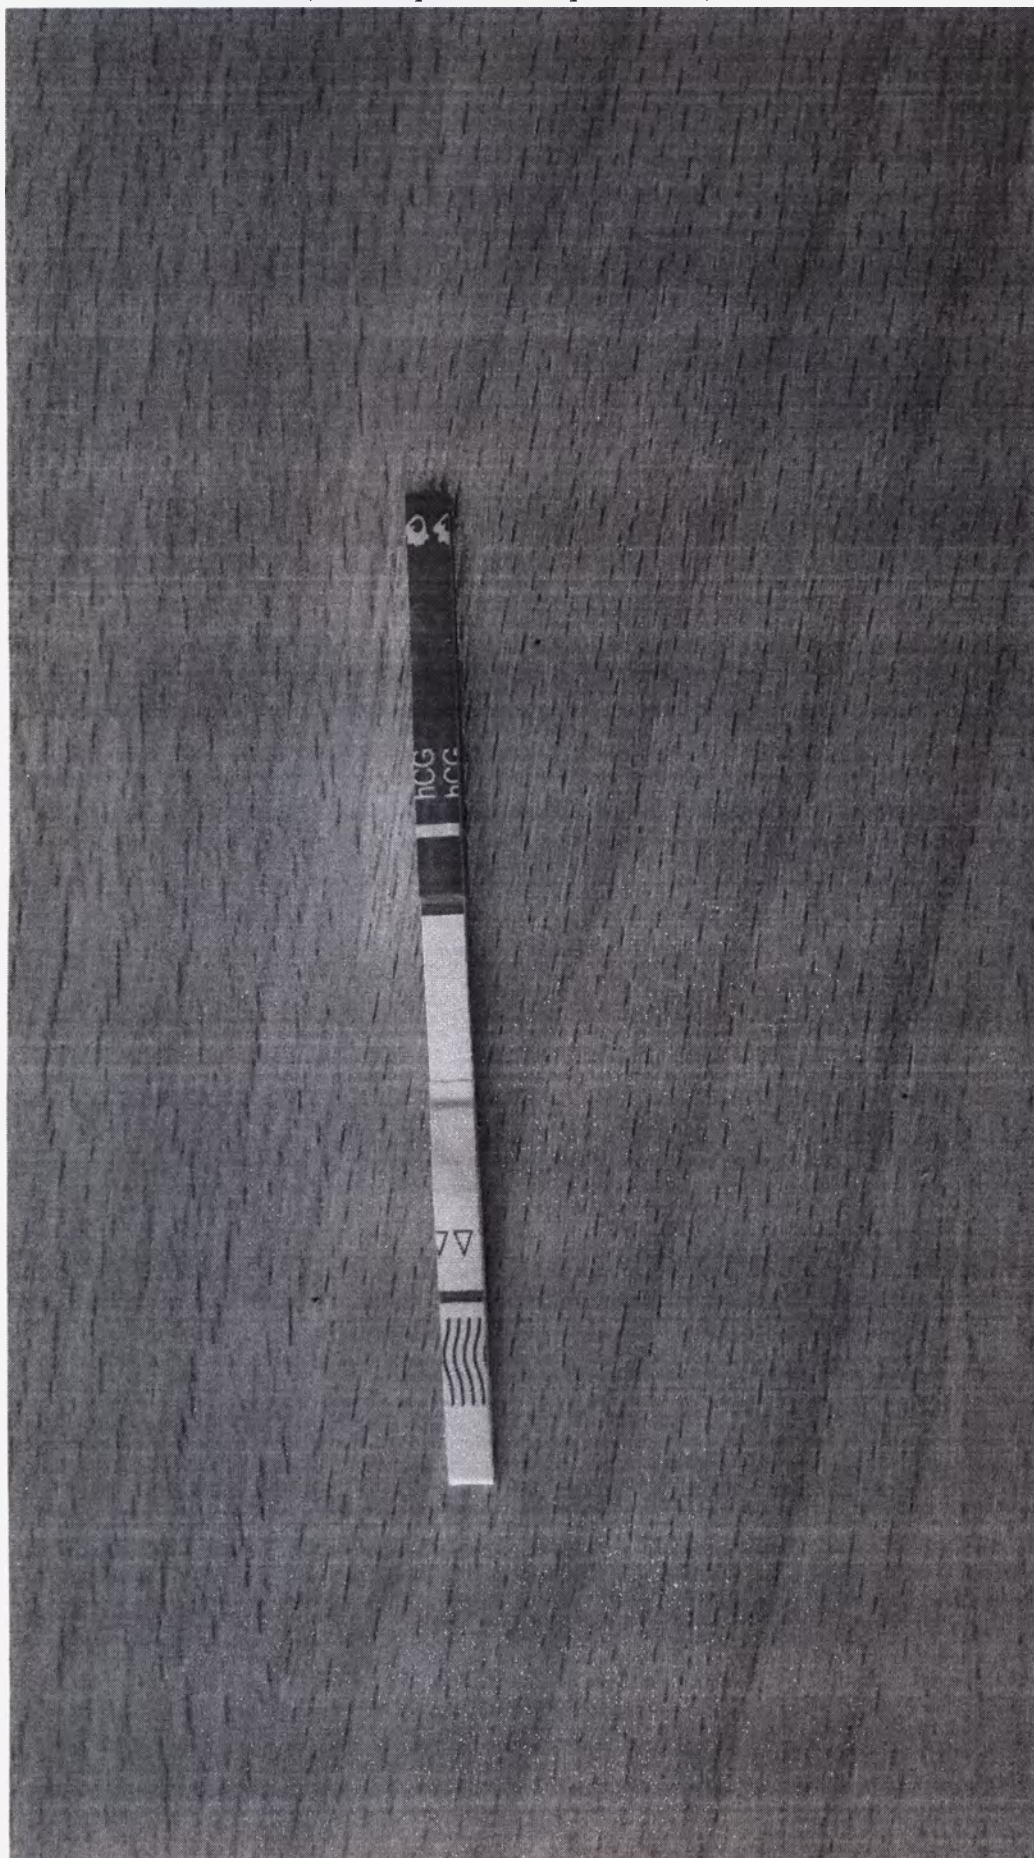


*Тест-система для выявления хорионического гонадотропина человека в моче
иммунохроматографическим методом «Тест-полоска для определения беременности SECRET
plus (hCG Rapid Test Strip SECRET plus)»*

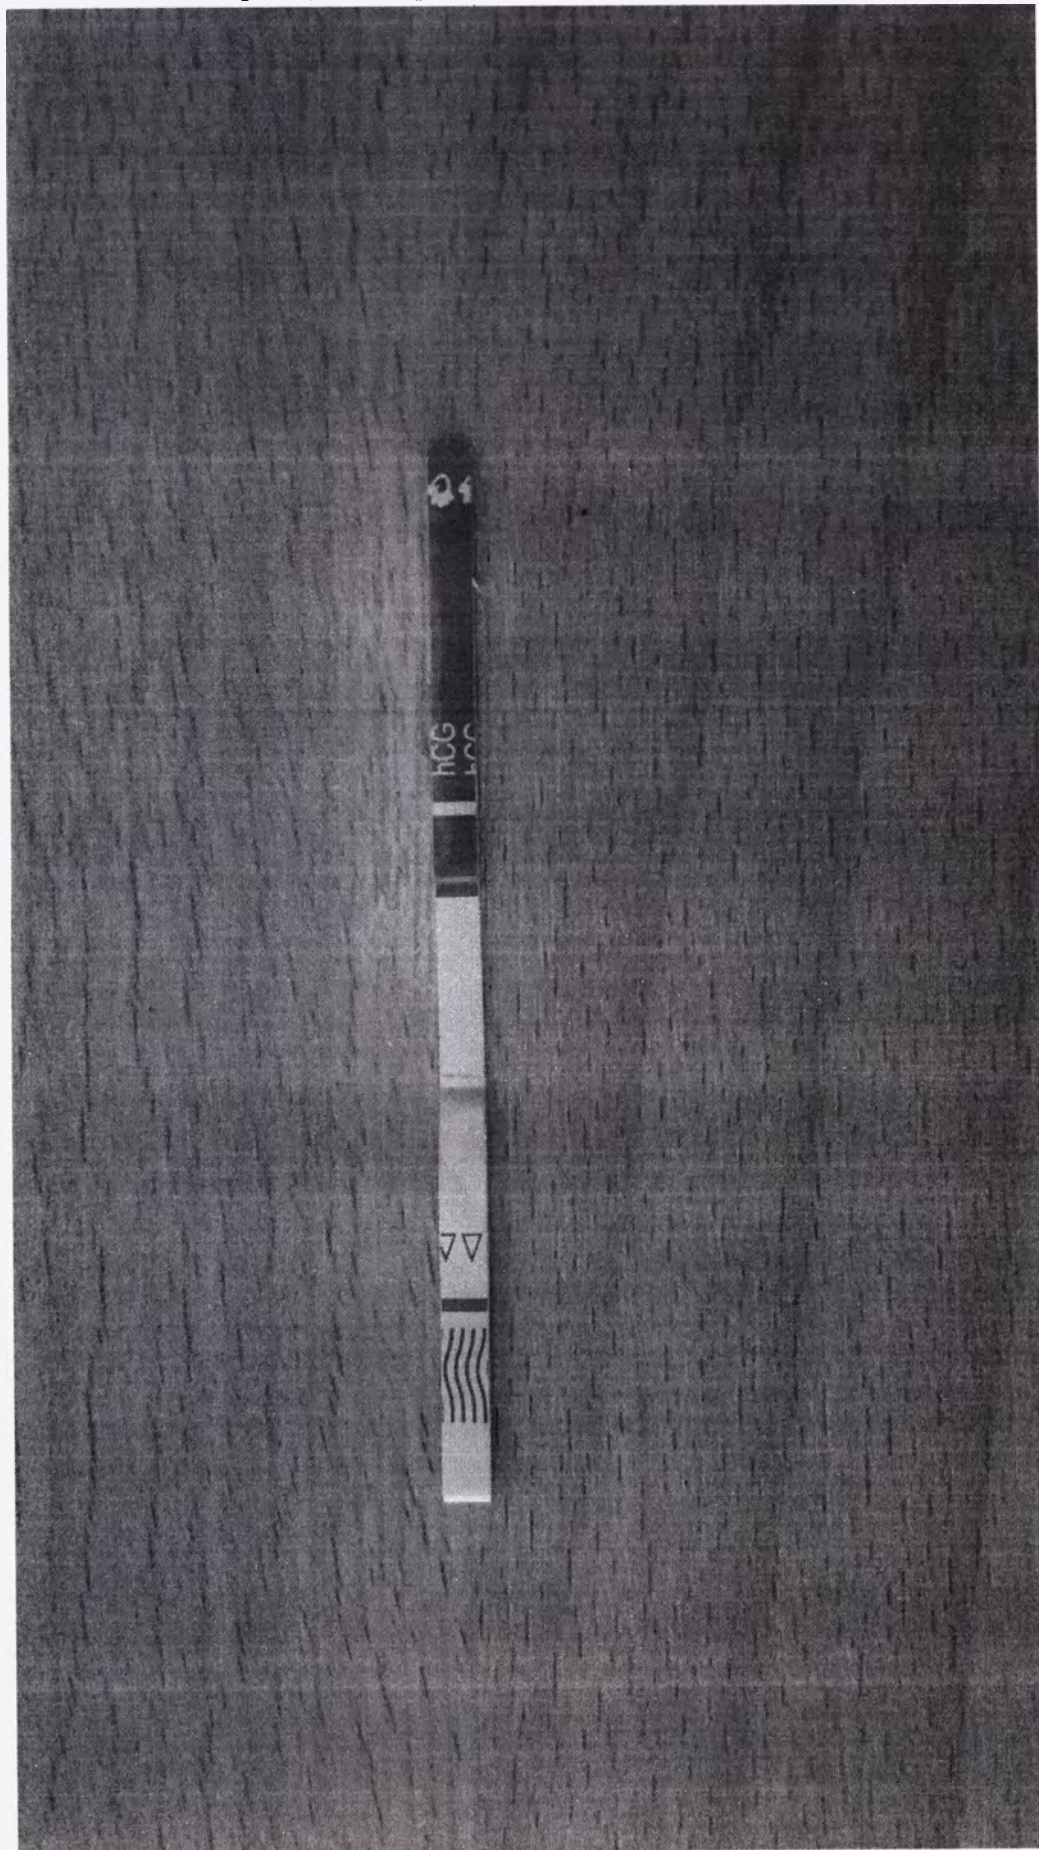


Тест-система для выявления хорионического гонадотропина человека в моче иммунохроматографическим методом «Тест-полоска для определения беременности ультрачувствительная ULTRA (hCG Enhanced Sensitivity Rapid Test Strip ULTRA)»

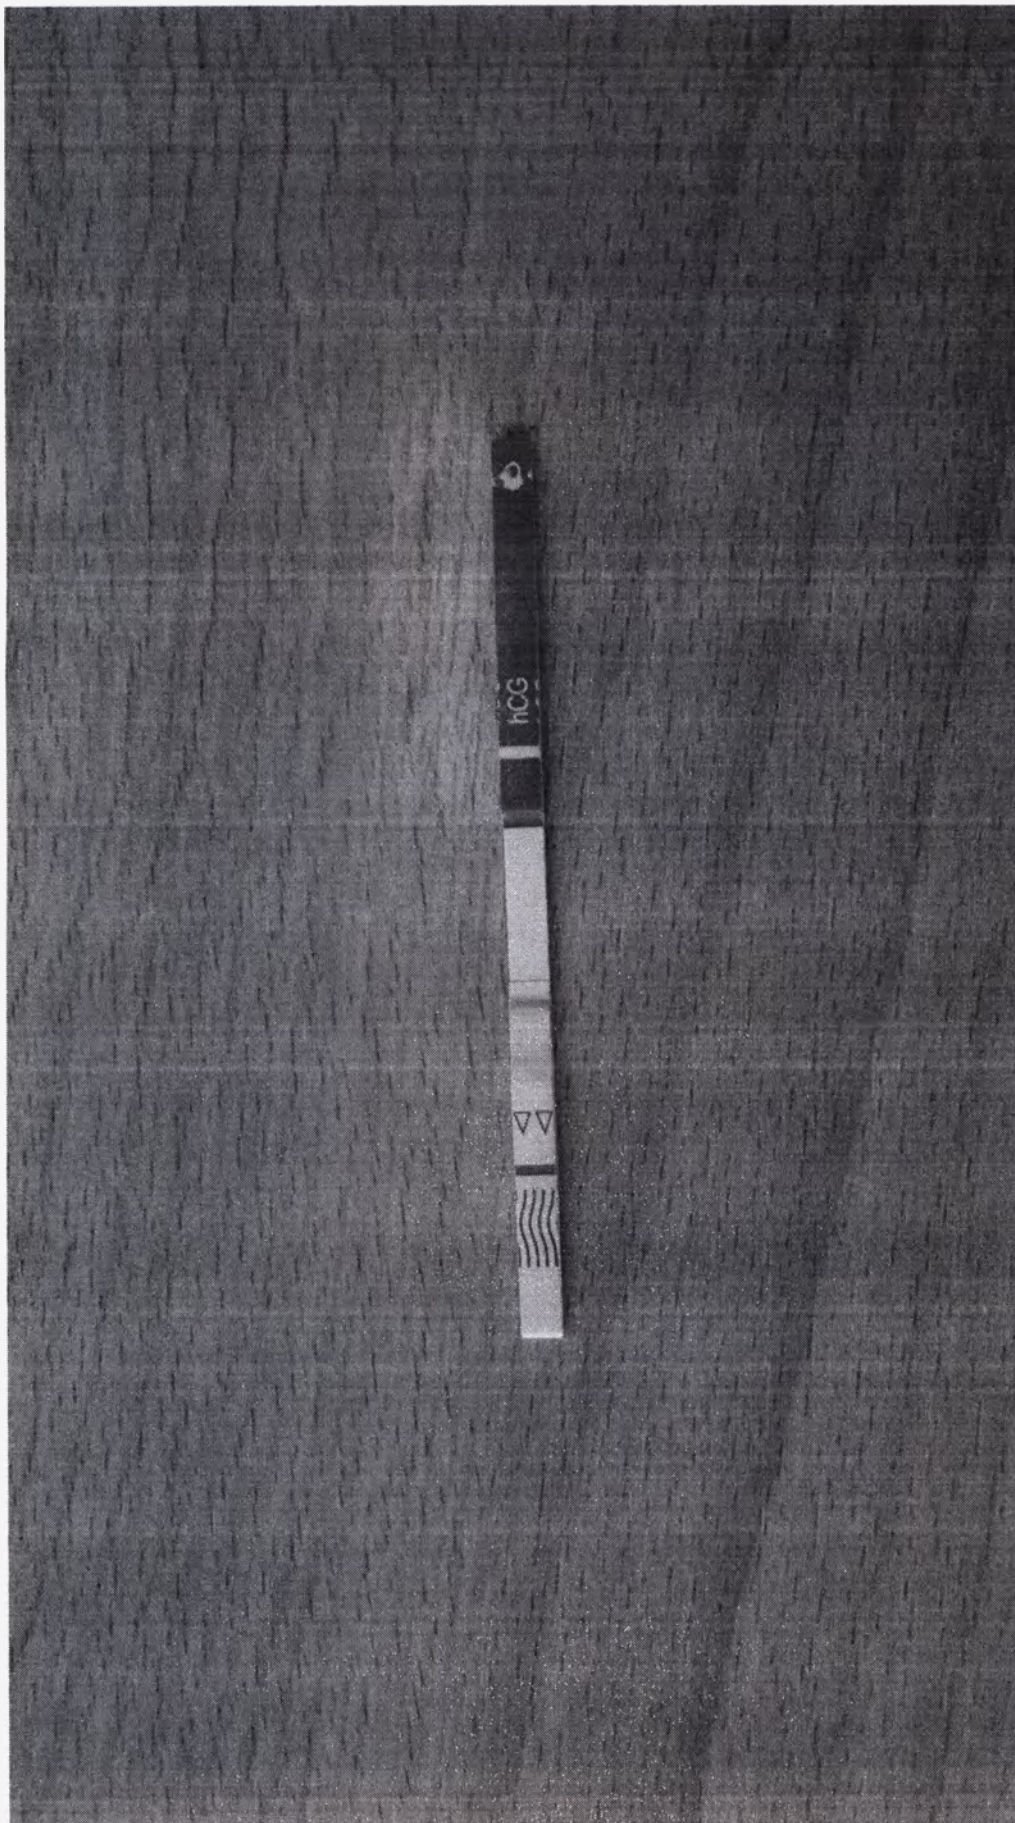

*Тест-система для выявления хорионического гонадотропина человека в моче
иммунохроматографическим методом «Тест струйный для определения беременности
SECRET comfort (hCG Midstream Rapid Test SECRET comfort)»*

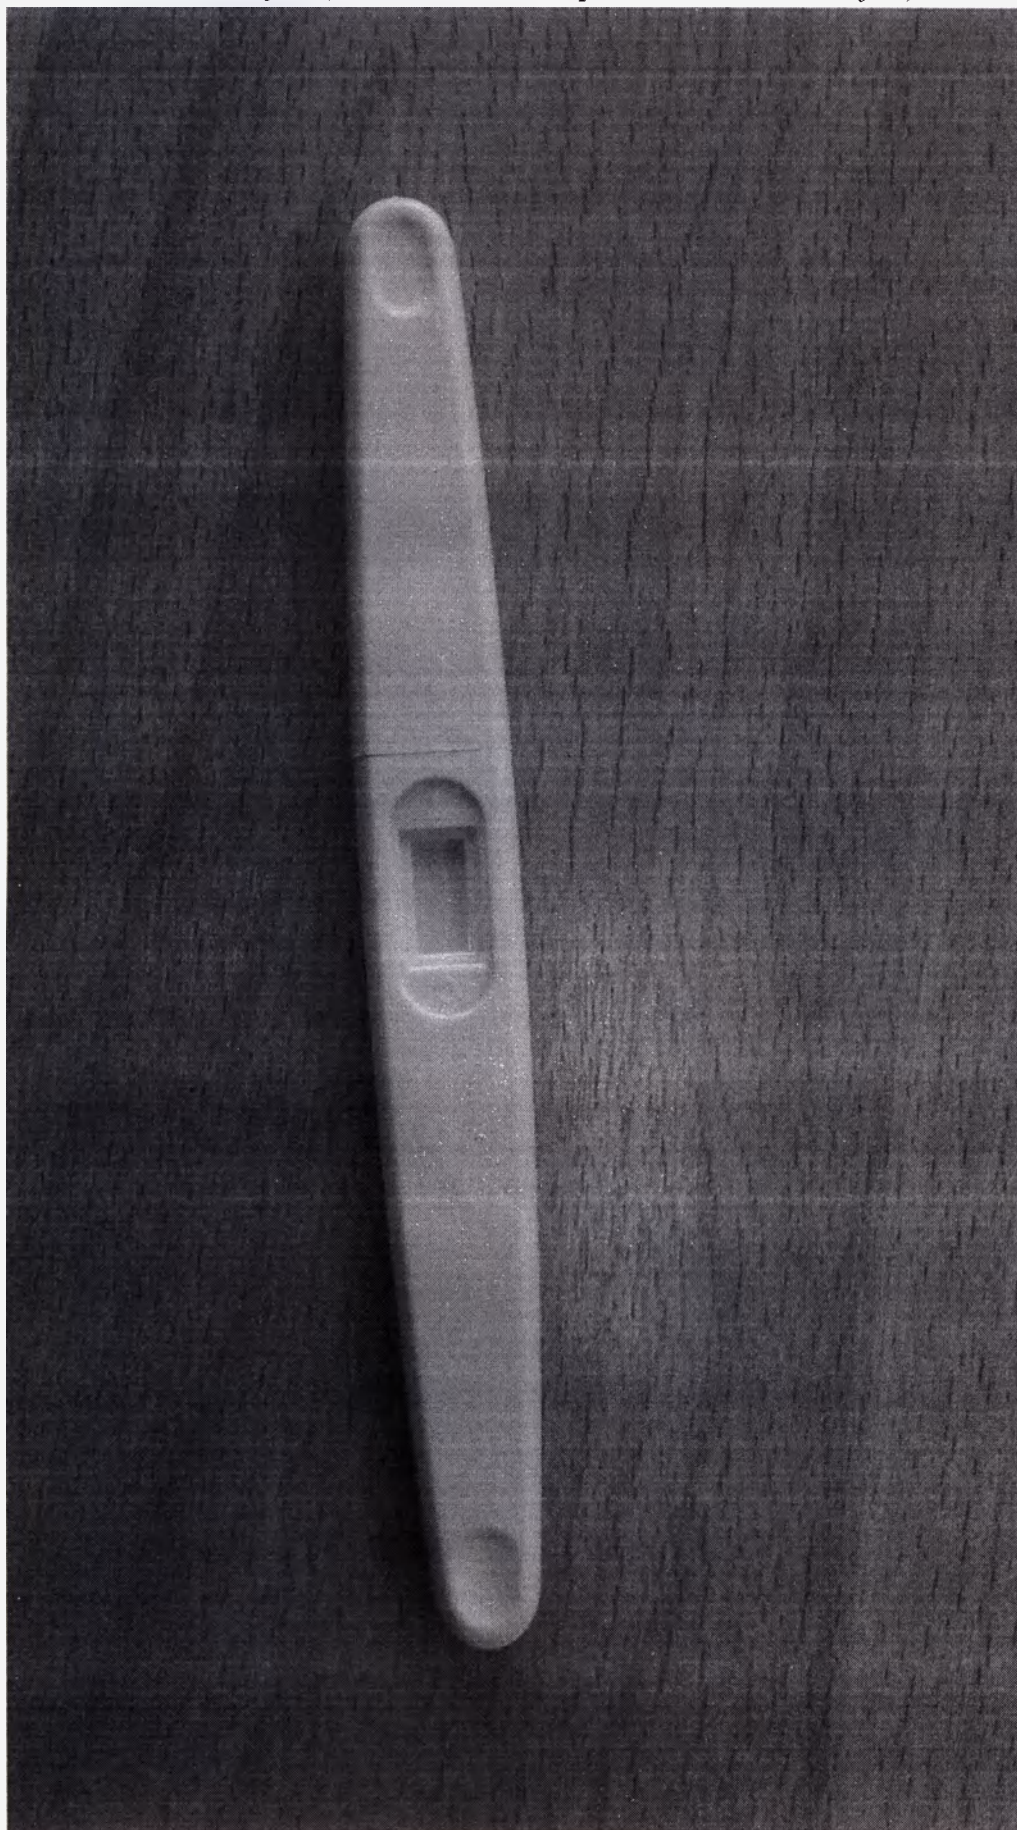

*Тест-система для выявления хорионического гонадотропина человека в моче
иммунохроматографическим методом «Тест струйный для определения беременности DUET
(hCG Enhanced Sensitivity Midstream Rapid Test DUET)»*

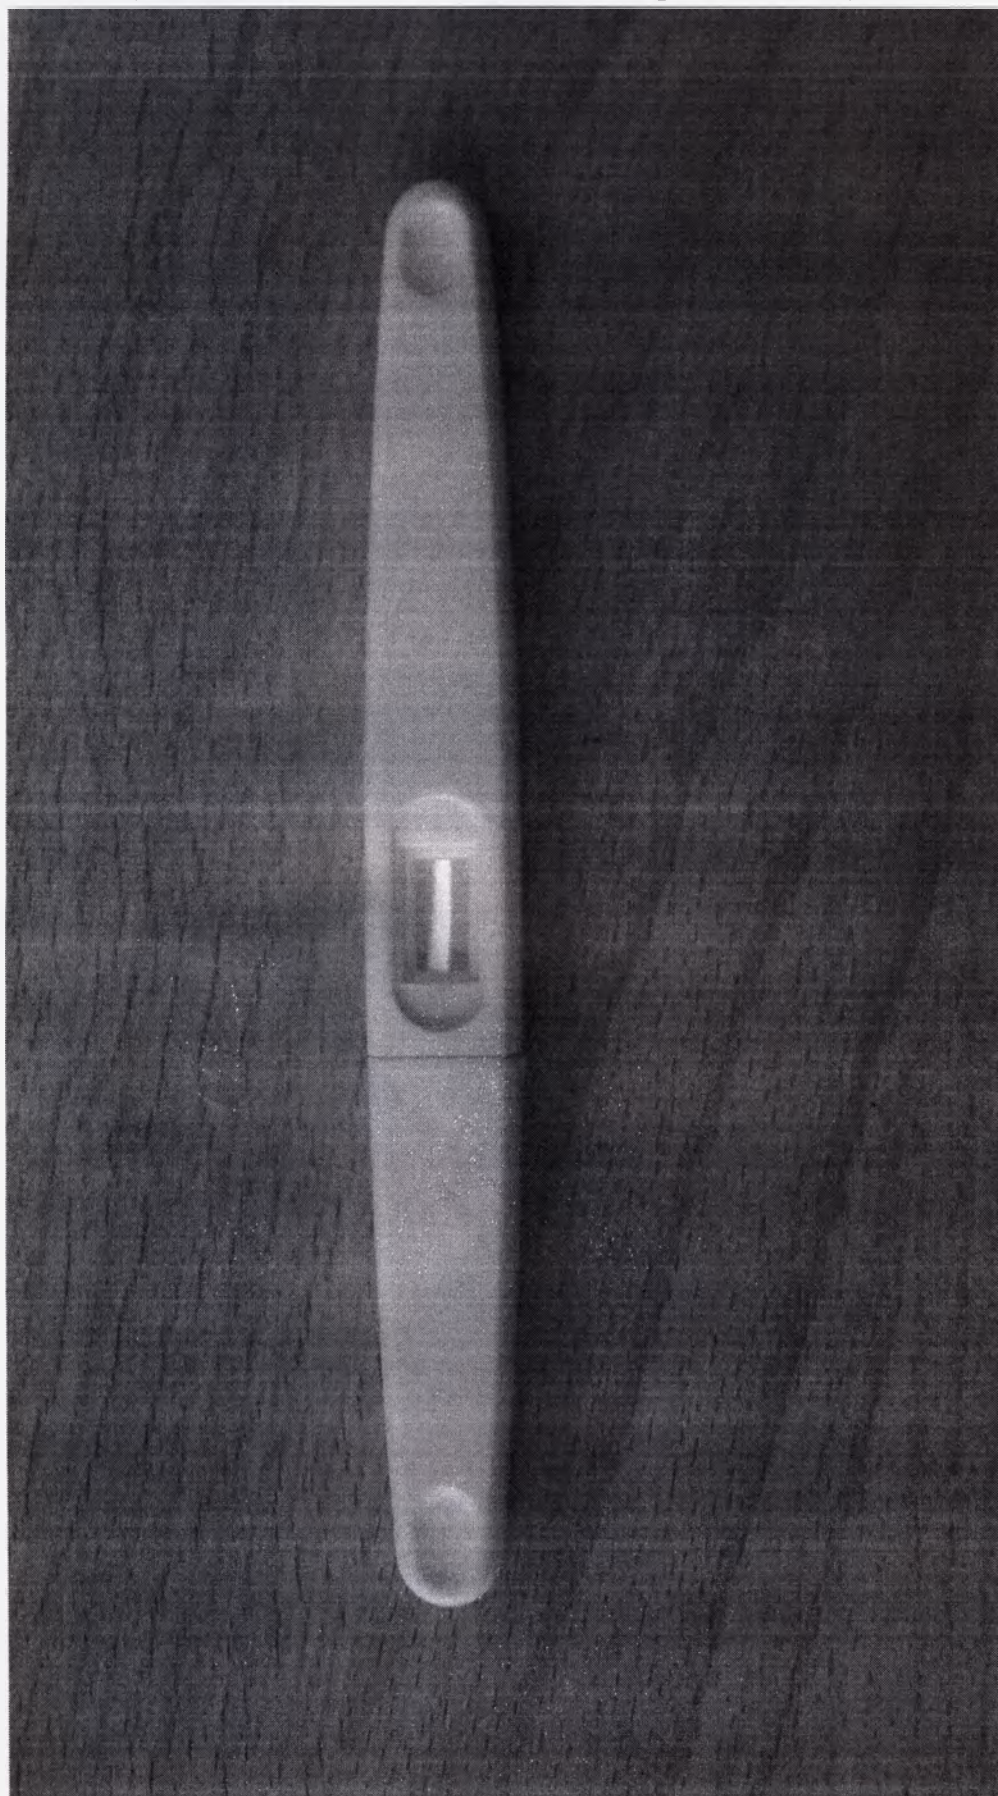

Все пронумеровано, сшито и

скреплено печатью 6 листов

директор ООО «КМС-КРЫМ»

Петренко Э. М.

