

Фотографические изображения


**Аппарат электрохирургический высокочастотный медицинский
оториноларингологический "Трилокс-ЛОР" с принадлежностями,
производства Zerone Co., Ltd. (Зерон Ко., Лтд.), Корея**

Генеральный директор
ООО «БОЗОН»
Беляков А.В.






Педаль ножная двойная [FS02-02R]

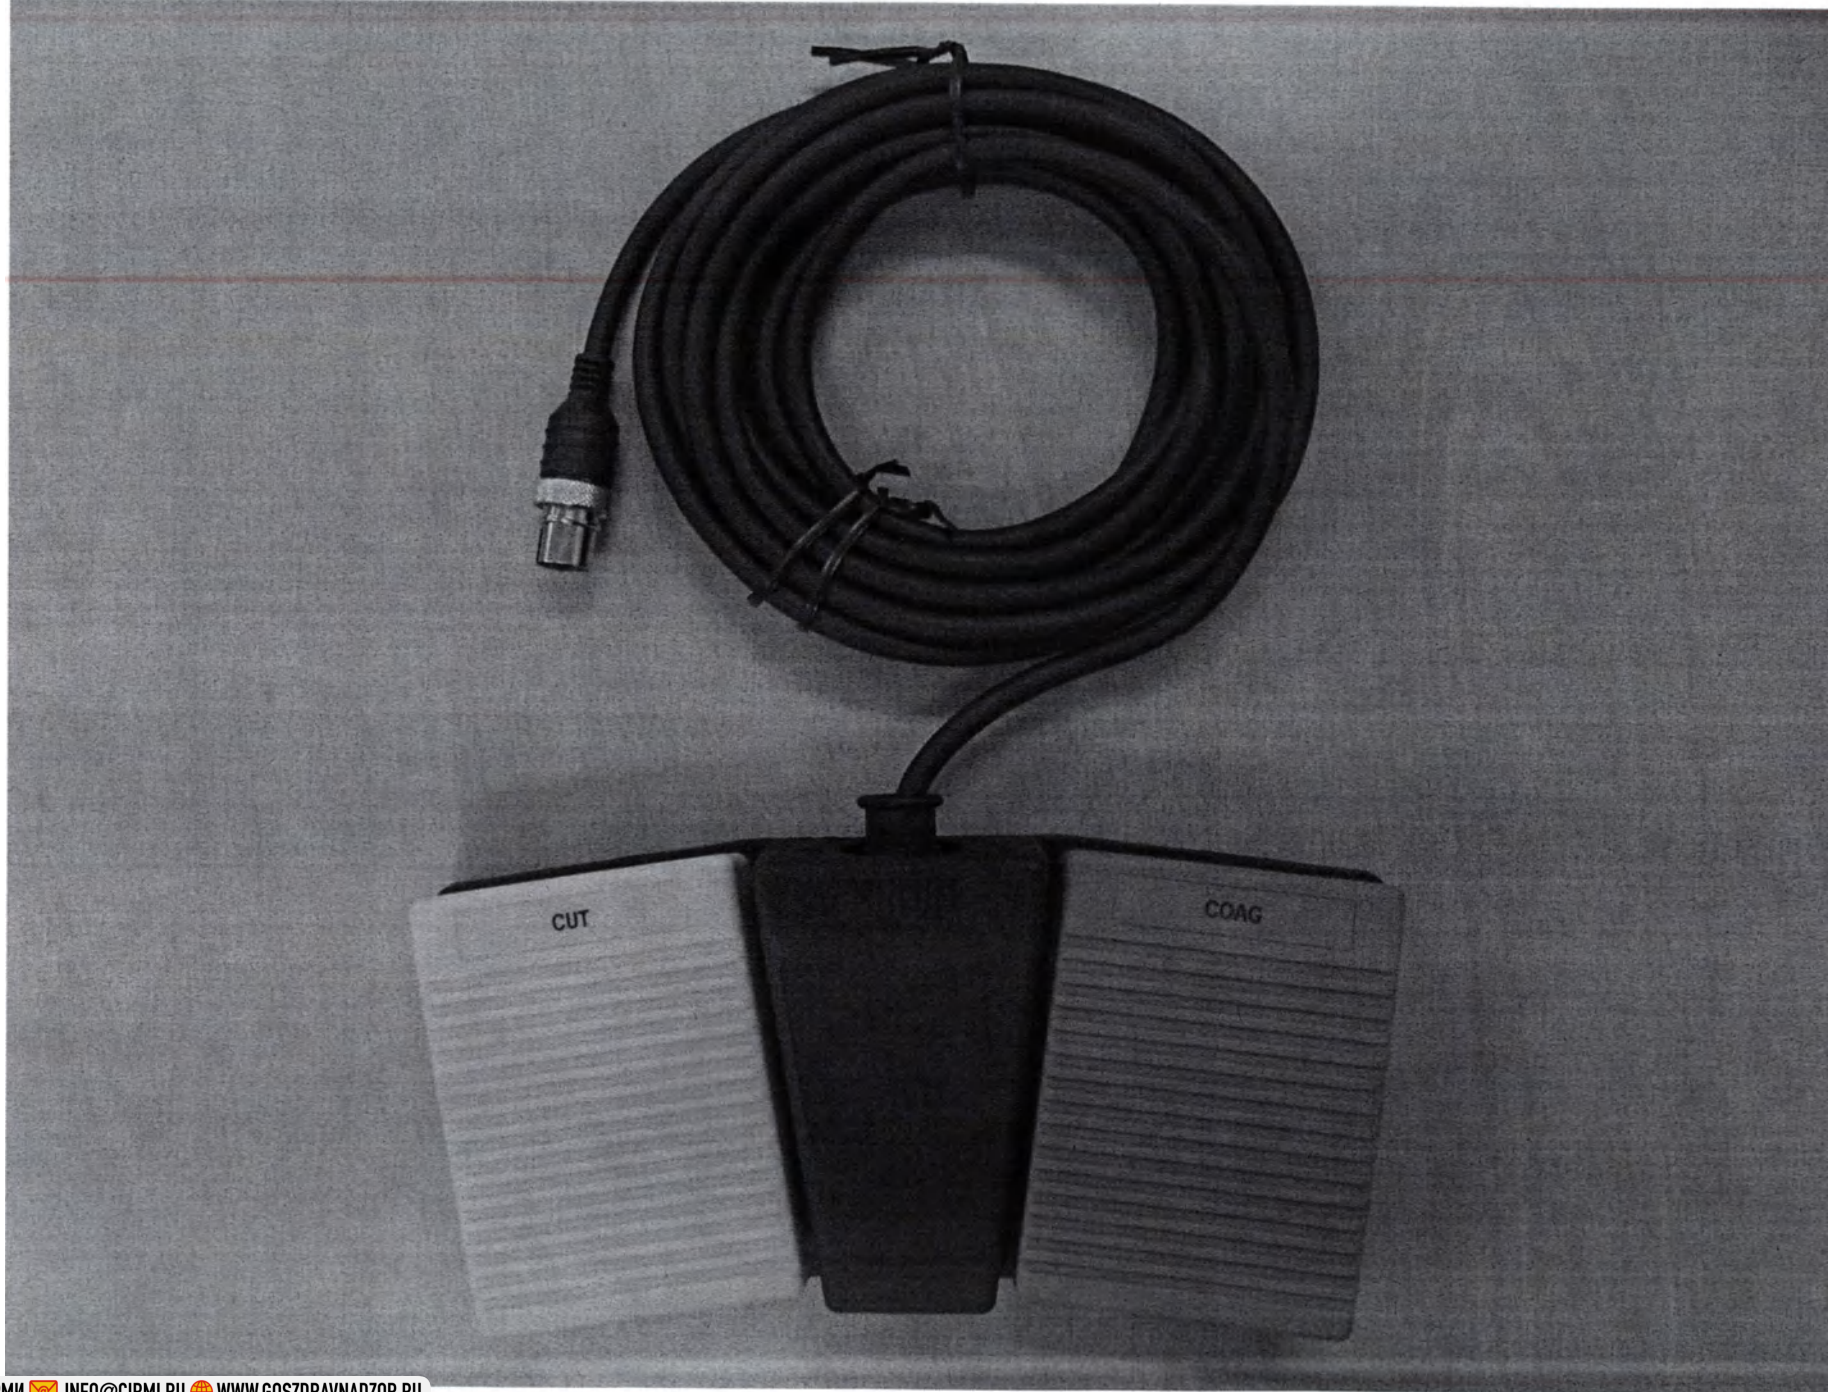

Электрод пациента силиконовый [PL02-02R]




Зонд Sens прямой, одноразовый, стерильный [HD03-01D]

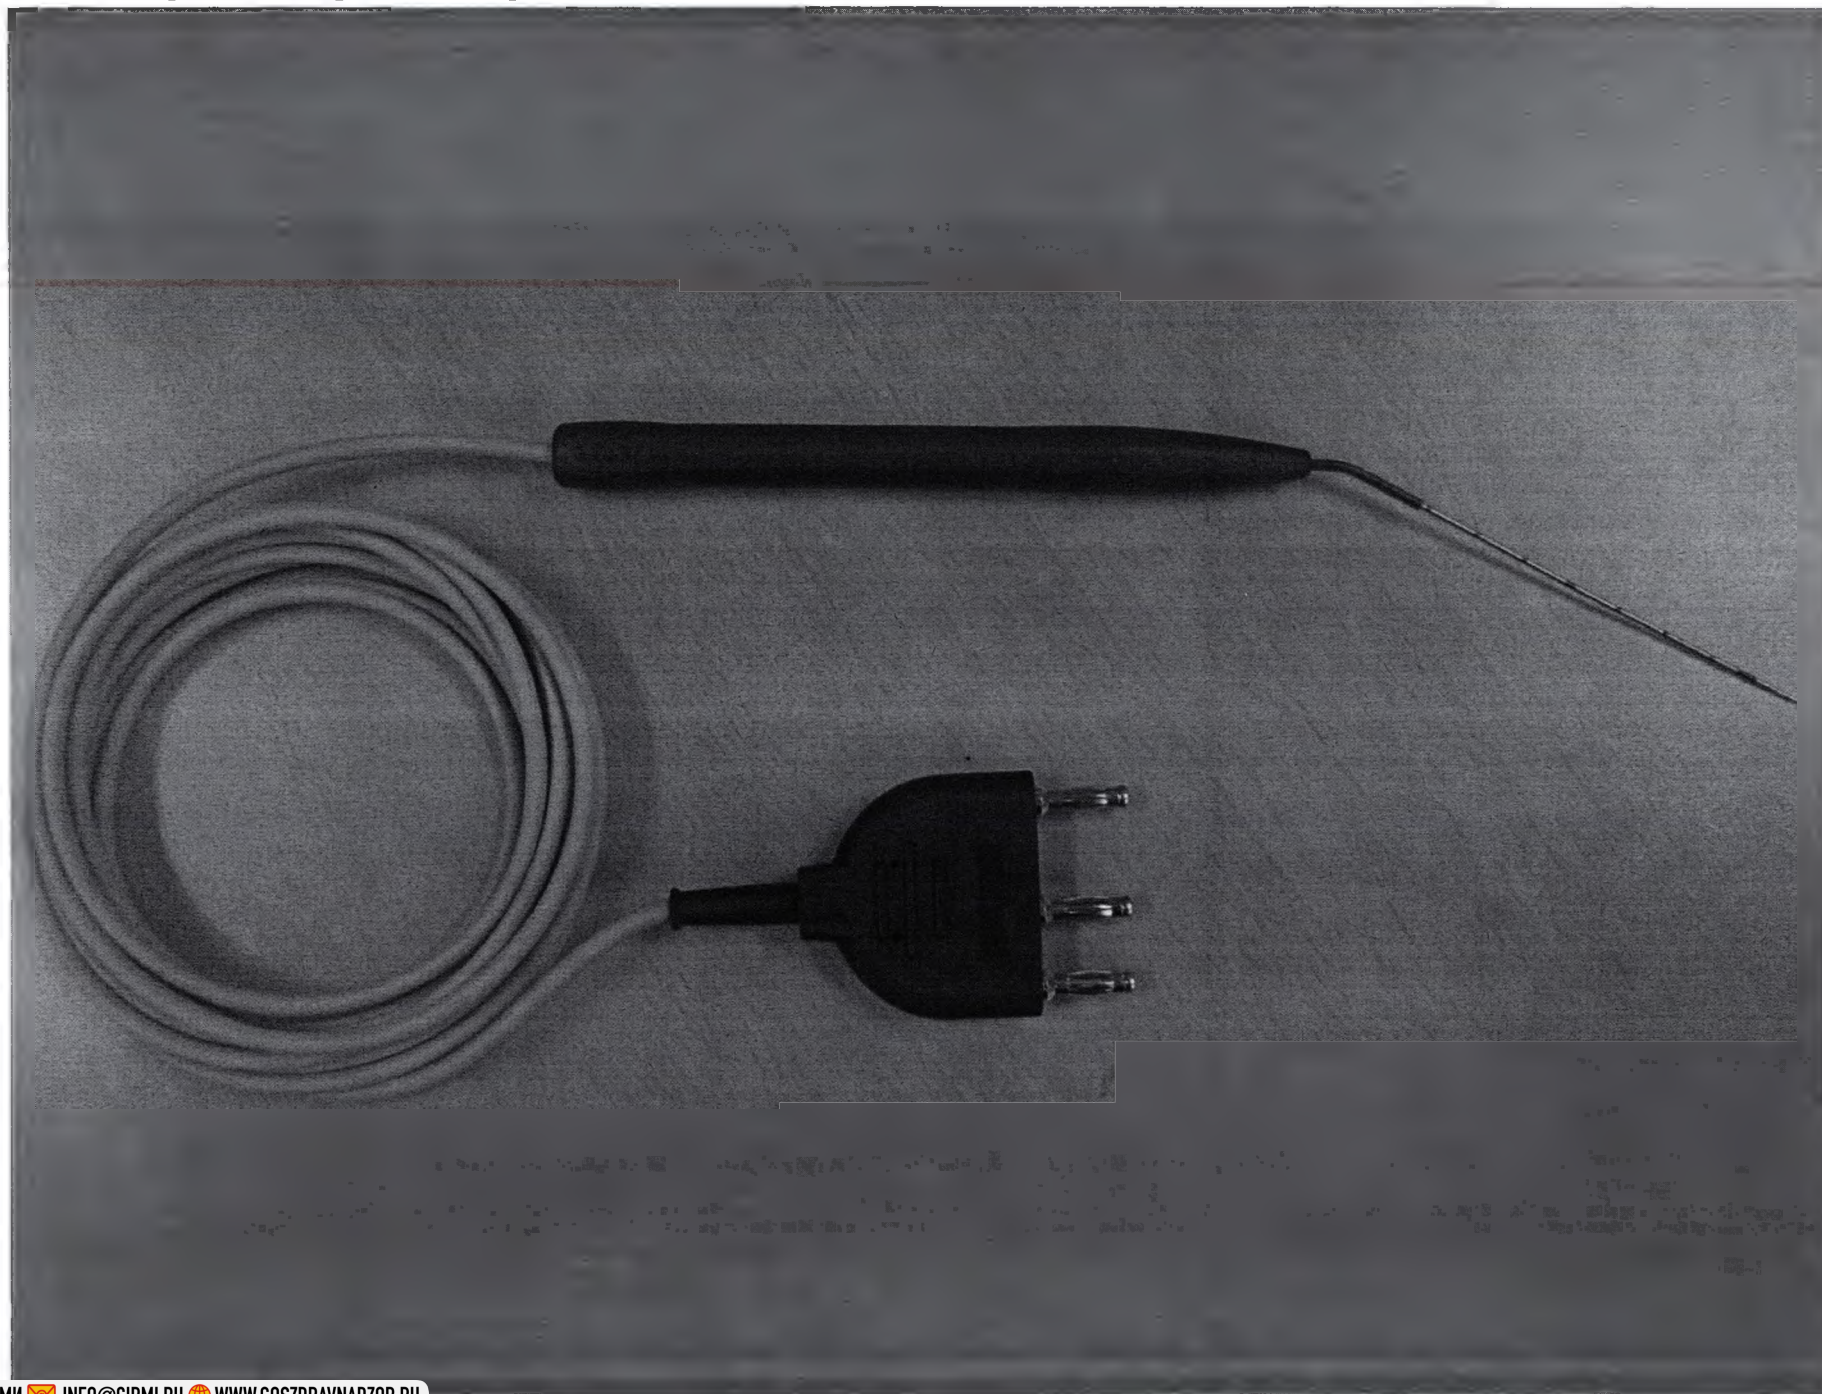

Зонд Sens изогнутый, одноразовый, стерильный [HD03-02D]



Держатель монополярный с кабелем [HD01-02R]

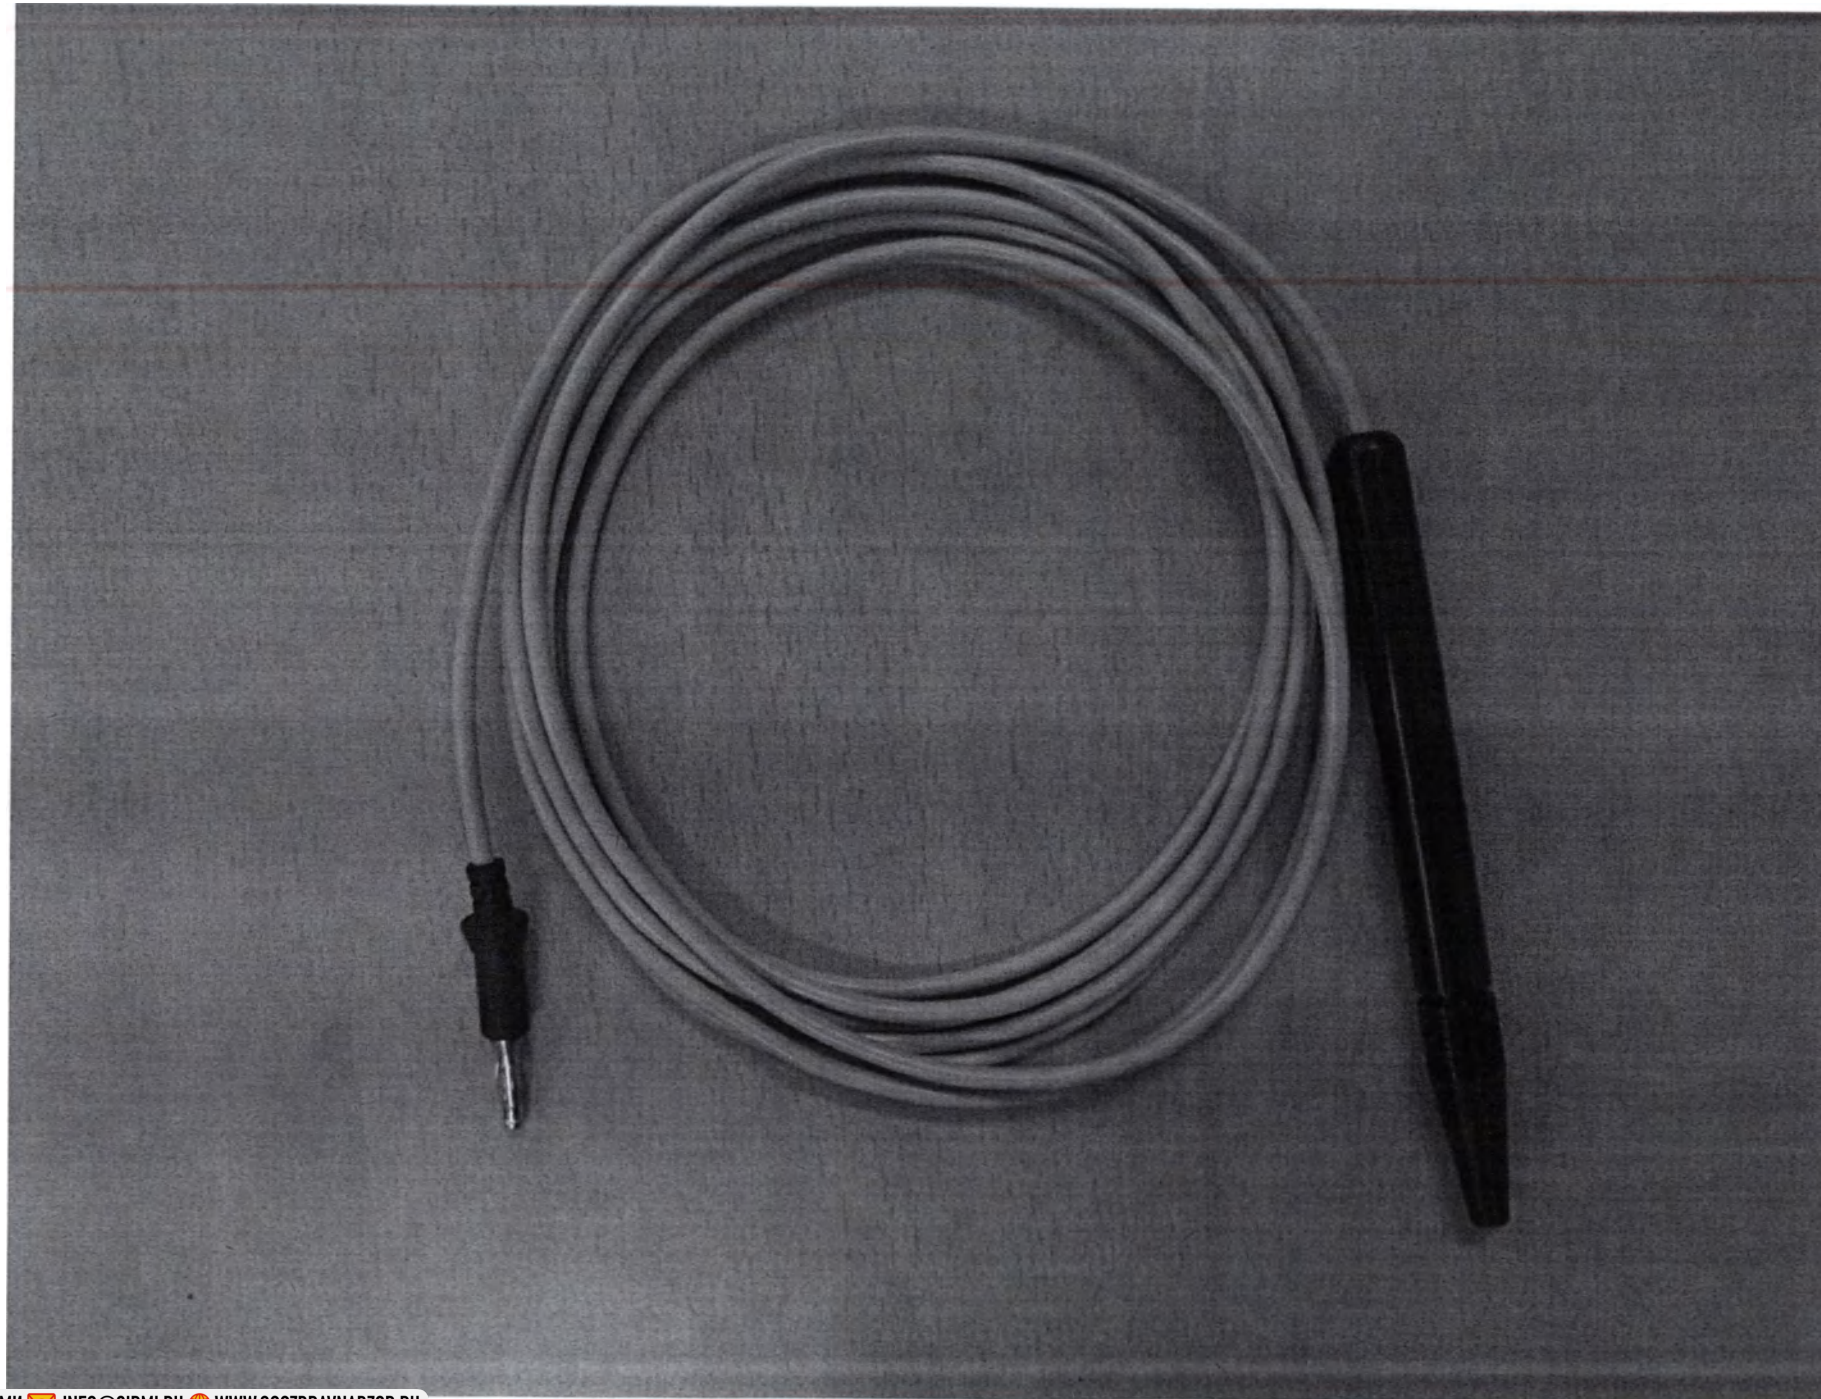



ZERONE
www.01zeus.com

(Shinil IT UTO, Dangjeong-dong)#810,
LS-Ro 13, Gunpo-si, Gyeonggi-do, Korea

☐ EL01-02D (knife 2.4 * 70mm) ☒ EL03-03D (Wire Straight)

☐ EL02-02D (ball 5mm) ☐ EL06-04D (Knife small)

☐ EL03-02D (needle 2.4 * 6mm)

열균 후 녹색 (Turns Green) **경 의 STEAM**
☐ EL04-02D (needle 2.4 * 70mm)

DO NOT USE IF PACK IS DAMAGED

☐ EL04-04D (needle Angled 45° 2.4 * 70mm)

열균 후 자주색 (Turns Purple)




031-476-6163

KYUNG IECT GAS


IND. CO.

E/O GAS & STEAM after 5cm
sterilizing them use.

Кабель электропитания [CA04-01R]

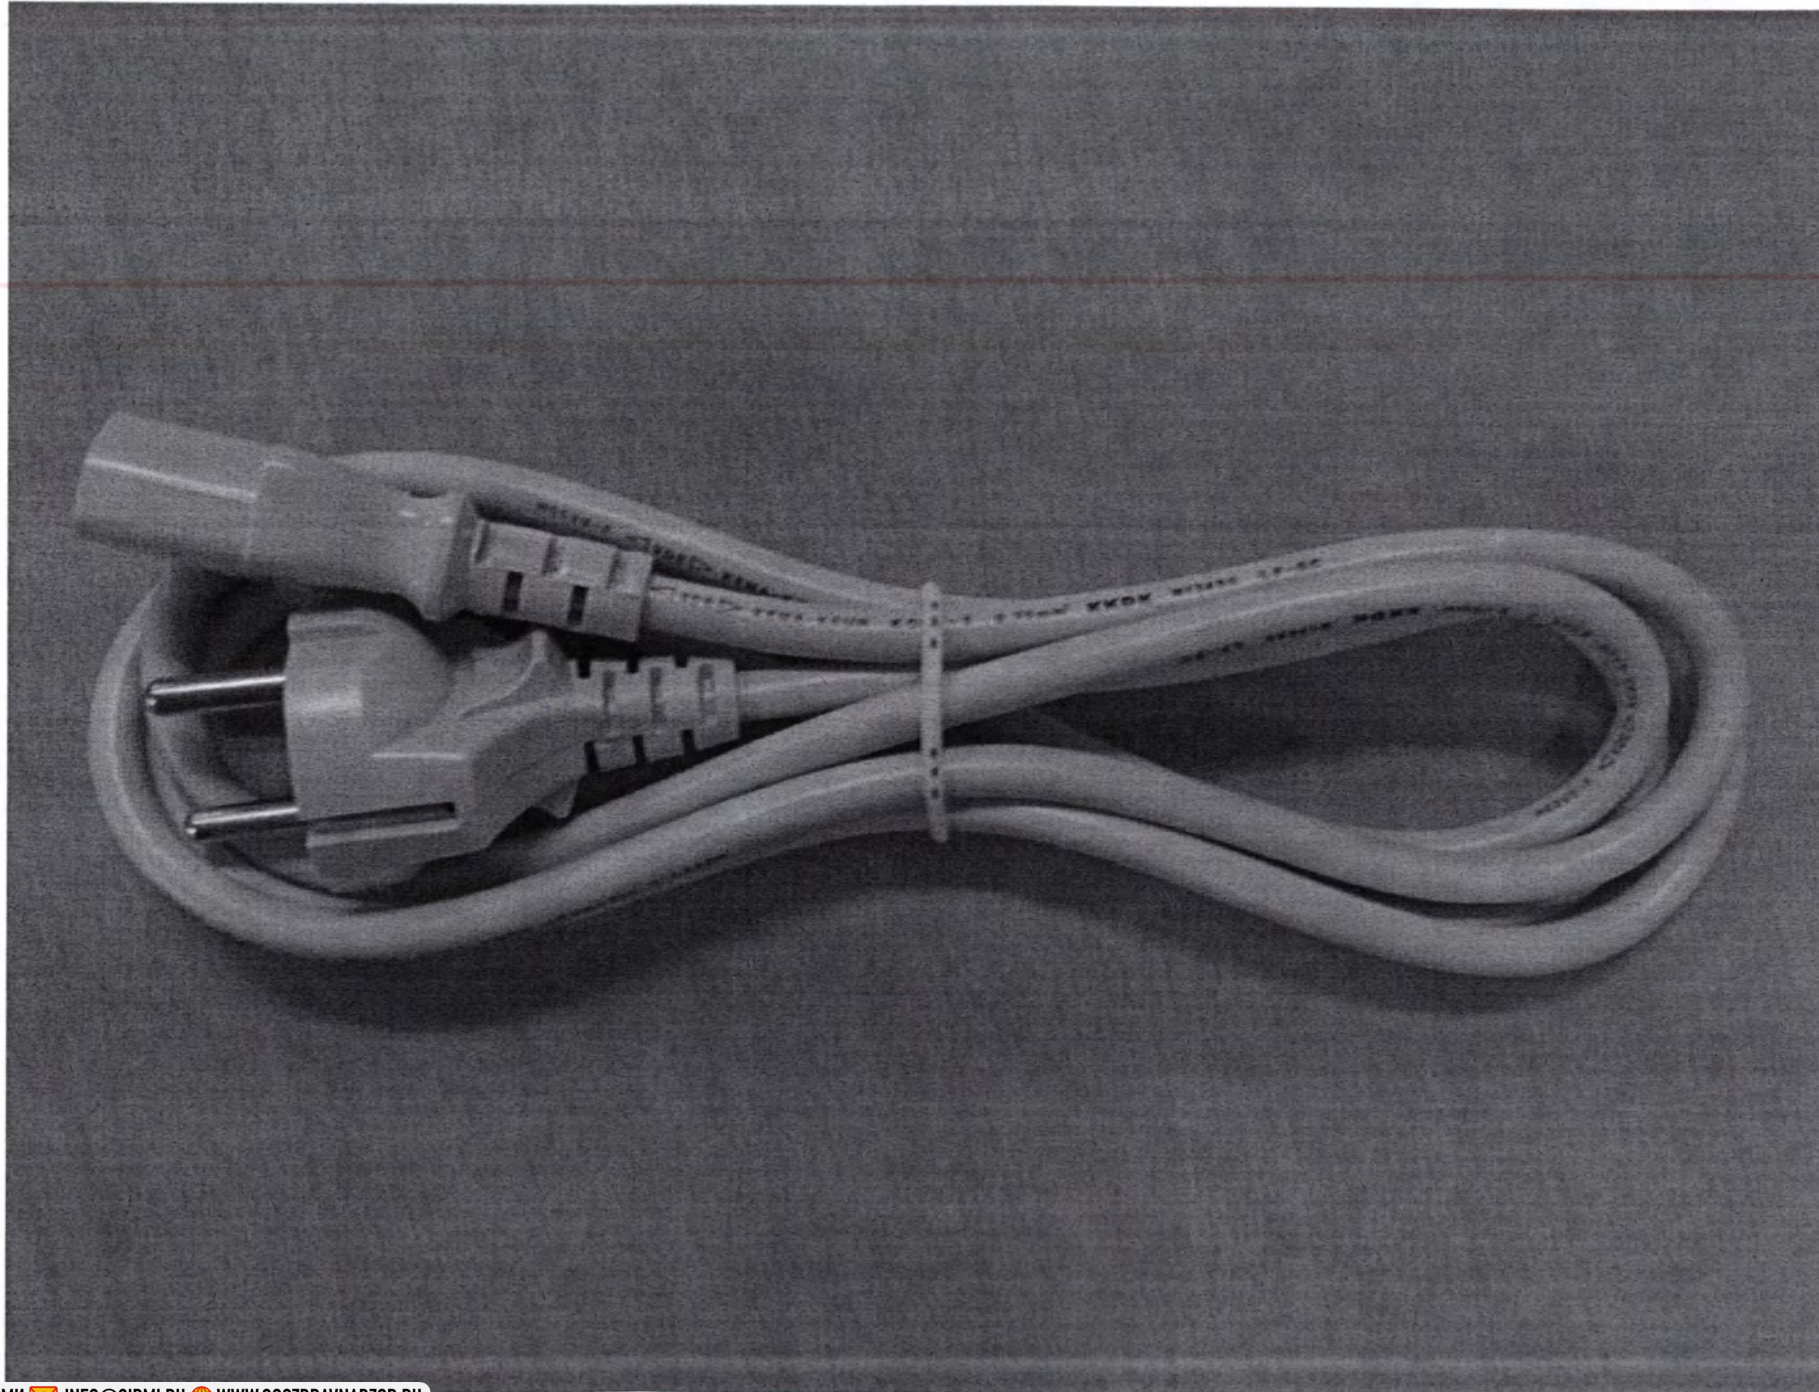

Кабель биполярный [CA01-02R]

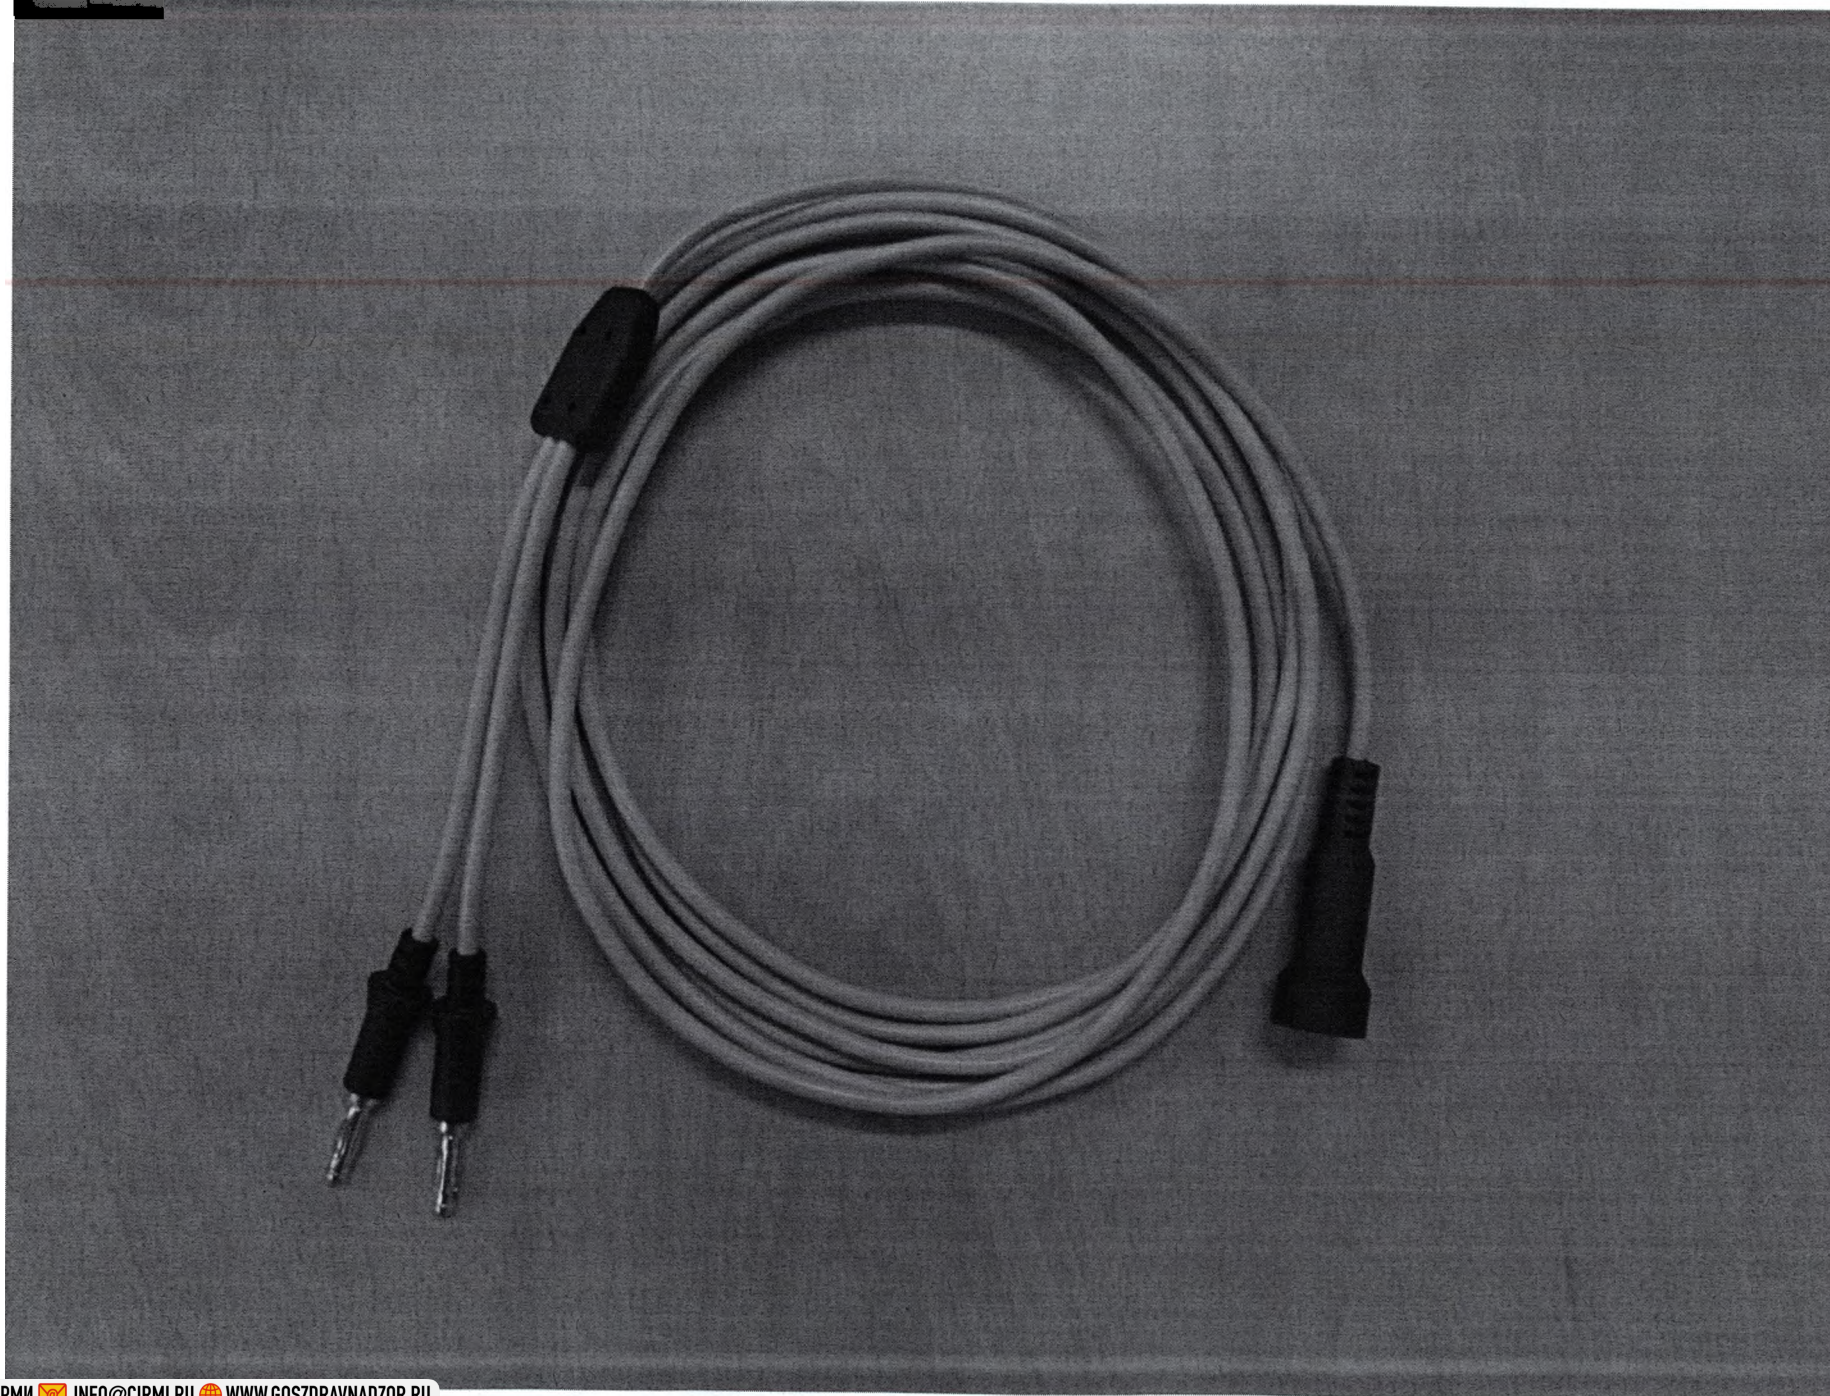

Всего прошито, проклеено и скреплено печатью
и подписью 12 листов.


Генеральный директор ООО «БОЗОН»
Беляков А.В

