


Директор зонального бизнес-подразделения
«Системы диагностической визуализации»
ООО «Сименс Здравоохранение»



Аспидов А.В.
«27» июля 2017 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

«Система синхронизации с дыханием AZ-733VI с принадлежностями»

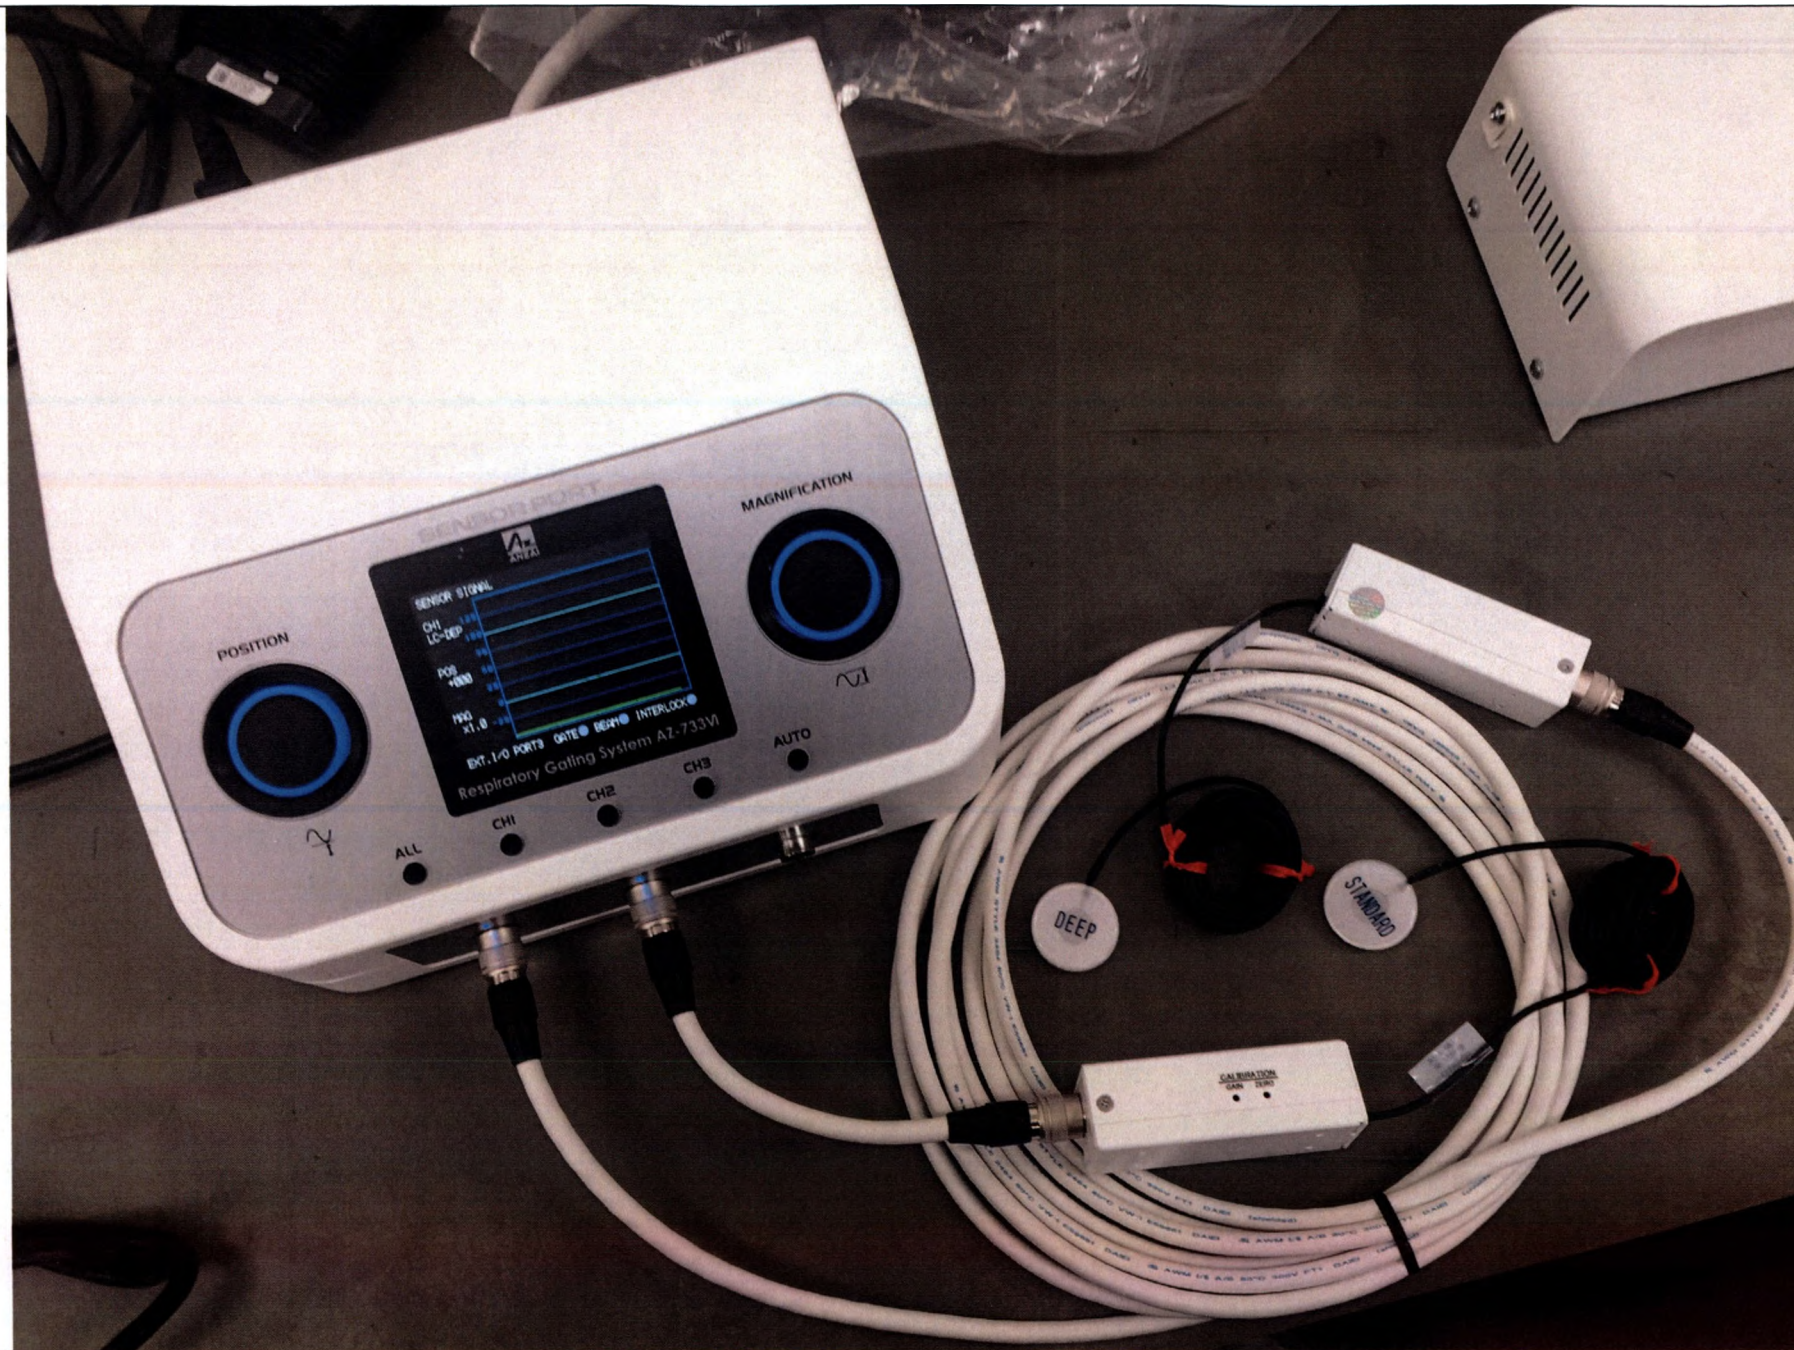



1. Порт датчика.










5. Датчик нагрузки стандартного типа.



6. Датчик нагрузки углубленного типа.

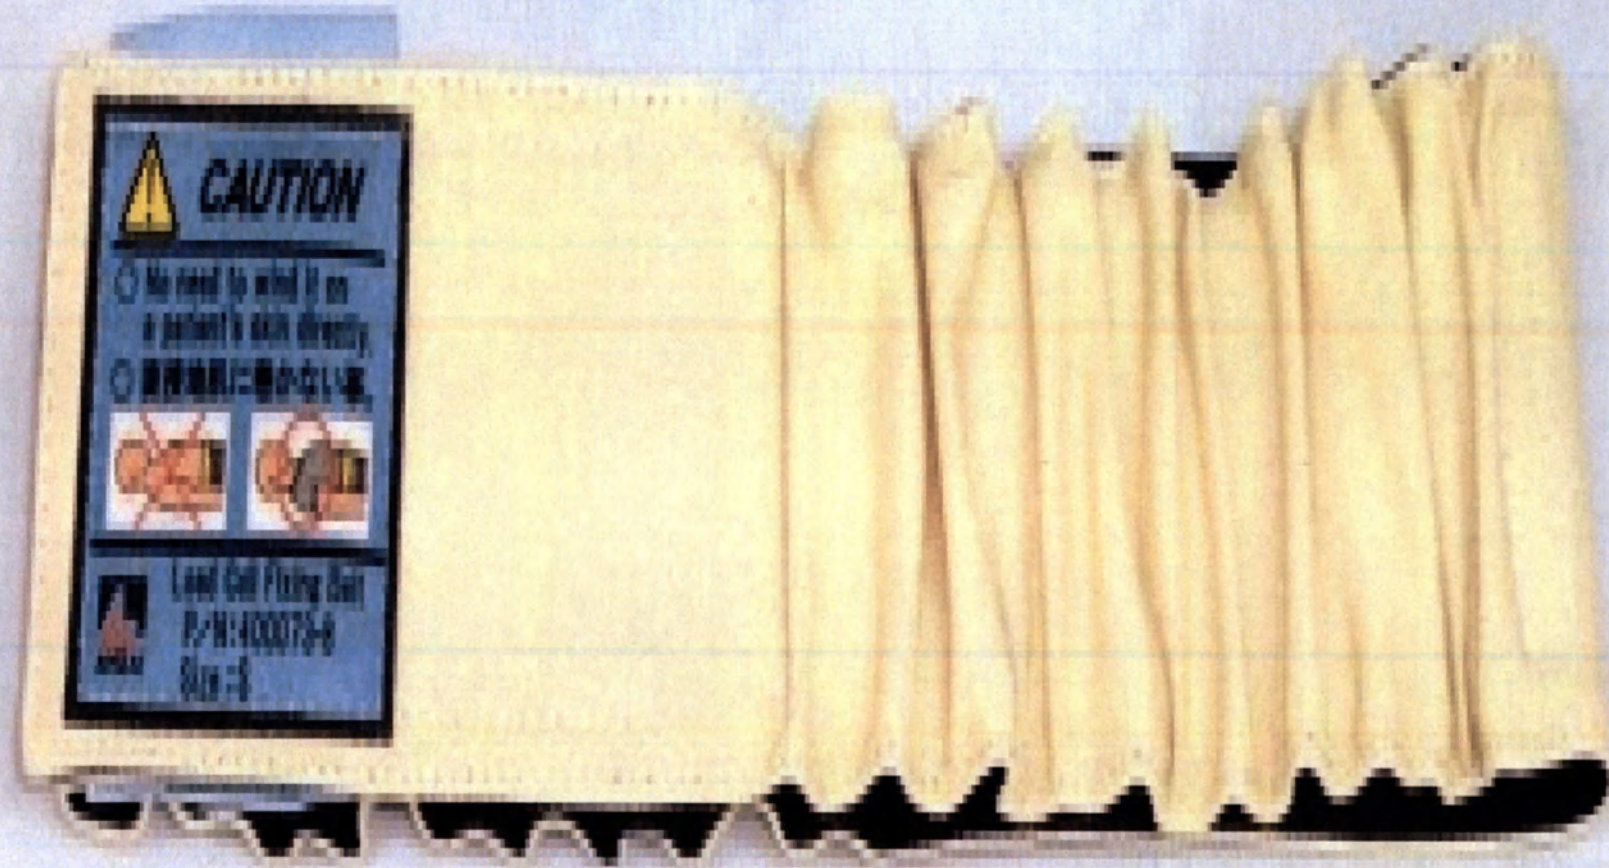













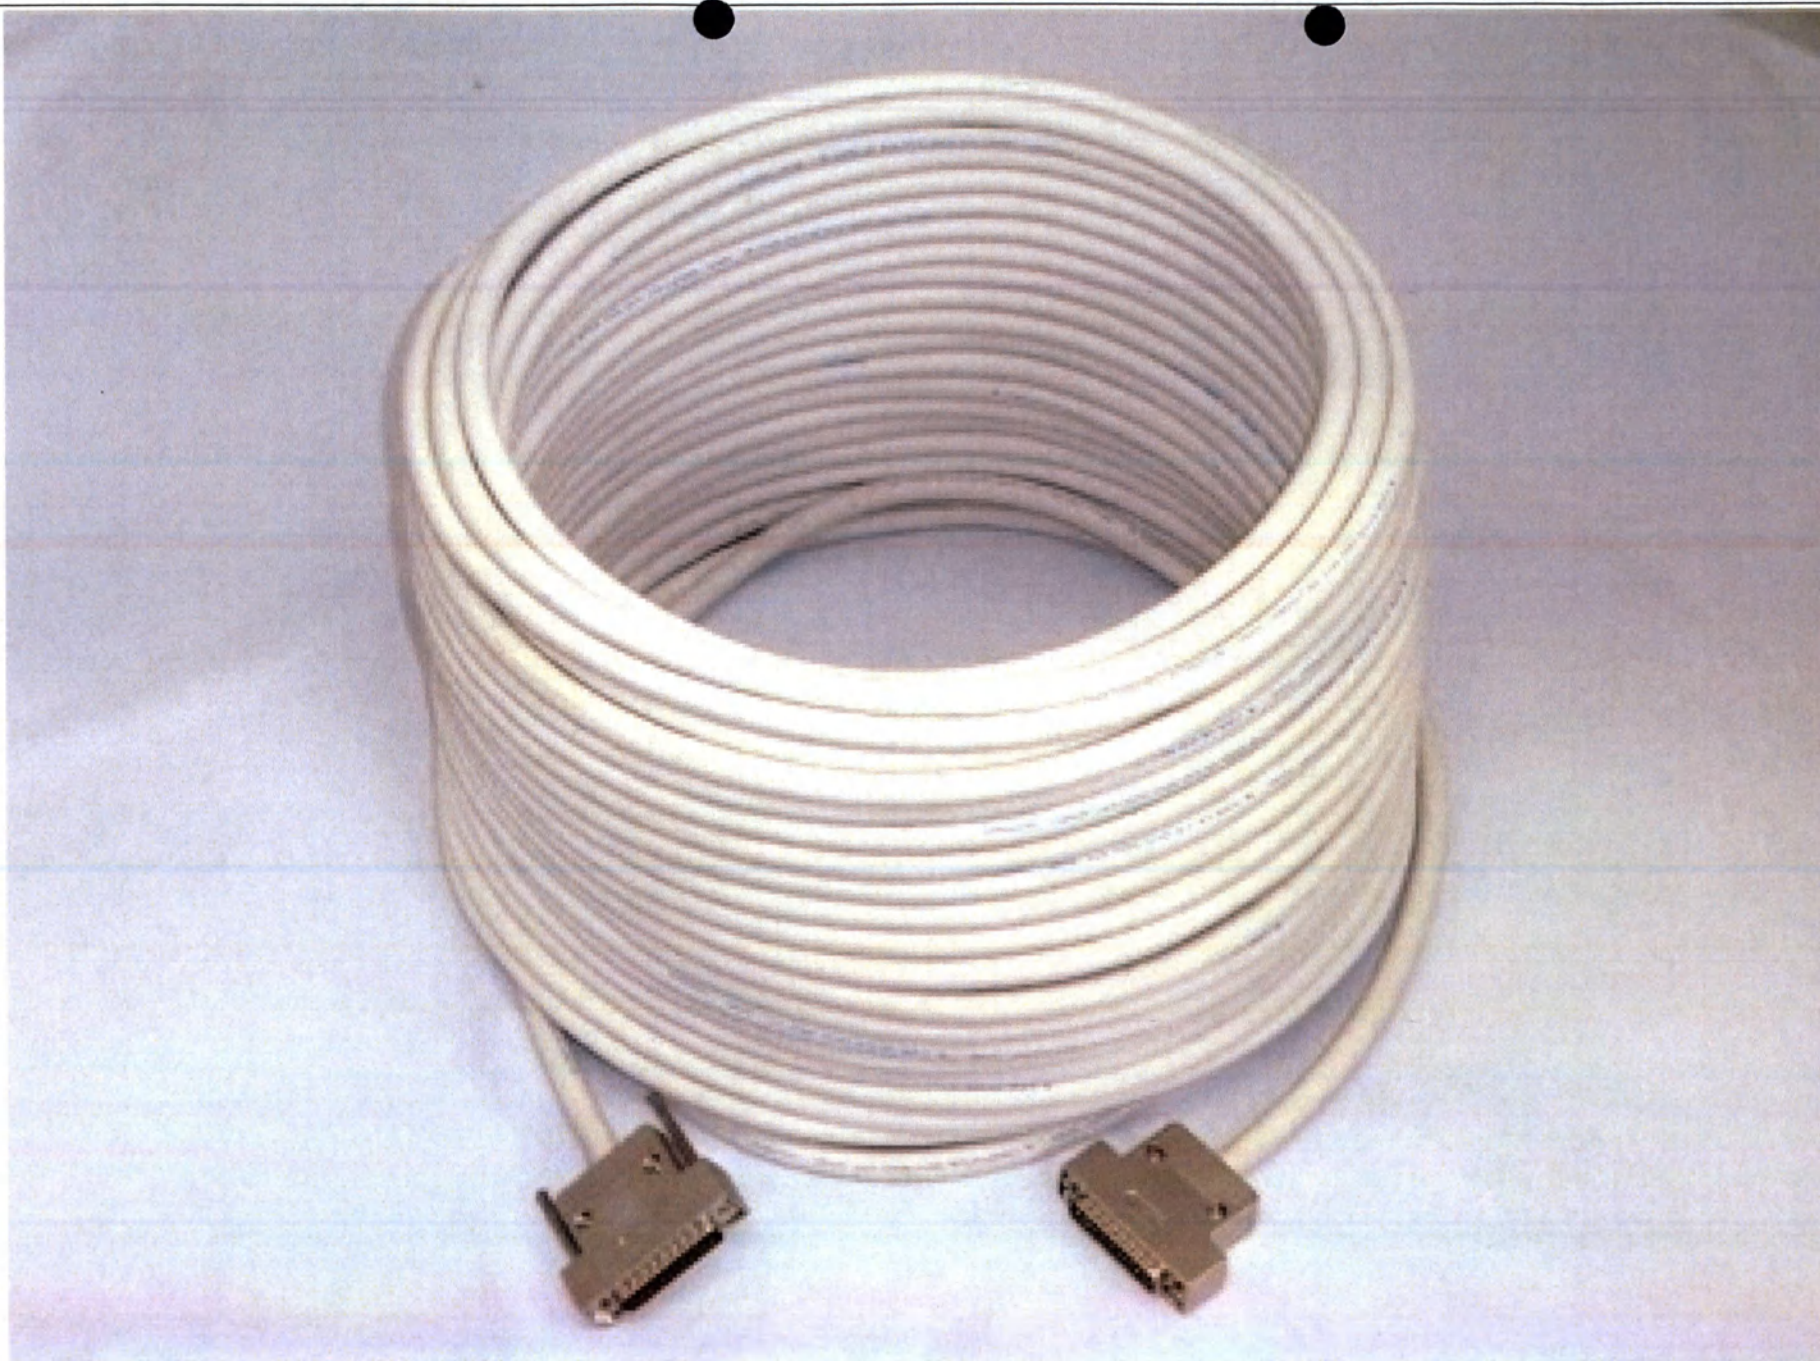

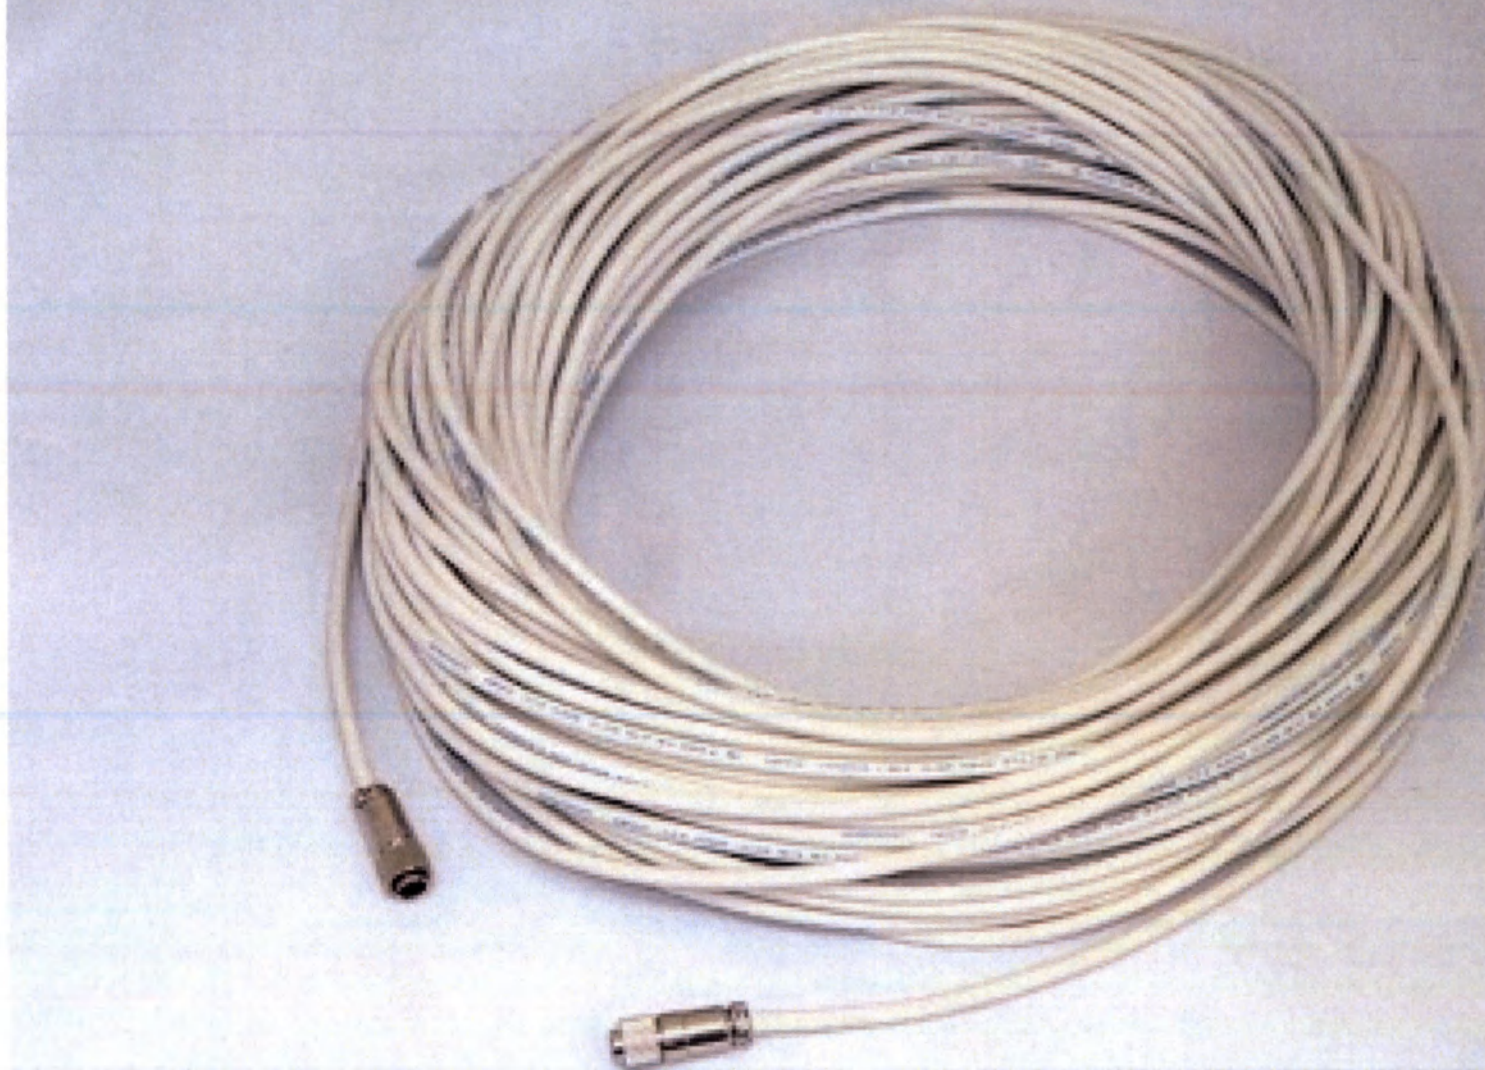


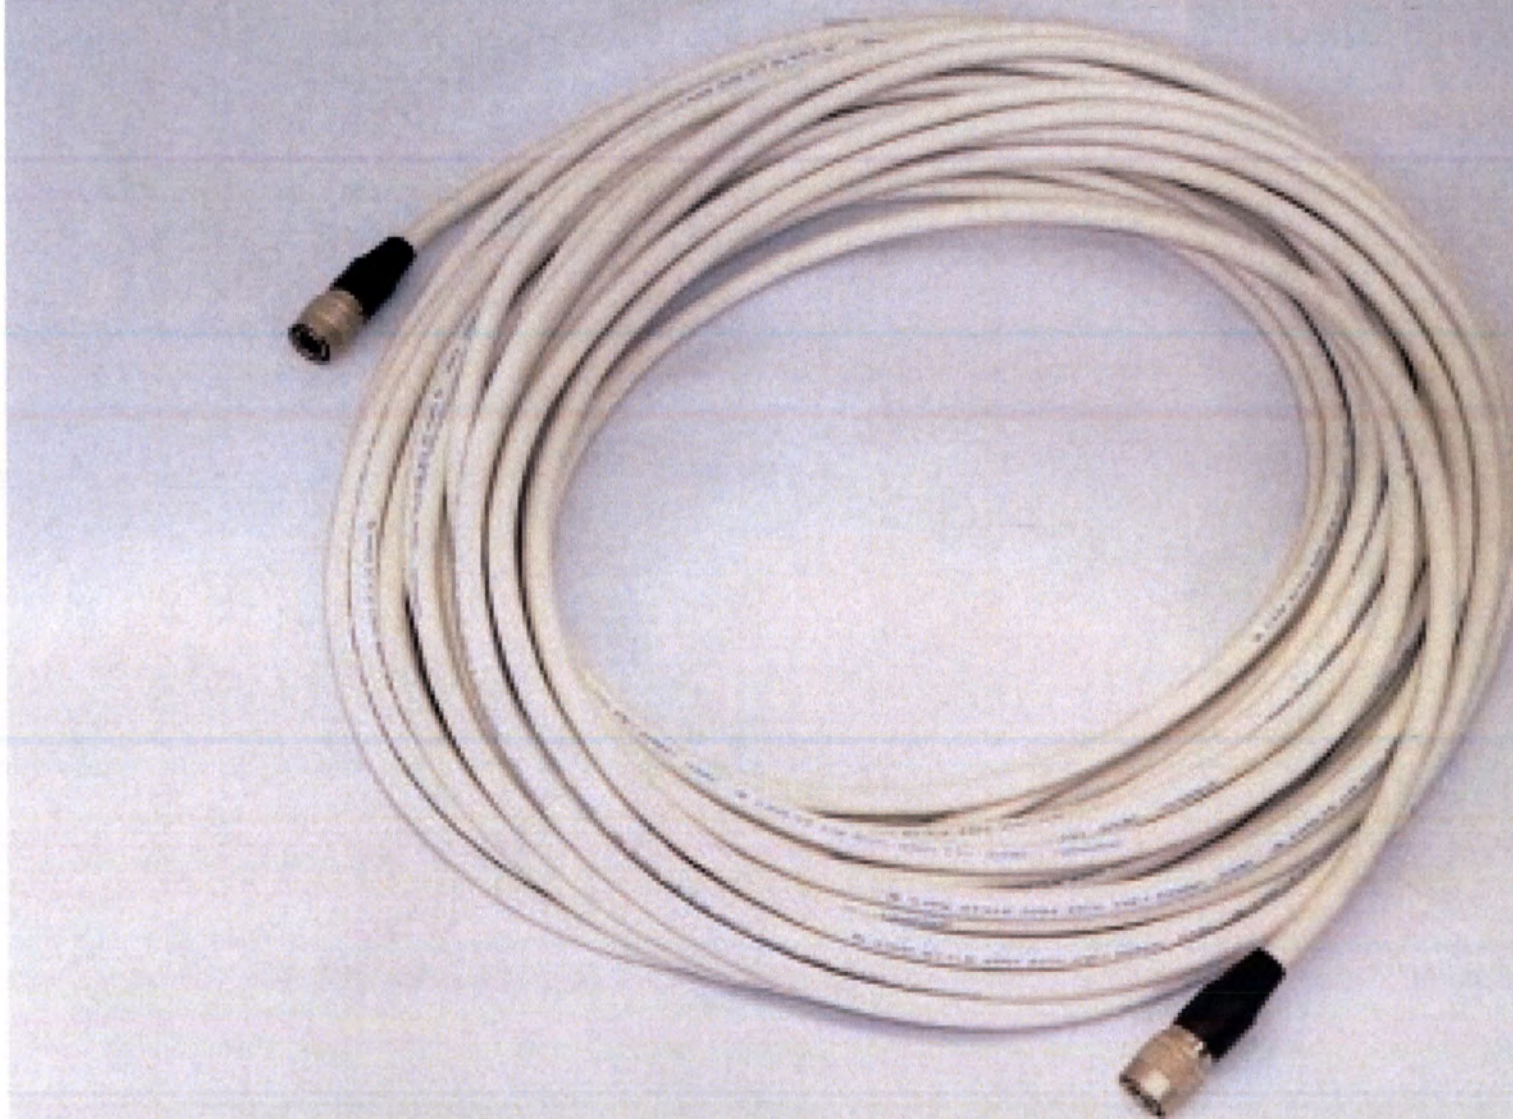


14 Кабель латчика (от порта латчика до датчика нагрузки или лазерного датчика).

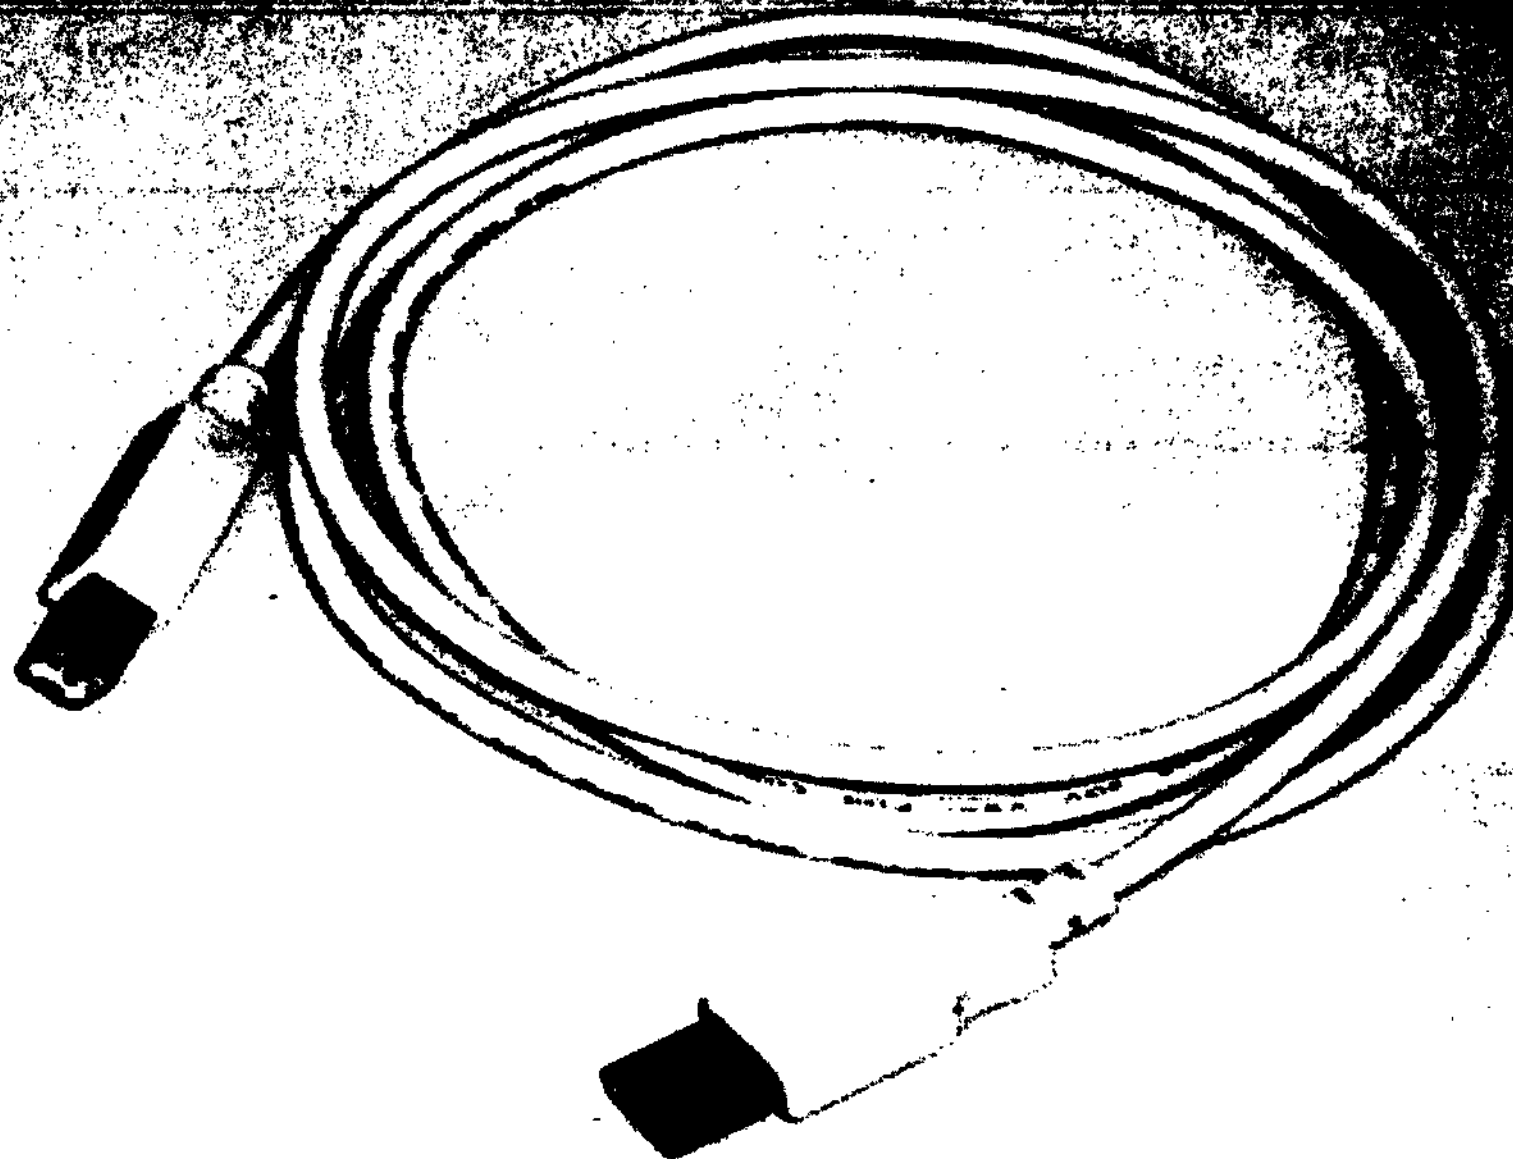

15. Кабель USB (от периферийной клавиатуры до персонального компьютера).

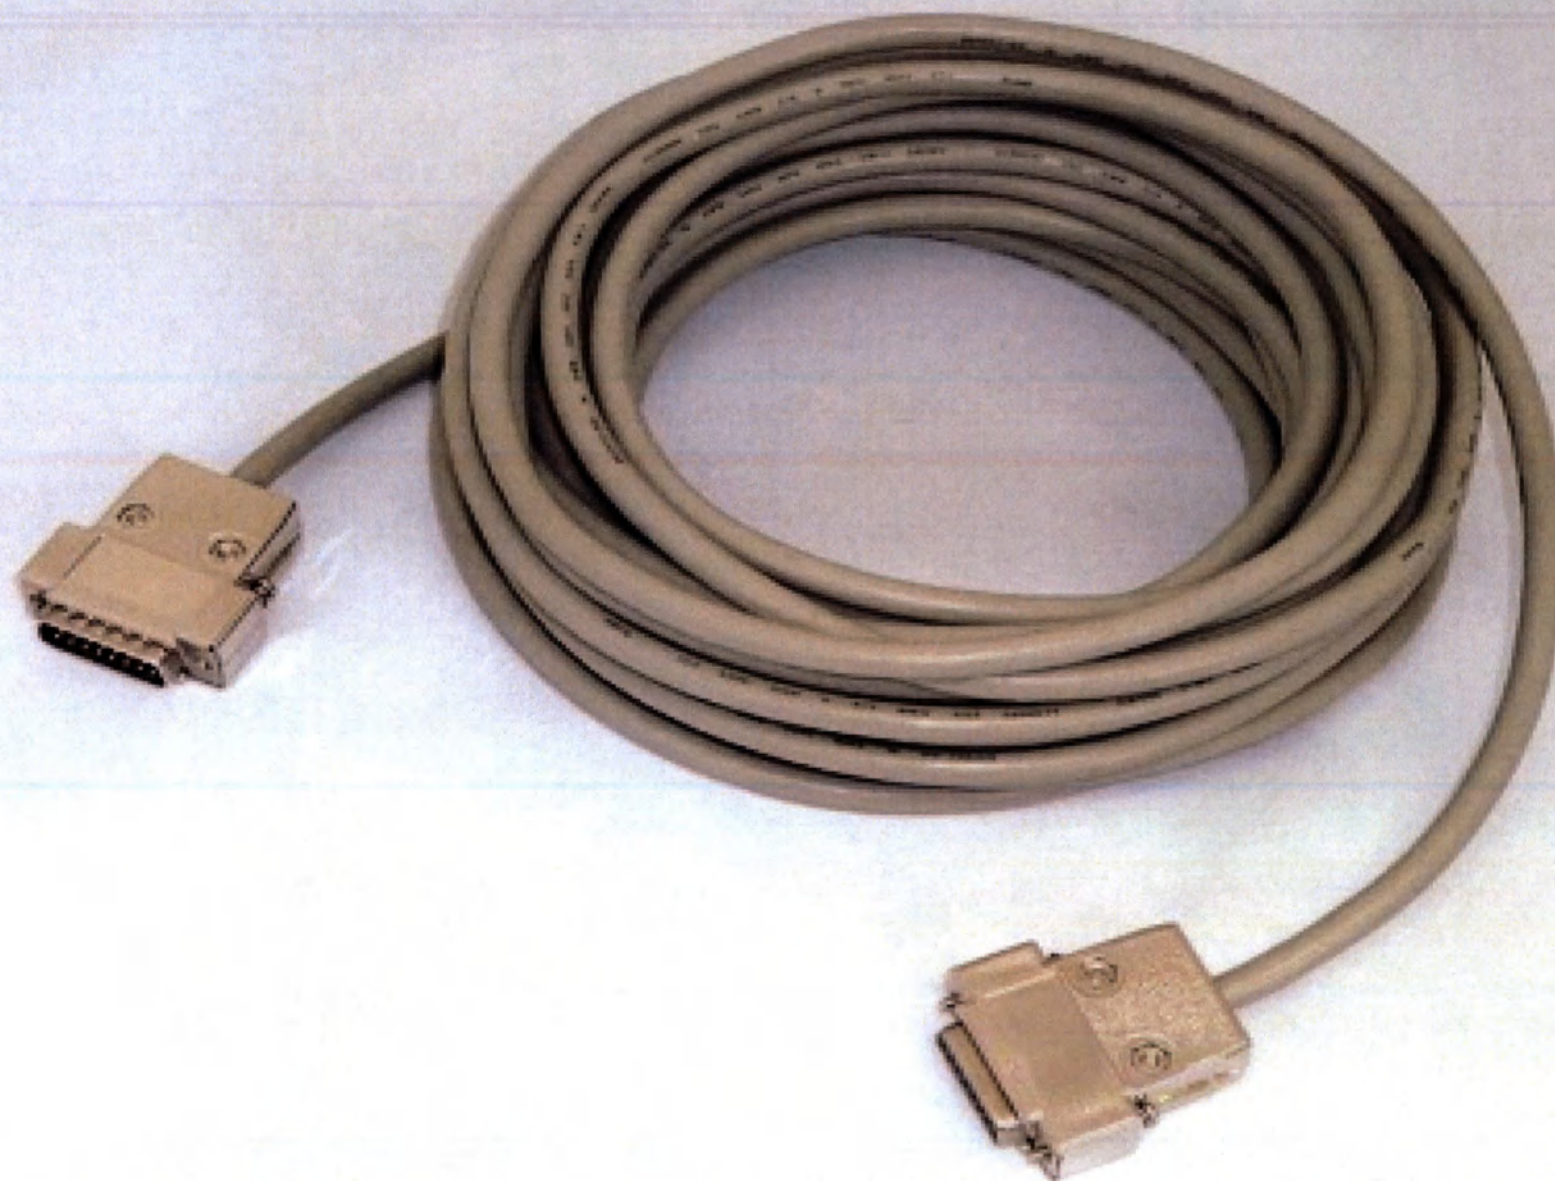

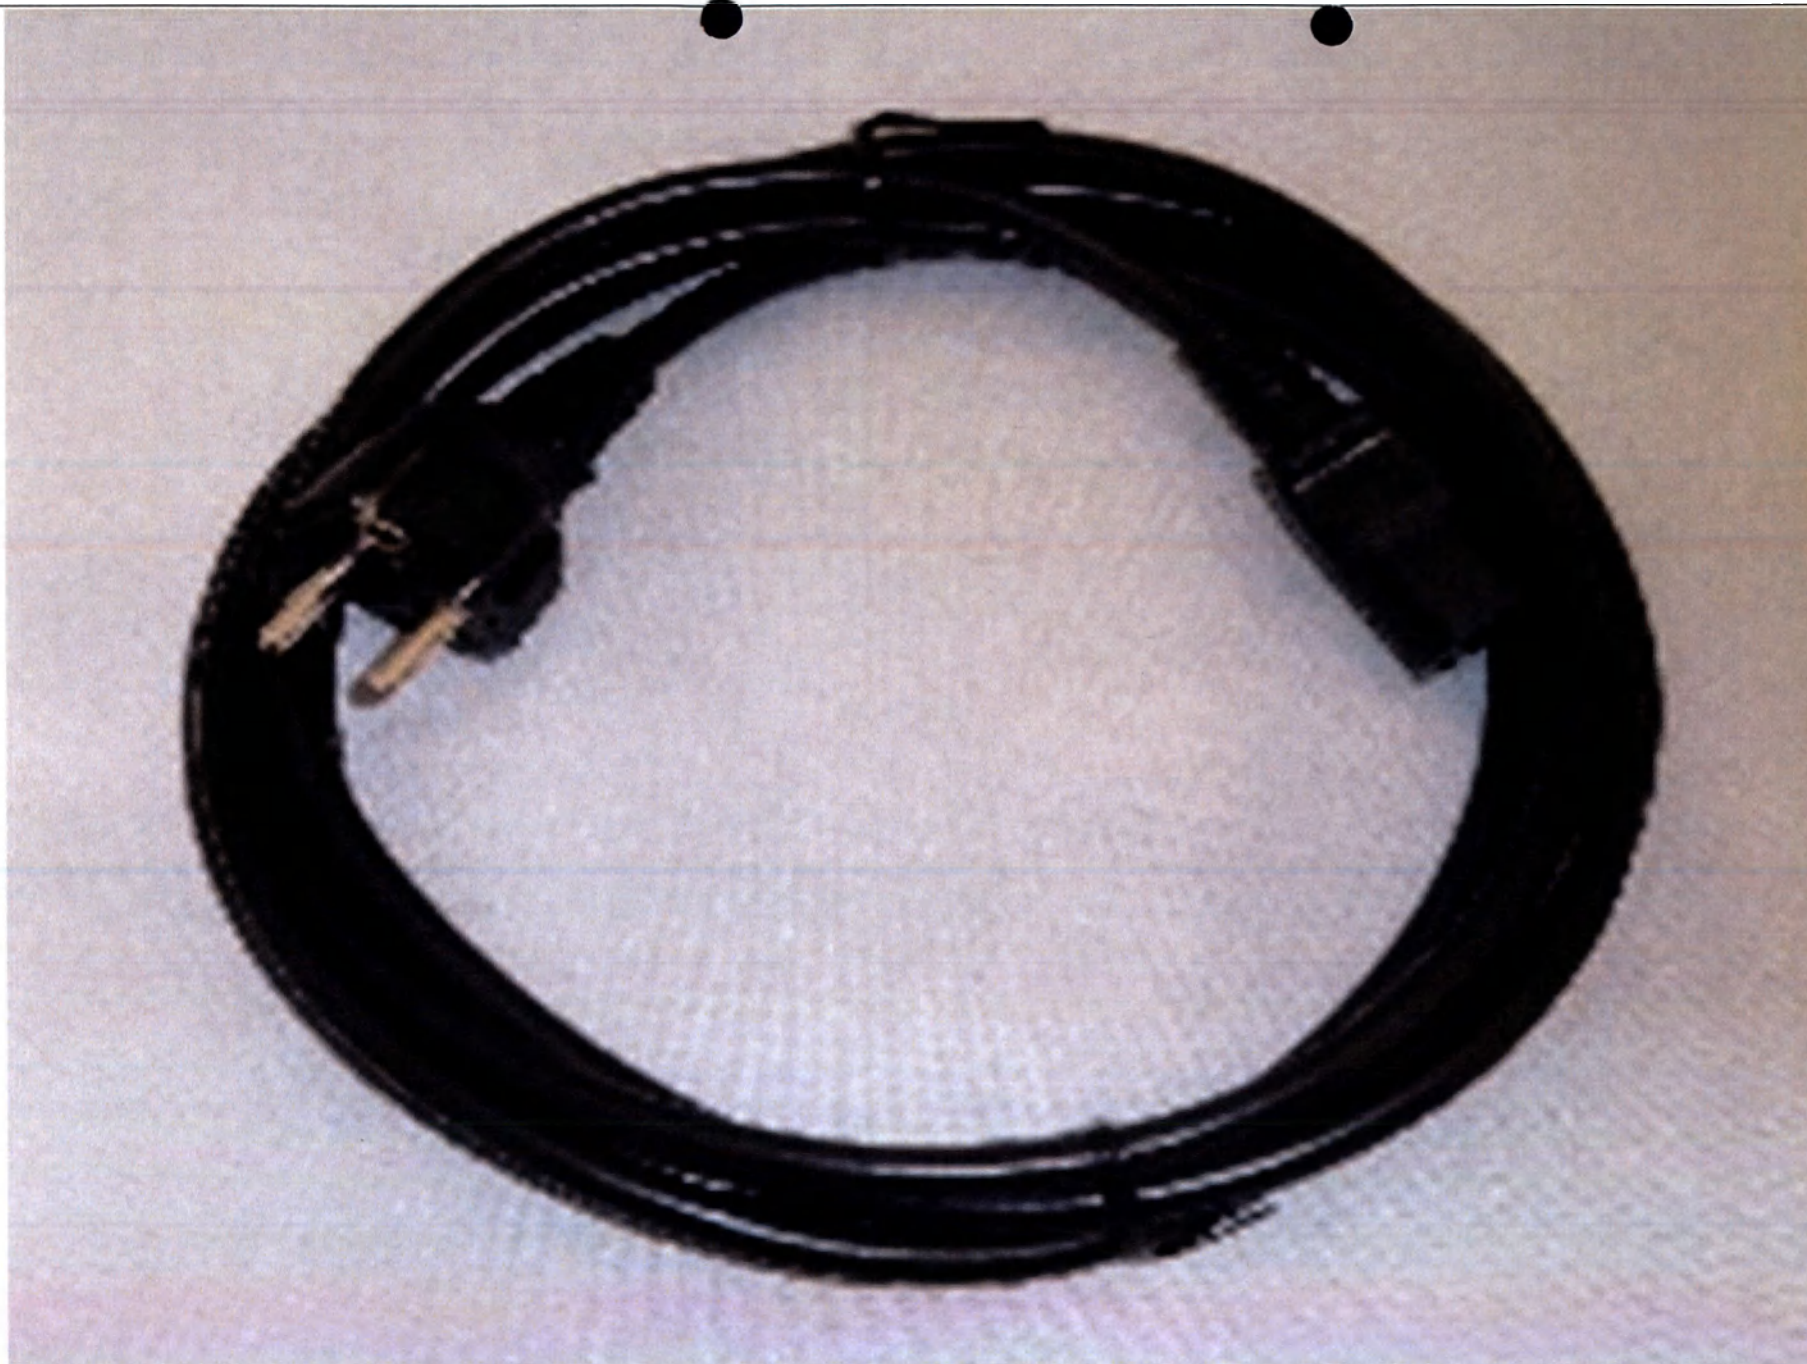

Система синхронизации с дыханием AZ-733VI

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД: 400322-30-13 Версия 1.0 2016-05-19



ANZAI MEDICAL CO., LTD.

02/788










3. Лазерный датчик (250 мм).

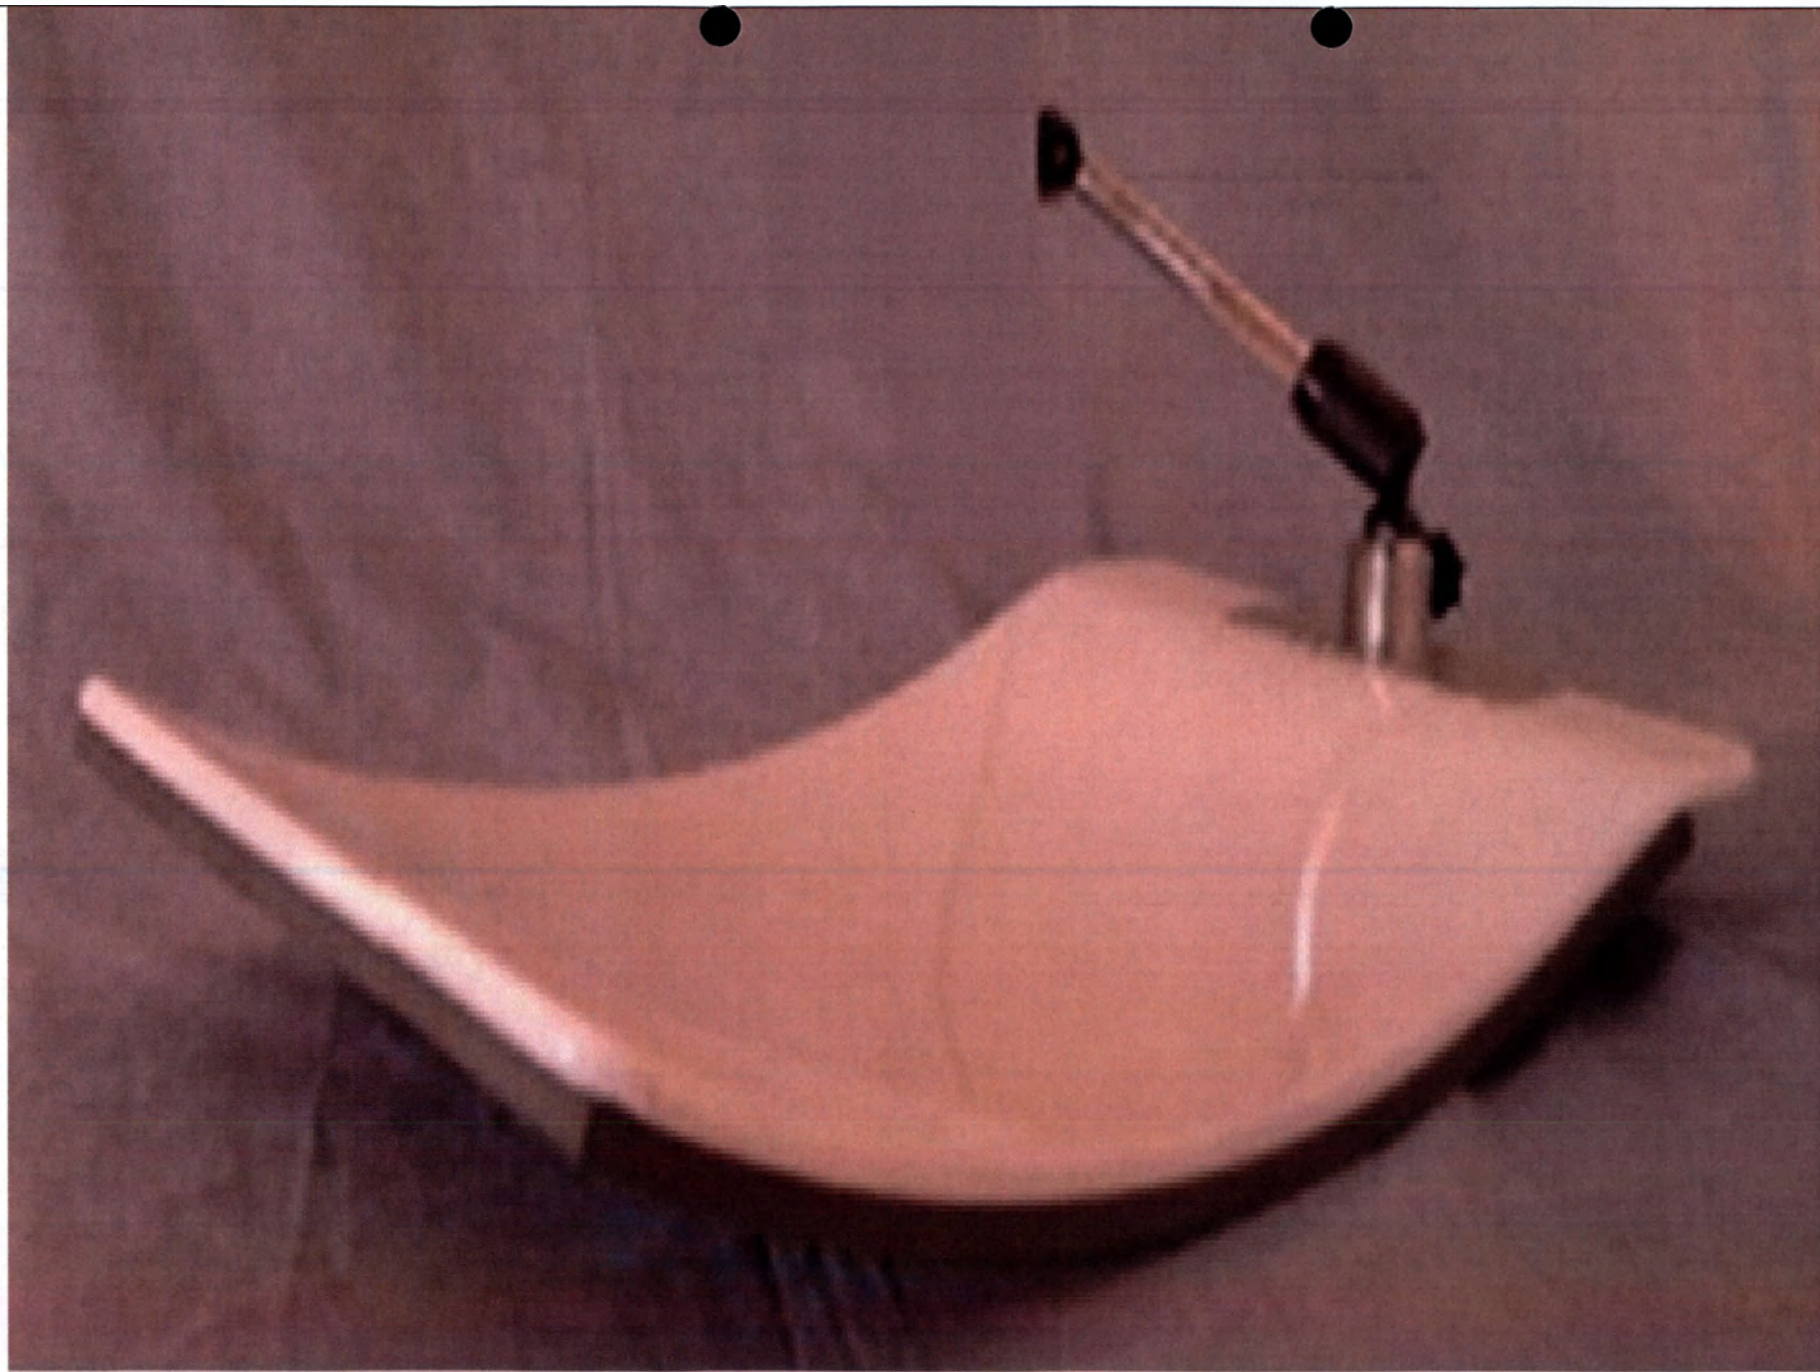





5. Крепление лазерного датчика (тип М).





6. Крепление лазерного датчика (тип Т).



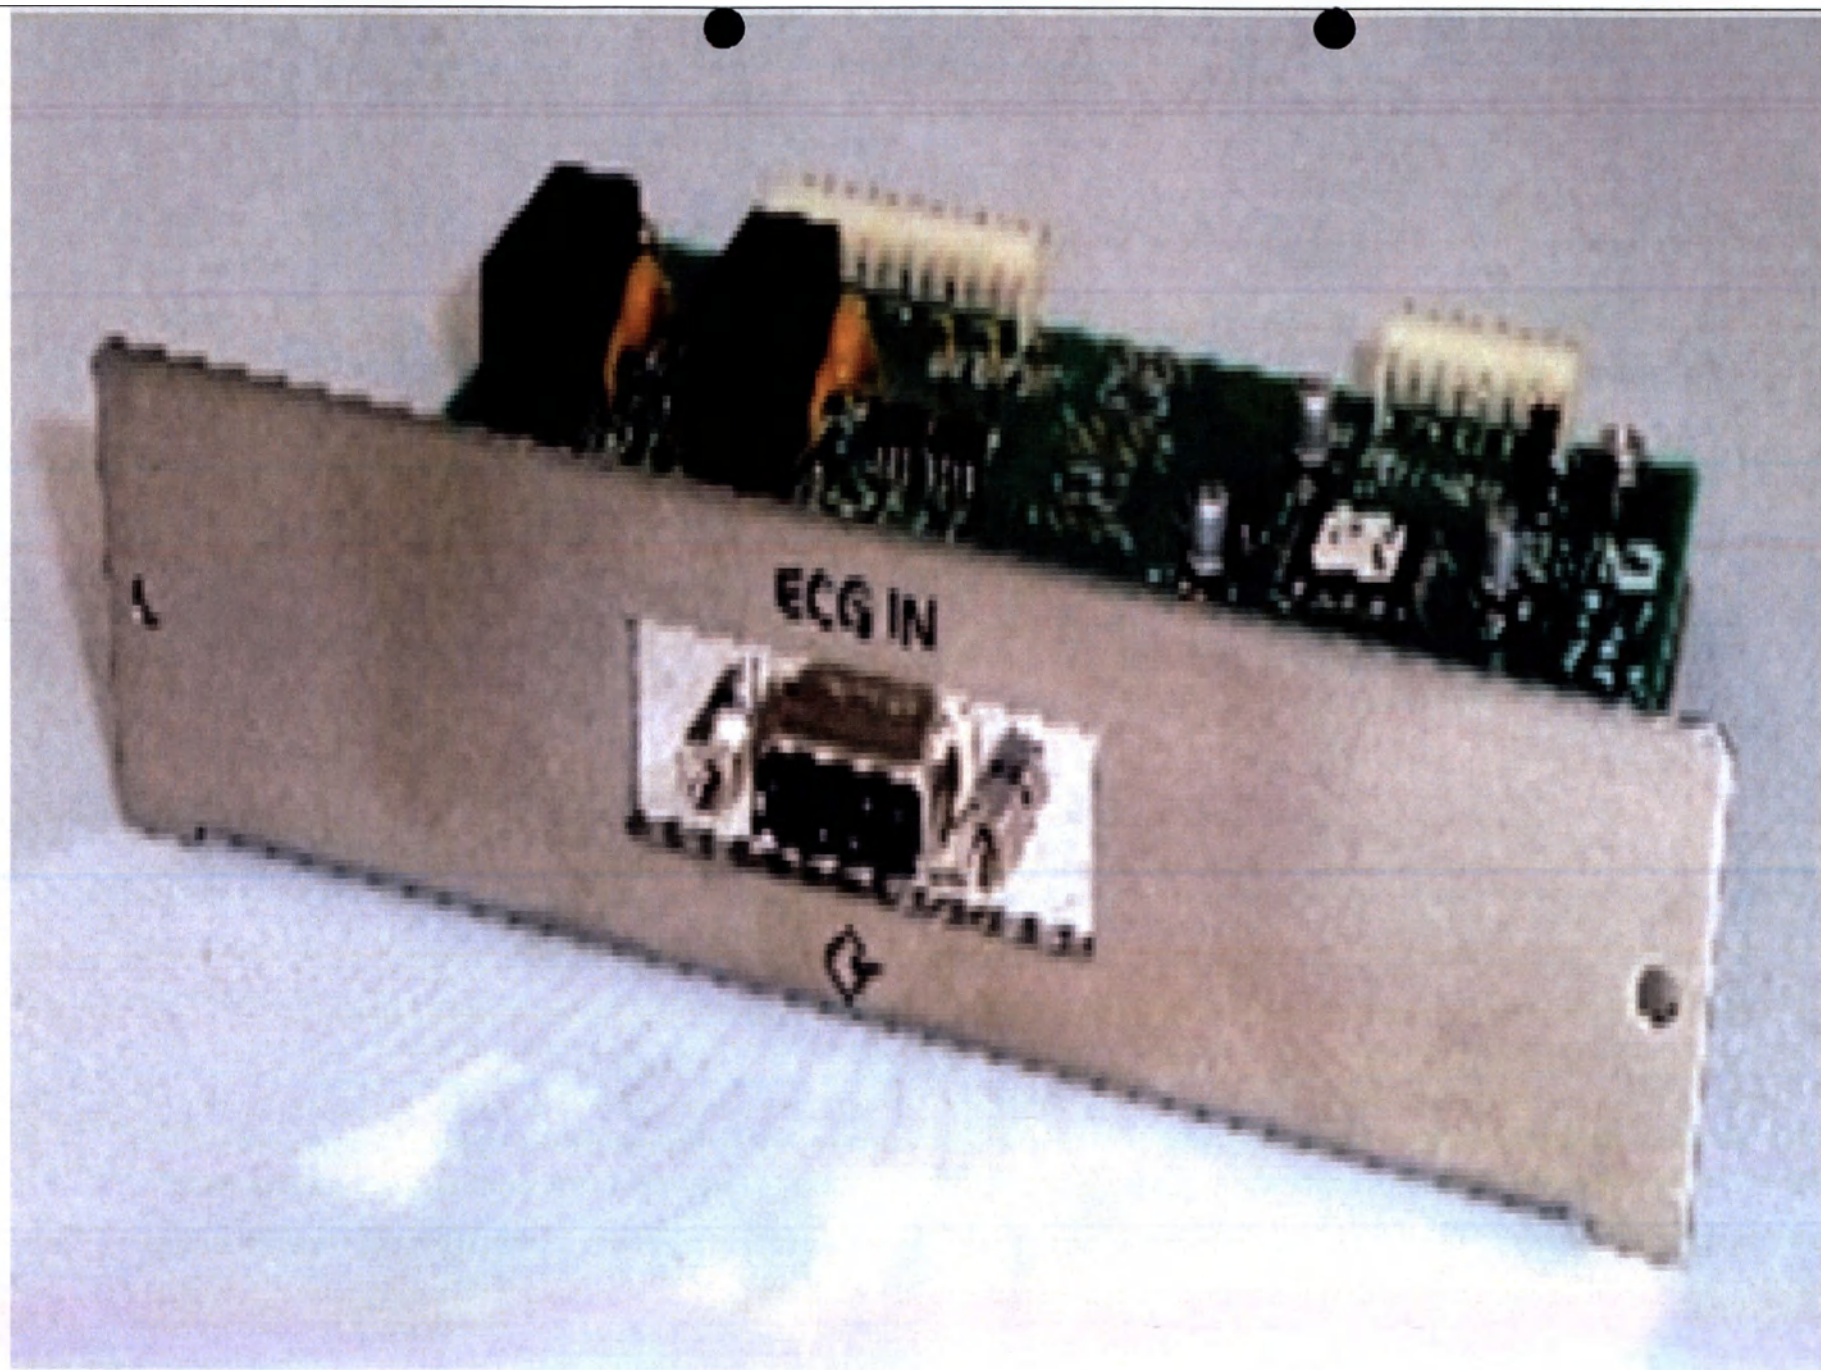


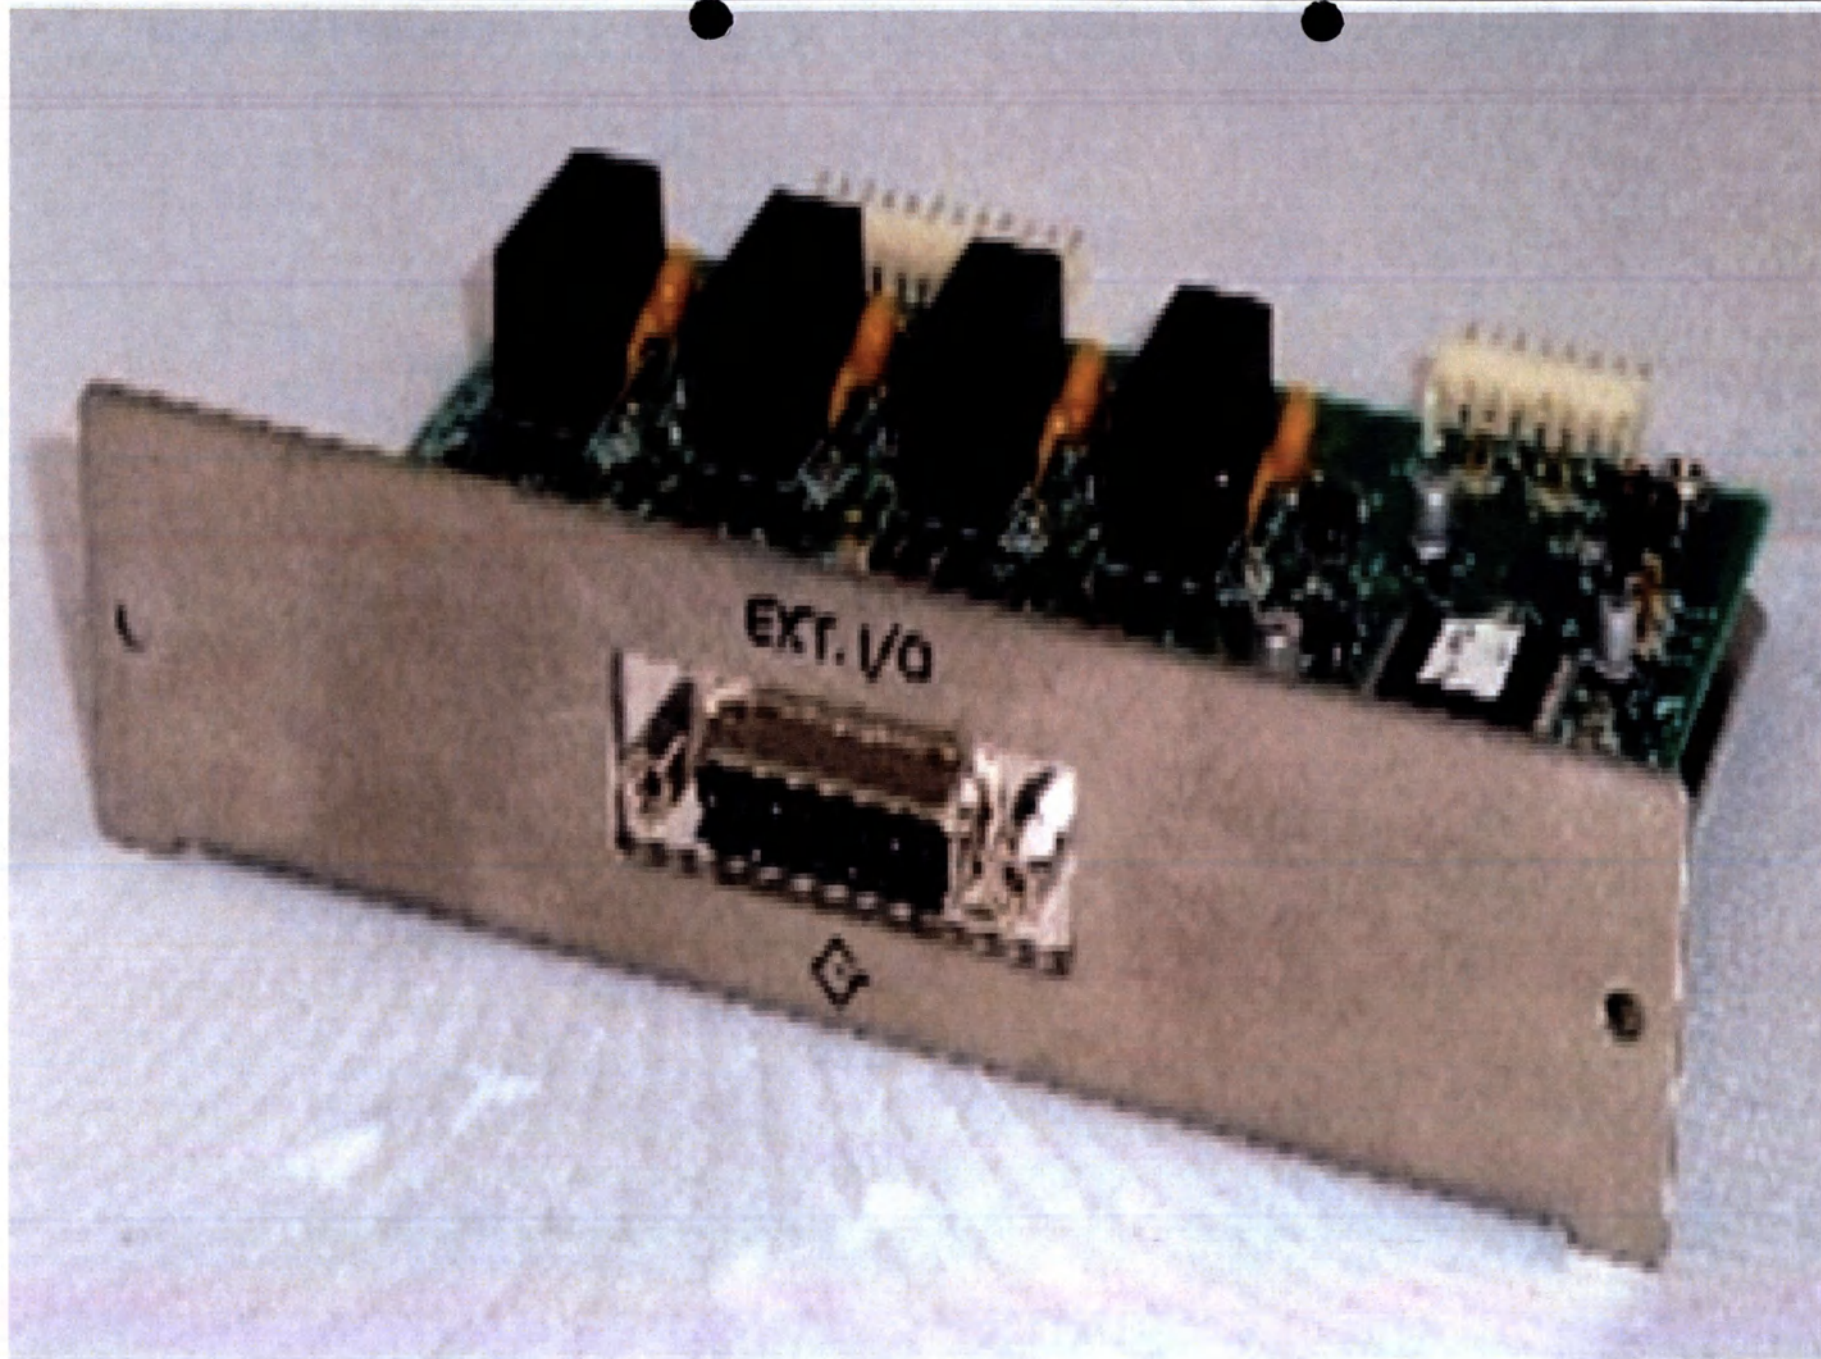

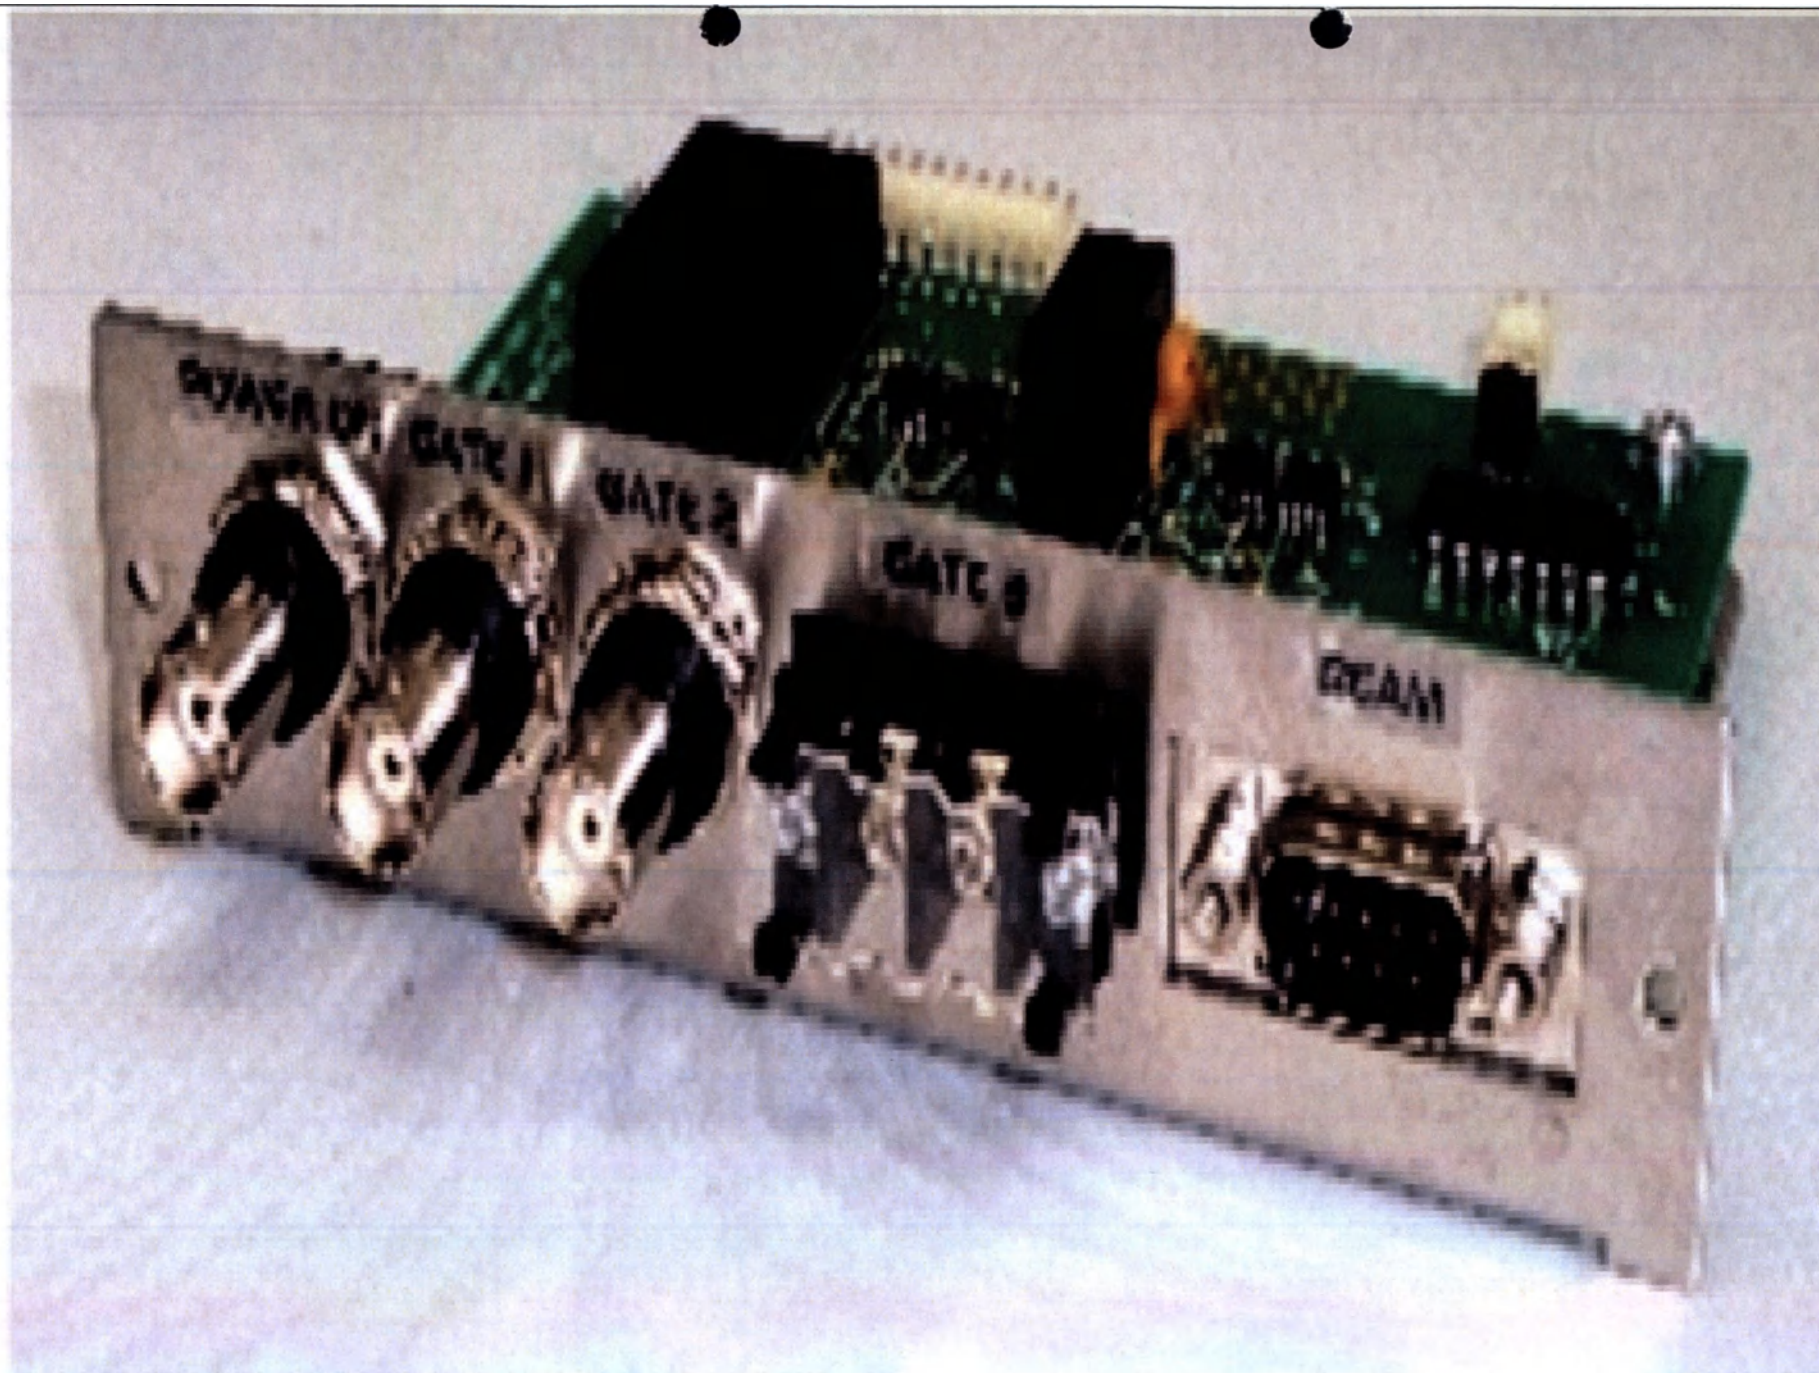


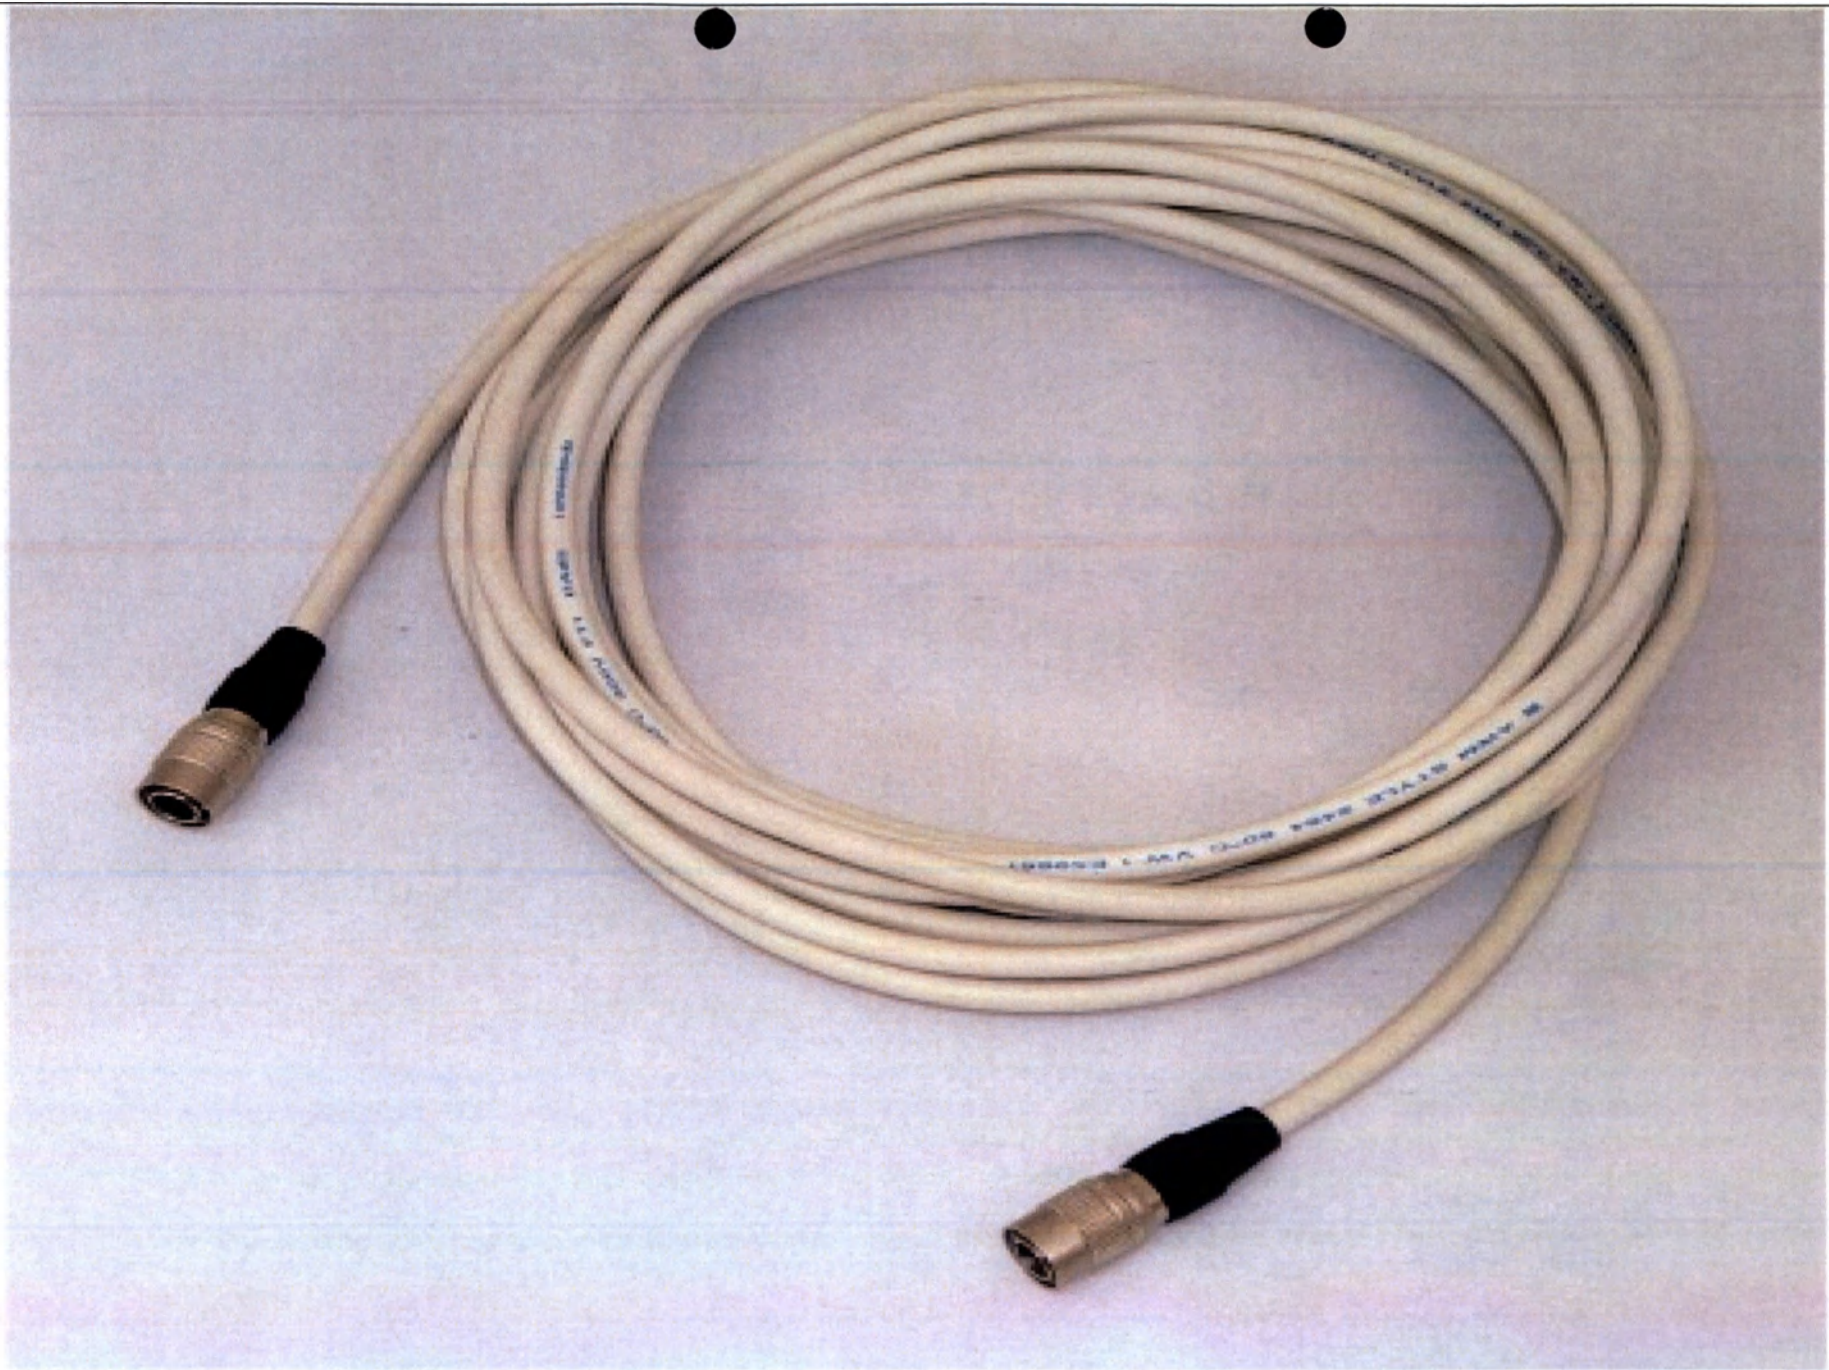


11. Кабель монитора кривых (от порта датчика до монитора кривых).

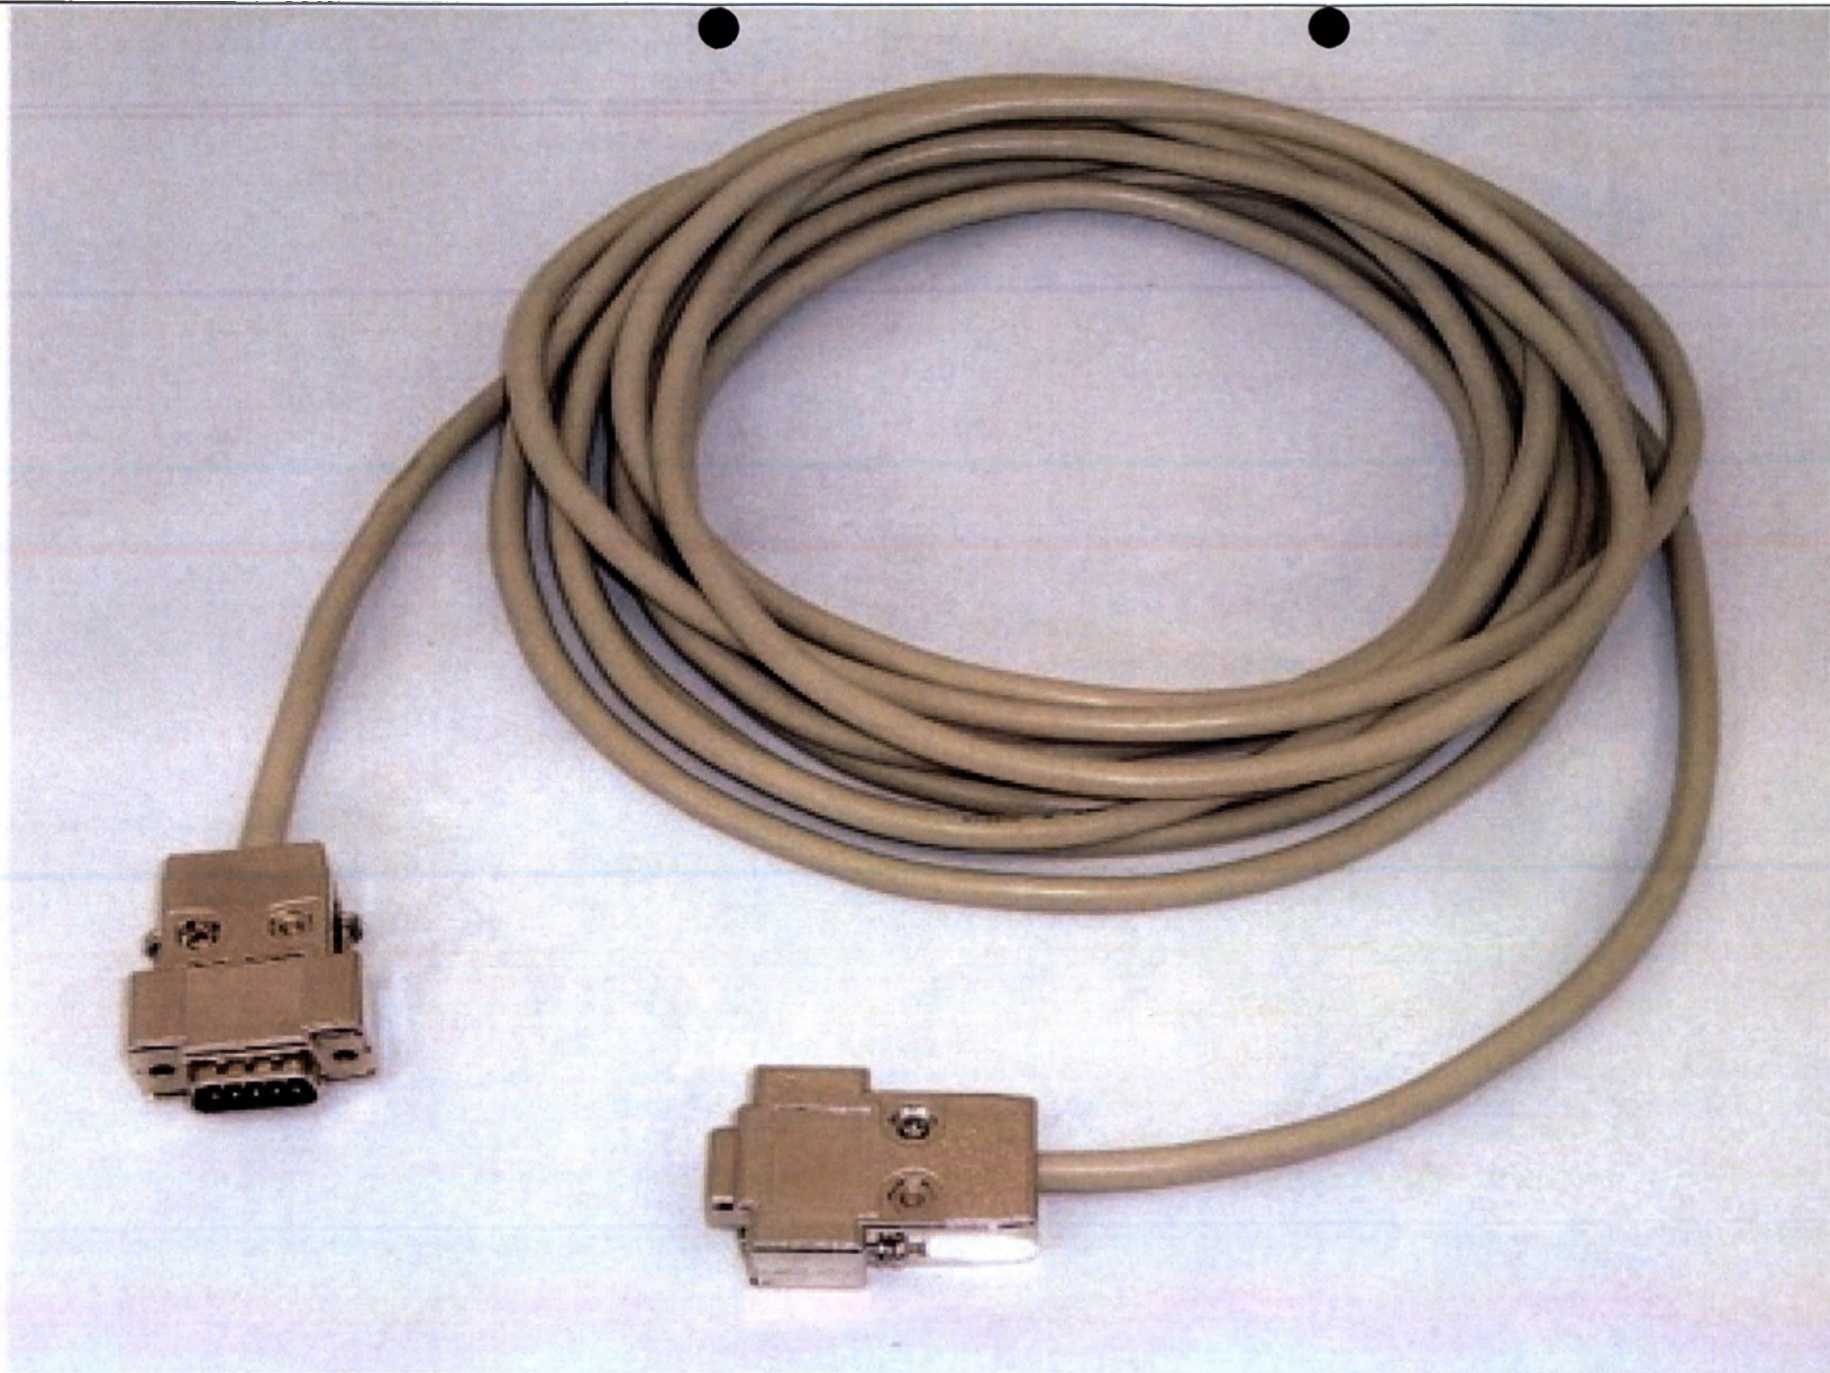

12. Кабель ЭКГ (от порта датчика до аппарата ЭКГ).

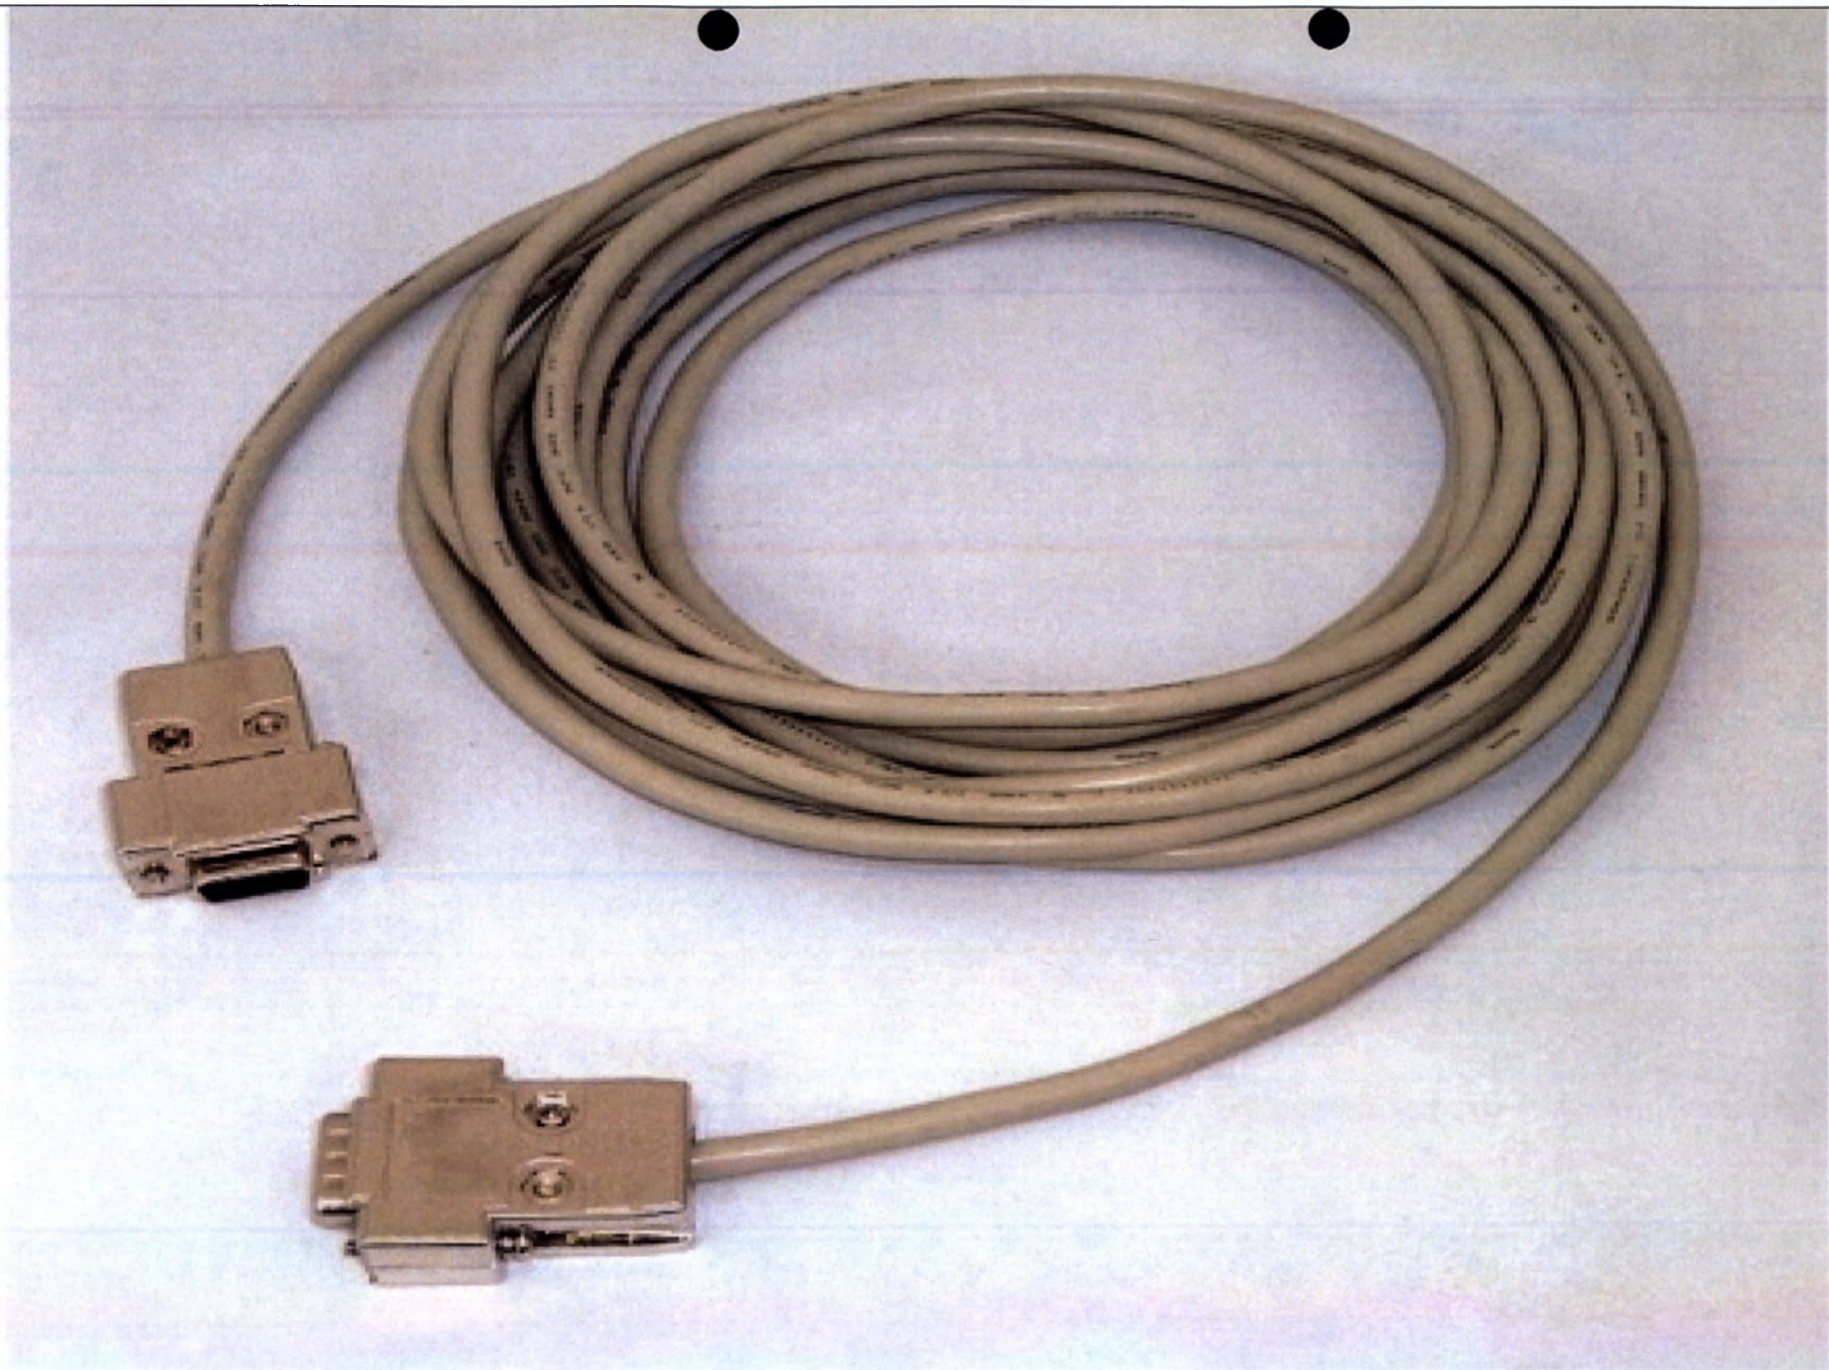


13. Кабель RS232C (от порта датчика до внешнего устройства).

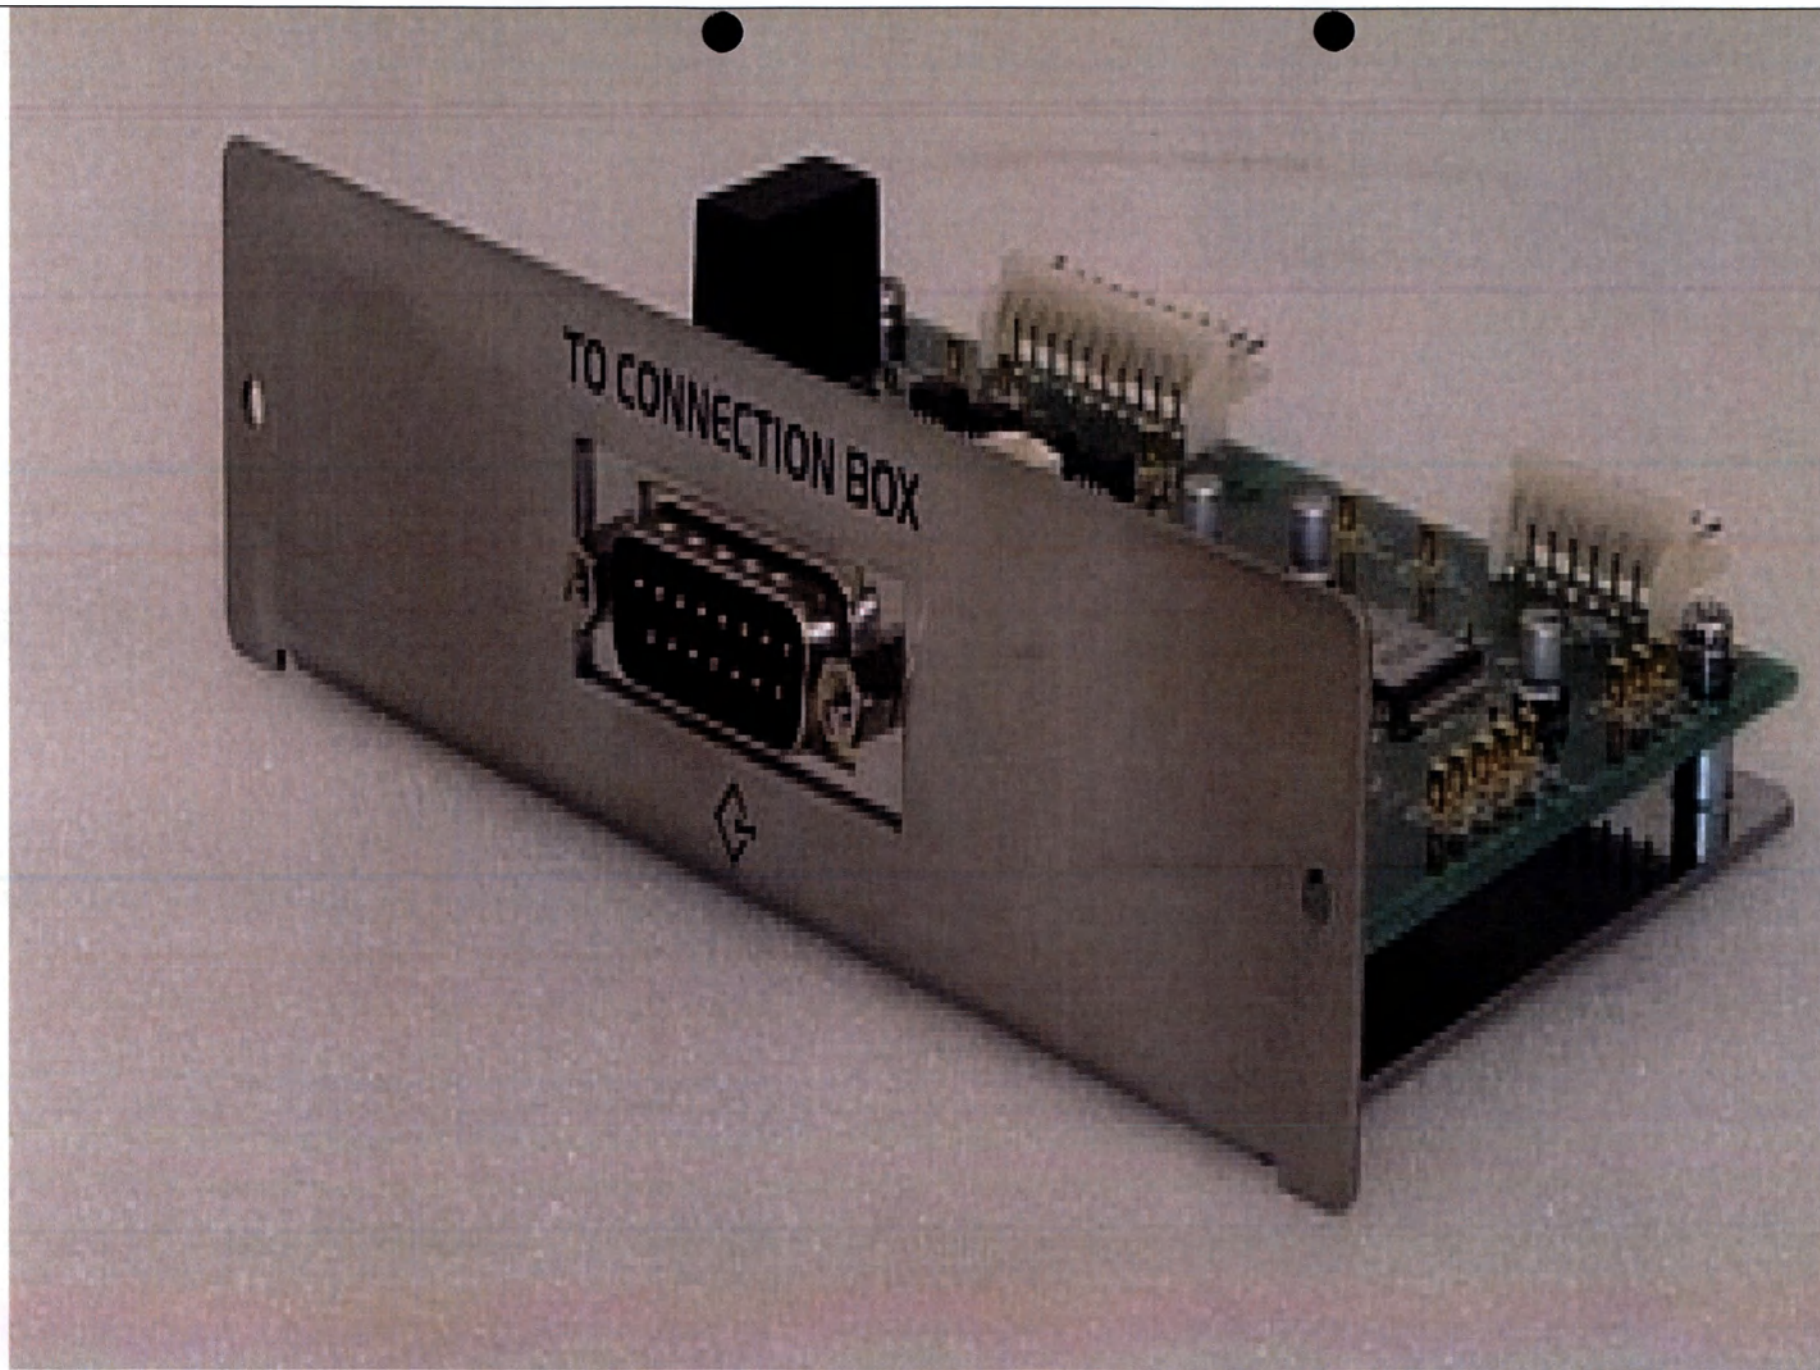


14. Интерфейсная плата 3.




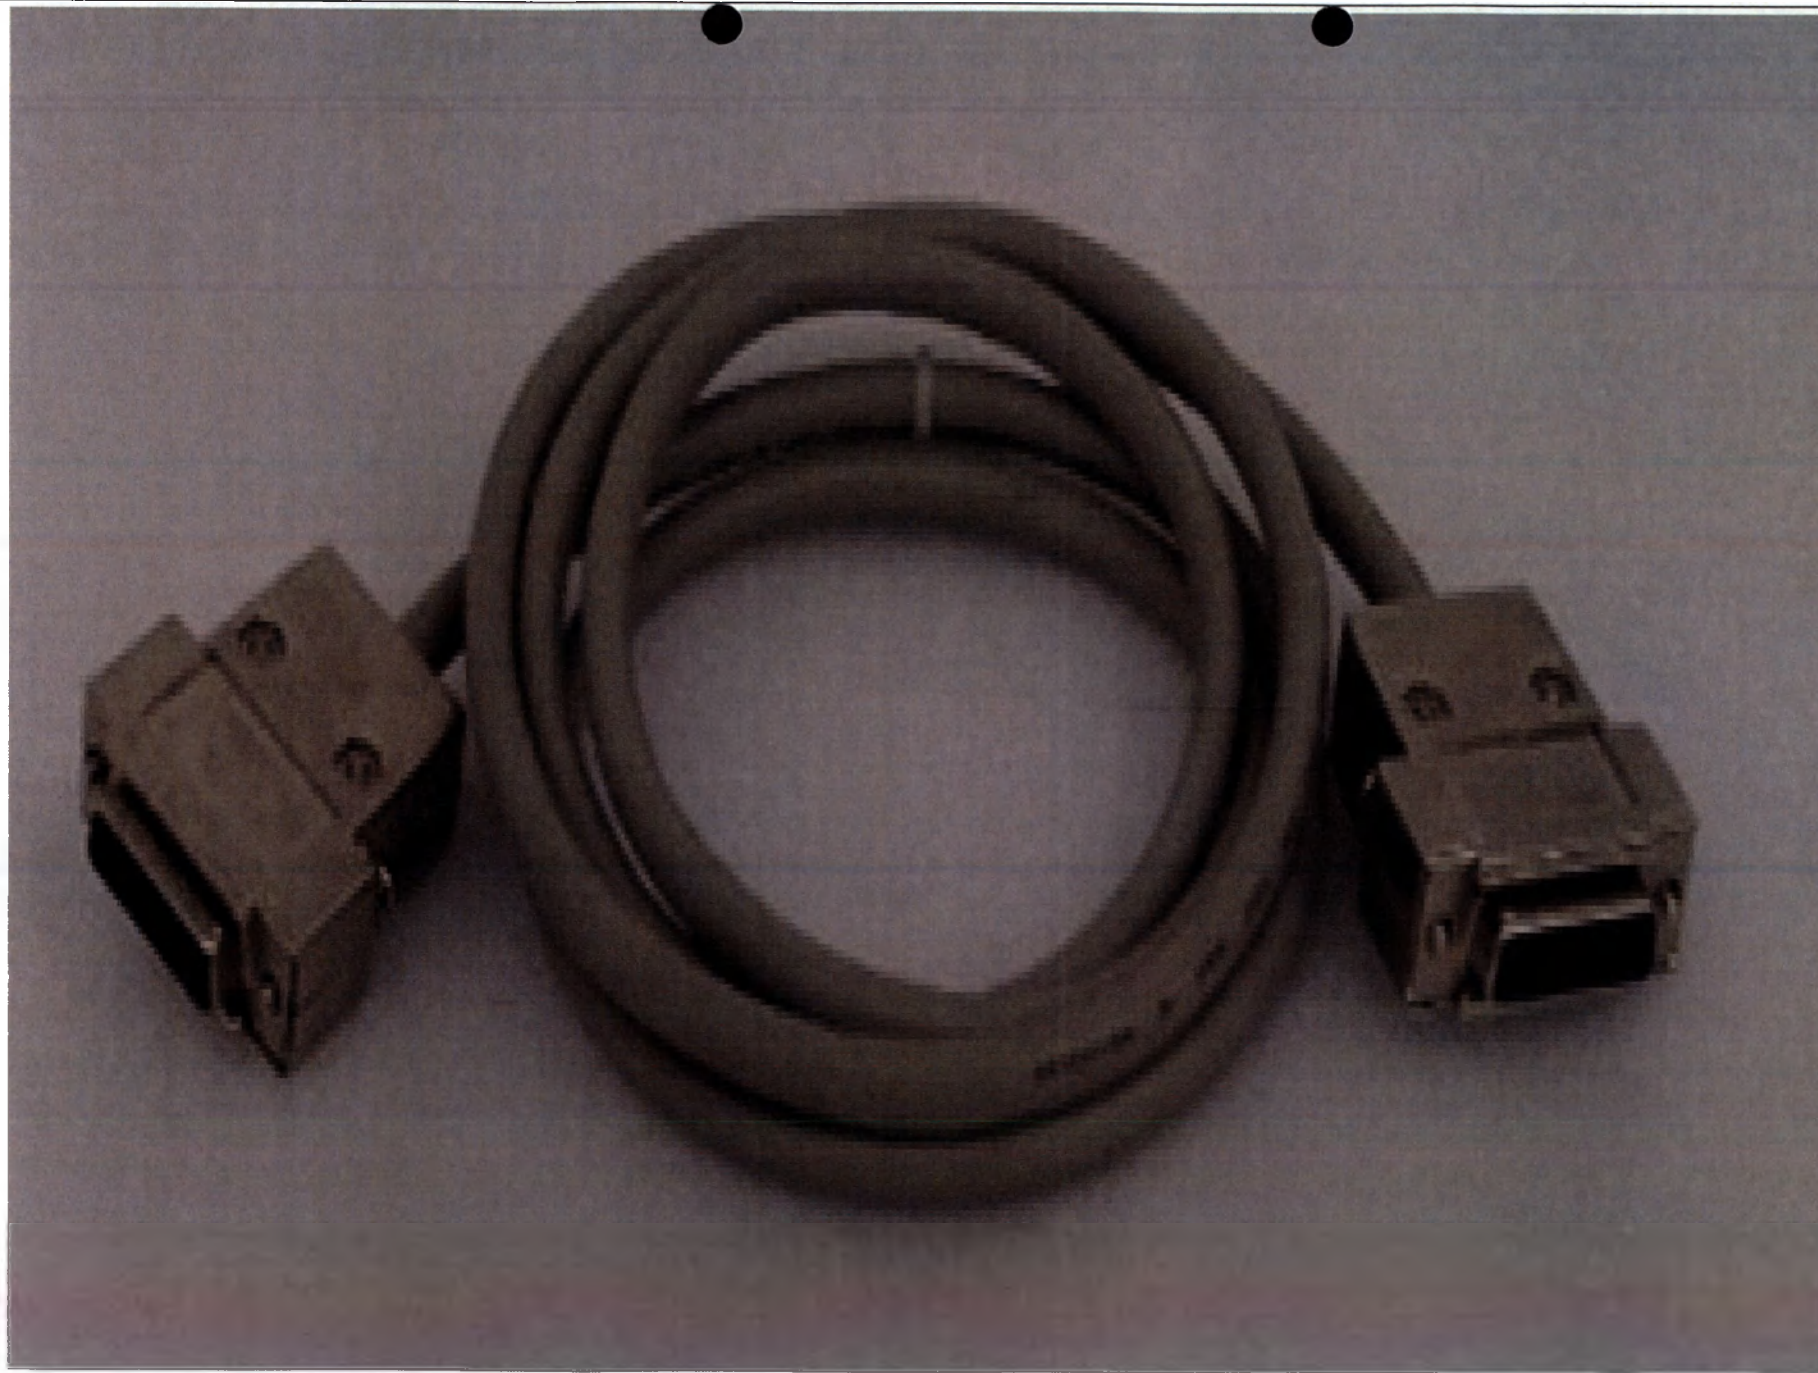



17. Основной блок датчика с ИК прицелом.

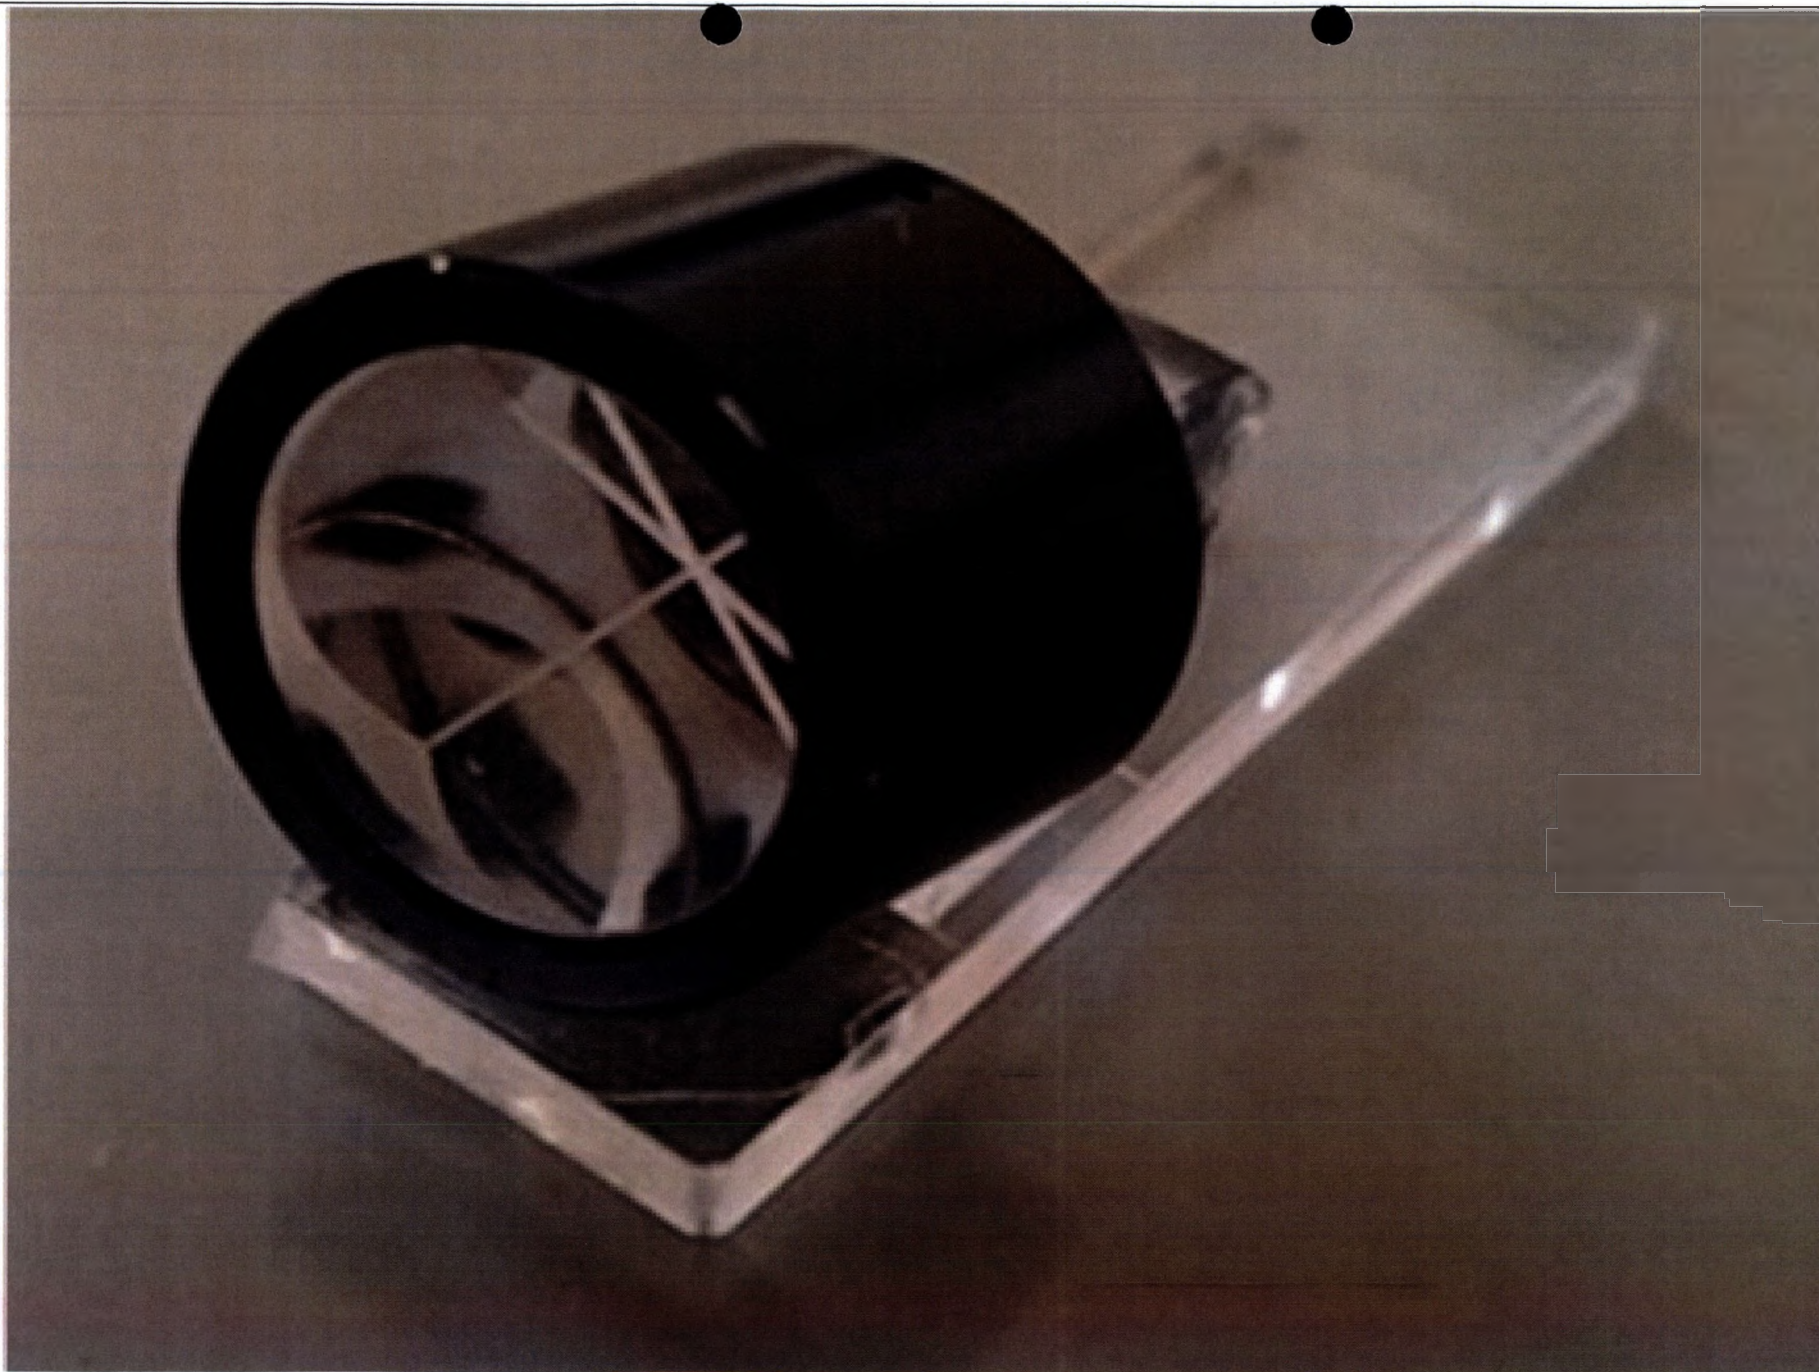

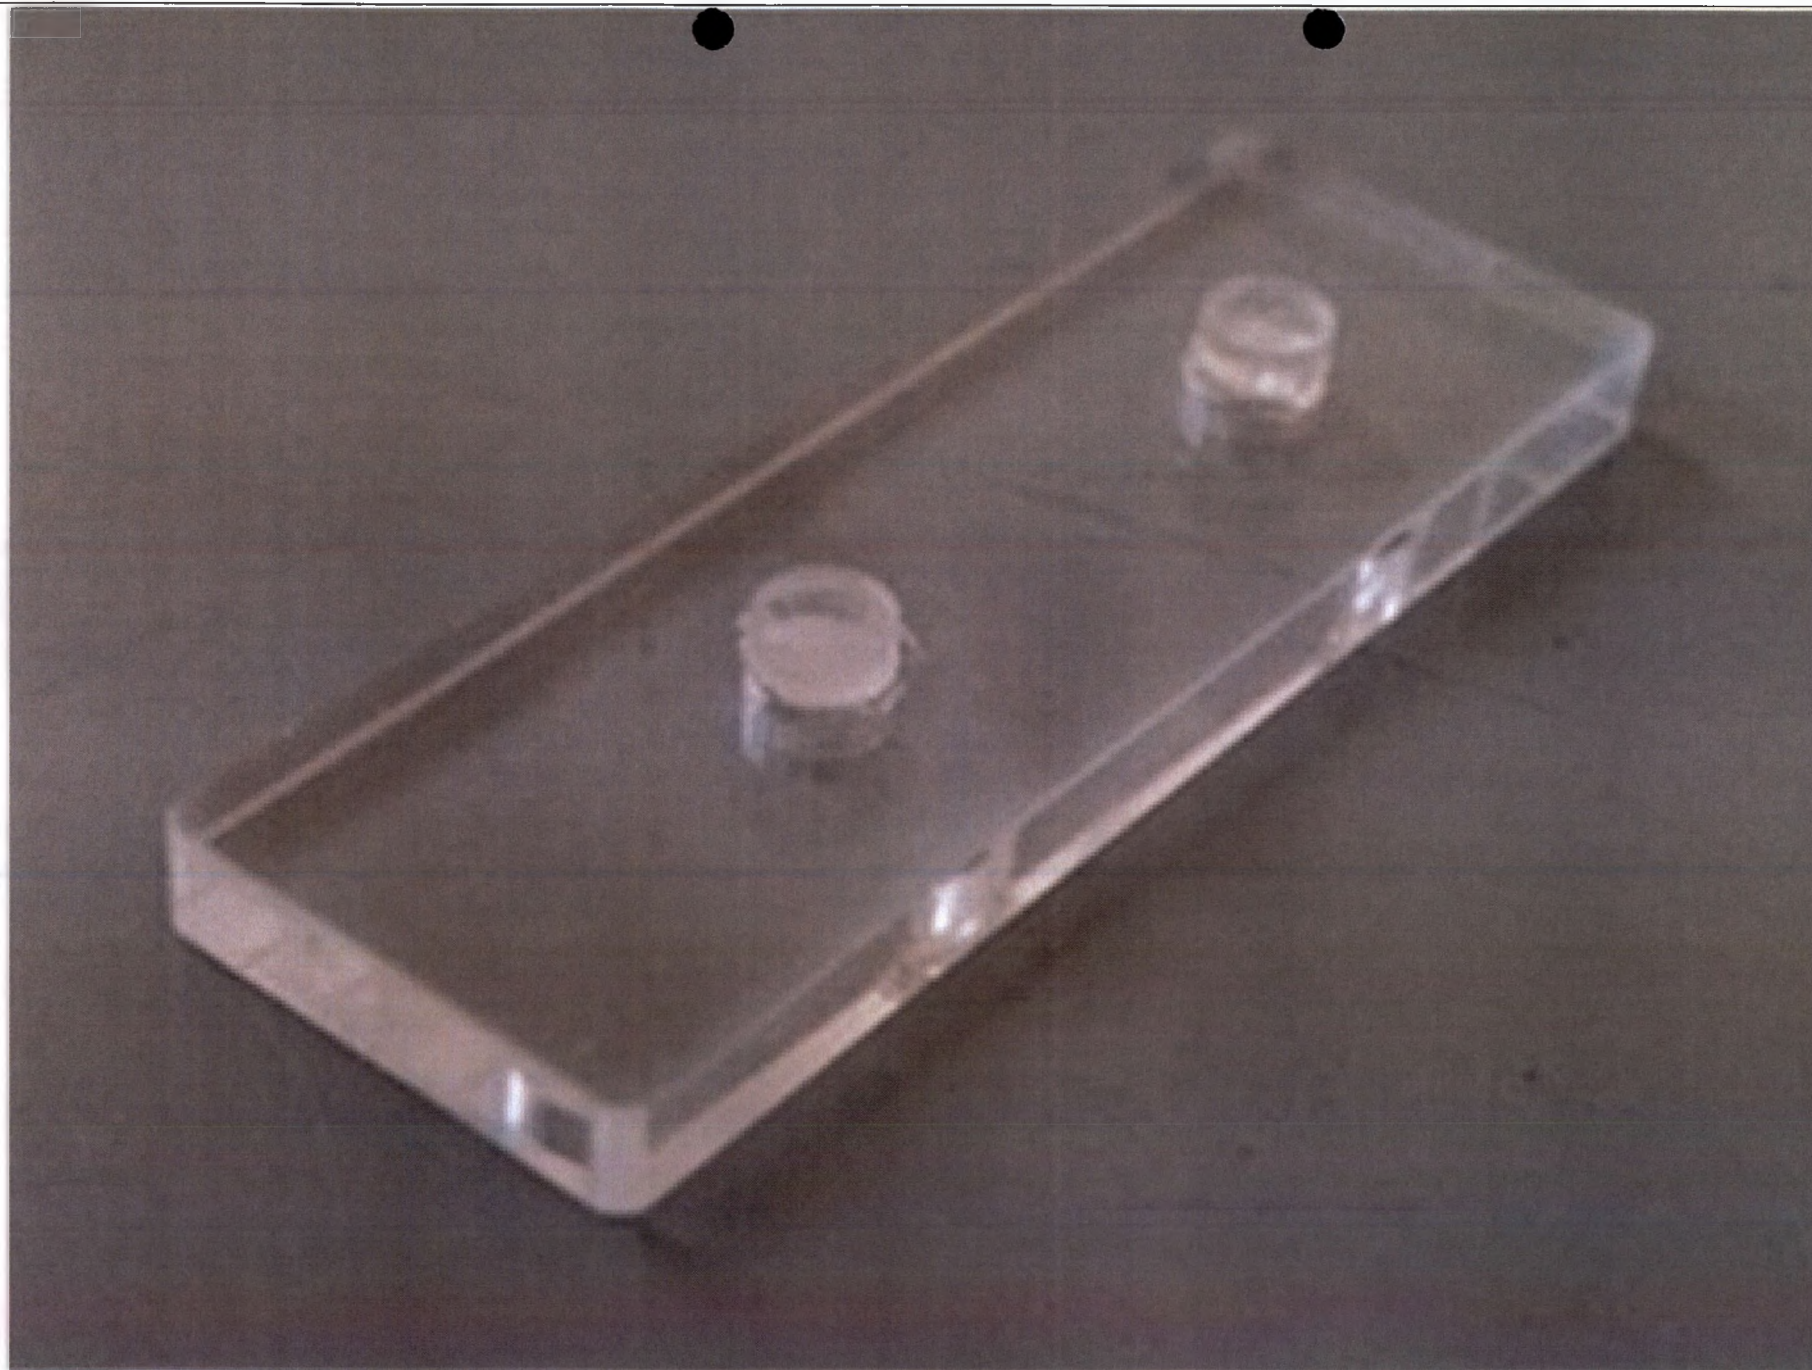





20. Крепление датчика с ИК прицелом (тип Т).




21. Чехол для системы синхронизации с дыханием.

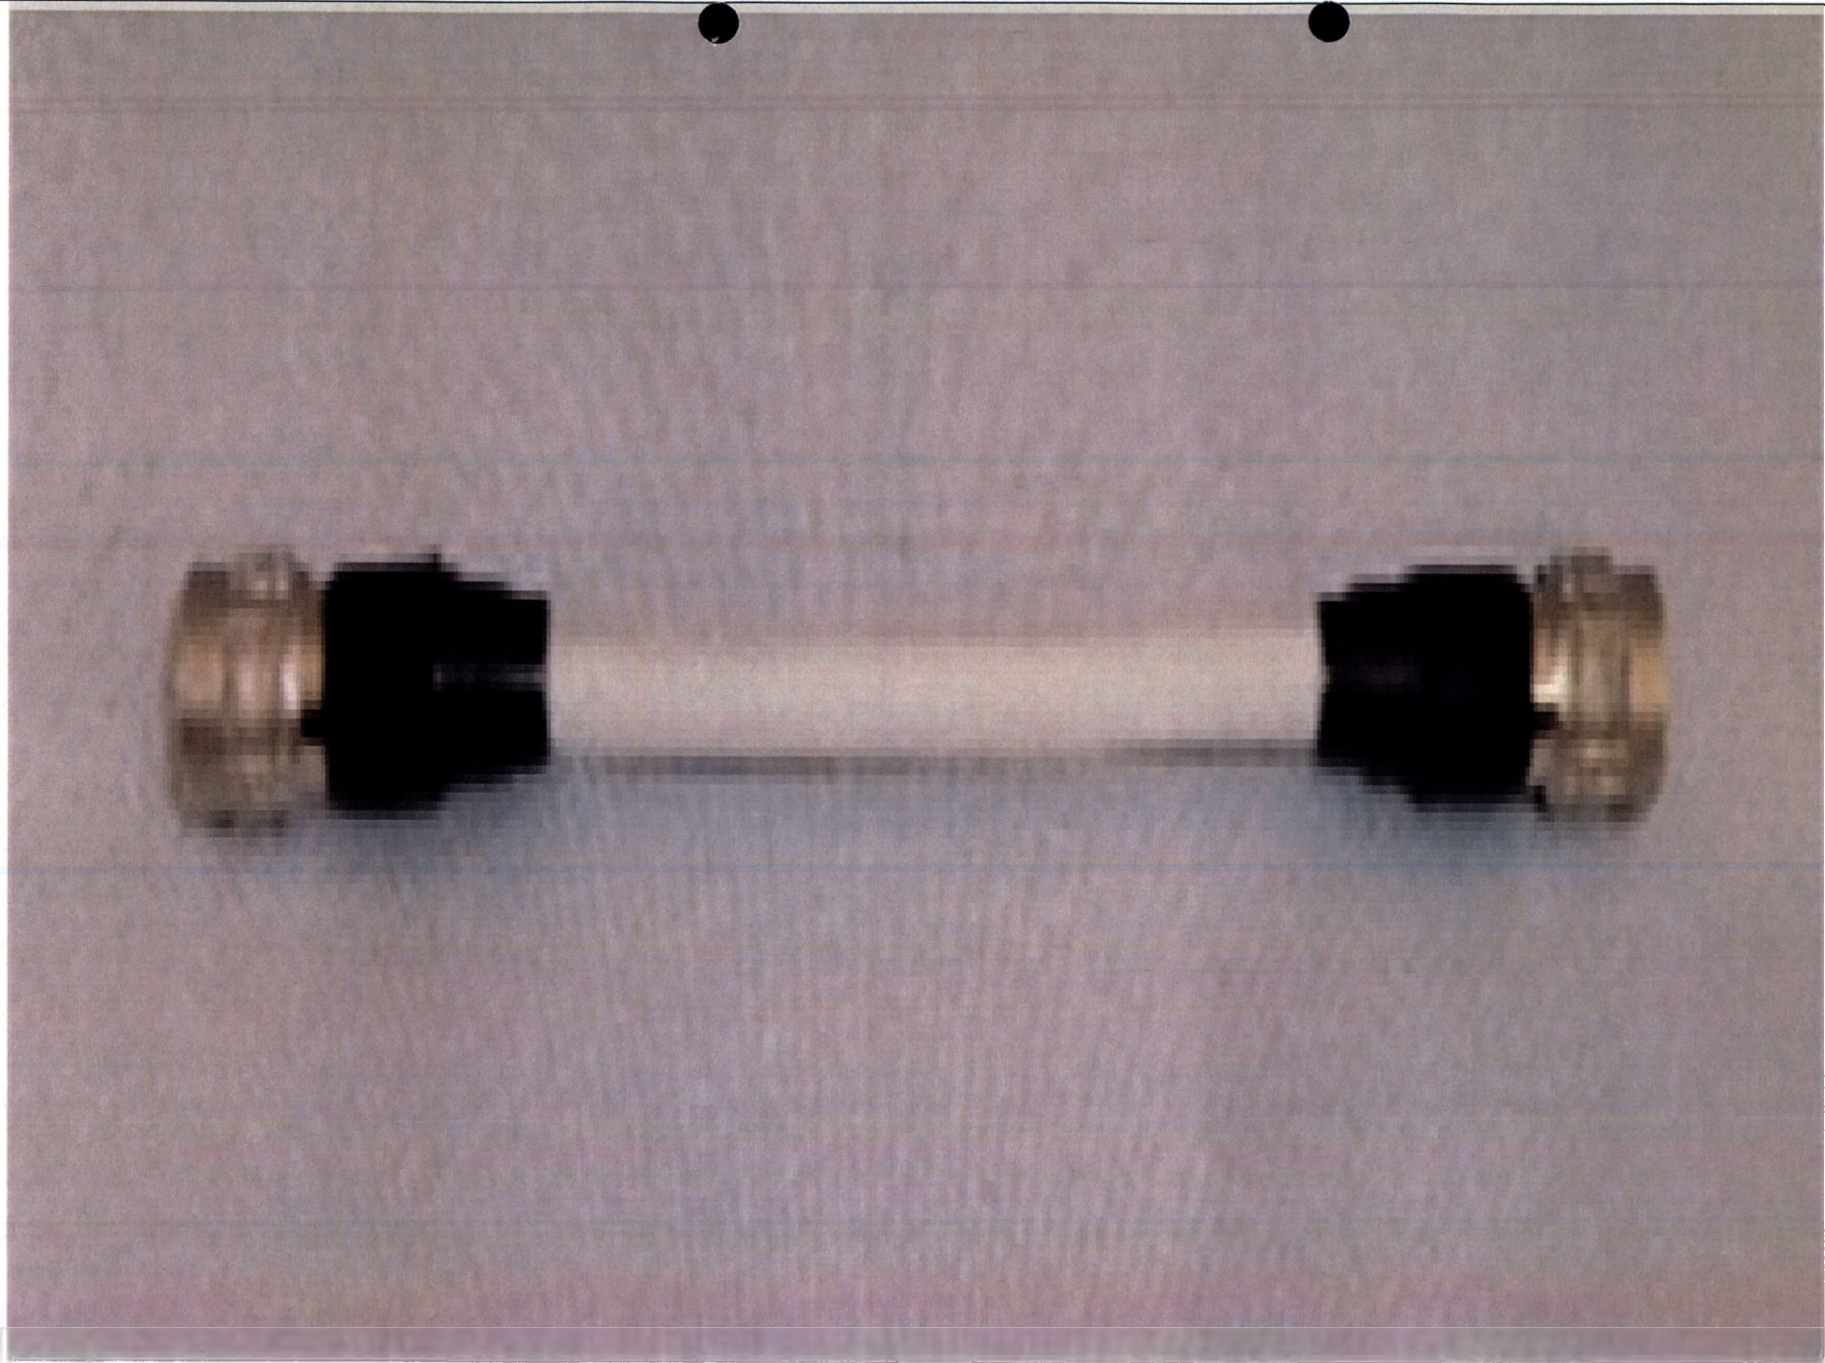


22 Кабели соединительные (не более 10 шт.). 15 см.

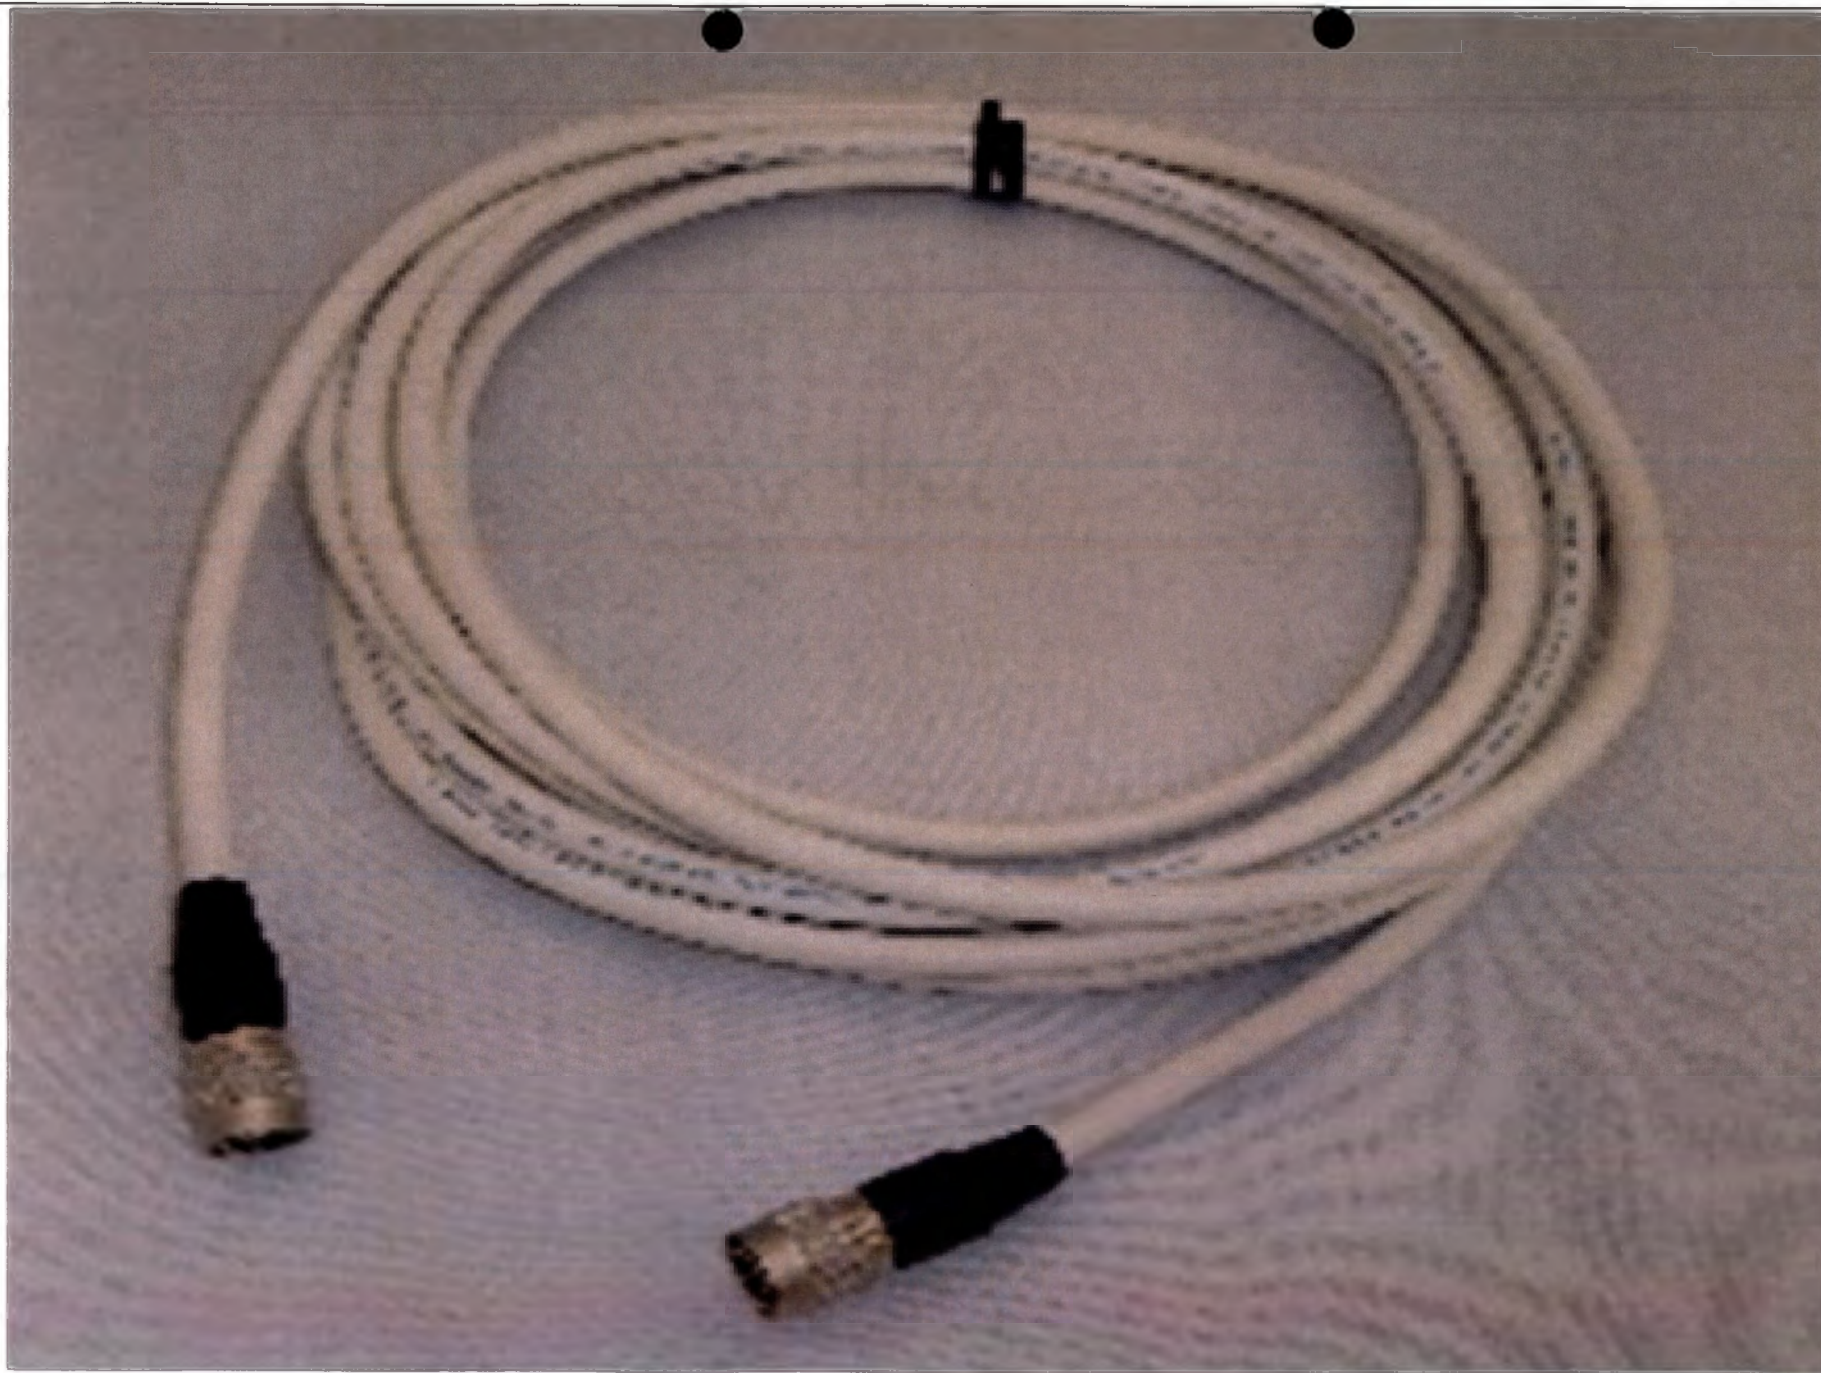

Кабели соединительные (не более 10 шт.). 5 м.

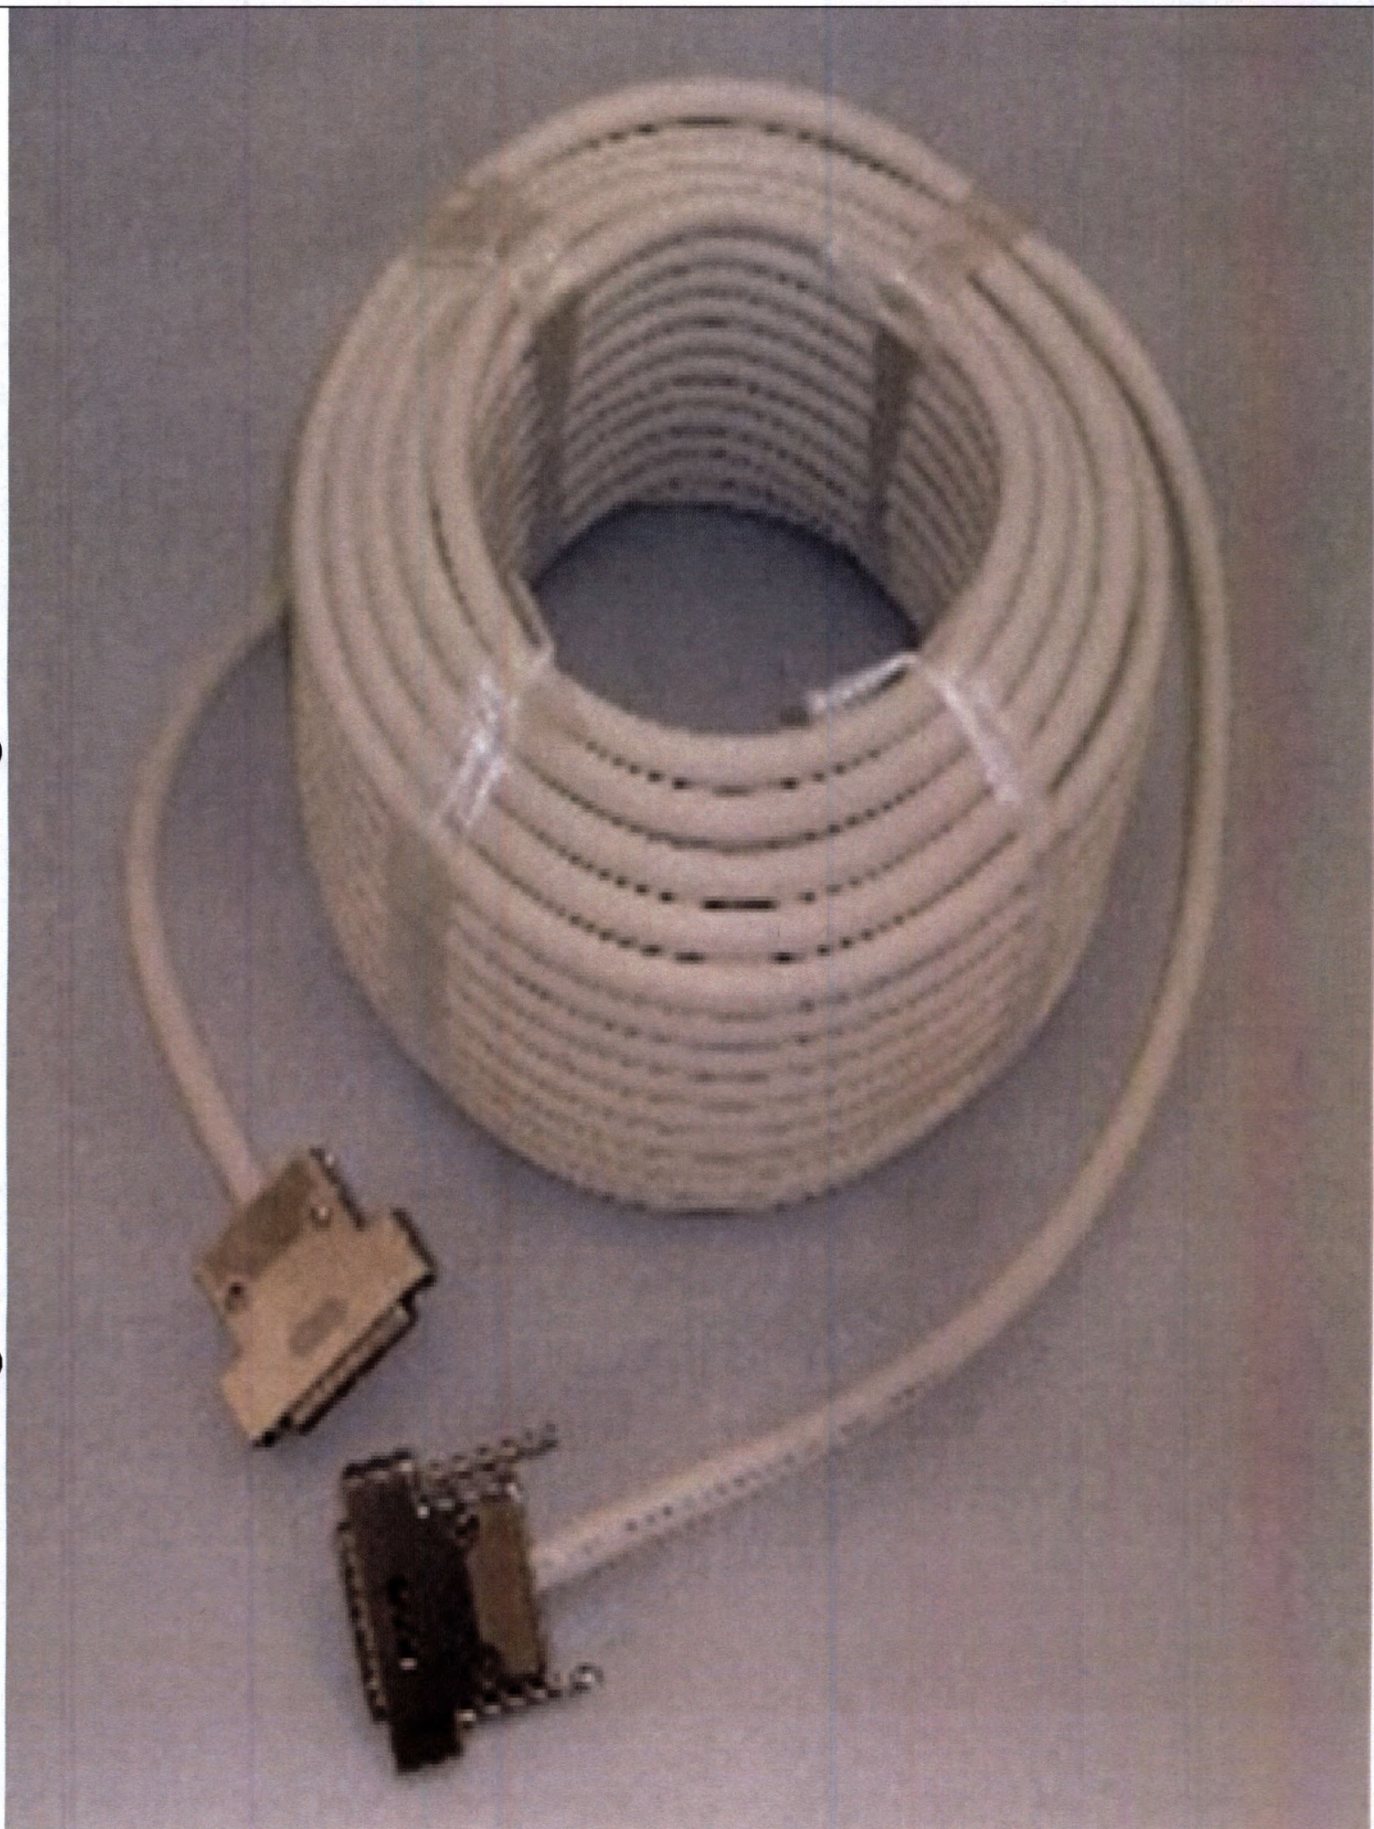


Кабели соединительные (не более 10 шт.). 30 м.

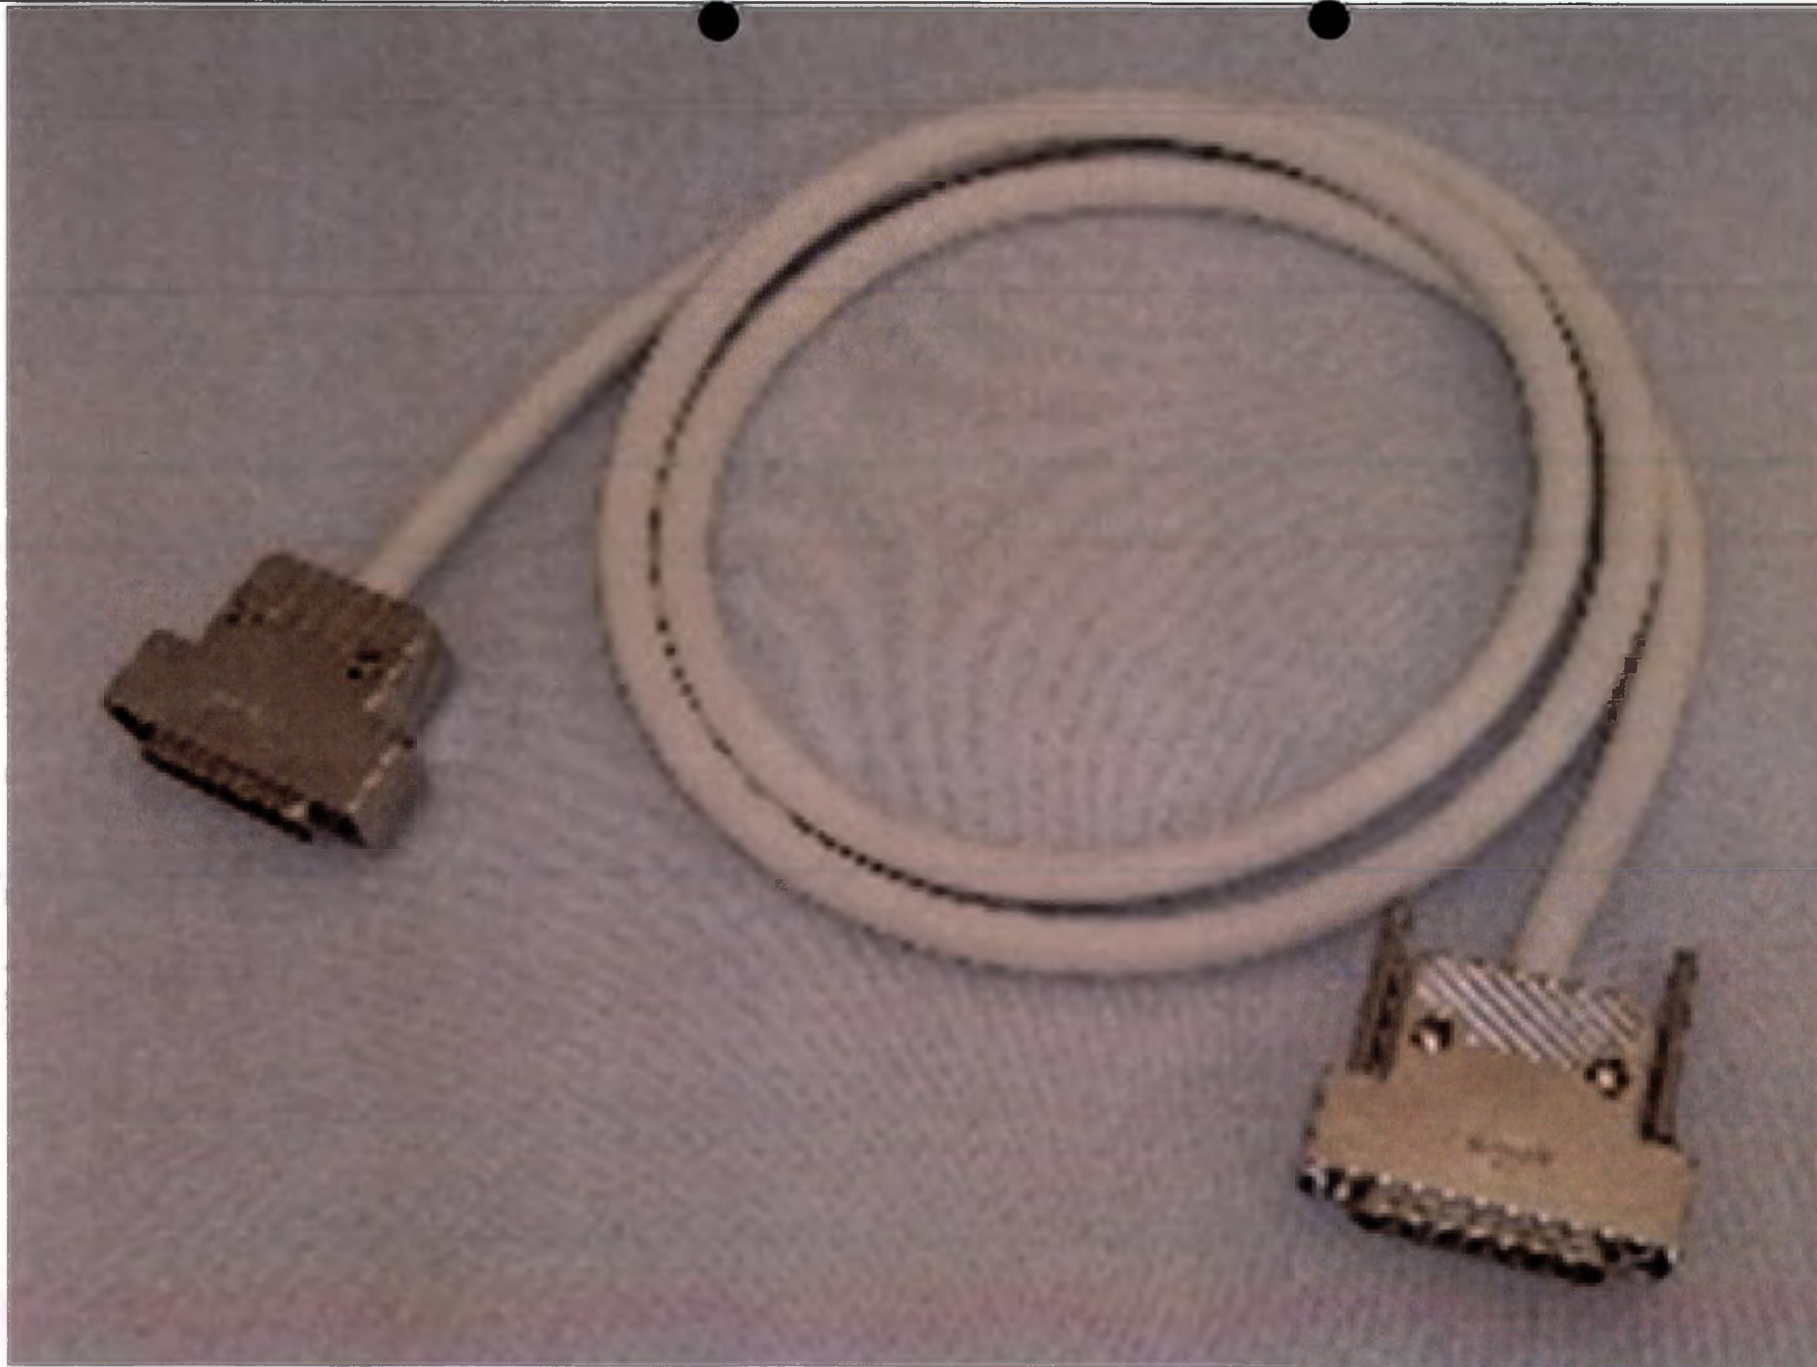


Кабели соединительные (не более 10 шт.). 1.6 м.




Кабели соединительные (не более 10 шт.). 1.5 м.

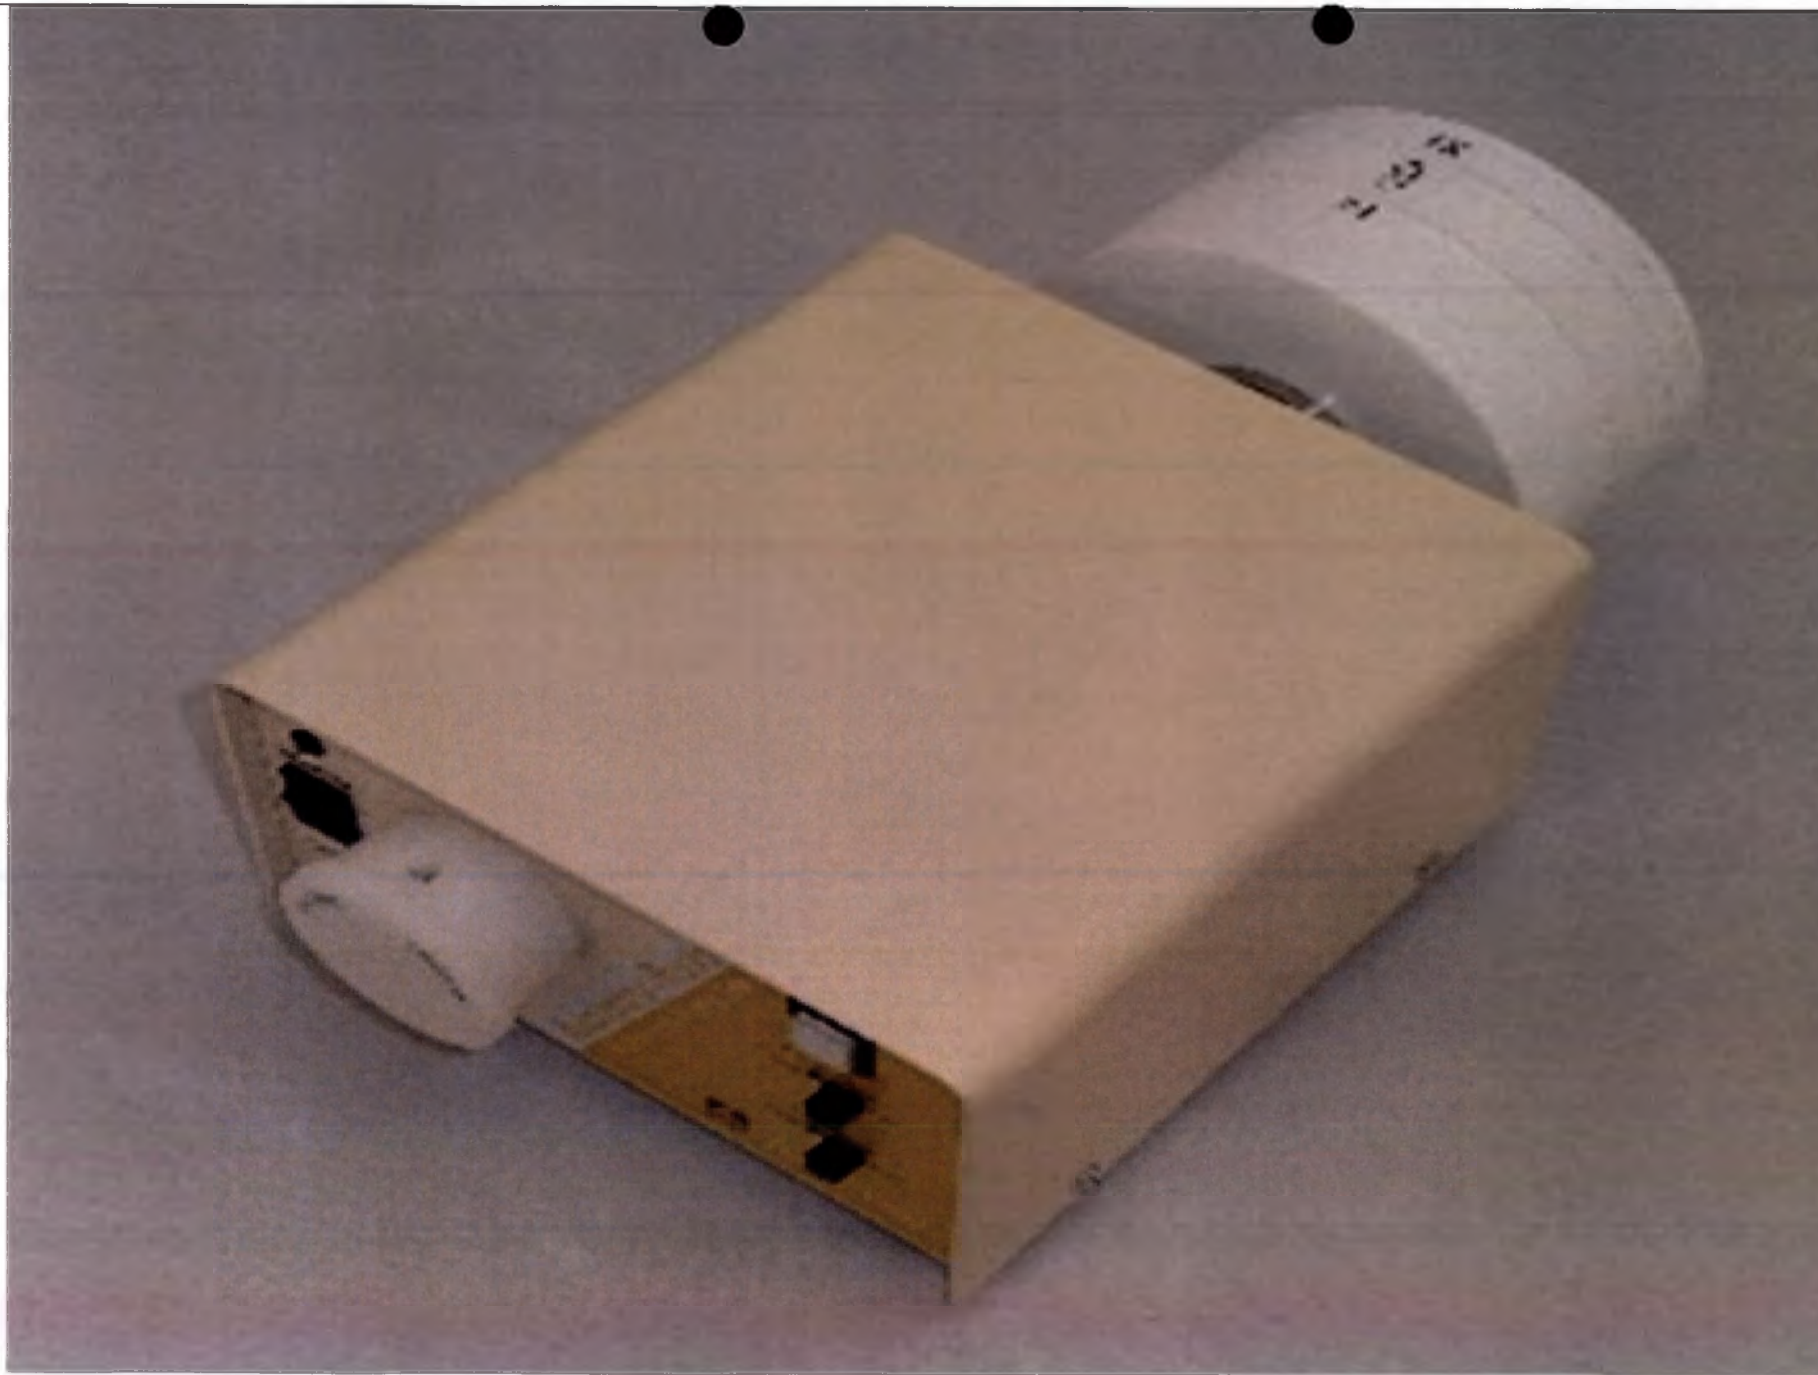

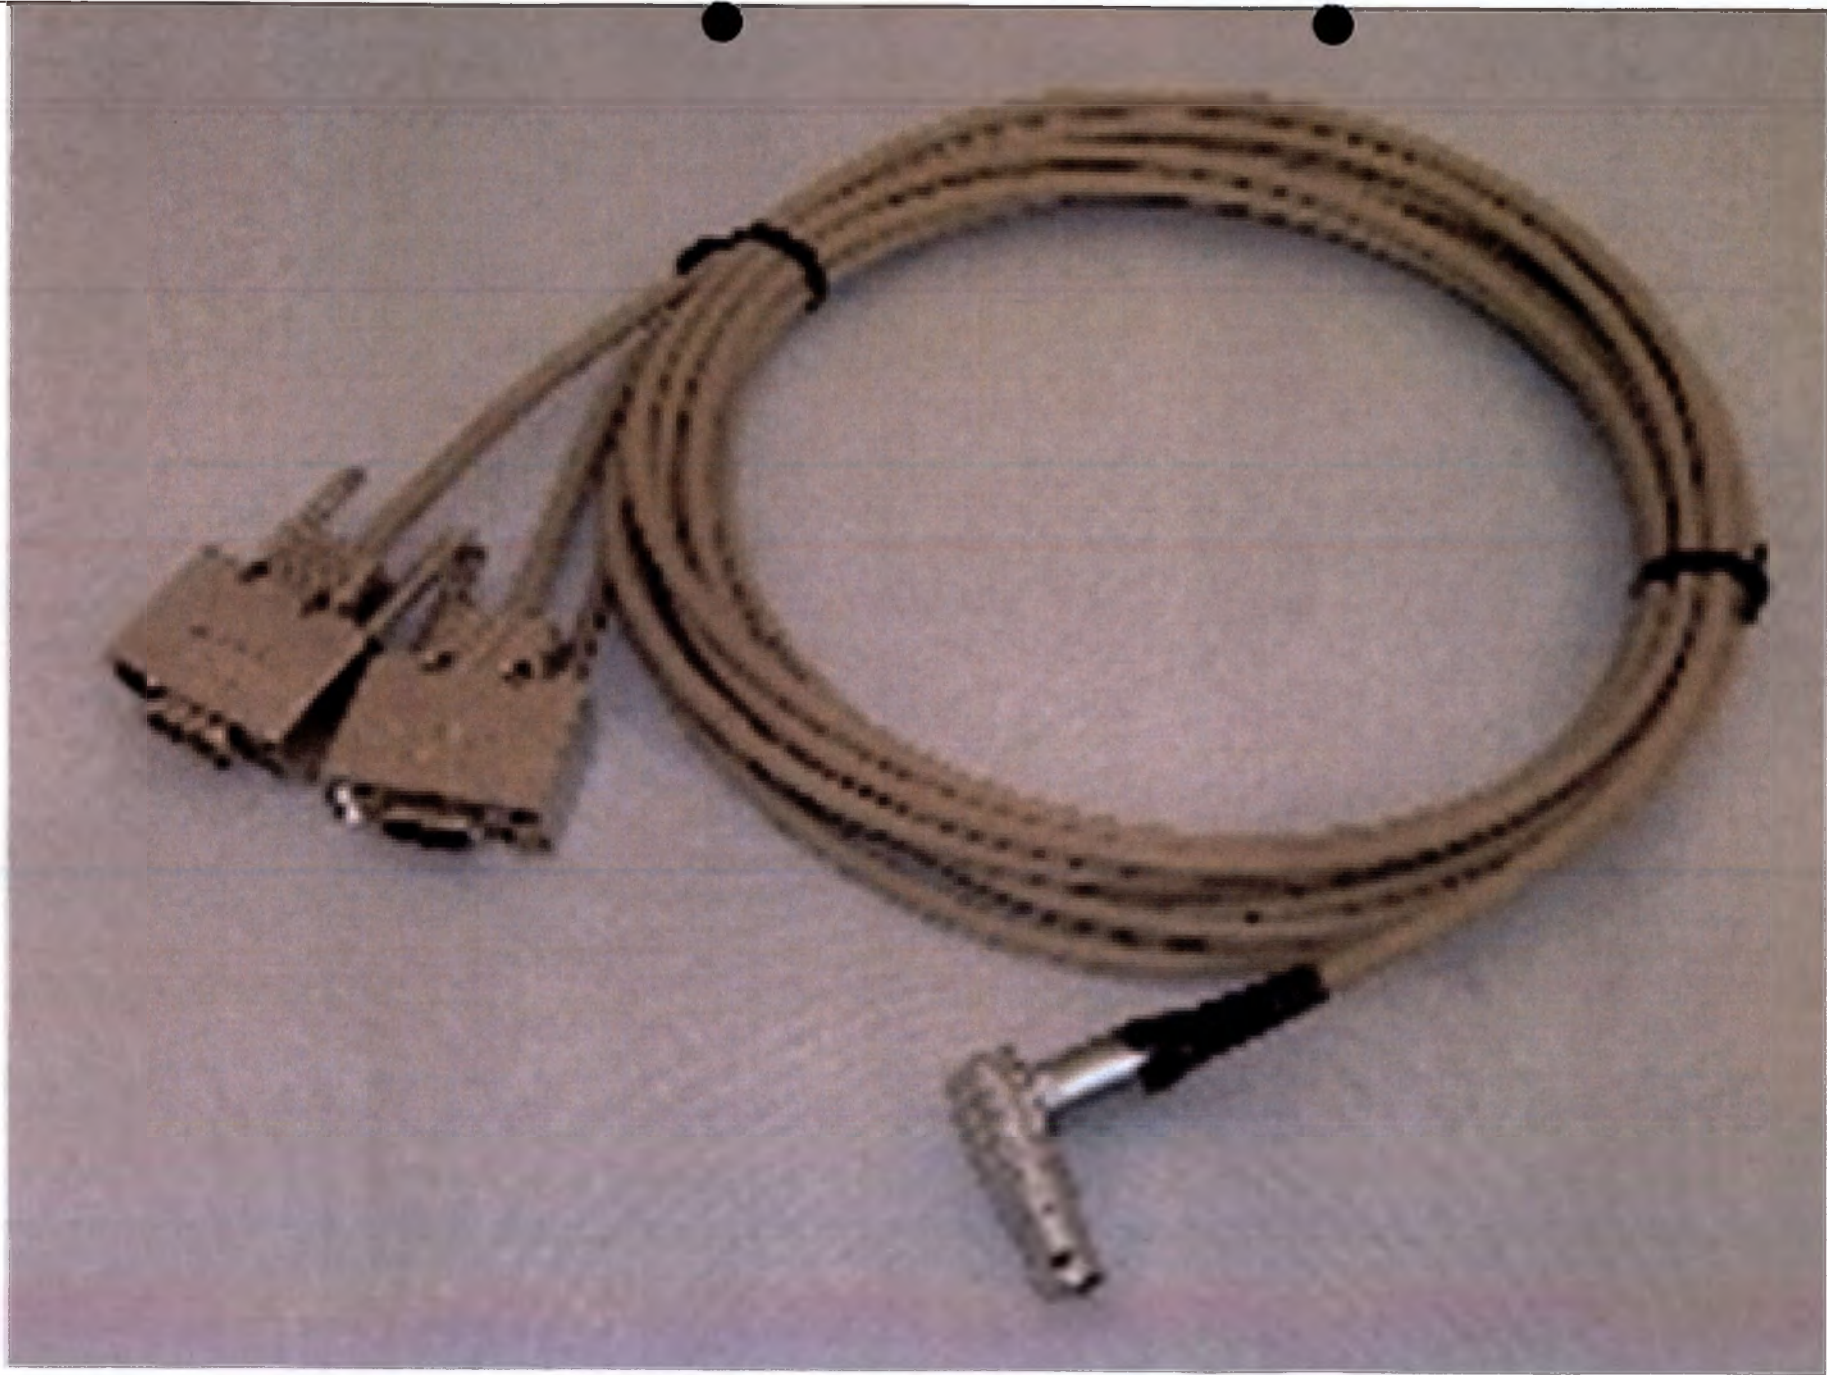


24. Кабель соединительный для подключения системы синхронизации с дыханием к система KT Siemens.

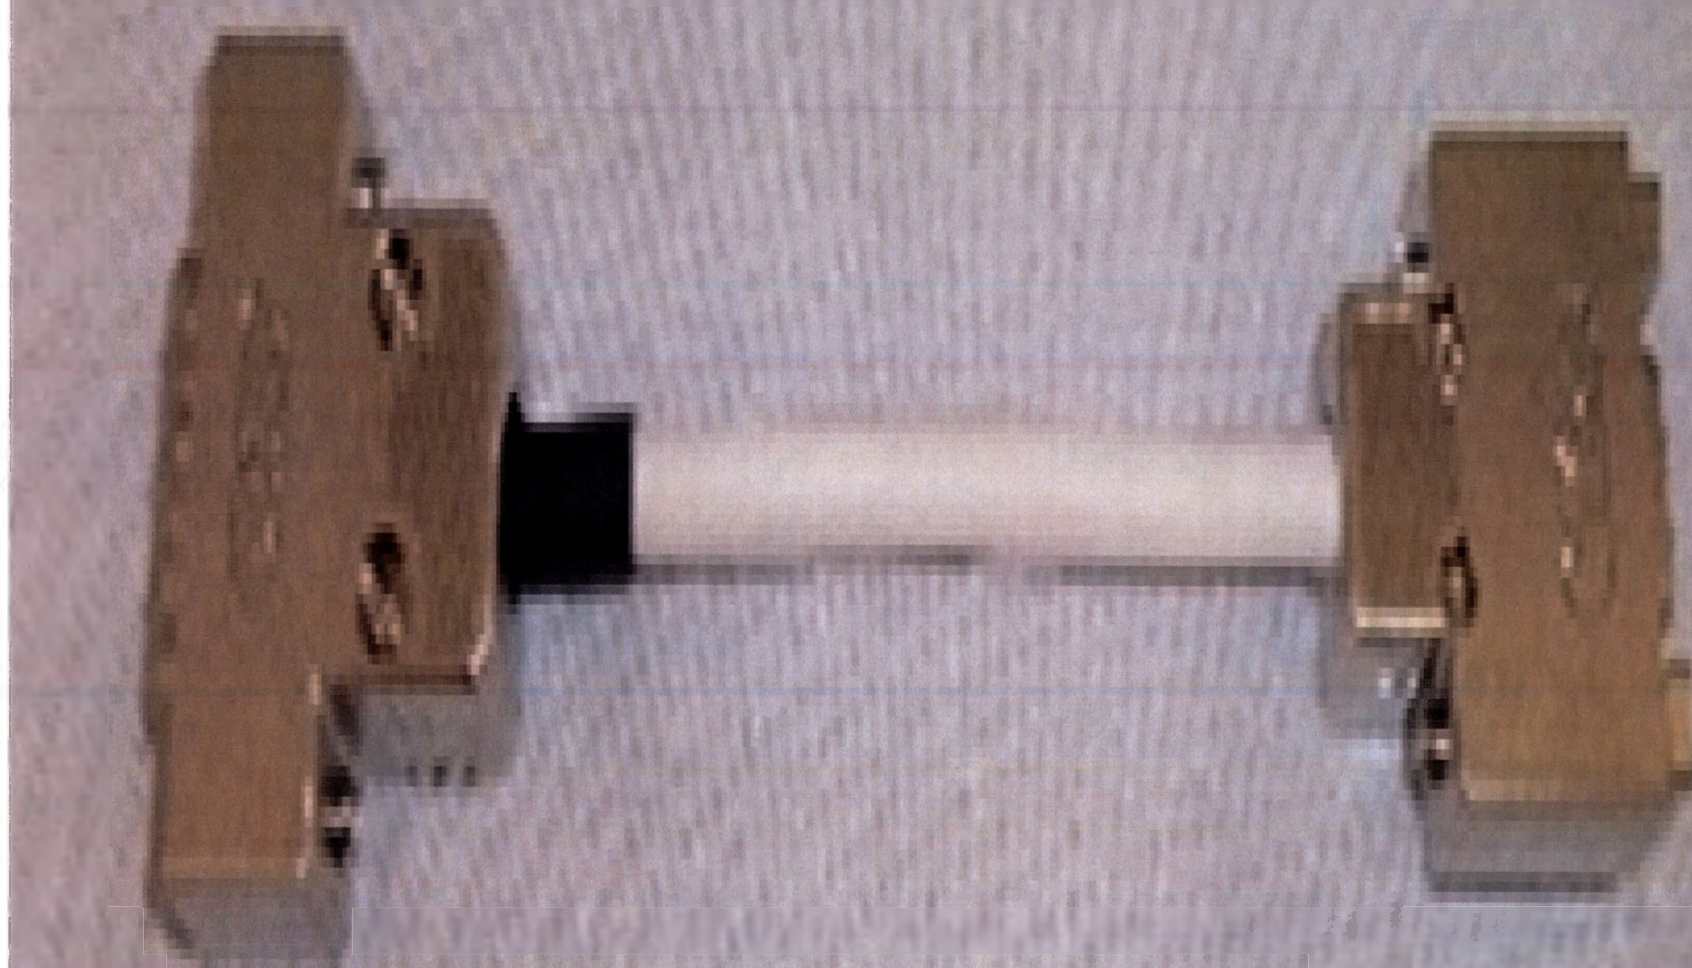



26. Кабель соединительный для подключения системы синхронизации с дыханием к системам ПЭТ/КТ Siemens.

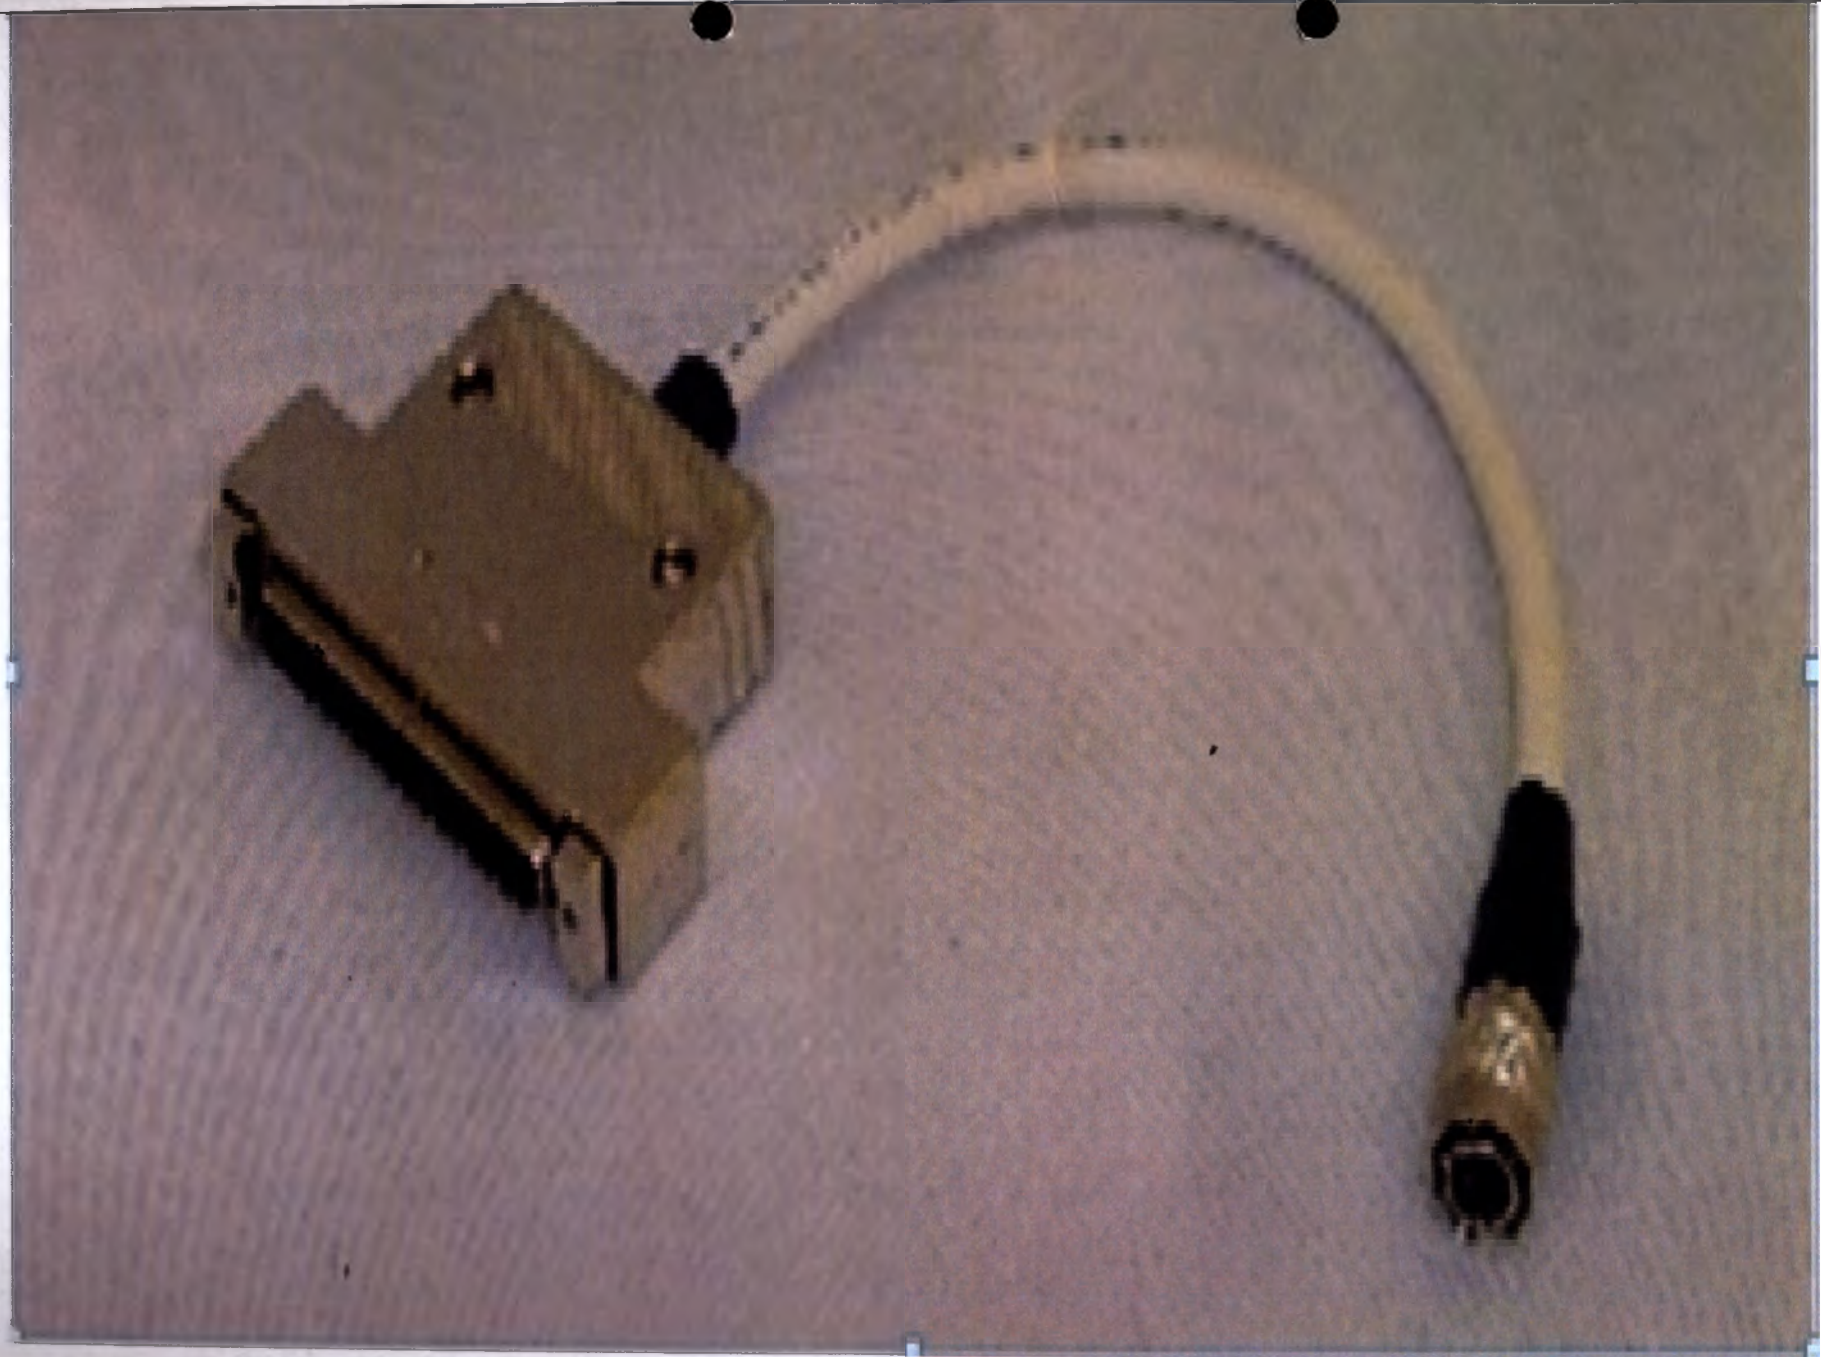

Всего прошито
пронумеровано 52
листов.

А. В. Аснугов

