








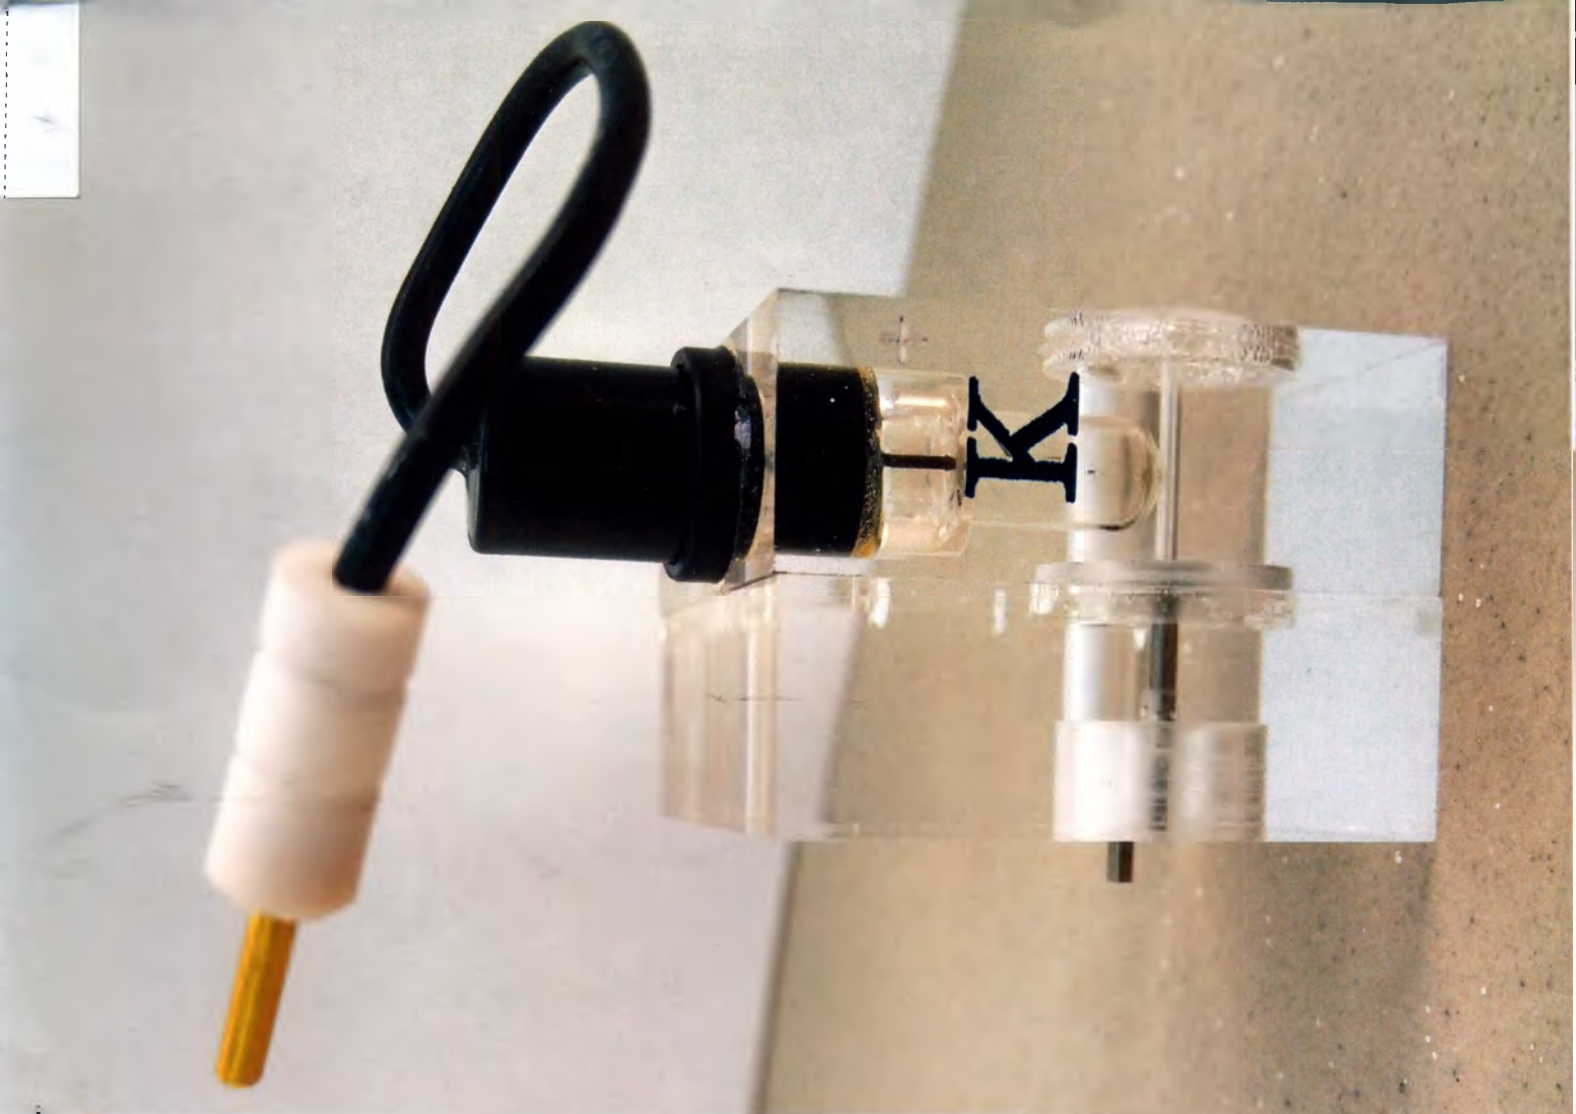



ПРОШИТО 4 ЛИСТОВ



ДИРЕКТОР

/ПОПОВ А.С./

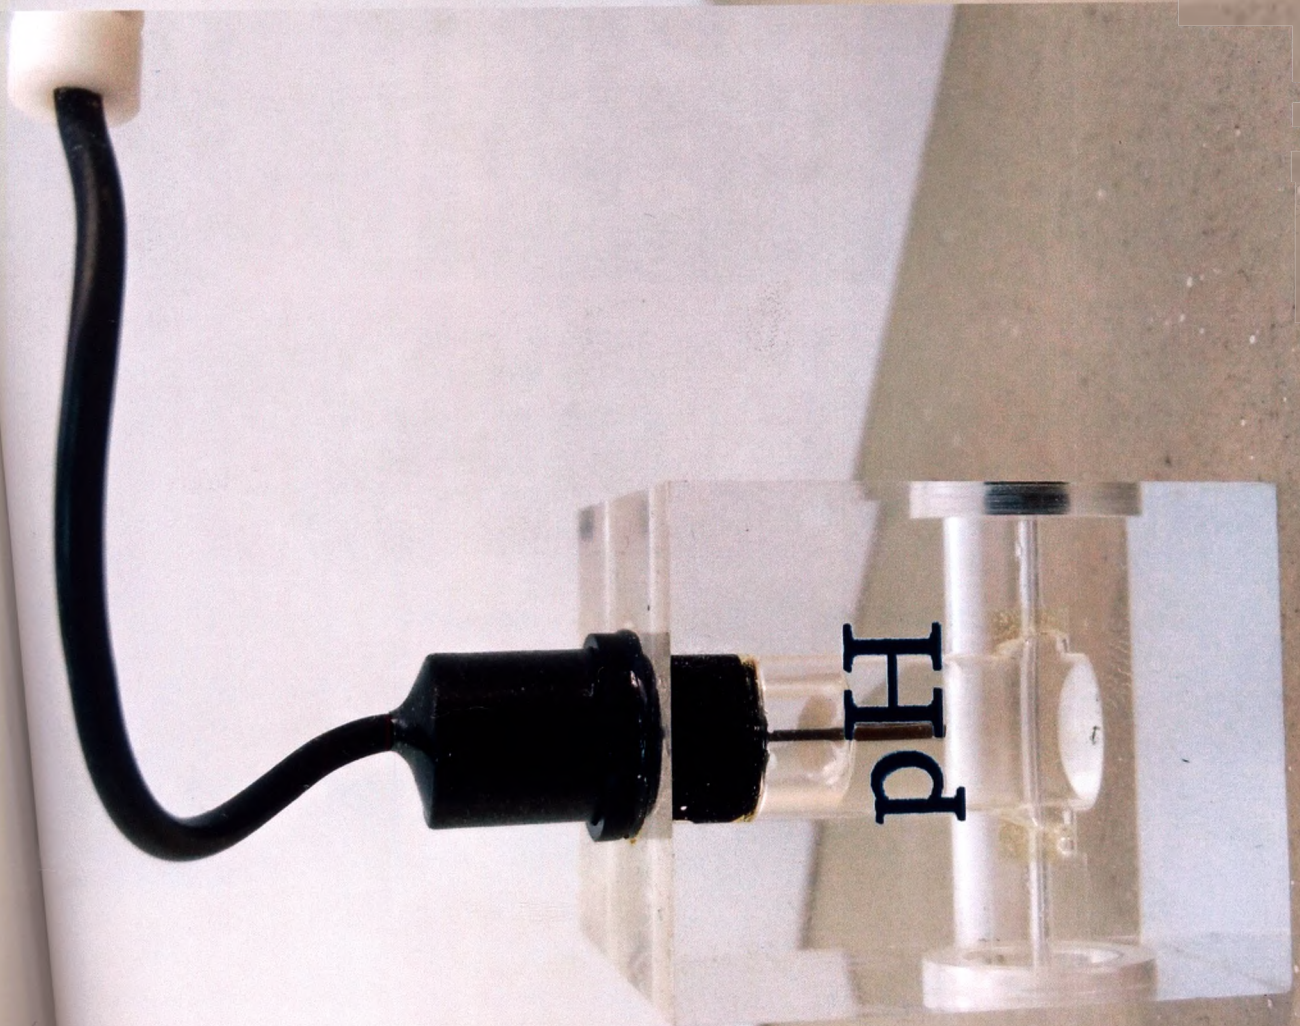

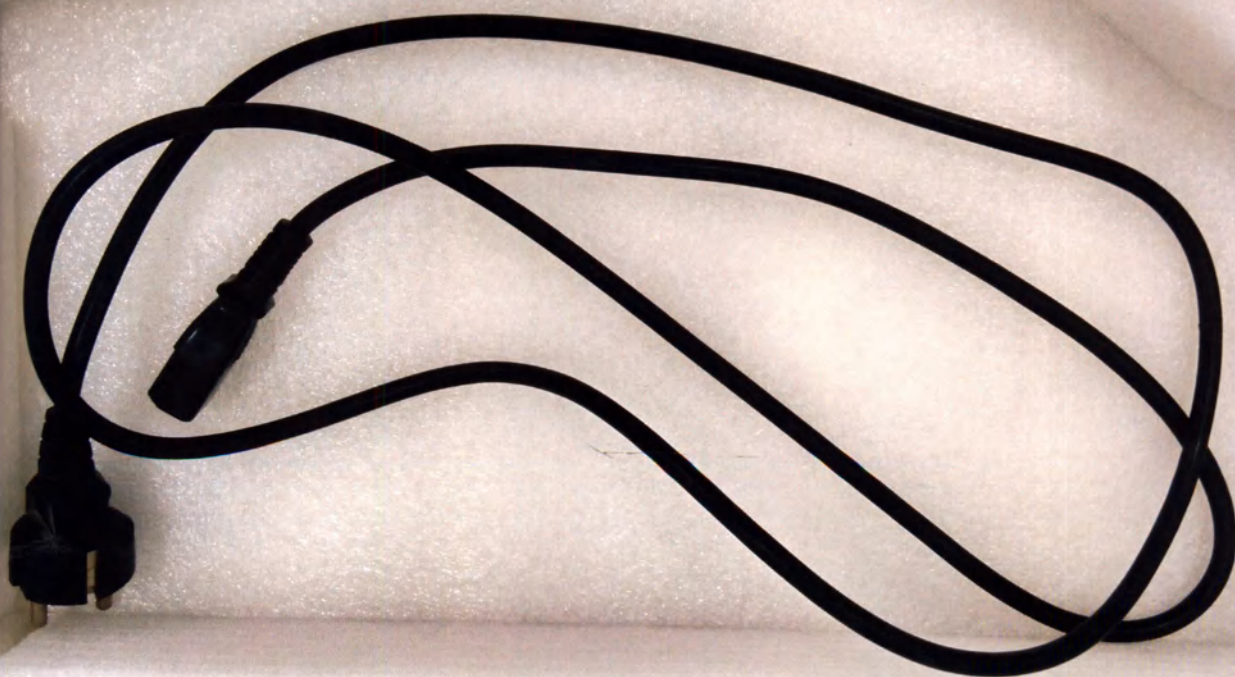

Анализатор электролитов "ТОПАЗ"
с принадлежностями



1572015021001


SN 1572015.02.1.001

Производитель: ООО "ИнТех72",
РФ, г.Тюмень

Дата производства: 04.2016

Технические условия:


ТУ 26.60.12-001-61991513-2016



Отметка ОТК



IP 21



TC-715

Габаритные размеры:
380 x 330 x 410 мм.

Масса: 10 кг.

220 В/50 ГЦ/60 Вт

26.60.12.119

код продукции

УТВЕРЖДАЮ



Директор
ООО «ИнТех72»

А.С. Попов

2016 г.

АНАЛИЗАТОР ЭЛЕКТРОЛИТОВ «ТОПАЗ»

ПО ТУ 26.60.12-001-61991513-2016

С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ

ПАСПОРТ

ИНТХ.941413.001ПС

Имя, № подл.	Подп. и дата	Взам. №	Имя, № дубл.	Подп. и дата

2016

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИнТех72»

ОКПД2 26.60.12.119

УТВЕРЖДАЮ



Директор
ООО «ИнТех72»
А.С. Попов
2017 г.

АНАЛИЗАТОР ЭЛЕКТРОЛИТОВ «ТОПАЗ»

по ТУ 26.60.12-001-61991513-2016

с принадлежностями

Руководство по эксплуатации

ИНТХ.941413.001 РЭ

(версия 1.0)

Тюмень
2017 г.

Имя, № подл.	Подпись и дата	Взам. инт. №	Имя, № дубл.	Подпись и дата



ПРОШИТО 3 ЛИСТОВ



ДИРЕКТОР

/ПОПОВ А.С./



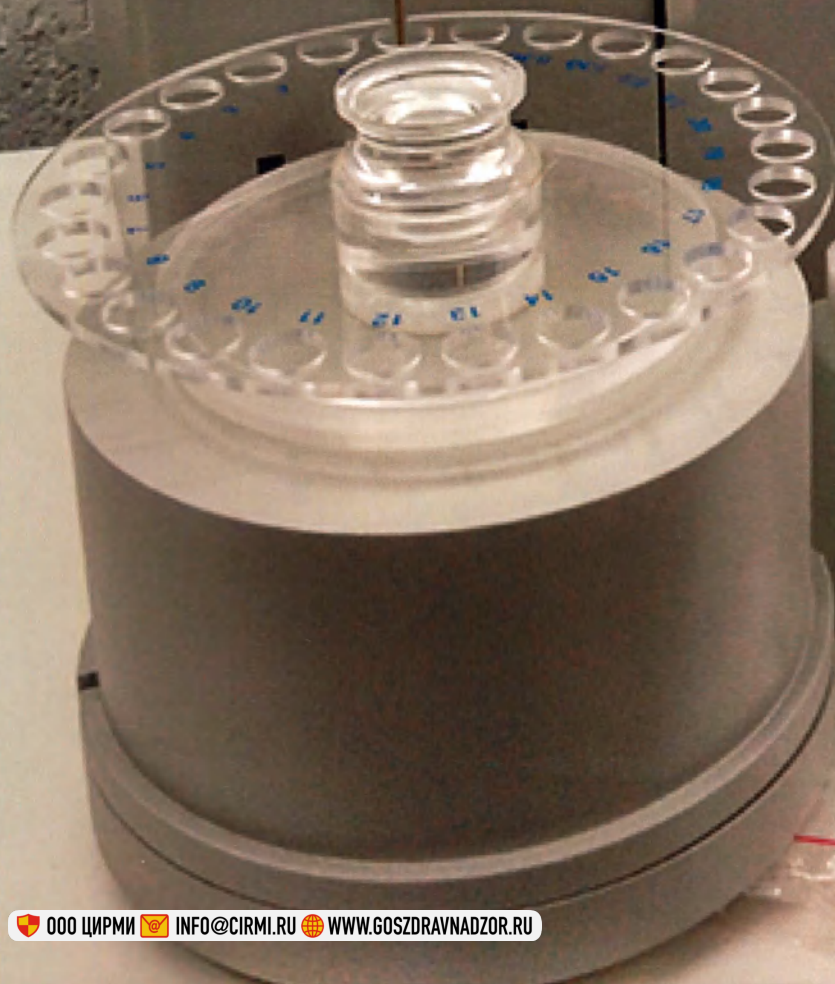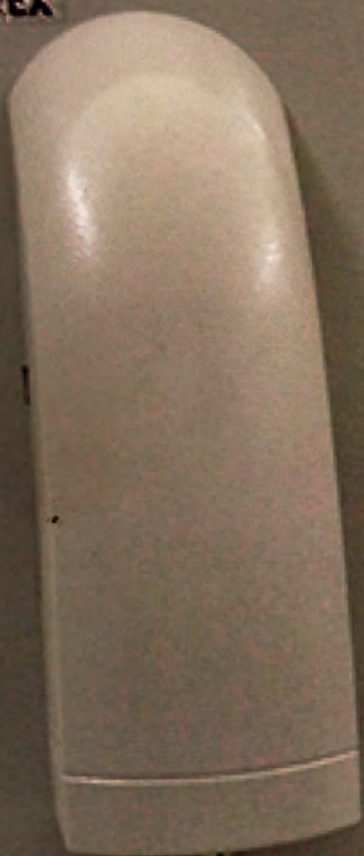

Анализатор электролитов "ТОПАЗ"



1572015021001

ОТК 1

Отметка ОТК

1572015 02 1 001

TC-715

Производитель: ООО "ИнТех72"

РФ, г. Тюмень

Дата производства: 04.2016

Технические условия

ТУ 26.51.53-001-61991513-2016

Габаритные размеры:

380 x 330 x 410 мм

Масса: 10 кг

220 В/50Гц/60 Вт



IP 21



FUS



IVD



2A

250 V



Power Switch





F 2AL250V




RS-232



Barcode

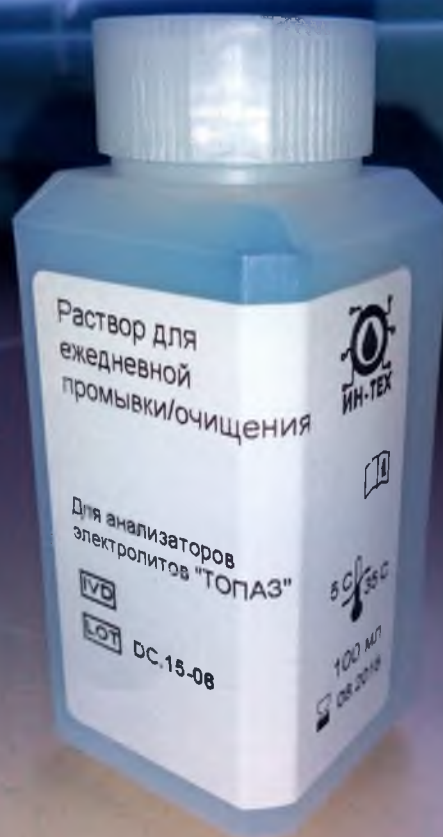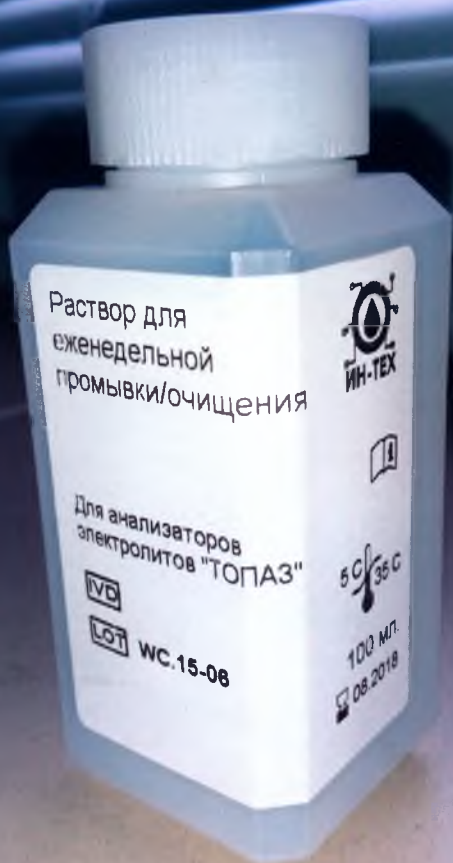

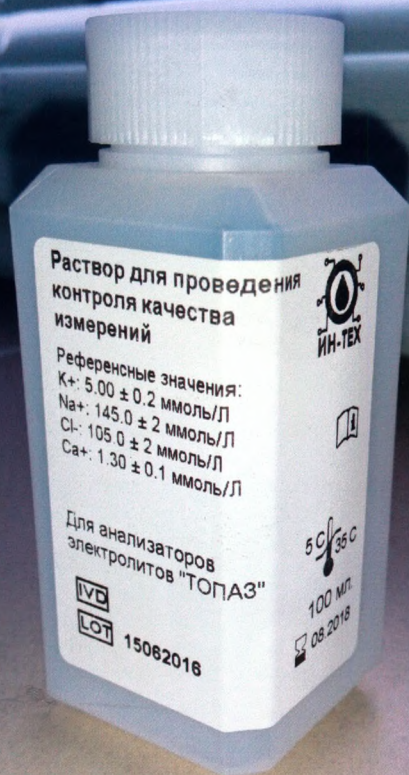



МЕМБРАНЫ

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЕЧКИ

ТРУБКИ НАСОСА

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД

Анализатор электролитов "ТОПАЗ"



1572015021001

ОТК 1

Отметка ОТК



IP 21



SN 1572015.02.1.001 LOT TC-715

Производитель: ООО "ИнТех72",
РФ, г.Тюмень

Дата производства: 04.2016

Технические условия:

ТУ 26.51.53-001-61991513-2016

Габаритные размеры:

380 x 330 x 410 мм.

Масса: 10 кг.

220 В/50 Гц/60 Вт



Блок стандартов

Использовать в течение 90 дней после установки. Перед установкой выдержать в условиях комнатной температуры не менее 1 часа. Срок годности 18 месяцев от даты производства.
НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!

Состав: Стандарт А 650 мЛ, Стандарт Б 350 мЛ, ёмкость для отходов. Концентрации:
Стандарт А: K^+ : 4.00 ммоль/Л, Na^+ : 140.0 ммоль/Л, Cl^- : 100.0 ммоль/Л, Ca^{2+} : 1.0 ммоль/Л
Стандарт Б: K^+ : 8.00 ммоль/Л, Na^+ : 110.0 ммоль/Л, Cl^- : 70.0 ммоль/Л, Ca^{2+} : 2.0 ммоль/Л

REF БС1000-3 LOT Б151116


Для использования с анализаторами серии ТОПА3

ООО "Интех72", Россия, г. Тюмень
ул. Николая Семенова 21

Смотреть инструкцию
к анализатору

Утилизировать согласно
действующим нормативам.

Произведено:
15.11.2016

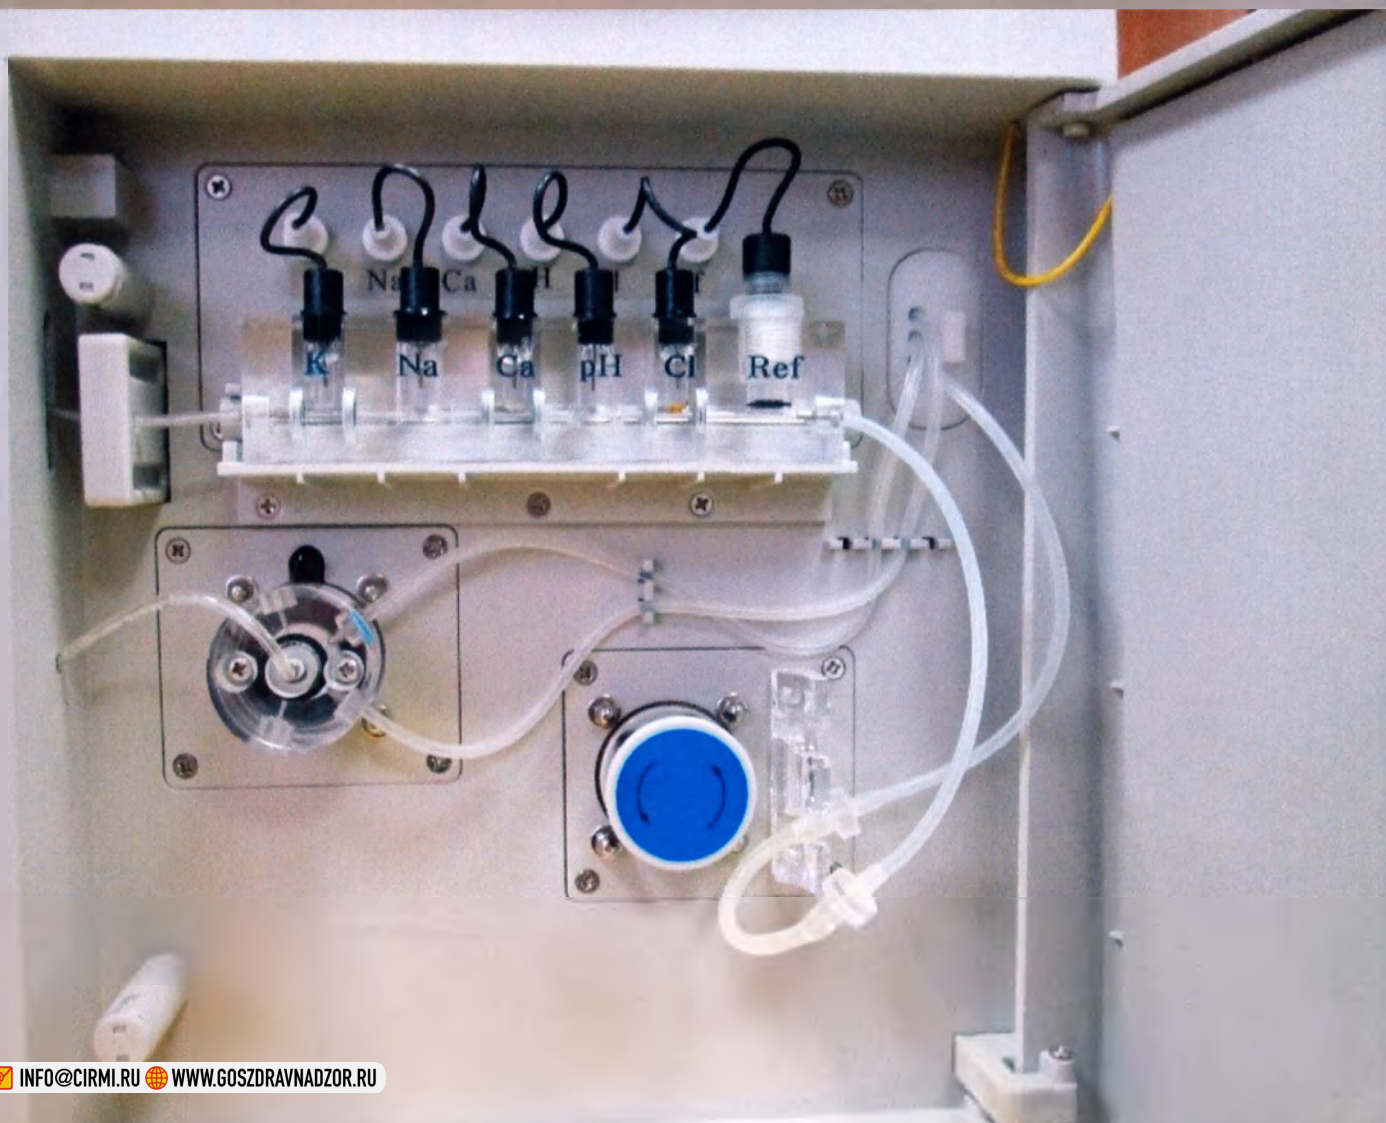



Отправитель: ООО «ИнТех72» 625015 Тюменская обл., Тюмень, ул. Судоремонтная 8-6 Моб.: +79068256505 Производство: ООО «ИнТех72» 625015 Россия, Тюменская обл., Тюмень, ул. Николая Семёнова 21/2		
Получатель:		
Габариты(ШхДхВ)	40х34х430 см	
Вес	ЧИСТО 10 кг	БРУТТО 14.5 кг
Примечание:		





Всего прошнуровано,
пронумеровано, скреплено печатью
10 листов



Директор
ООО "ИнТех72"  Попов А.С.