


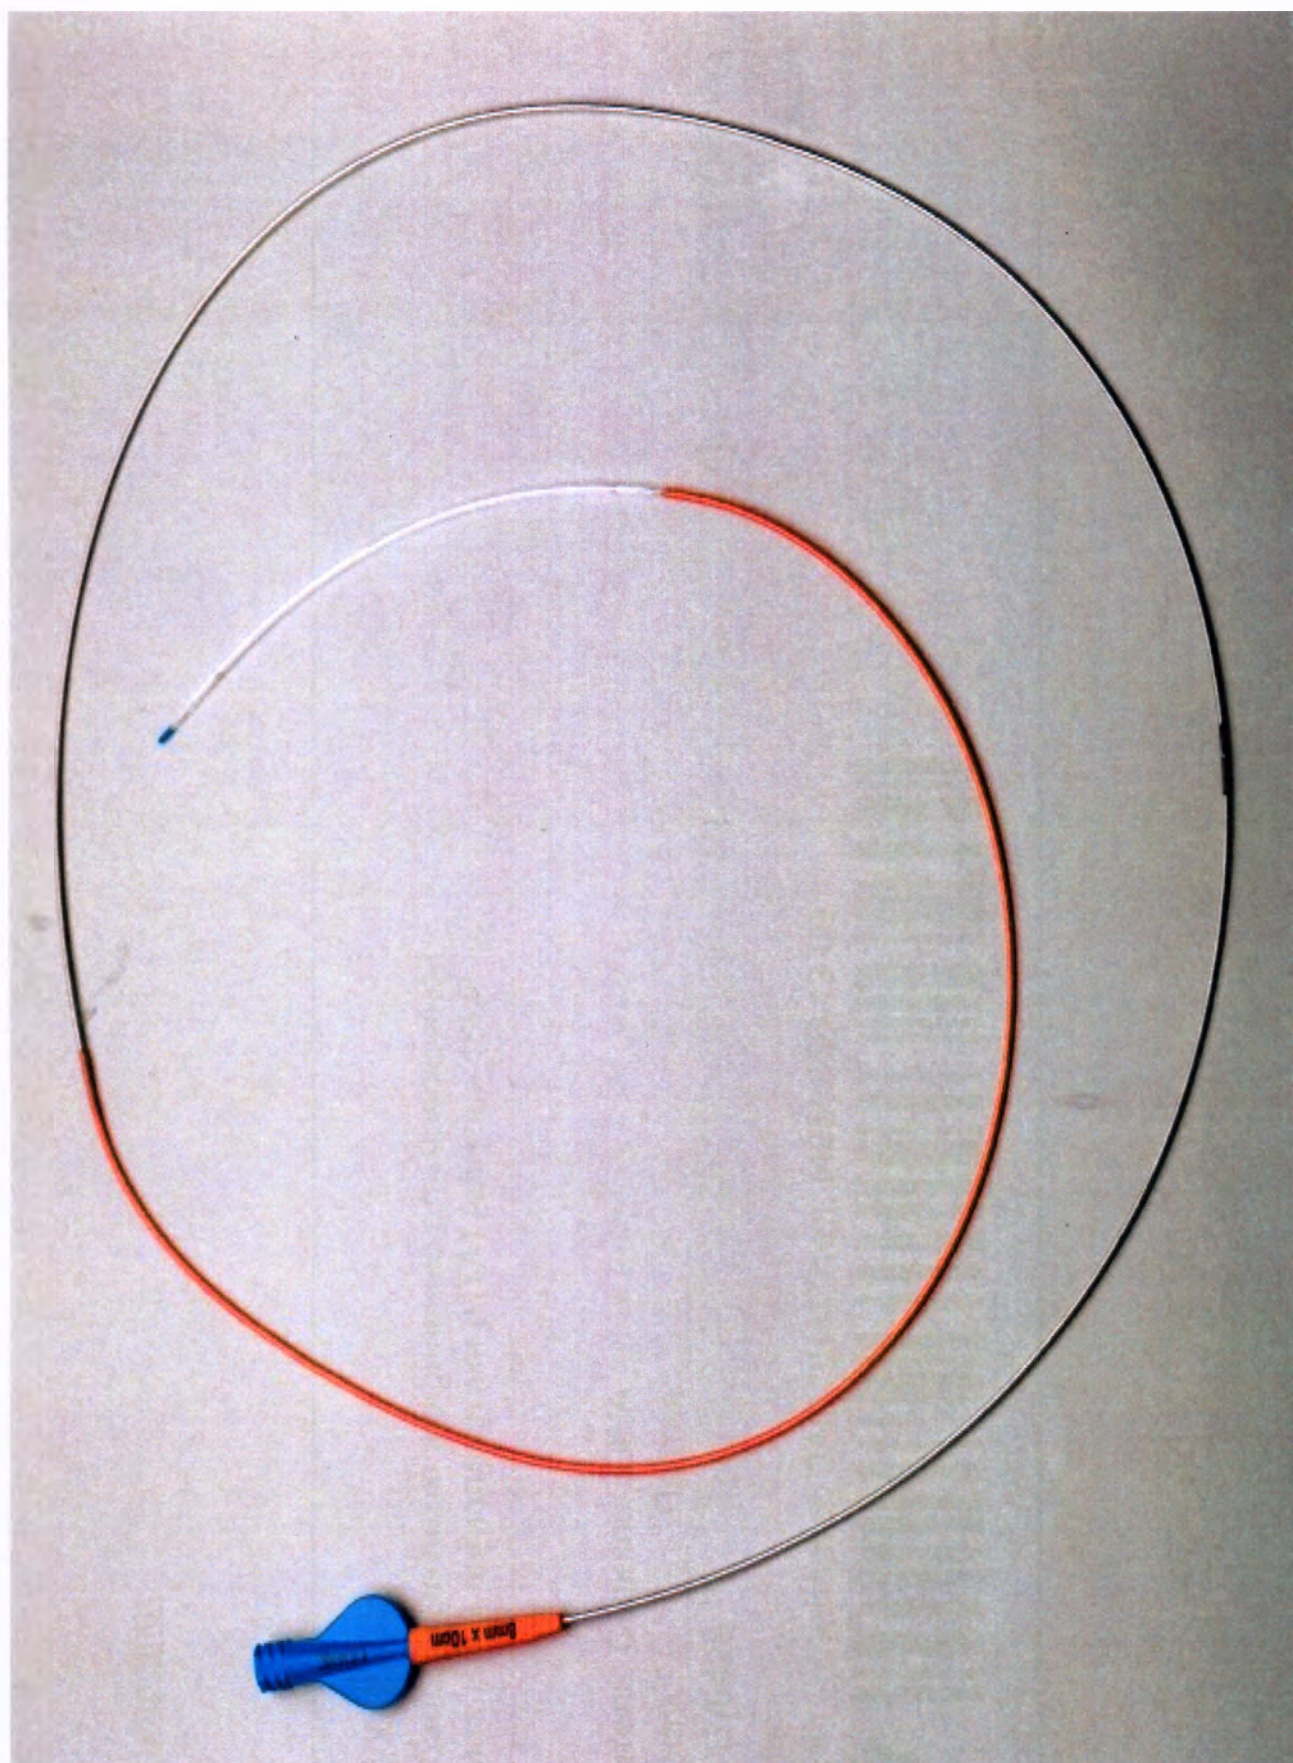

пакет маркировки:

TAX4-XX-XXX-X-X

катетеры баллонные низкопрофильные для чрескожной
транслюминальной ангиопластики (ЧТА) Advance 18LP


Производитель: Cook Inc., США

Срок годности: _____ Партия: _____

Рег.уд.: 2017/5425




Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09

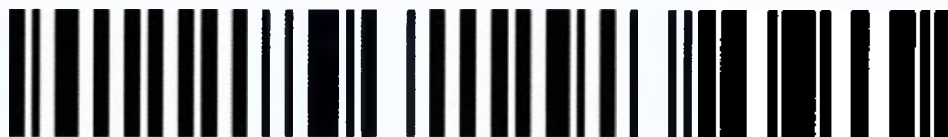

Варианты исполнения:

РТА3-14-150-1.5-2.; РТА3-14-150-1.5-4.; РТА3-14-150-2.5-10; РТА3-14-150-2.5-12.; РТА3-14-150-2.5-2.; РТА3-14-150-2.5-3.; РТА3-14-150-2.5-4.; РТА3-14-150-2.5-6.; РТА3-14-150-2.5-8.; РТА3-14-150-2-10.; РТА3-14-150-2-12.; РТА3-14-150-2-2.; РТА3-14-150-2-3.; РТА3-14-150-2-4.; РТА3-14-150-2-6.; РТА3-14-150-2-8.; РТА3-14-150-3-10; РТА3-14-150-3-12.; РТА3-14-150-3-2.; РТА3-14-150-3-3.; РТА3-14-150-3-4.; РТА3-14-150-3-6.; РТА3-14-150-3-8.; РТА3-14-50-1.5-2.; РТА3-14-50-1.5-4.; РТА3-14-50-2.5-10; РТА3-14-50-2.5-12.; РТА3-14-50-2.5-2.; РТА3-14-50-2.5-3.; РТА3-14-50-2.5-4.; РТА3-14-50-2.5-6.; РТА3-14-50-2.5-8.; РТА3-14-50-2-10.; РТА3-14-50-2-12.; РТА3-14-50-2-2.; РТА3-14-50-2-3.; РТА3-14-50-2-4.; РТА3-14-50-2-6.; РТА3-14-50-2-8.; РТА3-14-50-3-10.; РТА3-14-50-3-12.; РТА3-14-50-3-2.; РТА3-14-50-3-3.; РТА3-14-50-3-4.; РТА3-14-50-3-6.; РТА3-14-50-3-8.; РТА3-14-90-1.5-2.; РТА3-14-90-1.5-4.; РТА3-14-90-2.5-10; РТА3-14-90-2.5-12.; РТА3-14-90-2.5-2.; РТА3-14-90-2.5-3.; РТА3-14-90-2.5-4.; РТА3-14-90-2.5-6.; РТА3-14-90-2.5-8.; РТА3-14-90-2-10.; РТА3-14-90-2-12.; РТА3-14-90-2-2.; РТА3-14-90-2-3.; РТА3-14-90-2-4.; РТА3-14-90-2-6.; РТА3-14-90-2-8.; РТА3-14-90-3-10; РТА3-14-90-3-12.; РТА3-14-90-3-2.; РТА3-14-90-3-3.; РТА3-14-90-3-4.; РТА3-14-90-3-6.; РТА3-14-90-3-8.

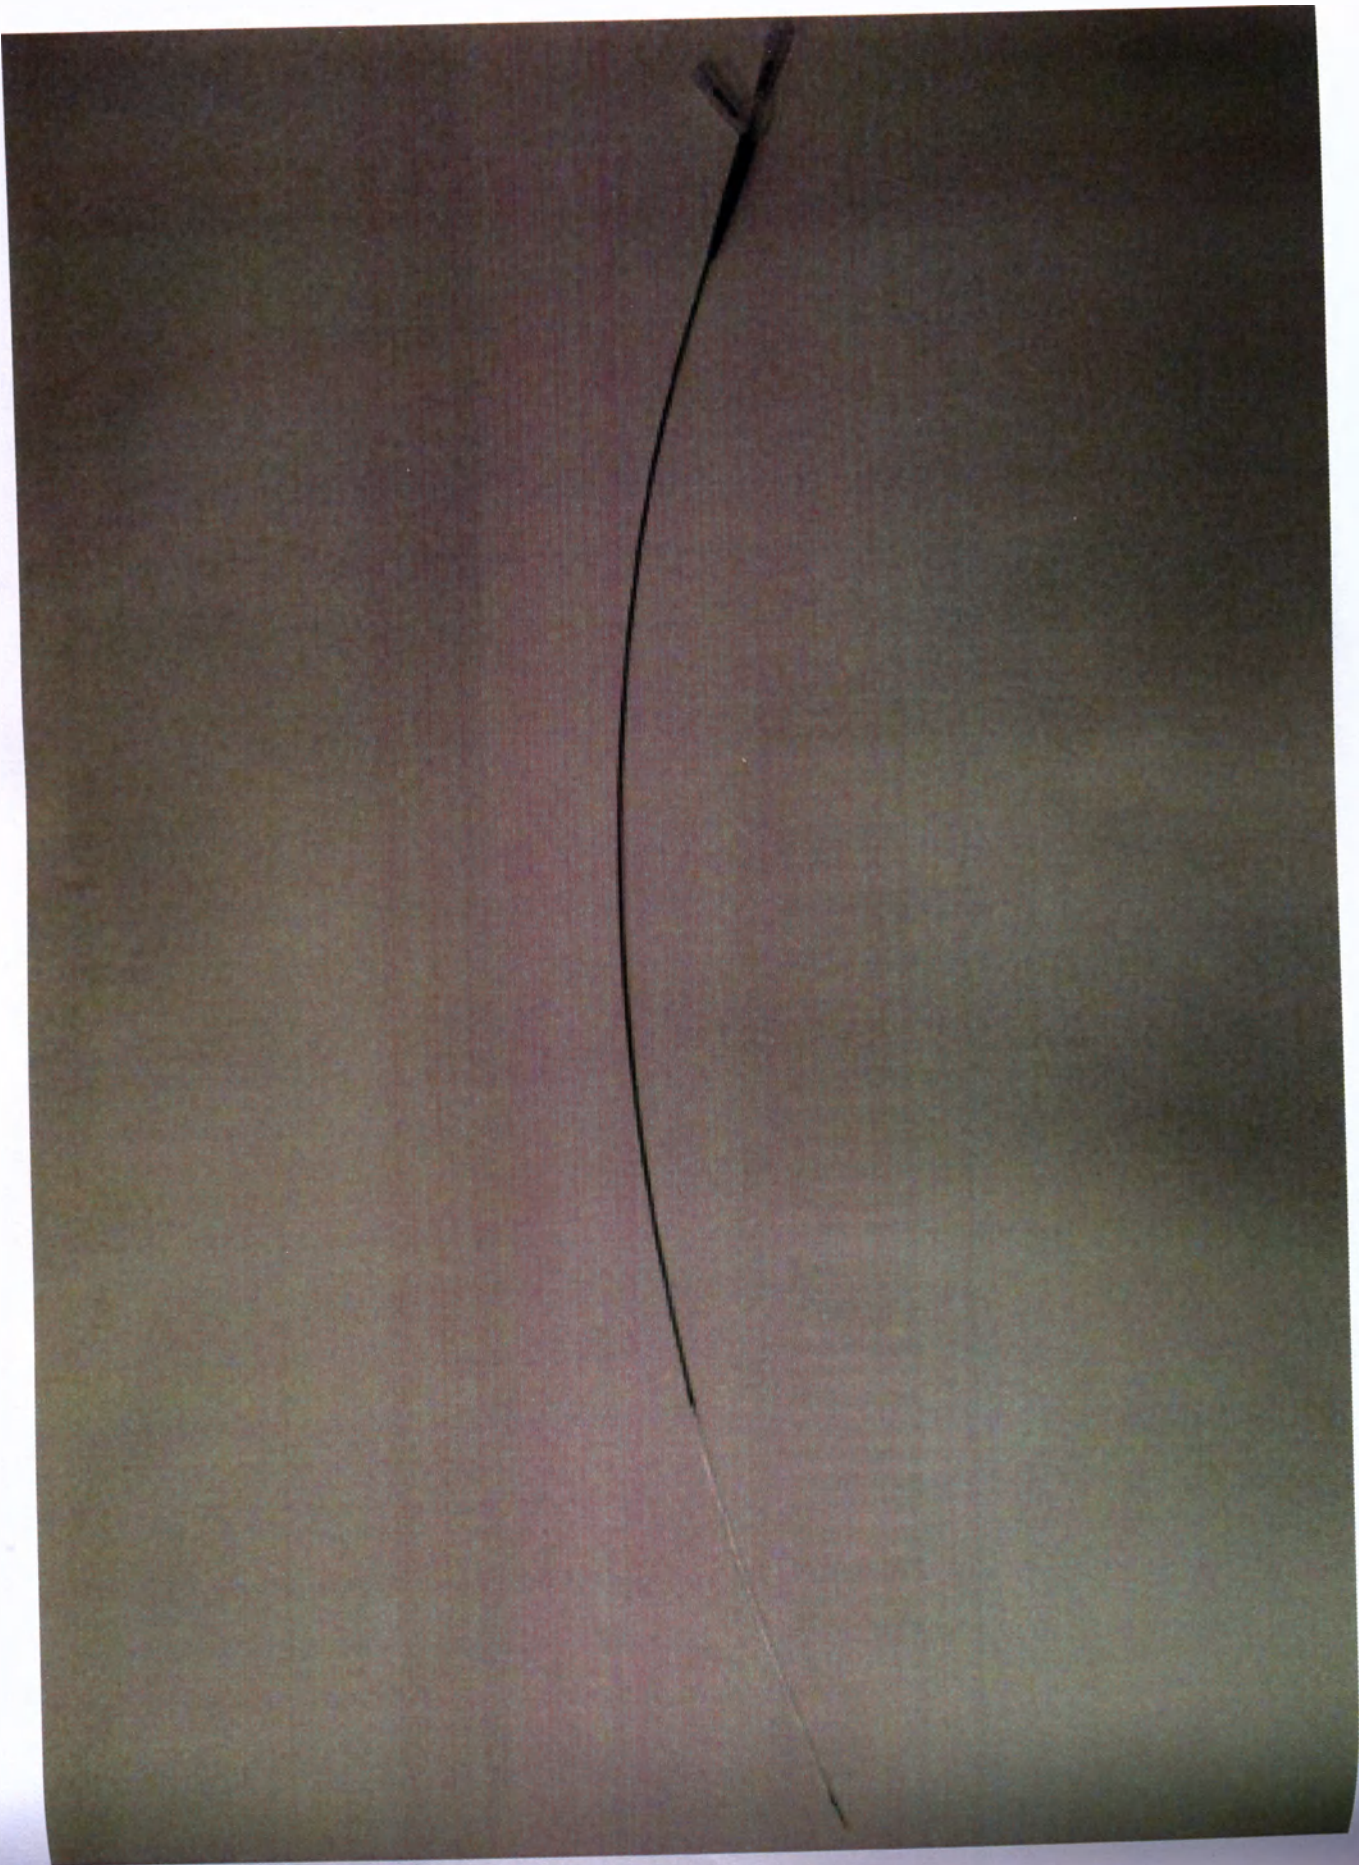

Макет маркировки:

РТА3-XX-XXX-XX-X

Катетеры баллонные ультра низкопрофильные для чрескожной
транслюминальной ангиопластики (ЧТА) Advance Micro 14

Производитель: Cook Inc., США

Срок годности: _____ Партия: _____

Рег.уд.: 2017/5425




Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



Варианты исполнения:

PTAX4-14-170-2.5-12.;PTAX4-14-170-2.5-16.;PTAX4-14-170-2.5-2.;PTAX4-14-170-2.5-20.;PTAX4-14-170-2.5-4.;PTAX4-14-170-2.5-6.; PTAX4-14-170-2.5-8.;PTAX4-14-170-2-12.;PTAX4-14-170-2-16.;PTAX4-14-170-2-2.;PTAX4-14-170-2-20.;PTAX4-14-170-2-4.;PTAX4-14-170-2-6.; PTAX4-14-170-2-8.;PTAX4-14-170-3-12.;PTAX4-14-170-3-16.;PTAX4-14-170-3-2.;PTAX4-14-170-3-20.;PTAX4-14-170-3-4.;PTAX4-14-170-3-6.; PTAX4-14-170-3-8.;PTAX4-14-170-4-12.;PTAX4-14-170-4-16.;PTAX4-14-170-4-2.;PTAX4-14-170-4-20.;PTAX4-14-170-4-4.;PTAX4-14-170-4-6.; PTAX4-14-170-4-8.;PTAX4-14-110-2-2.;PTAX4-14-110-2-4.;PTAX4-14-110-2-6.;PTAX4-14-110-2-8.; PTAX4-14-110-2-12.;PTAX4-14-110-2-16.; PTAX4-14-110-2-20.;PTAX4-14-110-2.5-2.;PTAX4-14-110-2.5-4.;PTAX4-14-110-2.5-6.;PTAX4-14-110-2.5-8.;PTAX4-14-110-2.5-12.; PTAX4-14-110-2.5-16.; PTAX4-14-110-2.5-20.;PTAX4-14-110-3-2.;PTAX4-14-110-3-4.;PTAX4-14-110-3-6.; PTAX4-14-110-3-8.; PTAX4-14-110-3-12.; PTAX4-14-110-3-16.;PTAX4-14-110-3-20.;PTAX4-14-110-4-2.;PTAX4-14-110-4-4.;PTAX4-14-110-4-6.; PTAX4-14-110-4-8.; PTAX4-14-110-4-12.; PTAX4-14-110-4-16.;PTAX4-14-110-4-20.

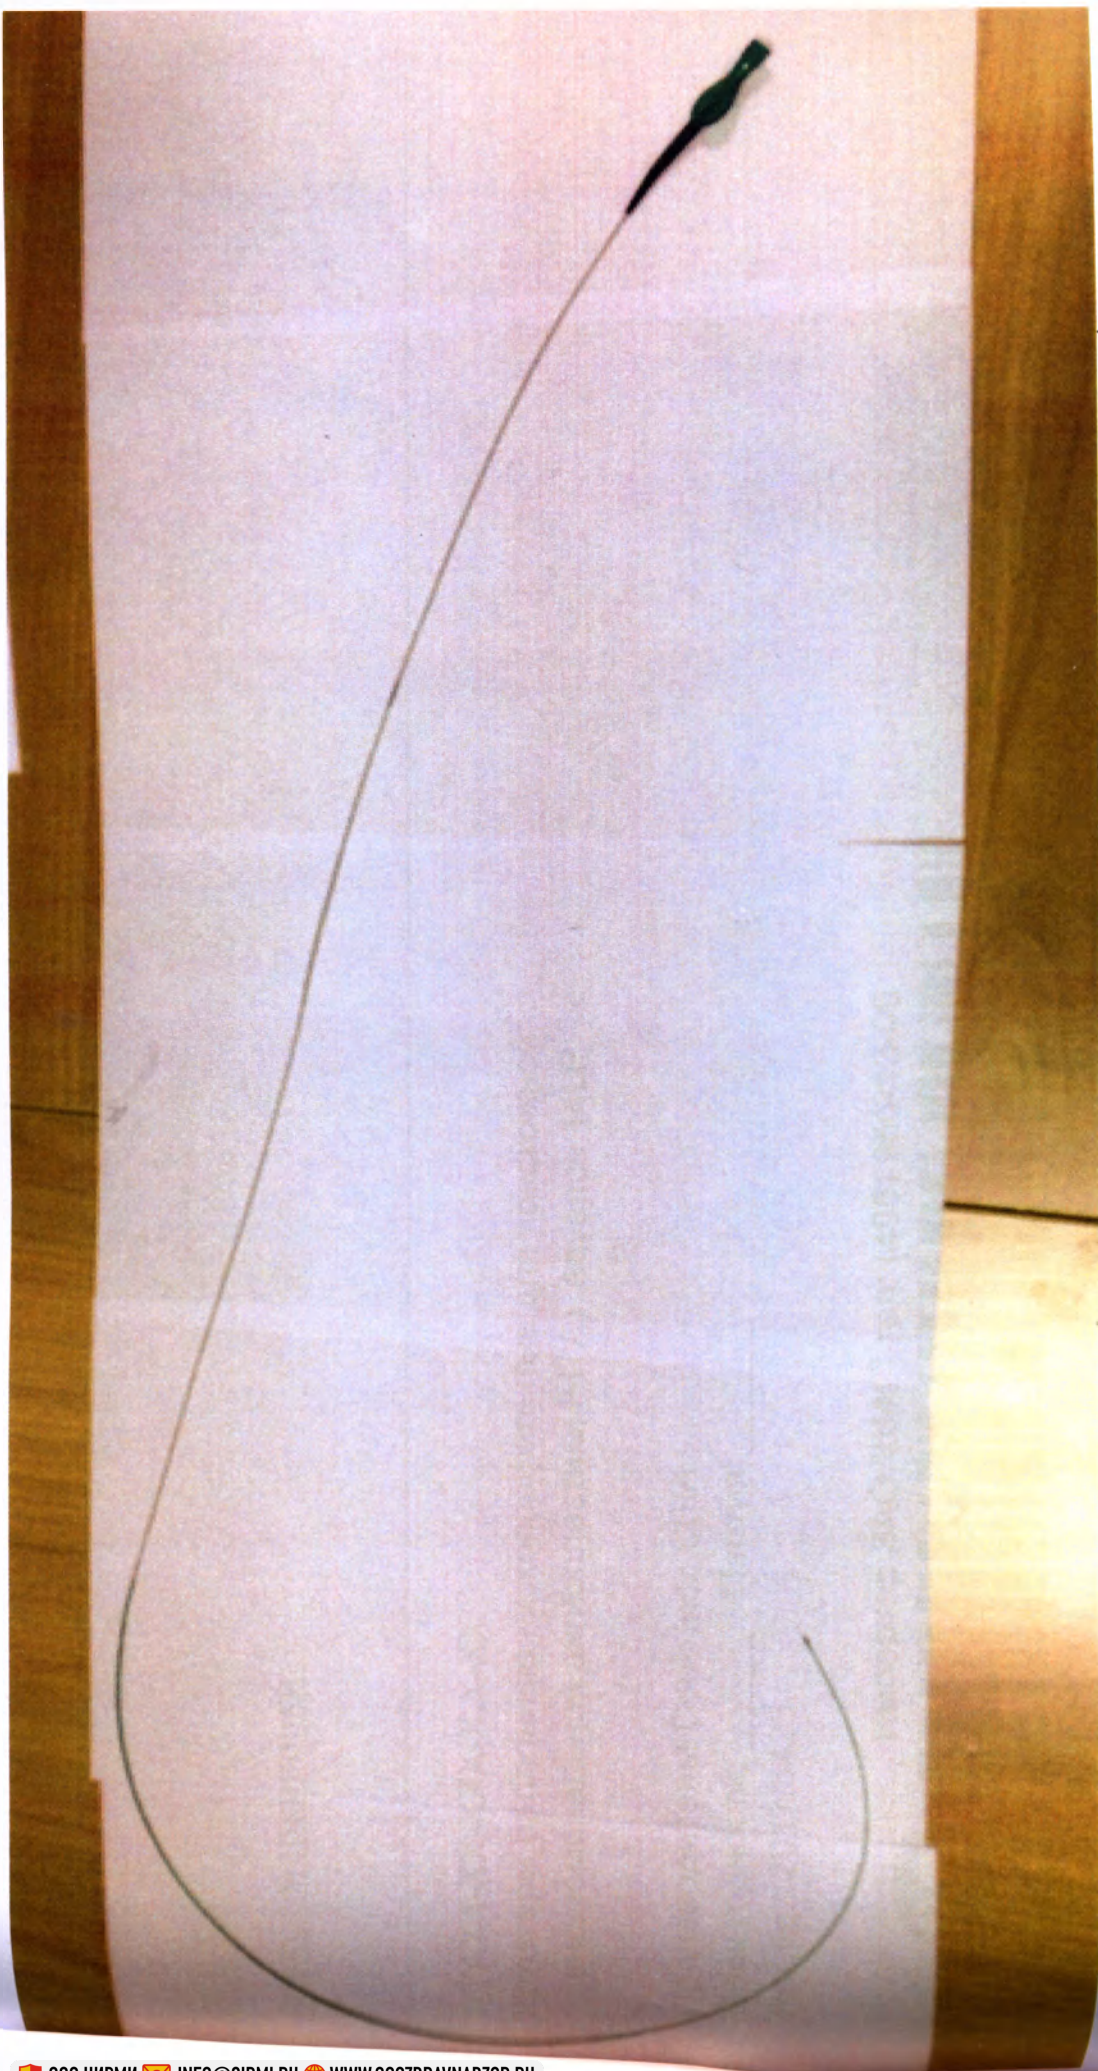

Макет маркировки:

РТАХ4-XX-XXX-X.X-XX

Катетеры баллонные низкопрофильные для чрескожной
транслюминальной ангиопластики (ЧТА) Advance 14LP

Производитель: Cook Inc., США

Срок годности: _____ Партия: _____

Рег.уд.: 2017/5425




Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



Катетеры баллонные низкопрофильные для чрескожной транслюминальной ангиопластики (ЧТА) Advance 35LP:

Варианты исполнения: РТА5-35-135-10-10.0; РТА5-35-135-10-12.0; РТА5-35-135-10-14.0; РТА5-35-135-10-3.0; РТА5-35-135-10-6.0; РТА5-35-135-10-8.0; РТА5-35-135-12-10.0; РТА5-35-135-12-12.0; РТА5-35-135-12-14.0; РТА5-35-135-12-8.0; РТА5-35-135-3-10.0; РТА5-35-135-3-12.0; РТА5-35-135-3-14.0; РТА5-35-135-3-2.0; РТА5-35-135-3-4.0; РТА5-35-135-3-8.0; РТА5-35-135-4-10.0; РТА5-35-135-4-12.0; РТА5-35-135-4-14.0; РТА5-35-135-4-2.0; РТА5-35-135-4-4.0; РТА5-35-135-4-8.0; РТА5-35-135-5-10.0; РТА5-35-135-5-12.0; РТА5-35-135-5-14.0; РТА5-35-135-5-2.0; РТА5-35-135-5-4.0; РТА5-35-135-5-6.0; РТА5-35-135-5-8.0; РТА5-35-135-6-10.0; РТА5-35-135-6-12.0; РТА5-35-135-6-14.0; РТА5-35-135-6-2.0; РТА5-35-135-6-4.0; РТА5-35-135-6-6.0; РТА5-35-135-6-8.0; РТА5-35-135-7-10.0; РТА5-35-135-7-12.0; РТА5-35-135-7-14.0; РТА5-35-135-7-2.0; РТА5-35-135-7-4.0; РТА5-35-135-7-6.0; РТА5-35-135-7-8.0; РТА5-35-135-8-10.0; РТА5-35-135-8-12.0; РТА5-35-135-8-14.0; РТА5-35-135-8-2.0; РТА5-35-135-8-4.0; РТА5-35-135-8-6.0; РТА5-35-135-8-8.0; РТА5-35-135-9-10.0; РТА5-35-135-9-12.0; РТА5-35-135-9-14.0; РТА5-35-135-9-3.0; РТА5-35-135-9-4.0; РТА5-35-135-9-6.0; РТА5-35-135-9-8.0; РТА5-35-80-10-10.0; РТА5-35-80-10-12.0; РТА5-35-80-10-14.0; РТА5-35-80-10-3.0; РТА5-35-80-10-4.0; РТА5-35-80-10-6.0; РТА5-35-80-10-8.0; РТА5-35-80-12-10.0; РТА5-35-80-12-12.0; РТА5-35-80-12-14.0; РТА5-35-80-12-4.0; РТА5-35-80-12-8.0; РТА5-35-80-3-10.0; РТА5-35-80-3-12.0; РТА5-35-80-3-14.0; РТА5-35-80-3-2.0; РТА5-35-80-3-4.0; РТА5-35-80-3-8.0; РТА5-35-80-4-10.0; РТА5-35-80-4-12.0; РТА5-35-80-4-14.0; РТА5-35-80-4-2.0; РТА5-35-80-4-4.0; РТА5-35-80-4-8.0; РТА5-35-80-5-10.0; РТА5-35-80-5-12.0; РТА5-35-80-5-14.0; РТА5-35-80-5-2.0; РТА5-35-80-5-4.0; РТА5-35-80-5-6.0; РТА5-35-80-5-8.0; РТА5-35-80-6-10.0; РТА5-35-80-6-12.0; РТА5-35-80-6-14.0; РТА5-35-80-6-2.0; РТА5-35-80-6-4.0; РТА5-35-80-6-6.0; РТА5-35-80-6-8.0; РТА5-35-80-7-10.0; РТА5-35-80-7-12.0; РТА5-35-80-7-14.0; РТА5-35-80-7-2.0; РТА5-35-80-7-4.0; РТА5-35-80-7-6.0; РТА5-35-80-7-8.0; РТА5-35-80-8-10.0; РТА5-35-80-8-12.0; РТА5-35-80-8-14.0; РТА5-35-80-8-2.0; РТА5-35-80-8-4.0; РТА5-35-80-8-6.0; РТА5-35-80-8-8.0; РТА5-35-80-9-10.0; РТА5-35-80-9-12.0; РТА5-35-80-9-14.0; РТА5-35-80-9-3.0; РТА5-35-80-9-4.0; РТА5-35-80-9-6.0; РТА5-35-80-9-8.0; РТА5-35-135-3-6.0; РТА5-35-135-3-17.0; РТА5-35-135-4-6.0; РТА5-35-135-4-17.0; РТА5-35-135-4-20.0; РТА5-35-135-5-17.0; РТА5-35-135-5-20.0; РТА5-35-135-10-2.0; РТА5-35-135-12-2.0; РТА5-35-135-6-17.0; РТА5-35-135-6-20.0; РТА5-35-135-7-17.0; РТА5-35-135-7-20.0; РТА5-35-135-9-2.0; РТА5-35-80-10-2.0; РТА5-35-80-3-6.0; РТА5-35-80-4-17.0; РТА5-35-80-5-17.0; РТА5-35-80-5-20.0; РТА5-35-80-6-17.0; РТА5-35-80-6-20.0; РТА5-35-80-7-17.0; РТА5-35-80-7-20.0; РТА5-35-80-9-2.0

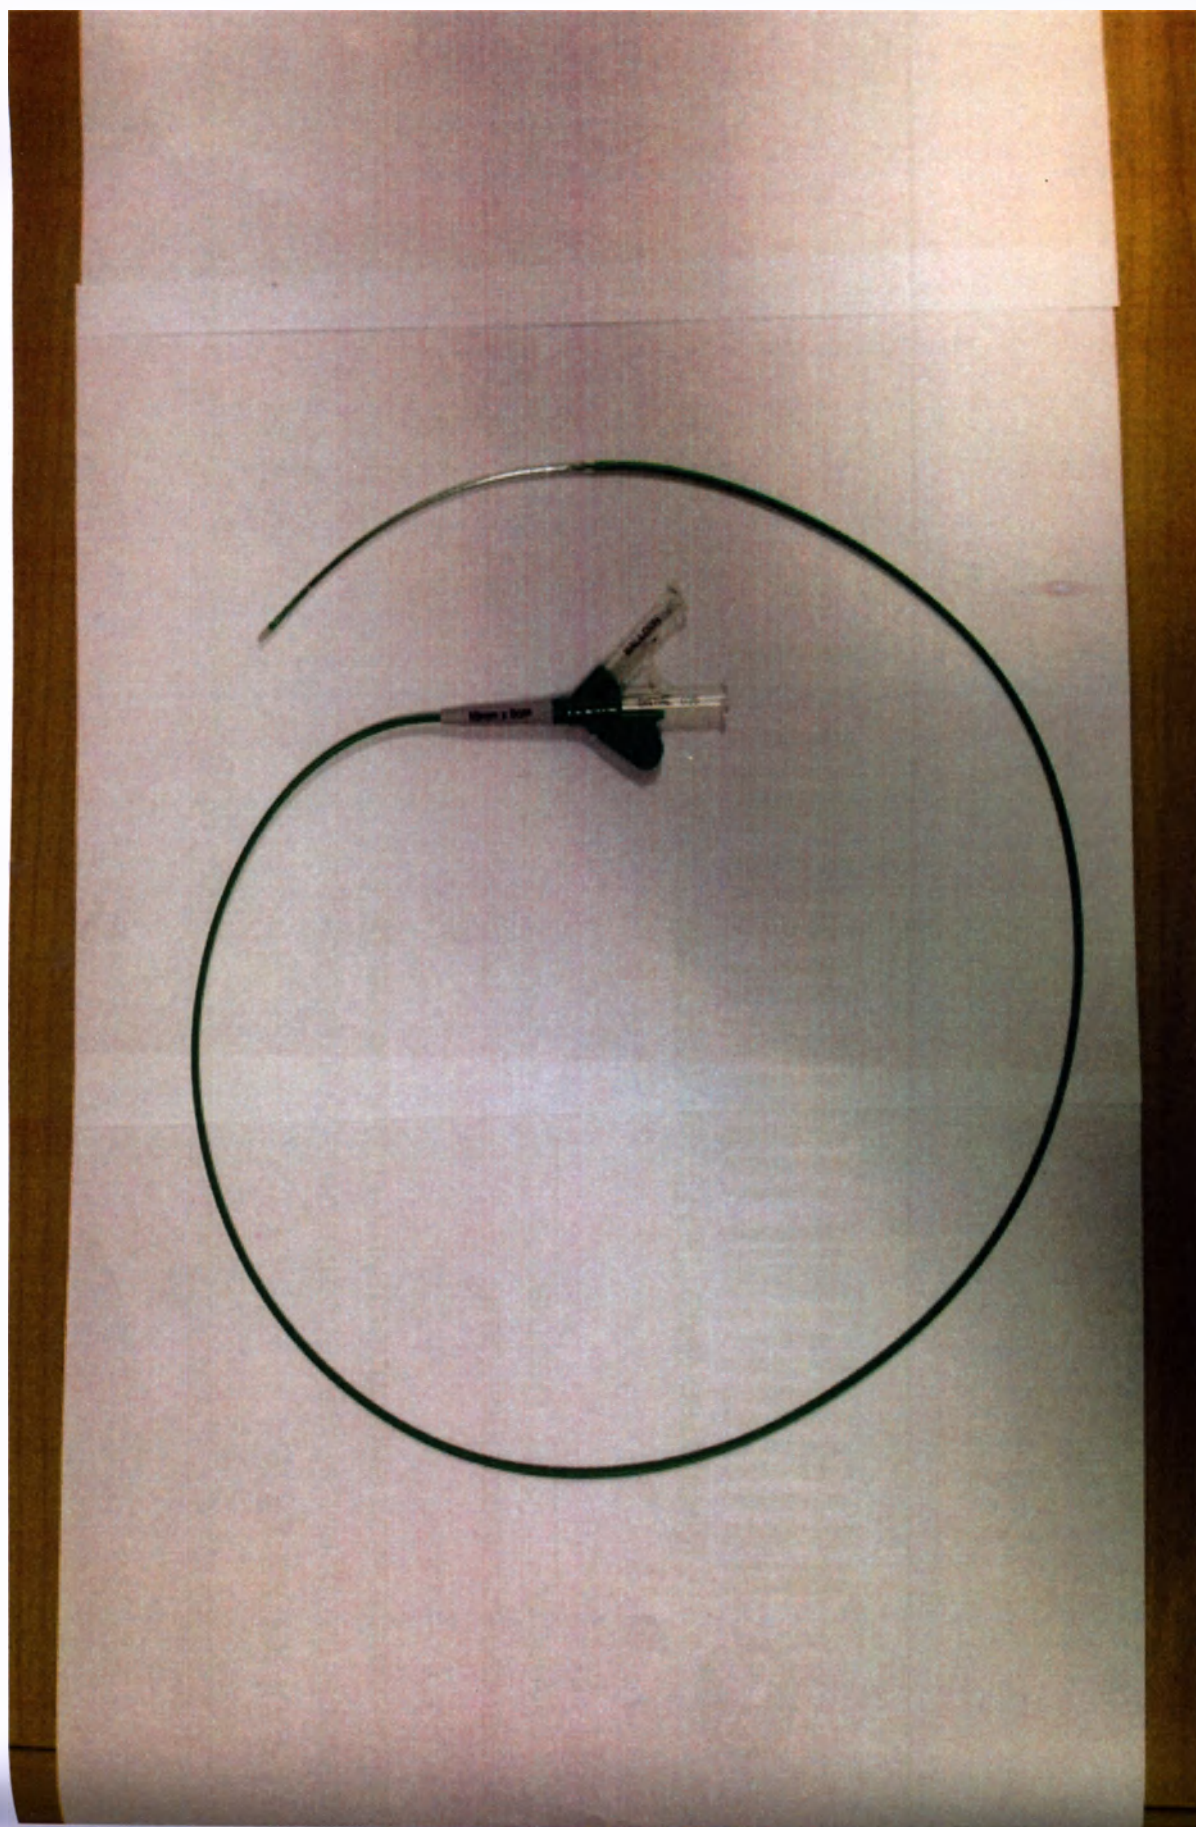

Макет маркировки:

РТА5-XX-XX-XX-XX.X

Катетеры баллонные низкопрофильные для чрескожной
транслюминальной ангиопластики (ЧТА) Advance 35LP

Производитель: Cook Inc., США

Срок годности: _____ Партия: _____

Рег.уд.: 2017/5425




Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



катетеры баллонные для чрезкожной транспюмinalьной ангиопластики (ЧТА) АТВ Advance

варианты исполнения:

АТВ5-35-120-10-3.0.;АТВ5-35-120-10-4.0.;АТВ5-35-120-10-6.0.;АТВ5-35-120-10-8.0.;АТВ5-35-120-12-4.0.;АТВ5-35-120-14-2.0.;АТВ5-35-120-4-2.0.;АТВ5-35-120-4-3.0.;АТВ5-35-120-4-4.0.;АТВ5-35-120-4-6.0.;АТВ5-35-120-4-8.0.;АТВ5-35-120-5-2.0.;АТВ5-35-120-5-3.0.;АТВ5-35-120-5-4.0.;АТВ5-35-120-5-6.0.;АТВ5-35-120-5-8.0.;АТВ5-35-120-6-2.0.;АТВ5-35-120-6-3.0.;АТВ5-35-120-6-4.0.;АТВ5-35-120-6-6.0.;АТВ5-35-120-6-8.0.;АТВ5-35-120-7-2.0.;АТВ5-35-120-7-3.0.;АТВ5-35-120-7-4.0.;АТВ5-35-120-7-6.0.;АТВ5-35-120-7-8.0.;АТВ5-35-120-8-2.0.;АТВ5-35-120-8-3.0.;АТВ5-35-120-8-4.0.;АТВ5-35-120-8-6.0.;АТВ5-35-120-8-8.0.;АТВ5-35-120-9-2.0.;АТВ5-35-120-9-4.0.;АТВ5-35-120-9-6.0.;АТВ5-35-120-9-8.0.;АТВ5-35-40-10-2.0.;АТВ5-35-40-10-3.0.;АТВ5-35-40-10-4.0.;АТВ5-35-40-10-6.0.;АТВ5-35-40-12-4.0.;АТВ5-35-40-14-4.0.;АТВ5-35-40-4-2.0.;АТВ5-35-40-4-3.0.;АТВ5-35-40-4-4.0.;АТВ5-35-40-4-6.0.;АТВ5-35-40-4-8.0.;АТВ5-35-40-5-2.0.;АТВ5-35-40-5-3.0.;АТВ5-35-40-5-4.0.;АТВ5-35-40-5-6.0.;АТВ5-35-40-5-8.0.;АТВ5-35-40-6-2.0.;АТВ5-35-40-6-3.0.;АТВ5-35-40-6-4.0.;АТВ5-35-40-6-6.0.;АТВ5-35-40-6-8.0.;АТВ5-35-40-7-2.0.;АТВ5-35-40-7-3.0.;АТВ5-35-40-7-4.0.;АТВ5-35-40-7-6.0.;АТВ5-35-40-7-8.0.;АТВ5-35-40-8-2.0.;АТВ5-35-40-8-3.0.;АТВ5-35-40-8-4.0.;АТВ5-35-40-8-6.0.;АТВ5-35-40-8-8.0.;АТВ5-35-40-9-2.0.;АТВ5-35-40-9-4.0.;АТВ5-35-40-9-6.0.;АТВ5-35-40-9-8.0.;АТВ5-35-80-10-2.0.;АТВ5-35-80-10-3.0.;АТВ5-35-80-10-4.0.;АТВ5-35-80-10-6.0.;АТВ5-35-80-12-4.0.;АТВ5-35-80-14-2.0.;АТВ5-35-80-14-4.0.;АТВ5-35-80-4-2.0.;АТВ5-35-80-4-3.0.;АТВ5-35-80-4-4.0.;АТВ5-35-80-4-6.0.;АТВ5-35-80-4-8.0.;АТВ5-35-80-5-2.0.;АТВ5-35-80-5-3.0.;АТВ5-35-80-5-4.0.;АТВ5-35-80-5-6.0.;АТВ5-35-80-5-8.0.;АТВ5-35-80-6-2.0.;АТВ5-35-80-6-3.0.;АТВ5-35-80-6-4.0.;АТВ5-35-80-6-6.0.;АТВ5-35-80-6-8.0.;АТВ5-35-80-7-2.0.;АТВ5-35-80-7-3.0.;АТВ5-35-80-7-4.0.;АТВ5-35-80-7-6.0.;АТВ5-35-80-7-8.0.;АТВ5-35-80-8-2.0.;АТВ5-35-80-8-3.0.;АТВ5-35-80-8-4.0.;АТВ5-35-80-8-6.0.;АТВ5-35-80-8-8.0.;АТВ5-35-80-9-2.0.;АТВ5-35-80-9-4.0.;АТВ5-35-80-9-6.0.;АТВ5-35-80-9-8.0.;C-АТВ5-35-40-8-4.0.-CDES.

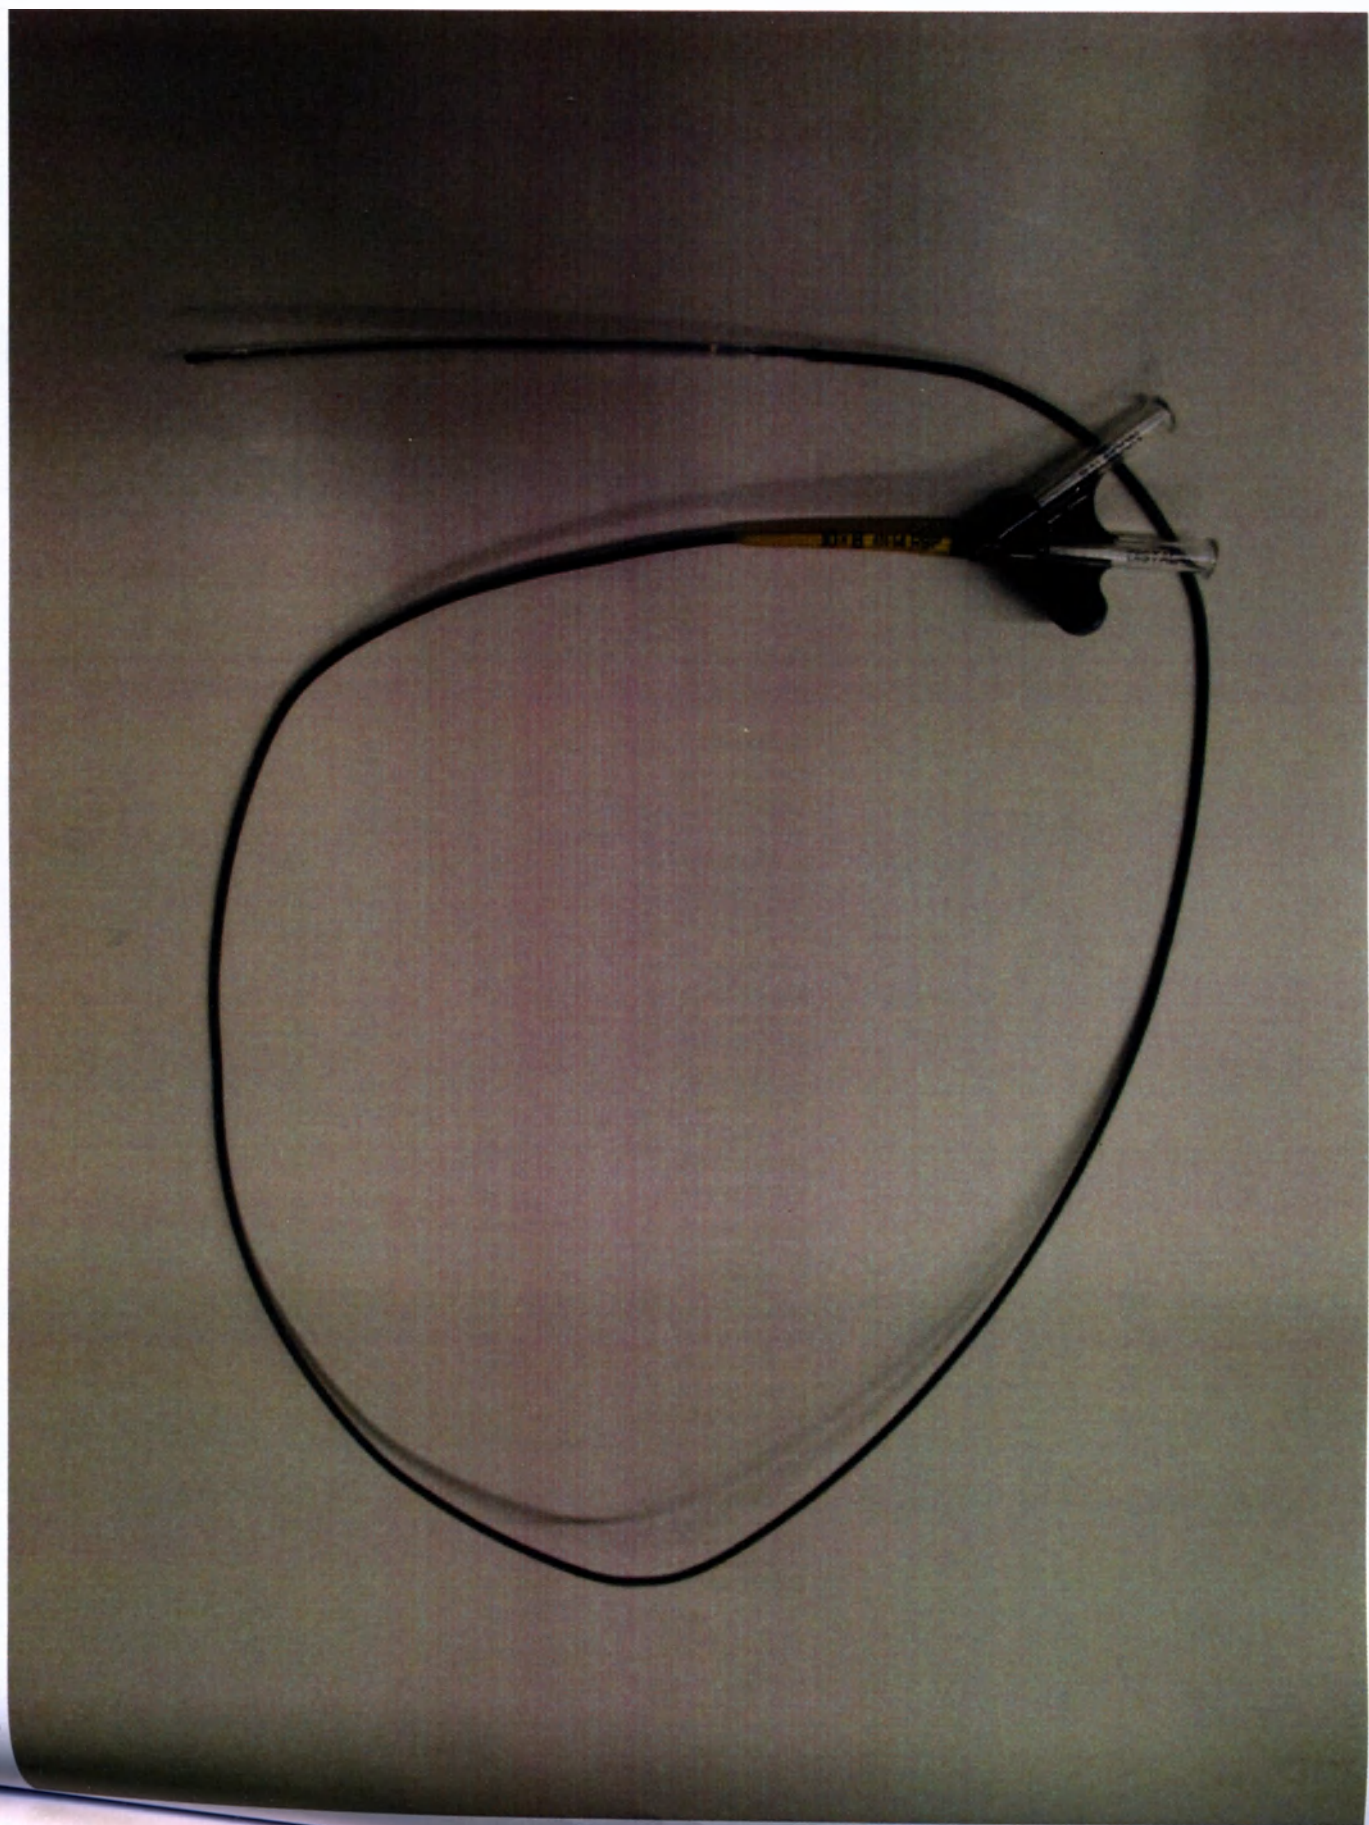

Макет маркировки:

ATB5-XX-XXX-XX-X.X

Катетер баллонный для чрескожной транслюминальной
ангиопластики (ЧТА) ATB Advance

Производитель: Cook Inc., США

Срок годности: _____ Партия: _____

Рег.уд.: 2017/5425



Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Макет маркировки:

CODA-X-XX-XX-XXX-XX

Катетеры баллонные CODA LP

Производитель: Cook Inc., США

Срок годности: _____ Партия: _____

Рег.уд.: 2017/5425




Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



Катетеры баллонные CODA

Варианты исполнения: CODA-10.0-35-100-32.; CODA-10.0-35-120-40.; CODA-2-10.0-35-120-32.;
CODA-2-10.0-35-120-40.; CODA-2-10.0-35-120-46.; CODA-2-10.0-35-140-46.

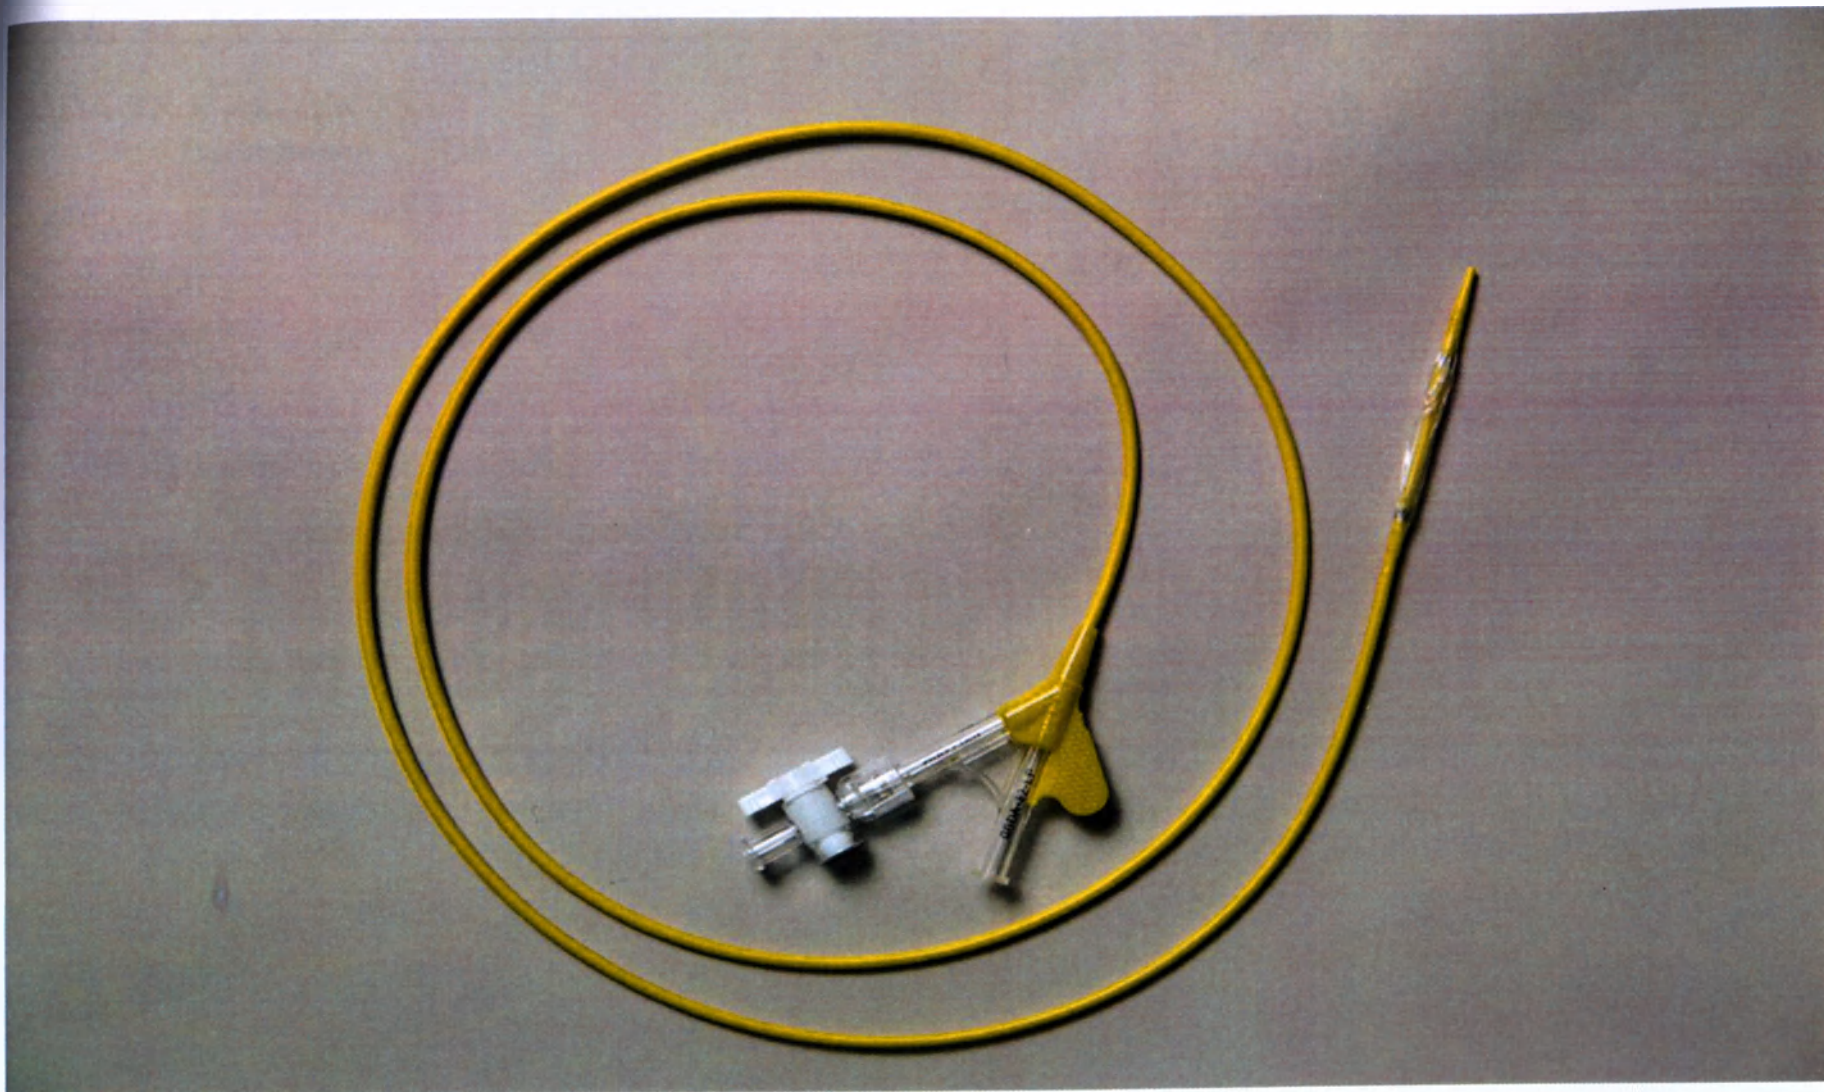

Макет маркировки:

CODA-XX.X-XX-XXX-XX

Катетеры баллонные CODA

Производитель: Cook Inc., США

Срок годности: _____ Партия: _____

Рег.уд.: 2017/5425



Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 19 листов
Генеральный директор

С.Н.

С.Н.Курин

