


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Аппарат рентгеновский цифровой для пульмонологии АРЦП "МЕДИПРОМ" (флюорограф цифровой) по ТУ 26.60.11.113-001-71327975-2005 в двух исполнениях

- исполнение 1 – на базе рентгенозащитной кабины;



- исполнение 2 – на базе напольного штатива».

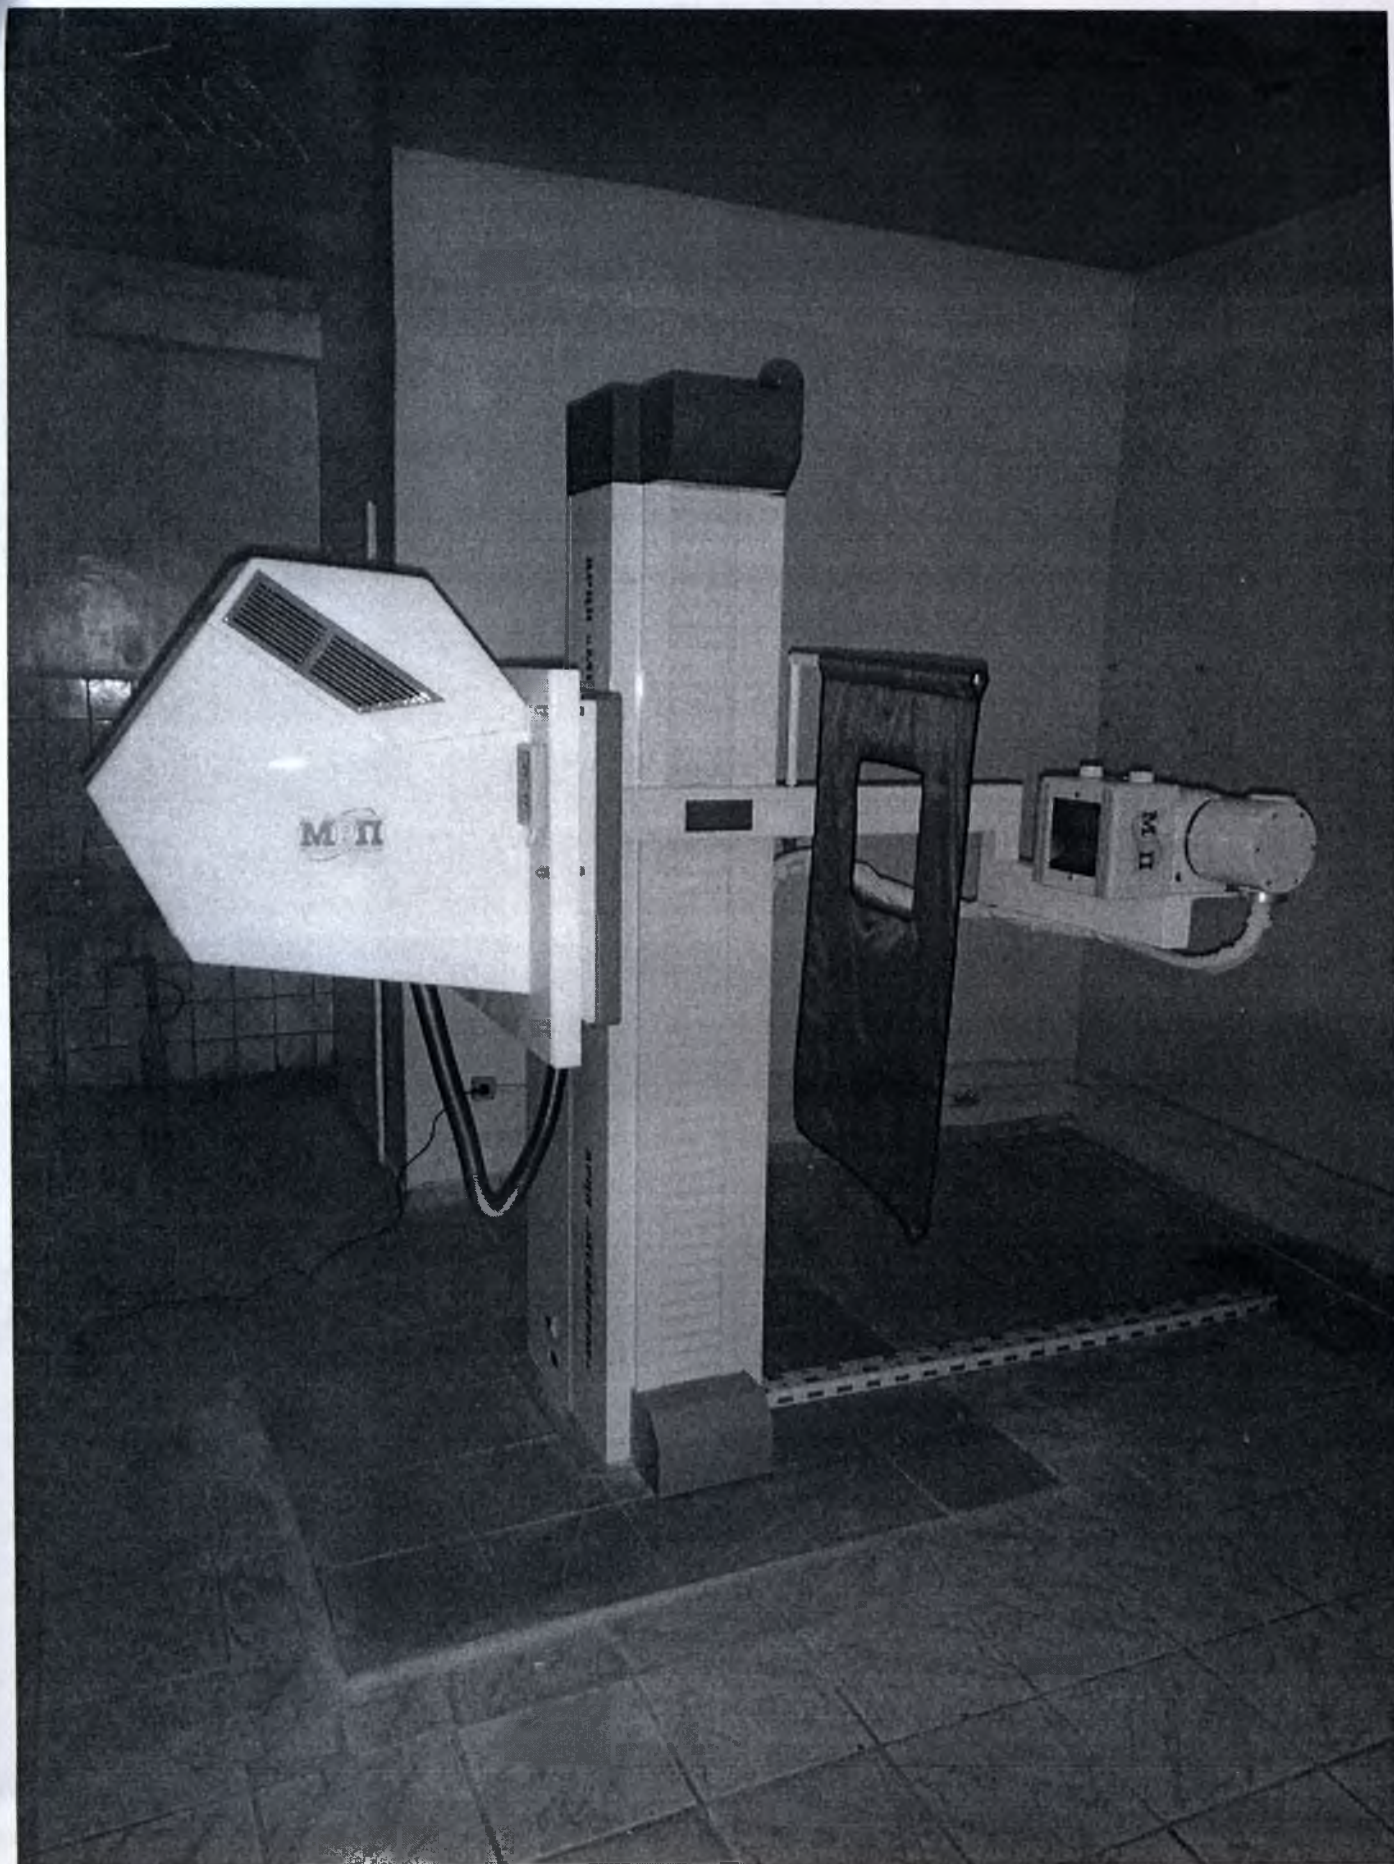

Генеральный директор
ООО «МОСРЕНТГЕНПРОМ»

Ширина Анна Сергеевна

Всего пронумеровано
пронумеровано и скреплено
печать

