


Фотографические изображения
Наборы реагентов для биохимических исследований in vitro

Набор реагентов для определения щелочной фосфатазы (Alkaline phosphatase liquid color)

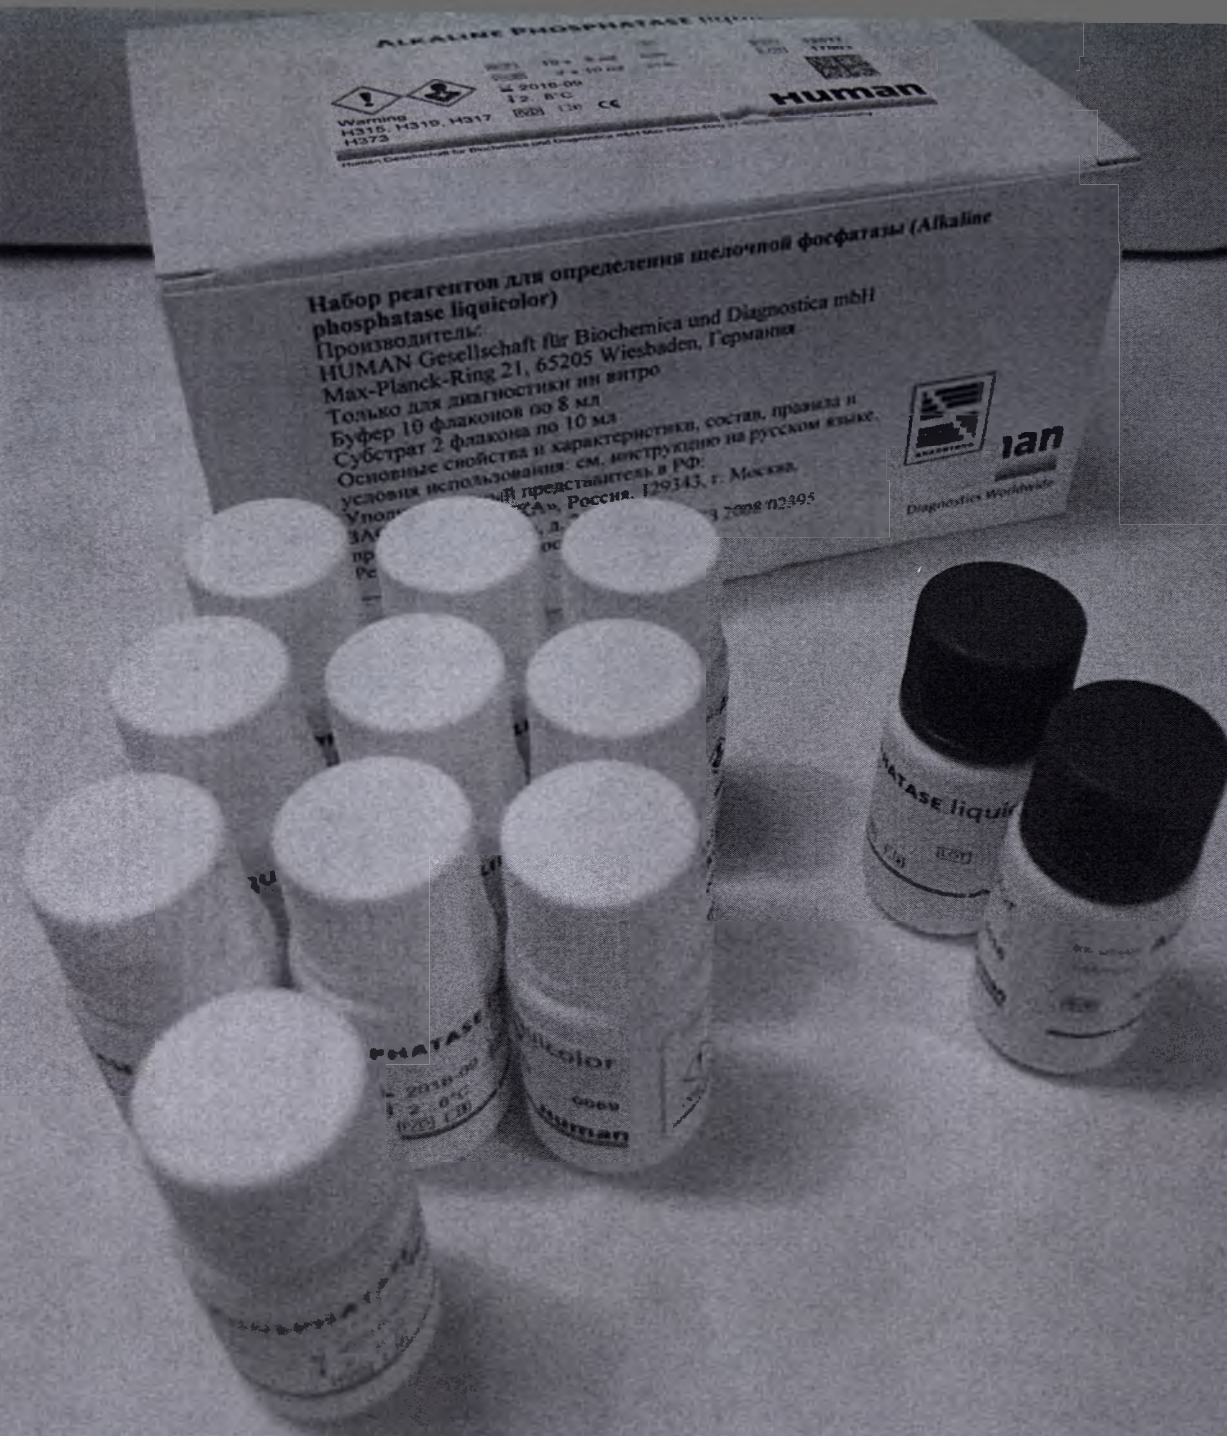

Набор реагентов для определения билирубина (Bilirubin D+T liquicolor)

Производитель:

HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH
Max-Planck-Ring 21, 65205 Wiesbaden, Германия

Только для диагностики in vitro

Реагент для определения общего билирубина 1 флакон 100 мл
О-нитритный реагент 1 флакон 9 мл

Реагент для определения прямого билирубина 1 флакон 100 мл
П-нитритный реагент 1 флакон 9 мл

Основные свойства и характеристики, состав, правила и условия использования: см. инструкцию на русском языке.

Уполномоченный представитель в РФ:


ЗАО «АНАЛИТИКА», Россия, 129343, г. Москва,

проезд Серебрякова, д. 2, корп. 1


Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/02395




Набор реактивов для определения холестерина (Cholesterol liquidcolor)
Холестерин

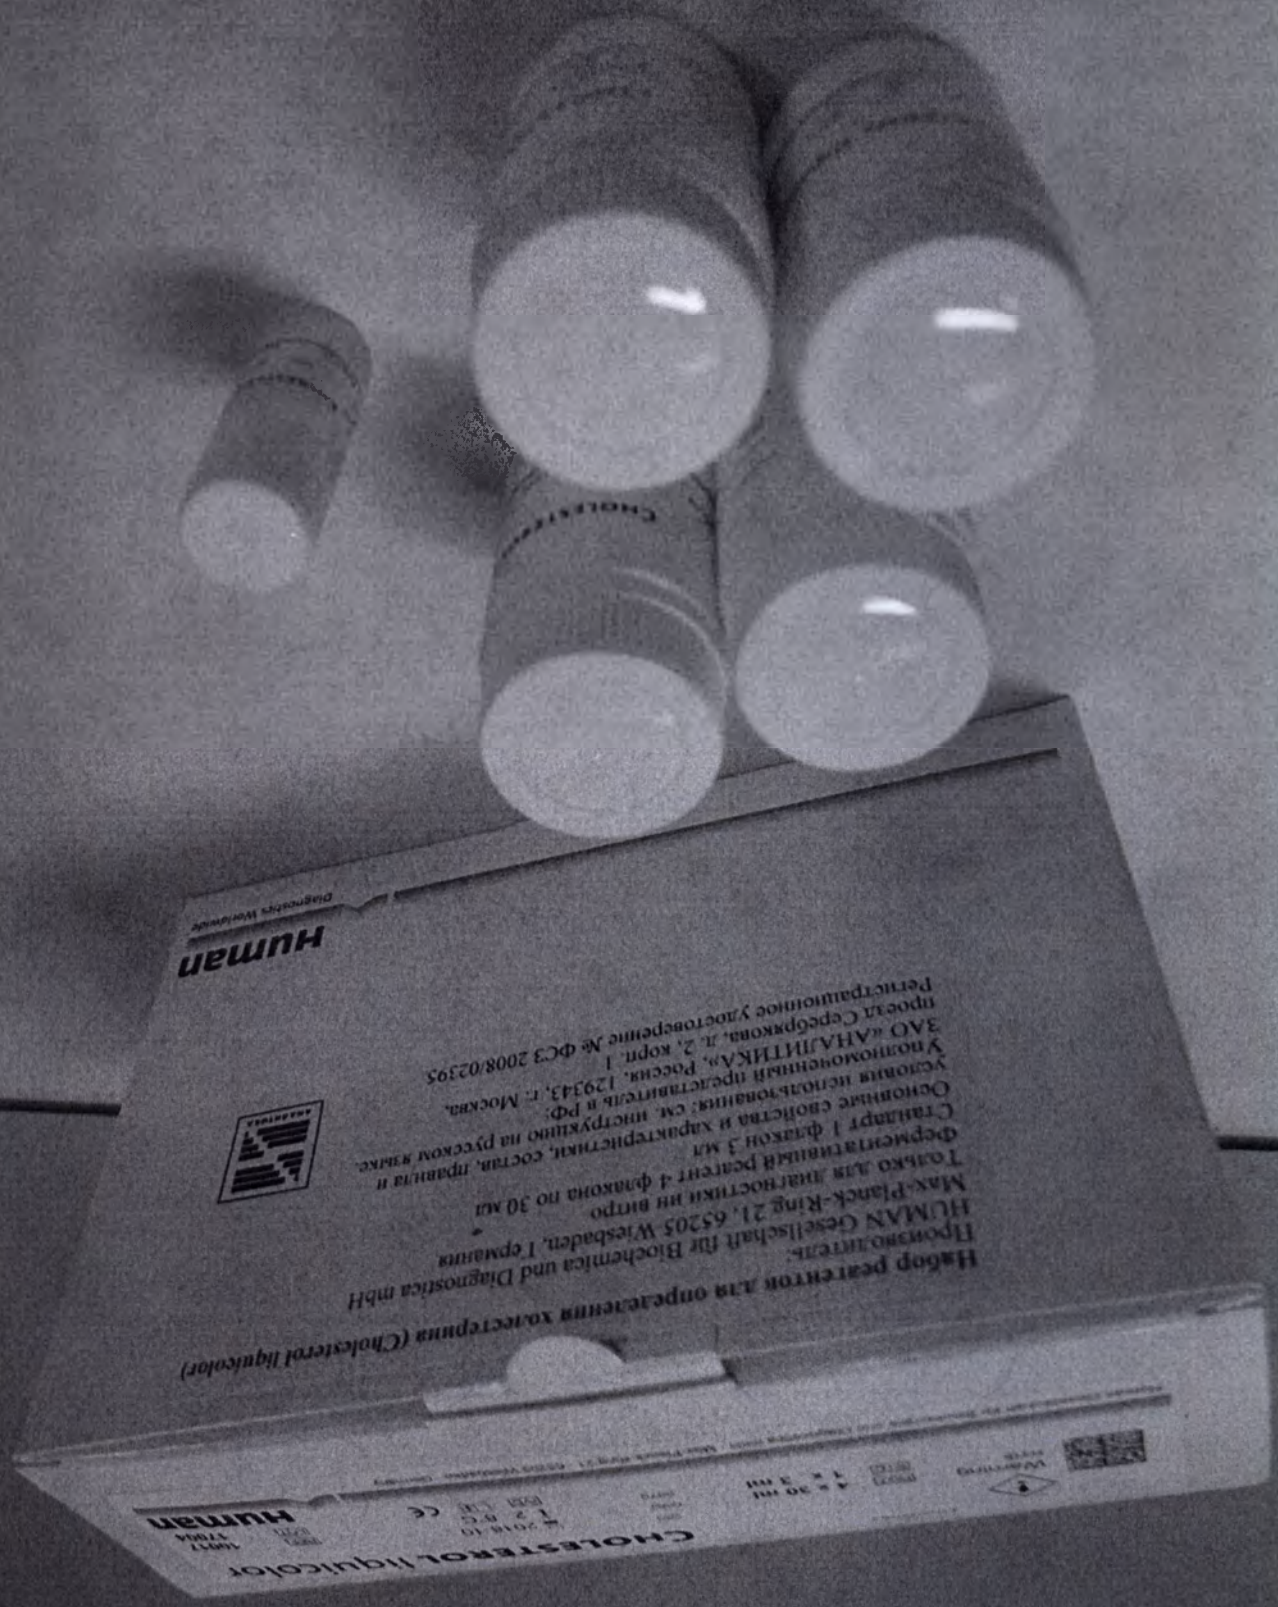


Handelsgenomsigt för aktiverad CK-NAC (aktiverad)
Klammarska

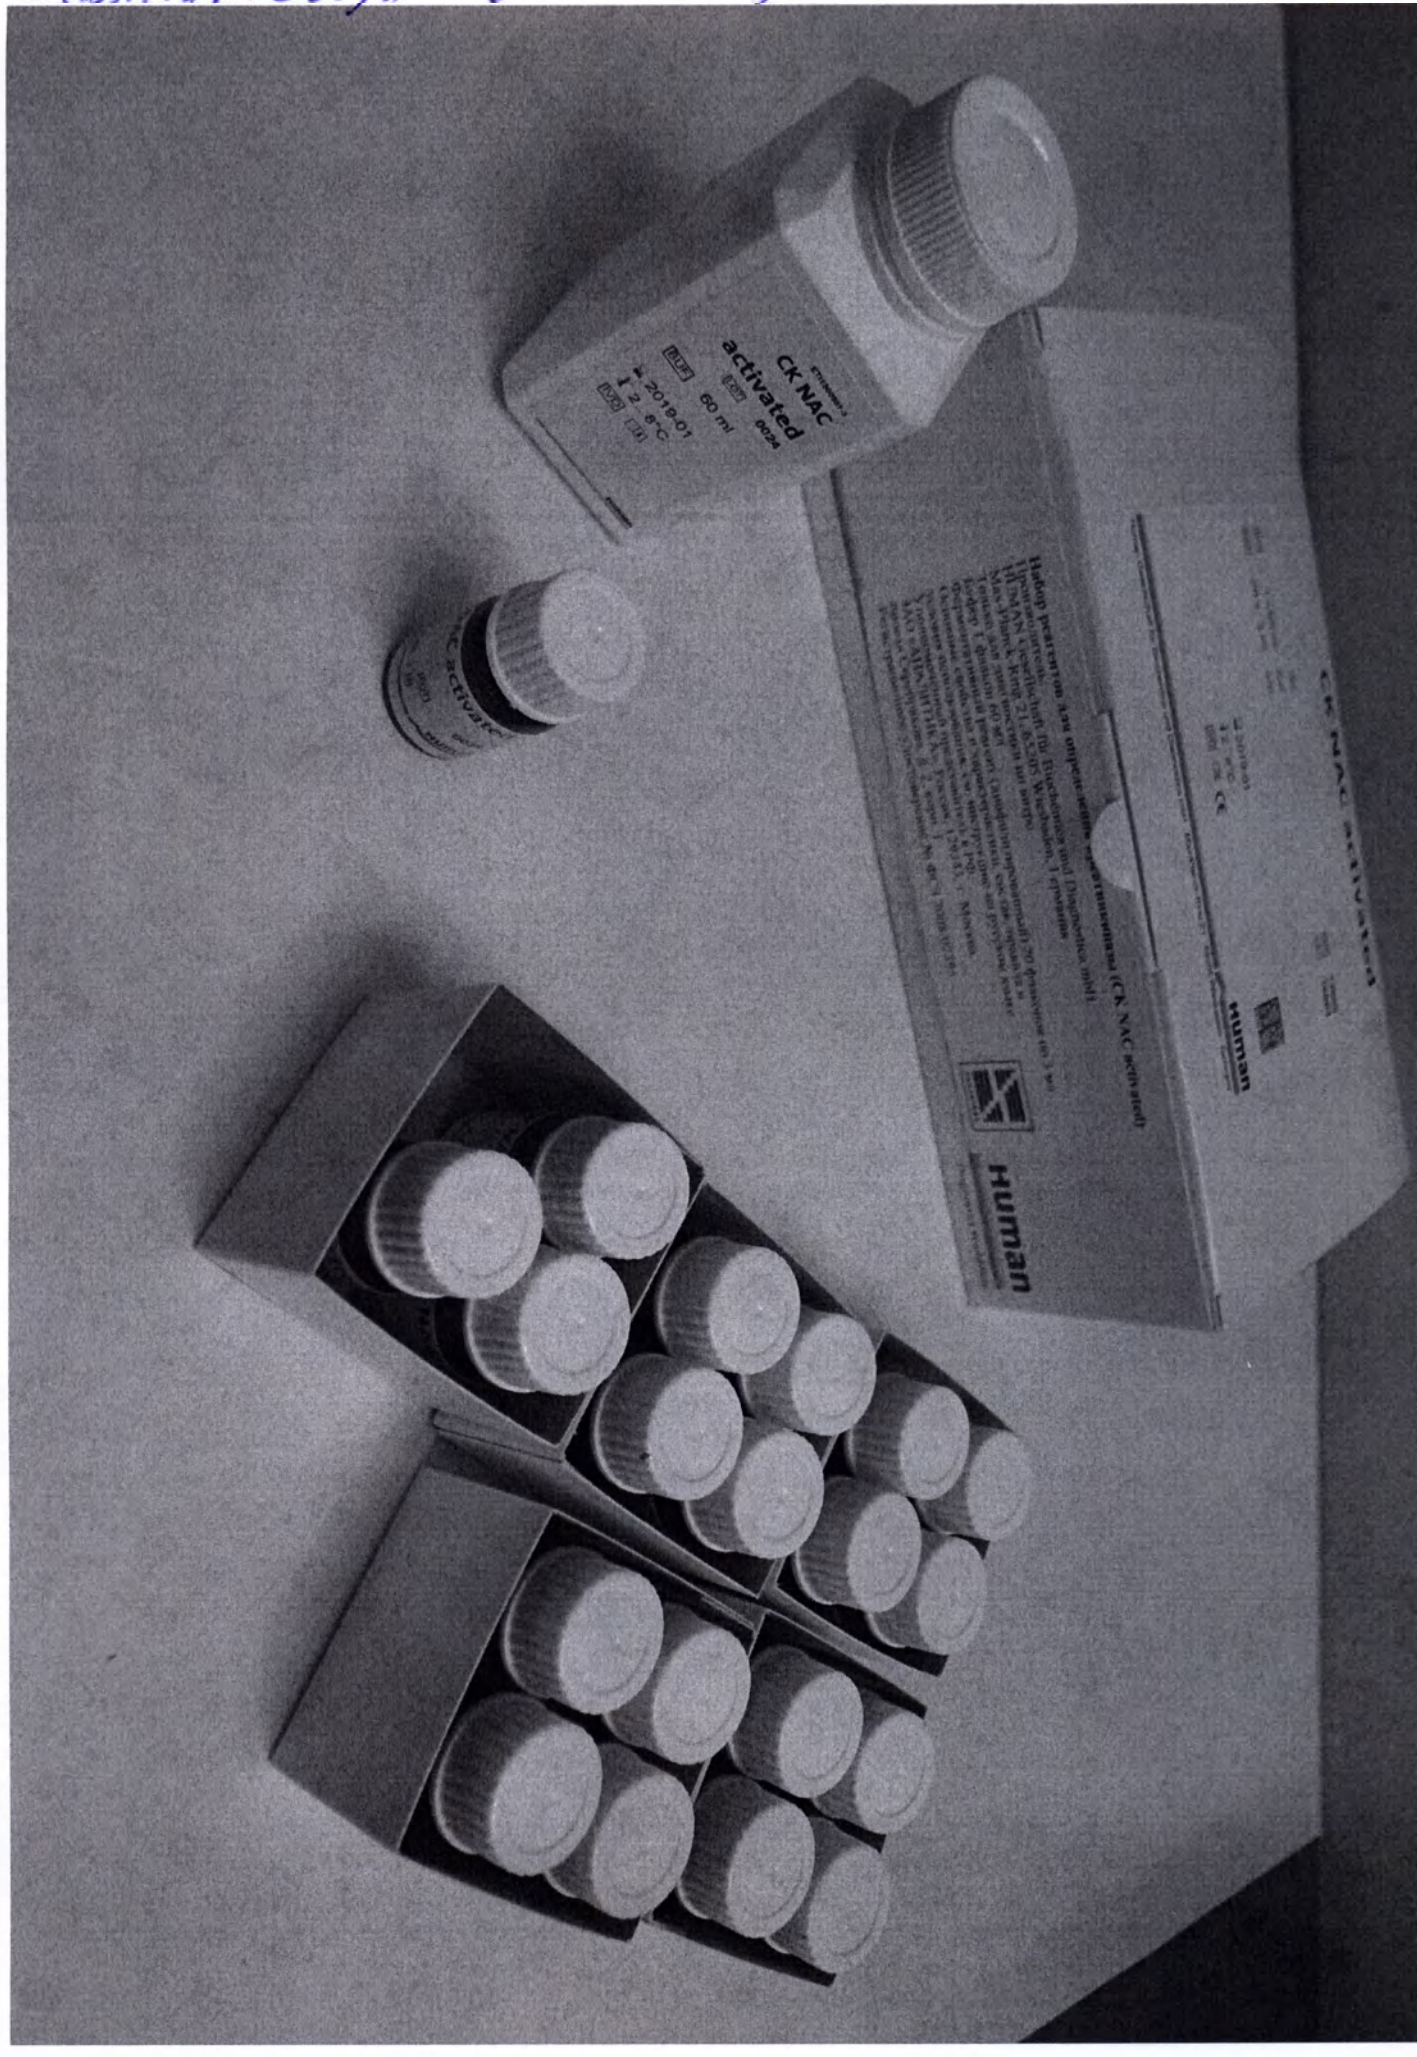


Исход. материал для исследования (NAC активирован)
CIC-MIB (NAC активирован)

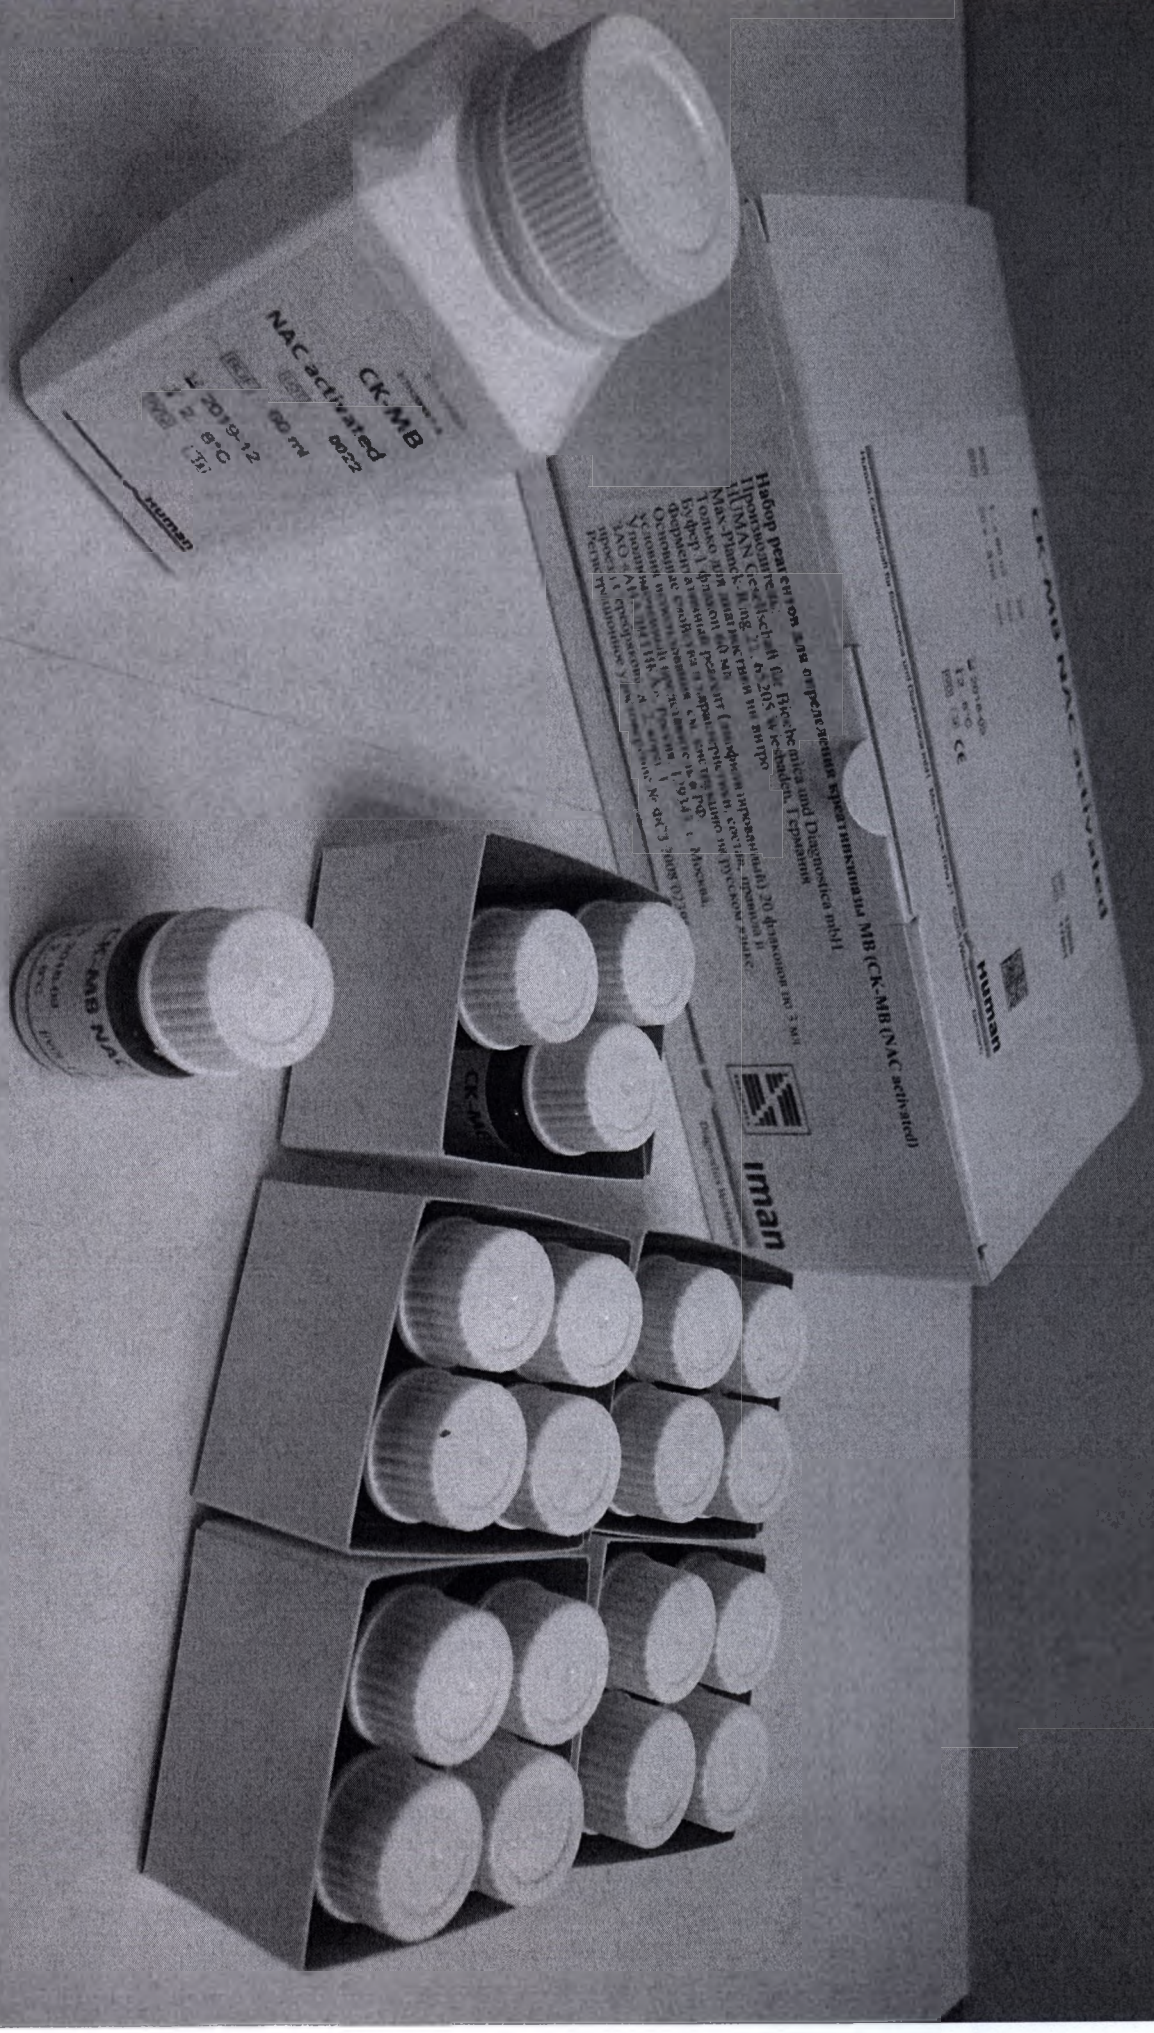


Набор реагентов для определения креатинина

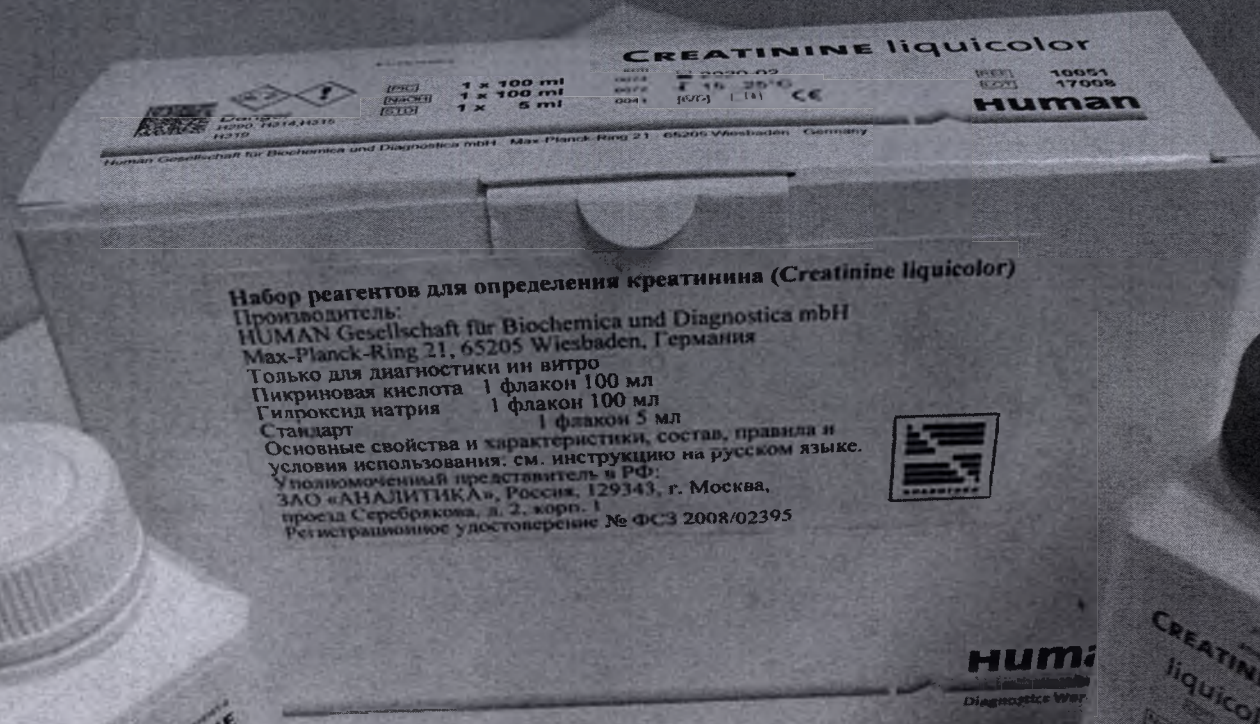

Набор реагентов для определения креатинина (Creatinine liquicolor)
Производитель:
HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH
Max-Planck-Ring 21, 65205 Wiesbaden, Германия
Только для диагностики in vitro
Пикриновая кислота 1 флакон 100 мл
Гидроксид натрия 1 флакон 100 мл
Стандарт 1 флакон 5 мл
Основные свойства и характеристики, состав, правила и условия использования: см. инструкцию на русском языке.
Уполномоченный представитель в РФ:
ЗАО «АНАЛИТИКА», Россия, 129343, г. Москва,
проспект Серебрякова, д. 2, корп. 1
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/02395

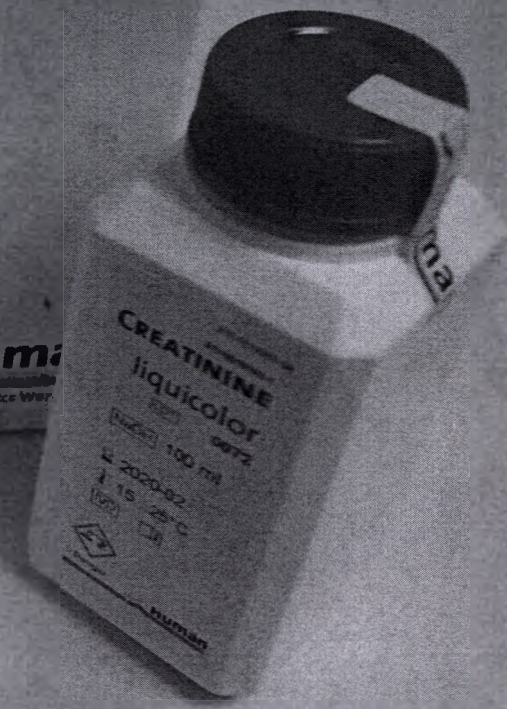


Набор реагентов для определения глюкозы (Glucose liquicolor)

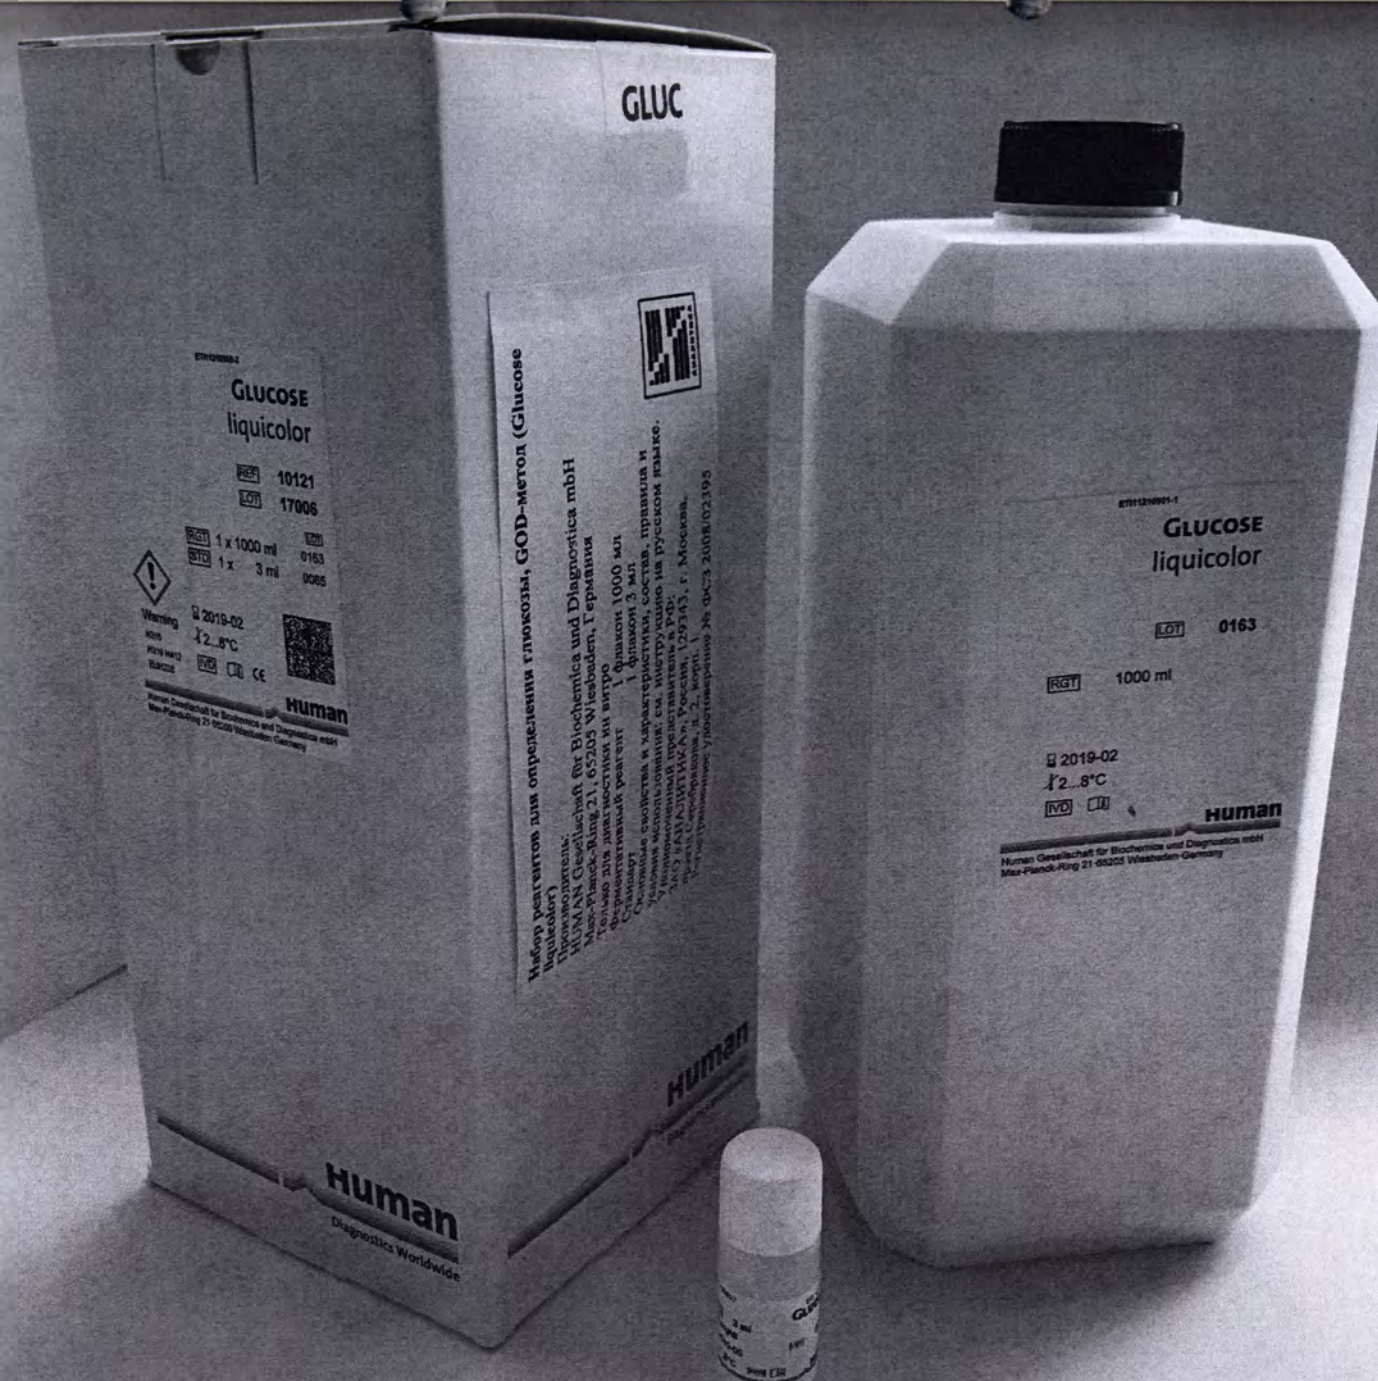




Human
Diagnostics Worldwide


Набор реагентов для определения АСТ (асат) liquidUV

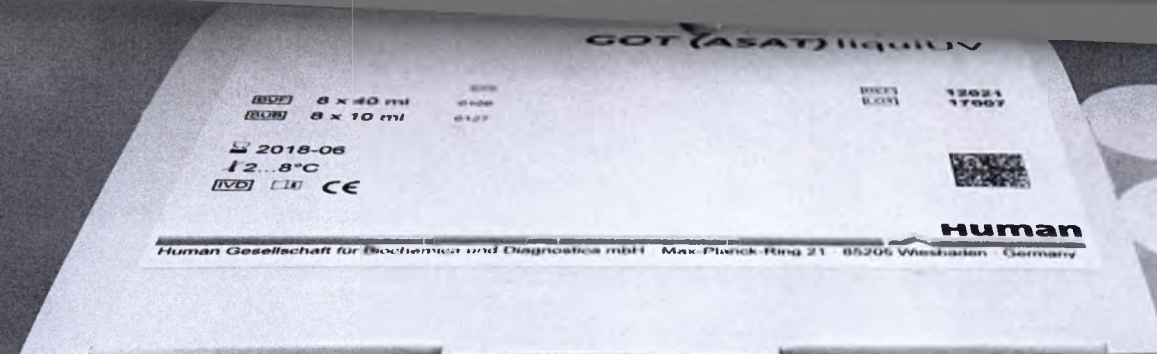


Набор реагентов для определения АСТ GOT (ASAT) liquidUV
Производитель:
HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH
Max-Planck-Ring 21, 65205 Wiesbaden, Германия
Только для диагностики in vitro
Буфер 8 флаконов по 40 мл
Субстрат 8 флаконов по 10 мл
Основные свойства и характеристики, состав, правила и условия использования: см. инструкцию на русском языке.
Уполномоченный представитель в РФ:
ЗАО «АНАЛИТИКА», Россия, 129343, г. Москва, проезд Серебрякова, д. 2, корп. 1
Регистрационное удостоверение № ФХ.3.2008/12393

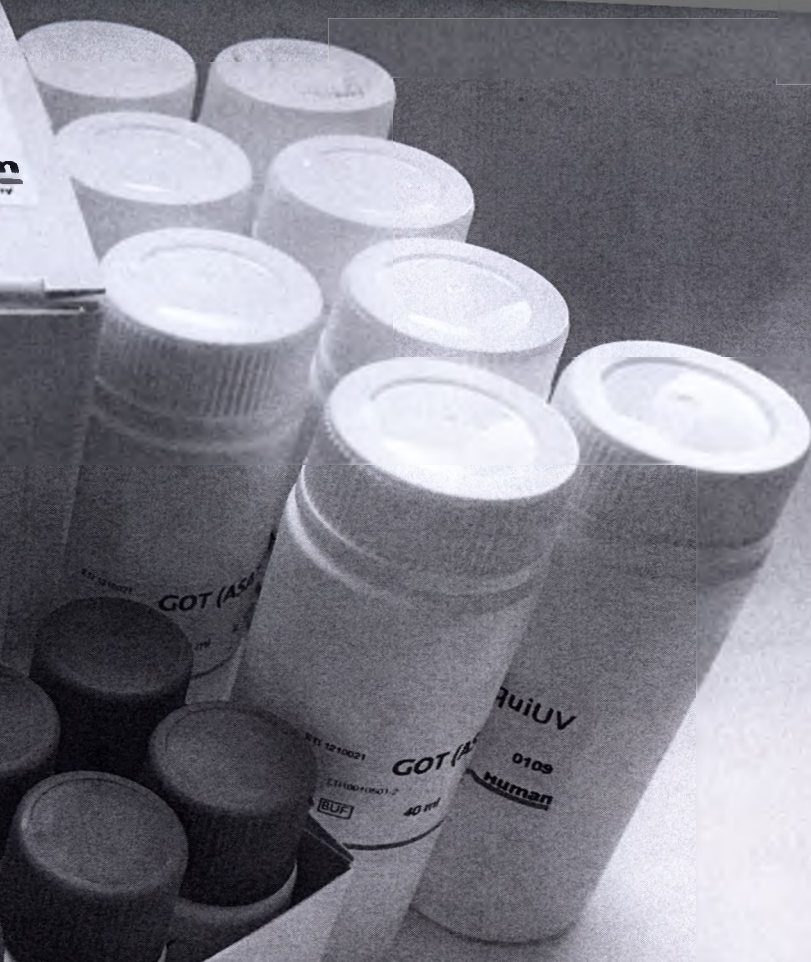

Набор реагентов для определения АЛТ (GPT (ALAT) liquiUV)

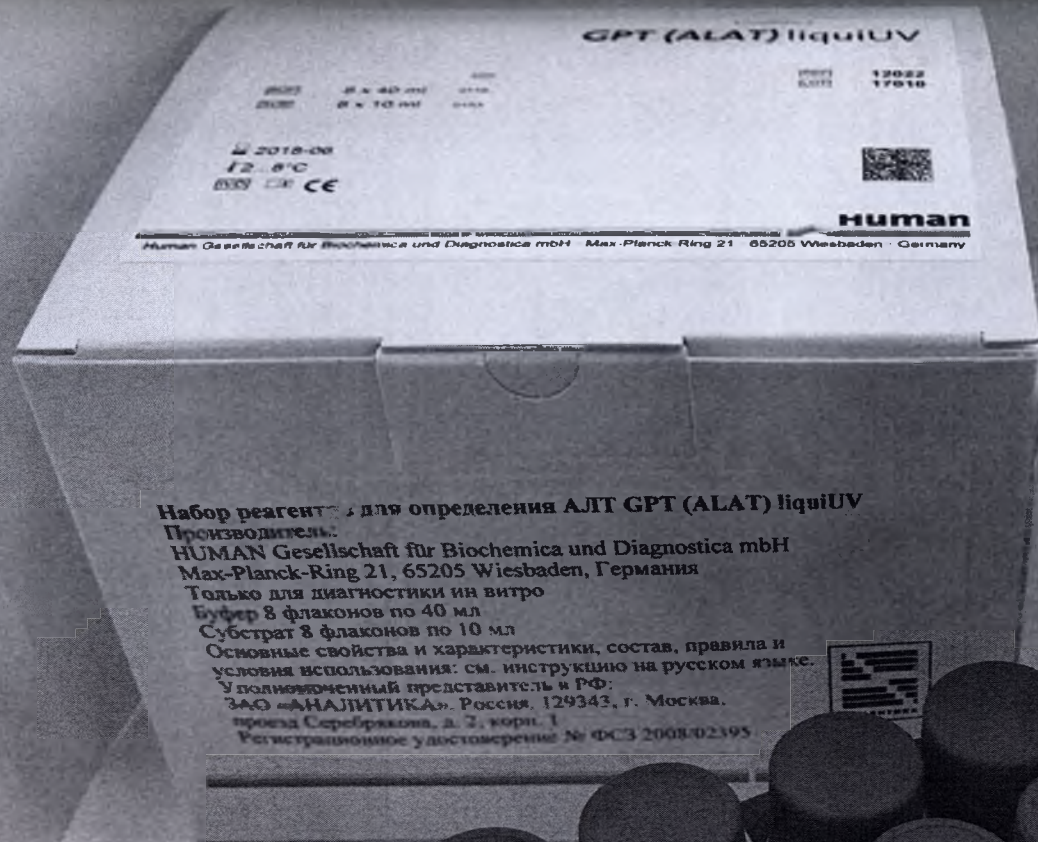

Набор реагентов для определения АЛТ GPT (ALAT) liquiUV
Производитель:
HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH
Max-Planck-Ring 21, 65205 Wiesbaden, Германия
Только для диагностики in vitro
Буфер 8 флаконов по 40 мл
Субстрат 8 флаконов по 10 мл
Основные свойства и характеристики, состав, правила и
условия использования: см. инструкцию на русском языке.
Уполномоченный представитель в РФ:
ЗАО «АНАЛИТИКА», Россия, 129343, г. Москва,
проезд Серебрякова, д. 2, корп. 1
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/02395

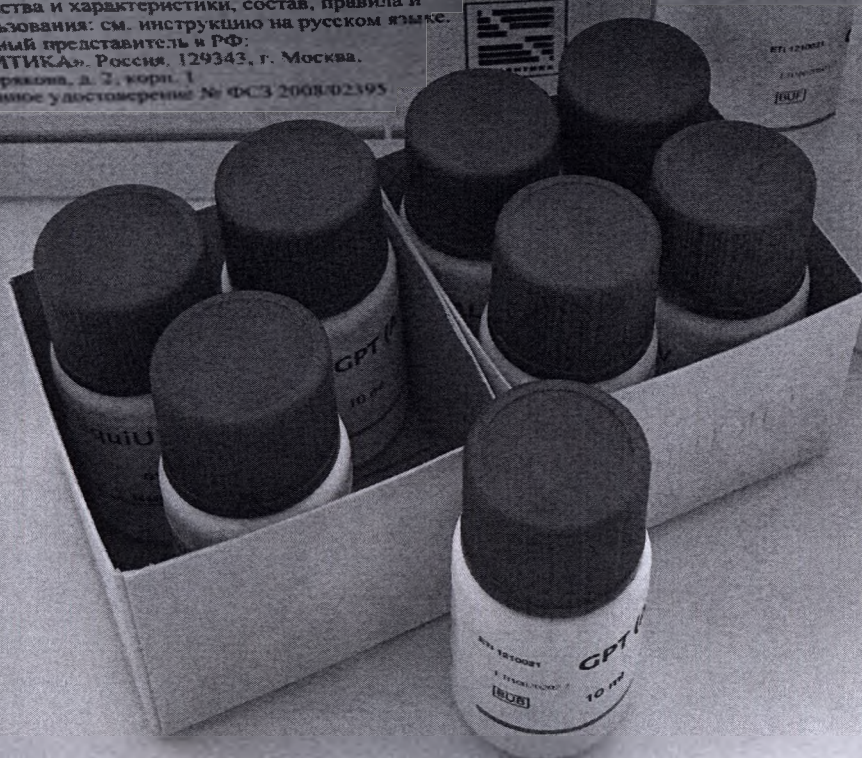

HDL CHOLESTEROL liquicolor



ENZ
SUB
CAL

1 x 60 ml
1 x 20 ml
1 x 4 ml

0066
0069
17005

2018-05

2...8°C

IVD A CE

REF
LOT

10084
17005

Human

Human Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH · Max-Planck-Ring 21 · 65205 Wiesbaden · Germany

Набор реагентов для определения холестерина высокой плотности (HDL Cholesterol liquicolor)

Производитель:

HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH
Max-Planck-Ring 21, 65205 Wiesbaden, Германия

Только для диагностики ин витро

Ферментативный реагент (белая крышка) 1 флакон 60 мл

Субстрат (зеленая крышка) 1 флакон 20 мл

Калибратор 1 флакон 4 мл


Основные свойства и характеристики, состав, правила и
условия использования: см. инструкцию на русском языке

Уполномоченный представитель в РФ:

ЗАО «АНАЛИТИКА», Россия, 129343, г. Москва,

проезд Серебрякова, д. 2, корп. 1

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/02395




human

Diagnostica Worldwide

Набор реагентов для определения холестерина высокой плотности (HDL Cholesterol liquicolor)

Набор реагентов для определения холестерина низкой плотности (LDL Cholesterol liquicolor)

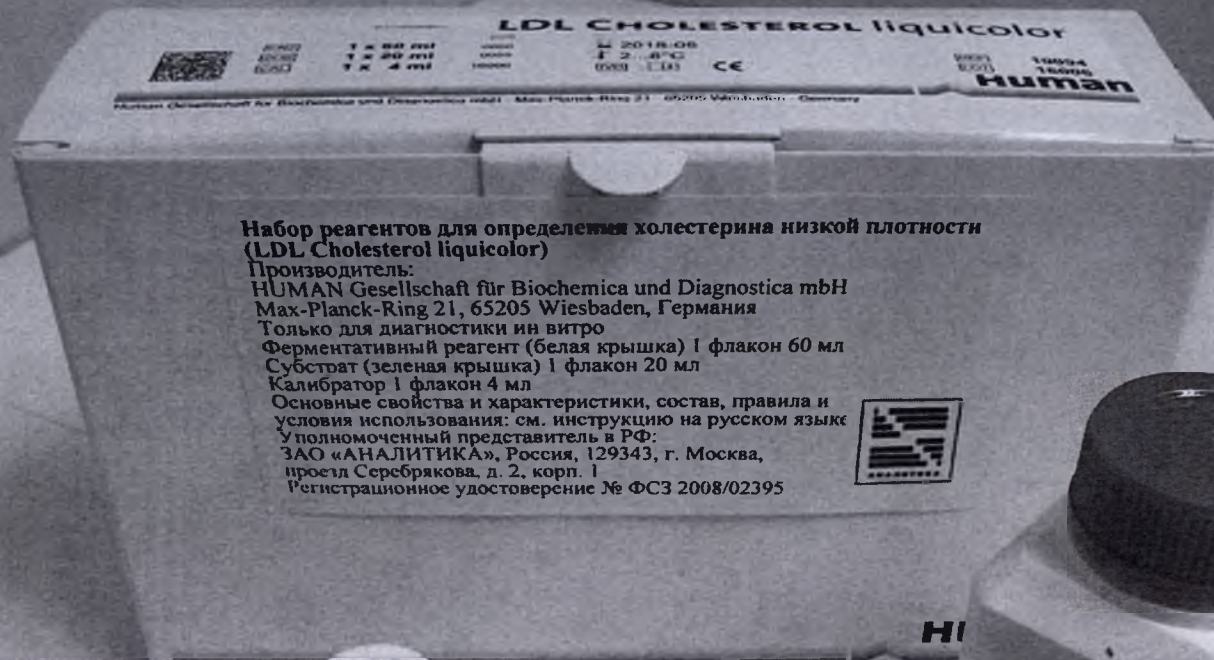

Набор реагентов для определения холестерина низкой плотности (LDL Cholesterol liquicolor)

Производитель:

HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH

Max-Planck-Ring 21, 65205 Wiesbaden, Германия

Только для диагностики in vitro

Ферментативный реагент (белая крышка) 1 флакон 60 мл

Субстрат (зеленая крышка) 1 флакон 20 мл

Калибратор 1 флакон 4 мл



Основные свойства и характеристики, состав, правила и условия использования: см. инструкцию на русском языке

Уполномоченный представитель в РФ:


ЗАО «АНАЛИТИКА», Россия, 129343, г. Москва,

проезд Серебрякова, д. 2, корп. 1

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/02395

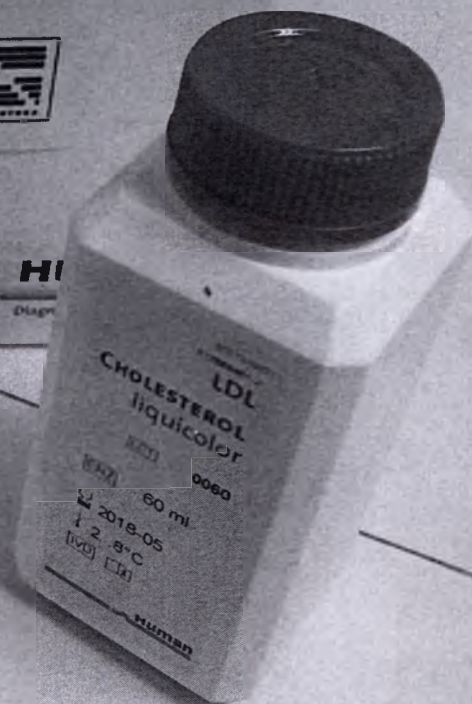

Набор реагентов для определения железа (Iron liquicolor)

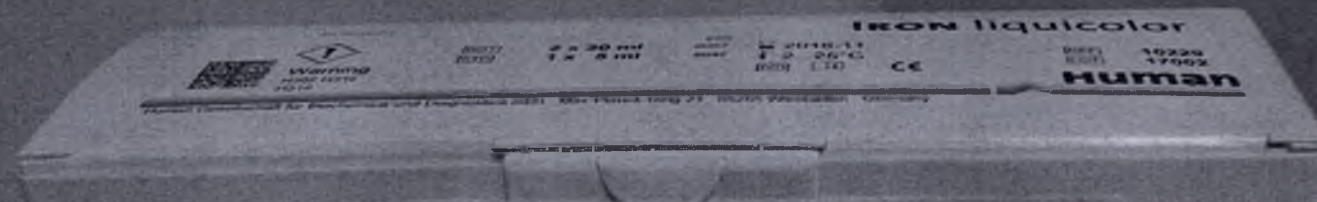

Набор реагентов для определения железа (Iron liquicolor)[®]

Производитель:

HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH
Max-Planck-Ring 21, 65205 Wiesbaden, Германия

Только для диагностики in vitro

Реагент ХЗБ (монореагент) 2 флакона по 30 мл



Стандарт 1 флакон 5 мл


Основные свойства и характеристики, состав, правила и условия использования: см. инструкцию на русском языке

Уполномоченный представитель в РФ:

ЗАО «АНАЛИТИКА», Россия, 129343, г. Москва,
проезд Серебрякова, д. 2, корп. 1

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/02395

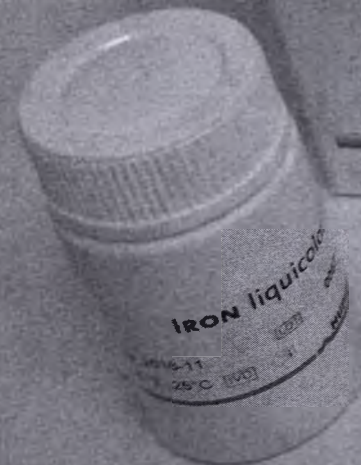

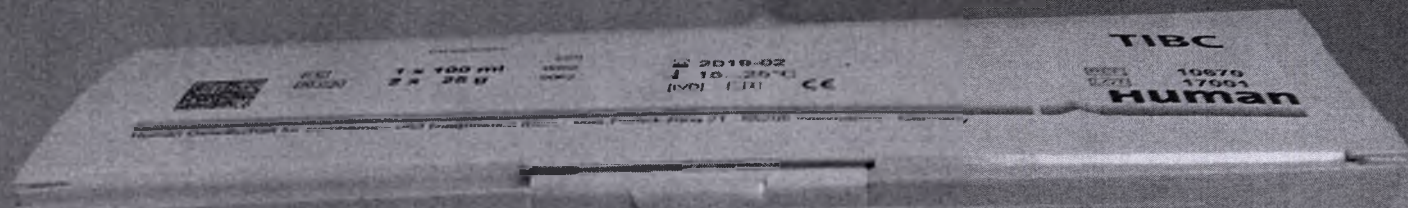

Набор реагентов для определения железосвязывающей способности (ТВС)

Производитель:

HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH
Max-Planck-Ring 21, 65205 Wiesbaden, Германия

Только для диагностики in vitro

Раствор железа 1 флакон 100 мл

Оксид алюминия 2 флакона по 25 г



Основные свойства и характеристики, состав, правила и условия использования: см. инструкцию на русском языке

Уполномоченный представитель в РФ:

ЗАО «АНАЛИТИКА», Россия, 129343, г. Москва,

проезд Серебрякова, д. 2, корп. 1

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/02395

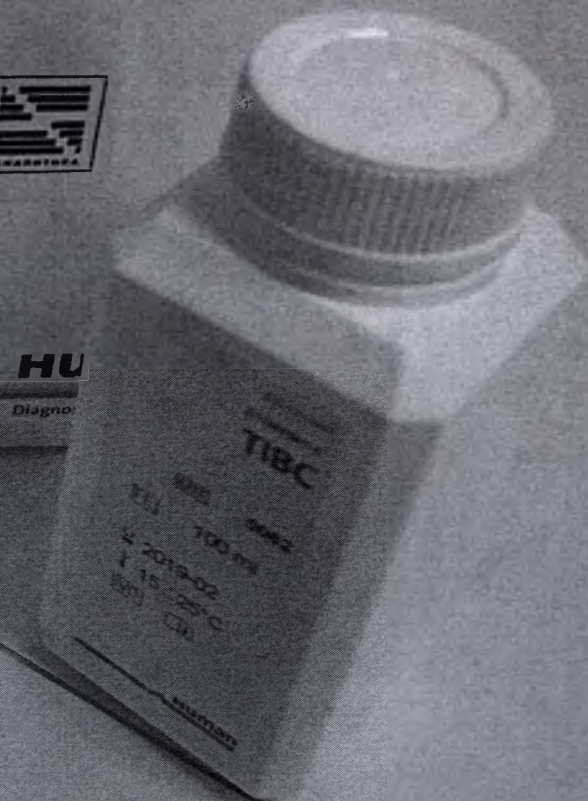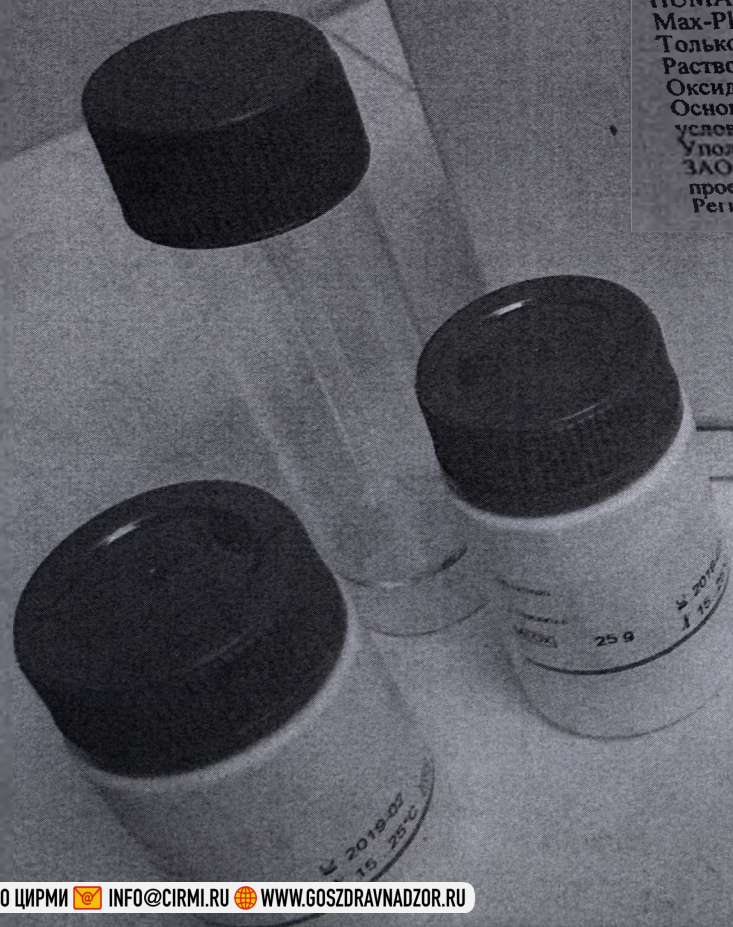

Набор реагентов для определения железосвязывающей способности (ТВС)

TRIGLYCERIDES liquicolor^{mono}

RCY 9 x 15 ml

0003

STD 1 x 3 ml

0058

2018-11

2...8°C

IVD CE

REF
LOT

10720P

17003



human

Human Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH · Max-Planck-Ring 21 · 65205 Wiesbaden · Germany

Набор реагентов для определения триглицеридов (Triglycerides liquicolor^{mono})

Производитель:

HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH

Max-Planck-Ring 21, 65205 Wiesbaden, Германия

Только для диагностики in vitro

Монореагент 9 флаконов по 15 мл

Стандарт 1 флакон 3 мл

Основные свойства и характеристики, состав, правила и условия использования: см. инструкцию на русском языке.

Уполномоченный представитель в РФ:

ЗАО «АНАЛИТИКА», Россия, 129343, г. Москва,

проезд Серебрякова, д. 2, корп. 1

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/02395



human

Diagnostics Worldwide

Набор реагентов для определения триглицеридов (Triglycerides liquicolor^{mono})

Производитель:

HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH

Max-Planck-Ring 21, 65205 Wiesbaden, Германия

Только для диагностики in vitro

Монореагент 9 флаконов по 15 мл

Стандарт 1 флакон 3 мл

Основные свойства и характеристики, состав, правила и условия использования: см. инструкцию на русском языке.

Уполномоченный представитель в РФ:

ЗАО «АНАЛИТИКА», Россия, 129343, г. Москва,


проезд Серебрякова, д. 2, корп. 1

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/02395



human




Diagnostics Worldwide

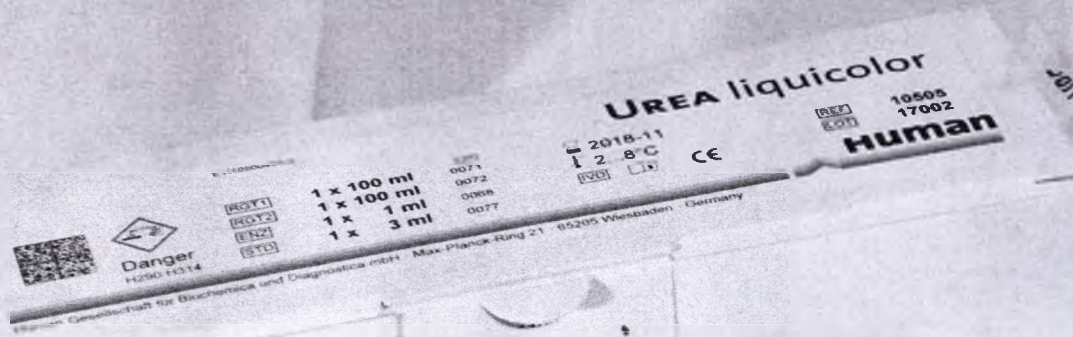

Набор реагентов для определения мочевины по конечной точке.
реагент 1 и реагент 2 (Urea liquicolor)
 Производитель:
 HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH
 Max-Planck-Ring 21, 65205 Wiesbaden, Германия
 Только для диагностики in vitro
 Реагент 1 1 флакон 100 мл
 Реагент 2 1 флакон 100 мл
 Ферментативный концентрат 1 флакон 1 мл
 Стандарт 1 флакон 3 мл
 Основные свойства и характеристики, состав, правила и
 условия использования: см. инструкцию на русском языке.
 Уполномоченный представитель в РФ:
 ЗАО «АНАЛИТИКА», Россия, 129343, г. Москва,
 проезд Серебрякова, д. 2, корп. 1
 Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/02395



Human
 Diagnostics Worldwide

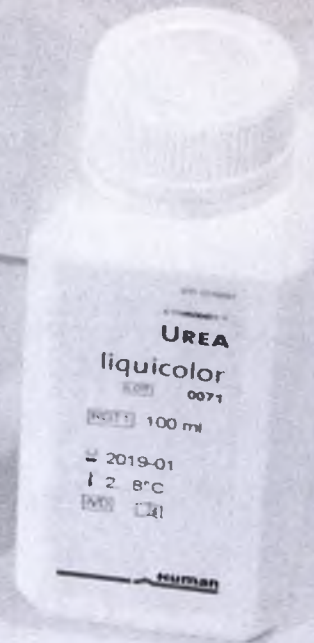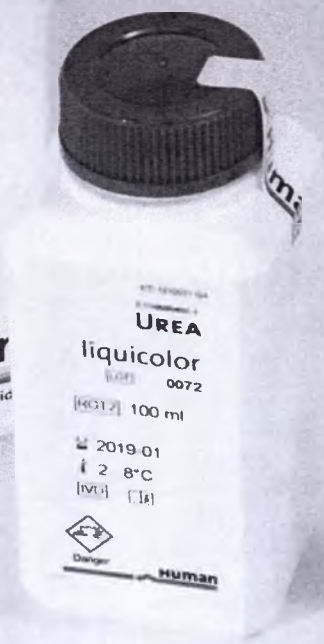

№. Набор реагентов для определения мочевины по конечной точке, реагент 1 и реагент 2 (Urea liquicolor)

Gesellschaft für
Biochemica und
Diagnostica mbH

Max-Planck-Ring 21
65205 Wiesbaden
Germany

Tel +49 6122 9988-0
Fax +49 6122 9988-100
human@human.de
www.human.de

UREA liquicolor

REF 10506
LOT 16007

RG1 1 x 1000 ml
ENZ 1 x 10 ml 0076
STD 1 x 3 ml 0075

2018-06
2.8°C

IVD CE

human

Human Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH
Max-Planck-Ring 21 65205 Wiesbaden Germany

Набор реагентов для определения мочевины по конечной точке,
реагент 1 (Urea liquicolor)

Применение:

Human Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH
Max-Planck-Ring 21, 65205 Wiesbaden, Германия

Техника для определения мочевой

Реагент 1

Ферментативный концентрат 1 флакон 1000 мл

Стандарт 1 флакон 3 мл

Основные свойства и характеристики, состав, правила и
условия хранения, см. инструкцию на русском языке.

Удостоверенный представитель в РФ:

ООО «МЕДИЦИКА», Россия, 129143, г. Москва,

пр-д Сербурова, д. 2, стр. 1

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/02395

Human

Diagnostics Worldwide

human

Diagnostics Worldwide

UREA liquicolor

LOT 0076

RG1 1000 ml

2018-06

2.8°C

IVD

human

Human Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH
Max-Planck-Ring 21 65205 Wiesbaden Germany

UREA liquicolor

Набор реагентов для определения мочевины по конечной точке, реагент 1 (Urea liquicolor)

Gesellschaft für
Biochemica und
Diagnostics mbH

Max-Planck-Ring 21
65205 Wiesbaden
Germany

Tel +49 6122-9988-0
Fax +49 6122-9988-100
human@human.de
www.human.de



Набор реагентов для определения мочевины по конечной точке,
реагент 2 (Urea liquicolor)

Применение:

HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostics mbH

Max-Planck-Ring 21, 65205 Wiesbaden, Германия

Только для лабораторного использования

Реагент 2 1 флакон 1000 мл

Основные свойства и характеристики, состав, принцип и

условия использования: см. инструкцию на русском языке.

Уникальный препарат для определения мочевины в ИФА

ЗАО «ИПА-ДИПКА», Россия, 129343, г. Москва,

пр-кт Сосновка, д. 2, литер. Г № 43 2008 02 05

Регистрационное удостоверение № ФД 3.2008.02.05

UREA liquicolor

REF 10507
LOT 17001

RG2 1 x 1000 ml 0074



Danger
H290 H314

2018-11
2-8°C

RG2 CE



human

Human Gesellschaft für Biochemica und Diagnostics mbH
Max-Planck-Ring 21, 65205 Wiesbaden, Germany

UREA liquicolor

LOT 0074

RG2 1000 ml



Danger

2018-11
2-8°C

RG2 CE

human


Human Gesellschaft für Biochemica und Diagnostics mbH
Max-Planck-Ring 21, 65205 Wiesbaden, Germany

Human


Diagnostics Worldwide


Human

Diagnostics Worldwide

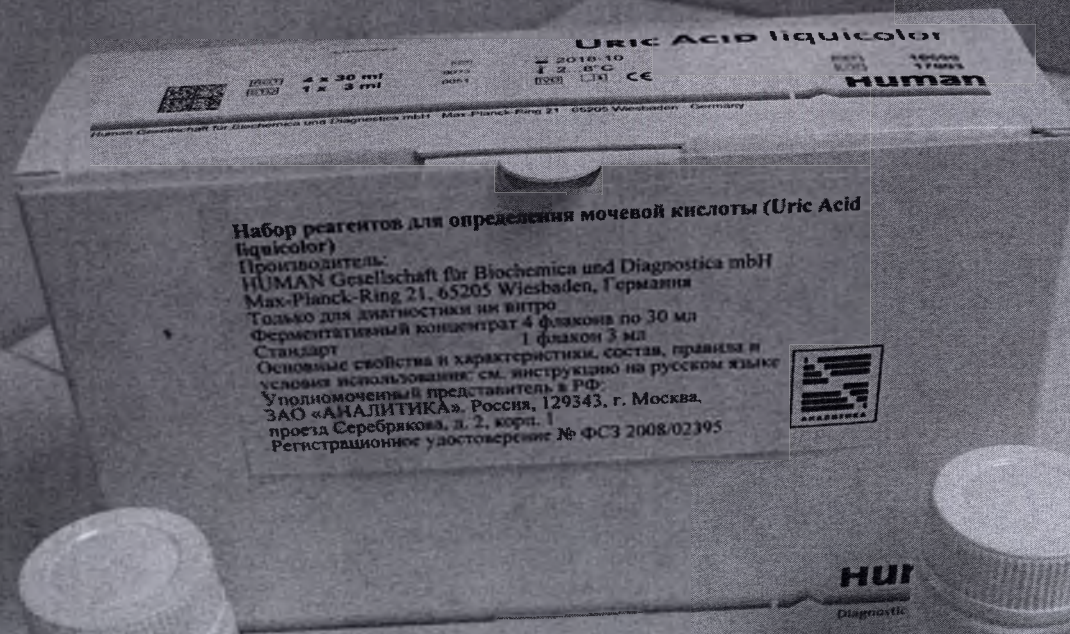

Набор реагентов для определения мочевой кислоты (Uric Acid liquicolor)
Производитель:
HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH
Max-Planck-Ring 21, 65205 Wiesbaden, Германия
Только для диагностики in vitro
Ферментативный концентрат 4 флакона по 30 мл
Стандарт 1 флакон 3 мл
Основные свойства и характеристики, состав, правила и условия использования: см. инструкцию на русском языке
Уполномоченный представитель в РФ:
ЗАО «АНАЛИТИКА», Россия, 129343, г. Москва,
проезд Серебрякова, д. 2, корп. 1
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/02395

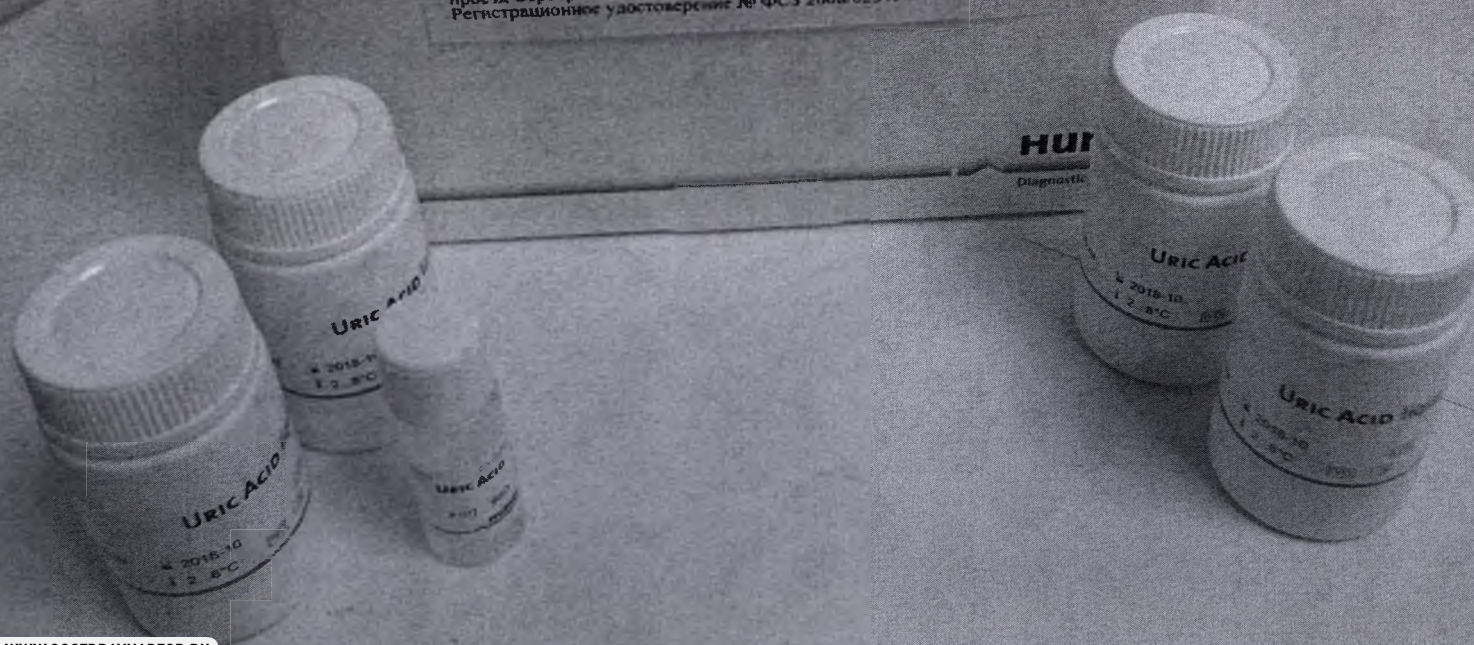

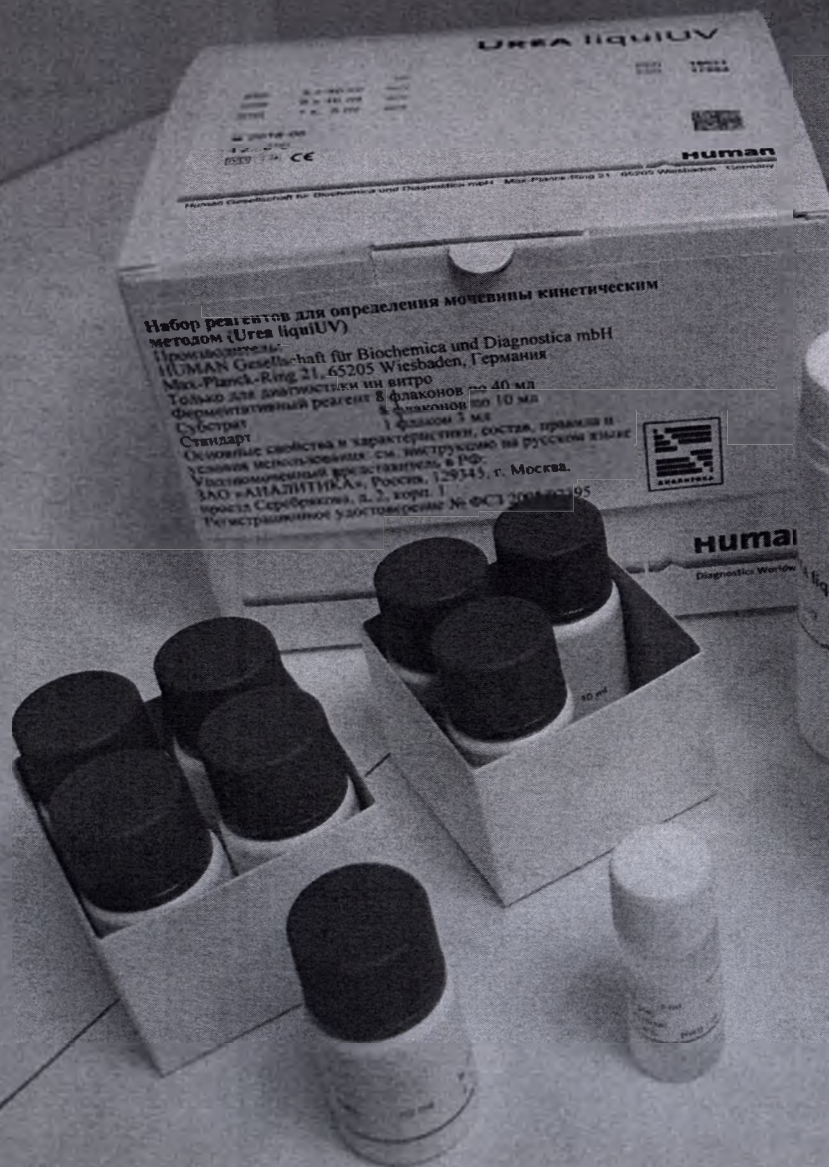

UREA LIQUIUV
HUMAN
Набор реагентов для определения мочевины кинетическим методом (Urea LiquiUV)
Производитель:
HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH
Max-Planck-Ring 21, 65205 Wiesbaden, Германия
Только для диагностики in vitro
Ферментативный реагент 8 флаконов по 40 мл
8 флаконов по 10 мл
Субстрат 1 флакон 3 мл
Стандарт
Основные свойства и характеристики, состав, правила и условия использования см. инструкцию на русском языке
Удостоверенный поставщик в РФ:
ЗАО «АНАЛИТИКА», Россия, 129345, г. Москва,
проезд Серебрякова, д. 2, корп. 1
Полное наименование: № ФСЗ 2004-00395

HUMAN
Diagnostics Worldwide



О. Набор реагентов для определения мочевины кинетическим методом (Urea LiquiUV)

Набор реактивов для определения мочевой кислоты. Ассортимент реактивов.
 Производитель:
 HOMA Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH
 HOMA Ring 21, 65205 Wiesbaden, Германия
 Max-Planck Ring 21, 65205 Wiesbaden, Германия
 Только для аналитических лабораторий
 Содержит 1 флакон по 60 мл
 Срок годности 3 года
 Условия хранения: хранить в прохладном месте
 Страна: Германия
 Основное назначение: определение мочевой кислоты в сыворотке крови
 Упаковка: 1 флакон по 60 мл
 Хранить в прохладном месте
 Москва, Россия
 ЗАО «Биохимикс»
 Москва, Россия
 Контактное лицо: г-н Александров
 Тел. (495) 216-00-00
 Факс (495) 216-00-00

Uric Acid
 Liquicolor
 60 ml
 LOT 06
 2-5°C
 EXP. DATE



1. 2016-06-01
 1. 2. 2016-06-01
 1. 2. 2016-06-01
 1. 2. 2016-06-01



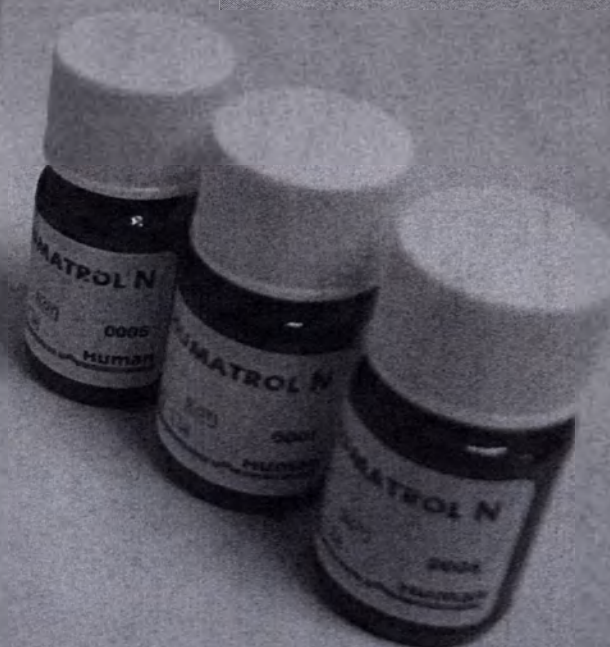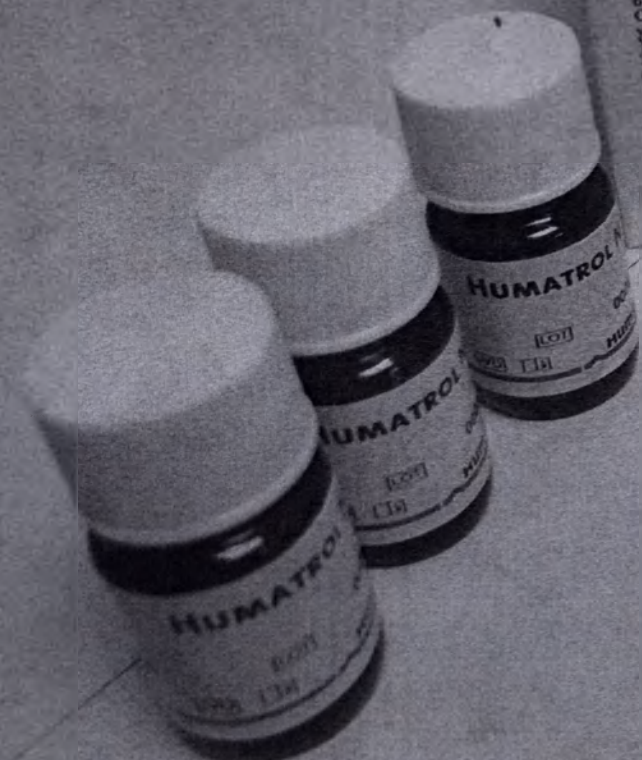




Набор контрольных материалов Humatrol N

23. Набор контрольных материалов (Humatrol P)

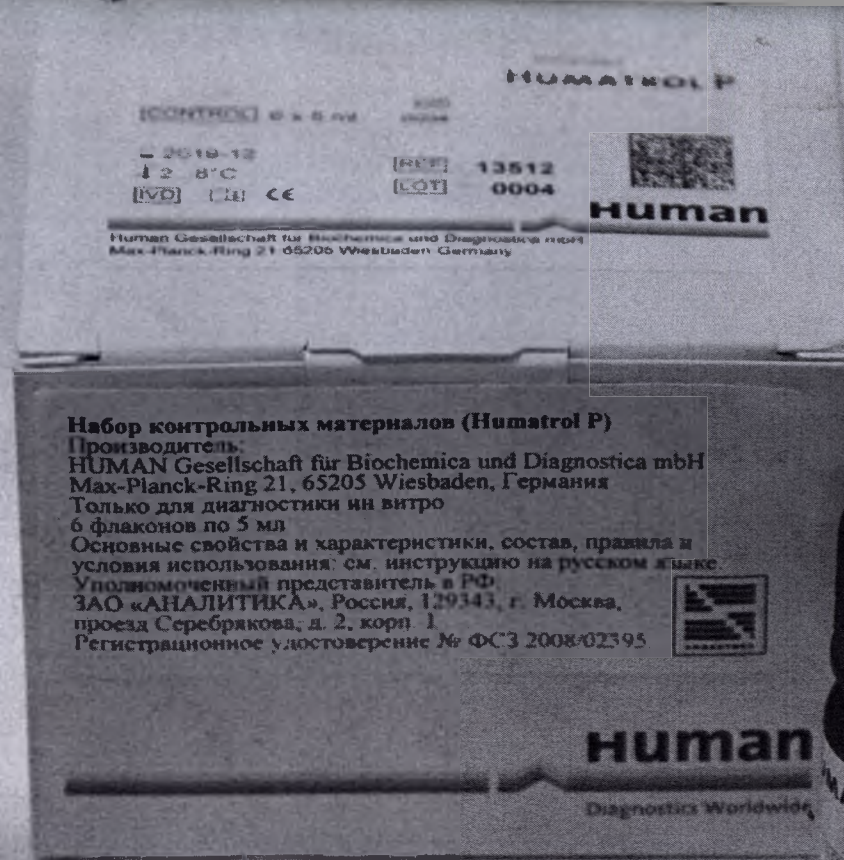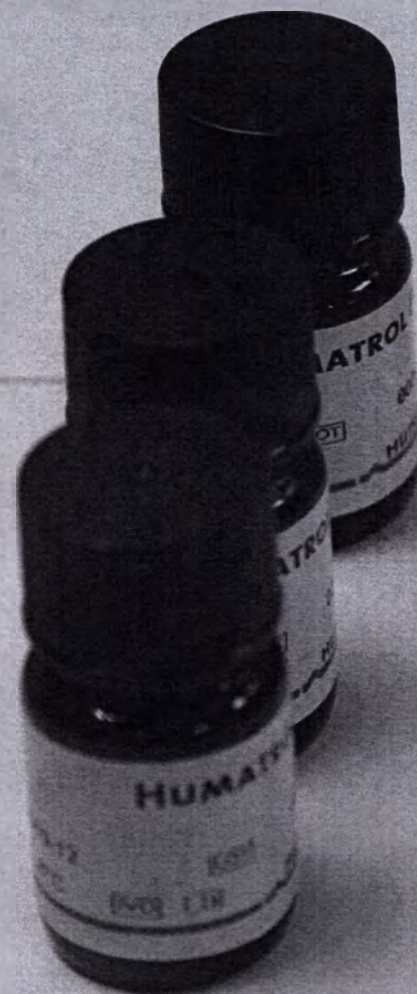

Набор контрольных материалов (Humatrol P)
Производитель:
HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH
Max-Planck-Ring 21, 65205 Wiesbaden, Германия
Только для диагностики in vitro
6 флаконов по 5 мл
Основные свойства и характеристики, состав, правила и
условия использования: см. инструкцию на русском языке
Уполномоченный представитель в РФ:
ЗАО «АНАЛИТИКА», Россия, 129343, г. Москва,
проезд Серебрякова, д. 2, корп. 1
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/02395



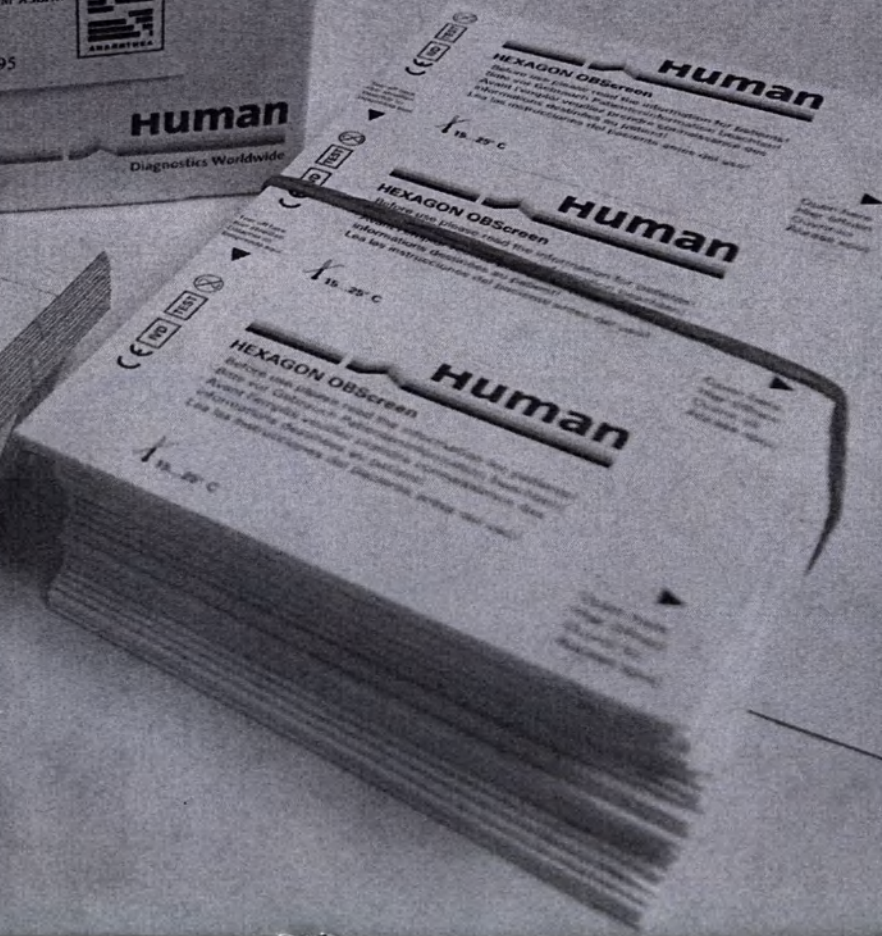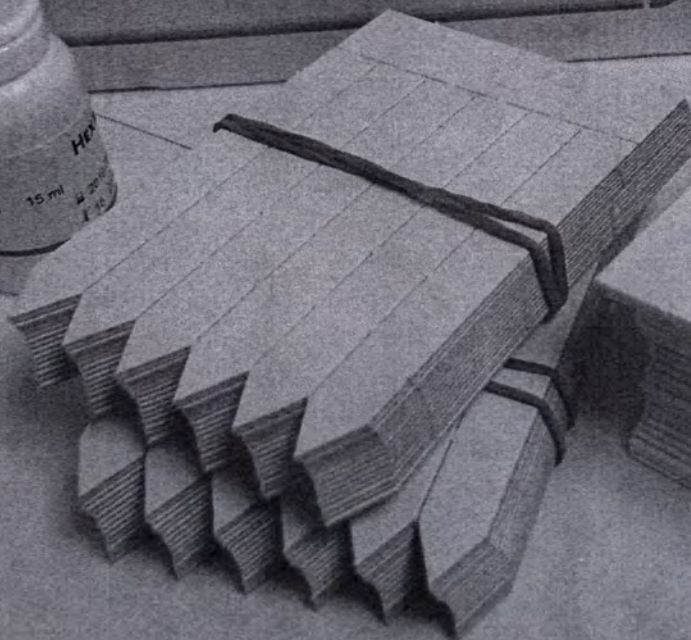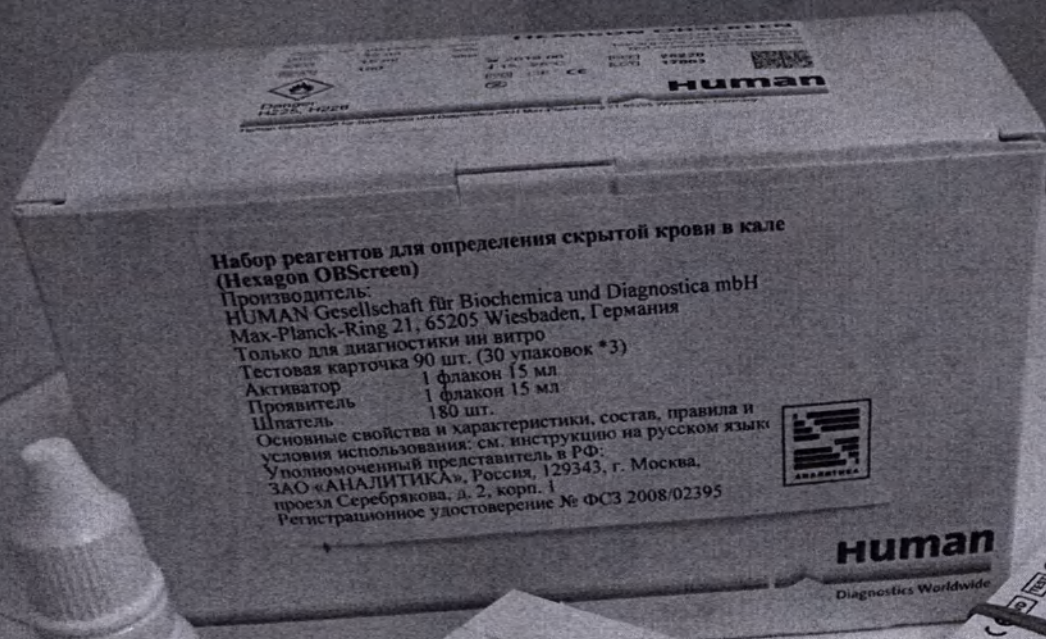

Набор реагентов для определения скрытой крови в кале (Hexagon OScreen)

Прошито и пронумеровано 14 листа
Генеральный директор
ЗАО «АНАЛИТИКА»

П.Г. Каленик

