



Фотографическое изображение медицинского изделия
Ультразвуковой диагностический аппарат
PT60A–RUS
с принадлежностями

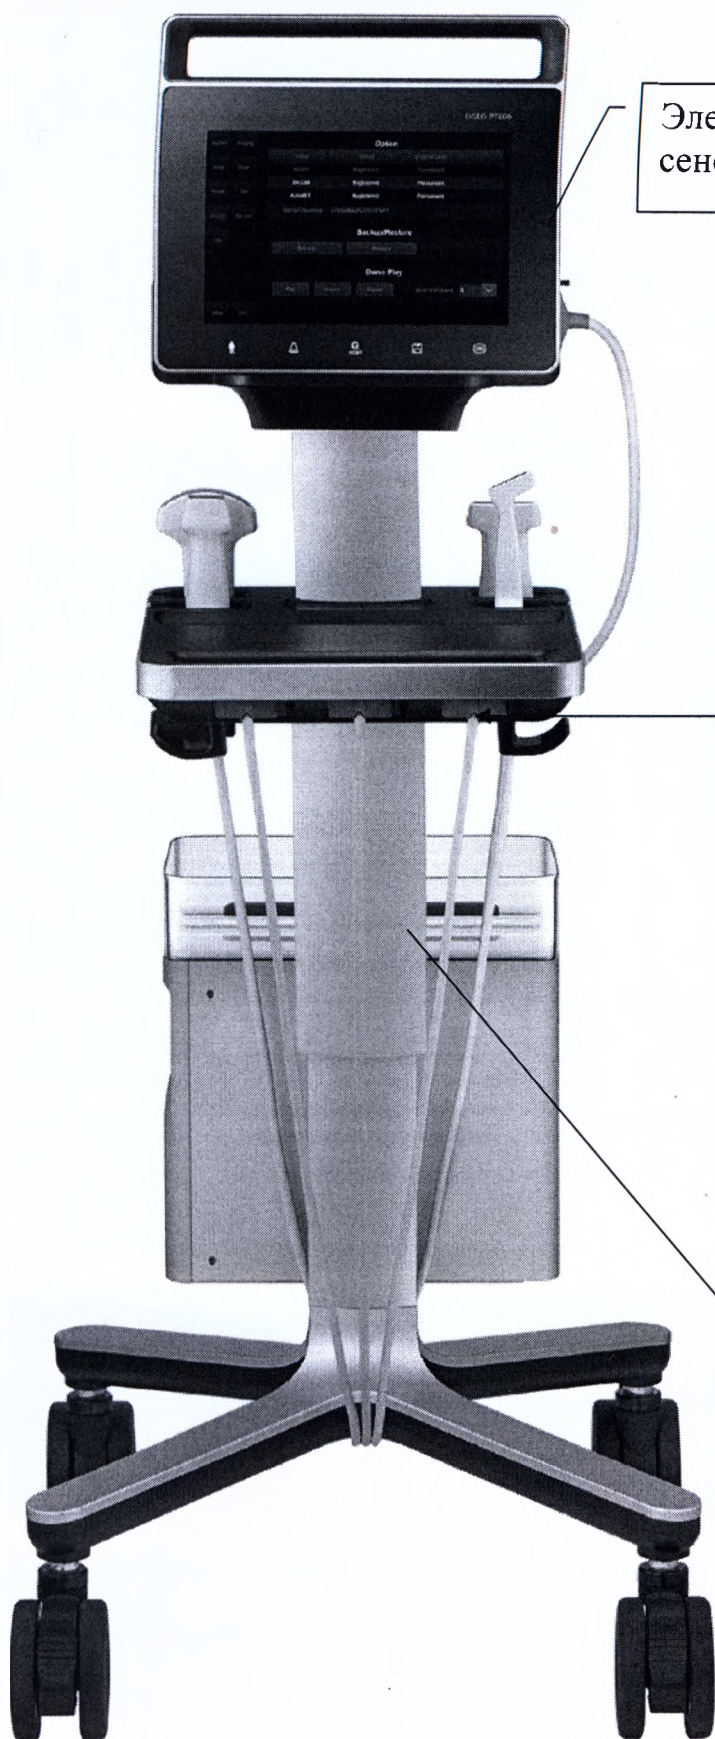

Электронная консоль со встроенным сенсорным экраном

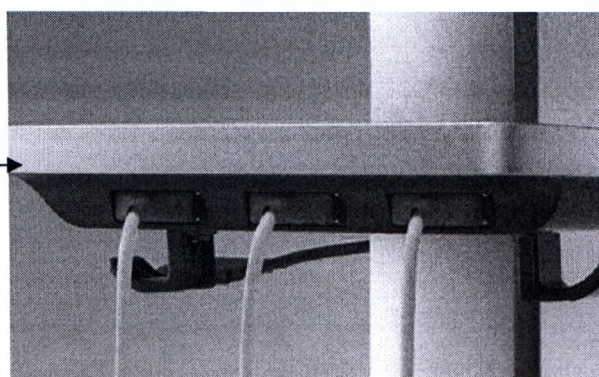


Разветвитель для подключения дополнительных датчиков

Приборная тележка

Электронная консоль со встроенным сенсорным экраном



Подставка

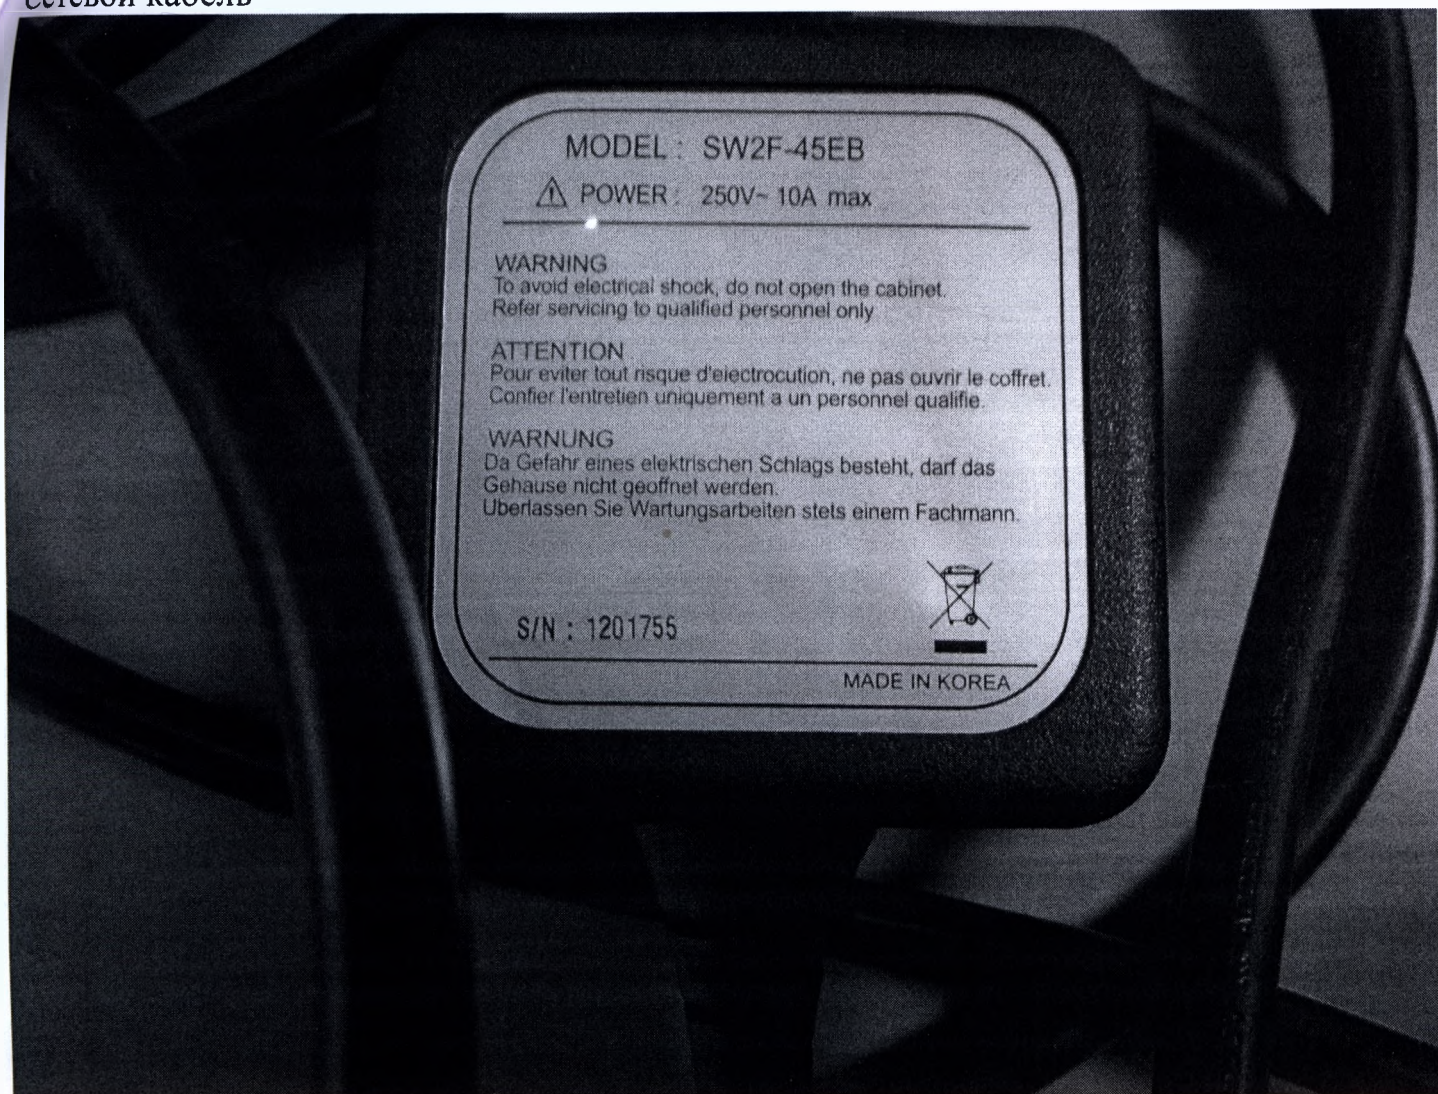

MODEL : SW2F-45EB

⚠ POWER : 250V~ 10A max

WARNING

To avoid electrical shock, do not open the cabinet.
Refer servicing to qualified personnel only

ATTENTION

Pour éviter tout risque d'électrocution, ne pas ouvrir le coffret.
Confier l'entretien uniquement à un personnel qualifié.

WARNUNG

Da Gefahr eines elektrischen Schlags besteht, darf das
Gehäuse nicht geöffnet werden.
Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets einem Fachmann.

S/N : 1201755



MADE IN KOREA

Системный адаптер





SAMSUNG

SAMSUNG MEDISON

**SAMSUNG
MEDISON**

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИЙ АППАРАТ

PT60A-RUS


Эксплуатационная документация
производителя



Руководство пользователя

Принадлежности:
Датчики конвексные:
С2-5 МГц




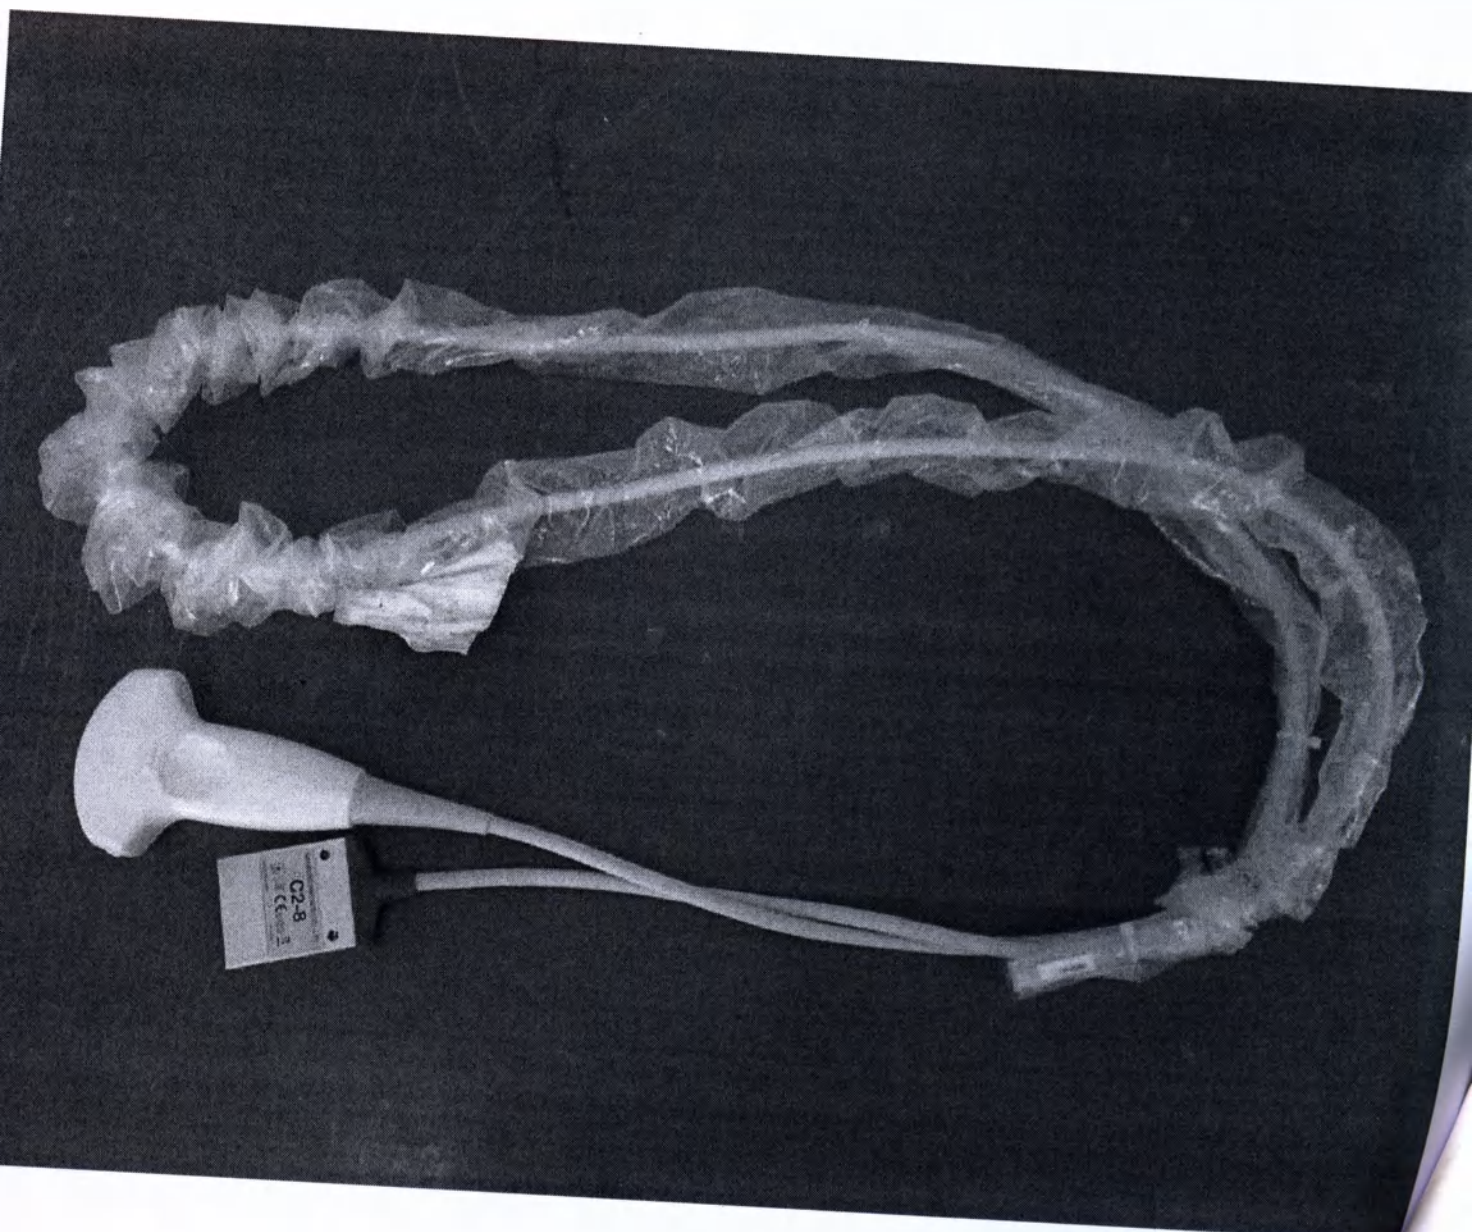


C2-8 MT II

EVN4-9 МГц




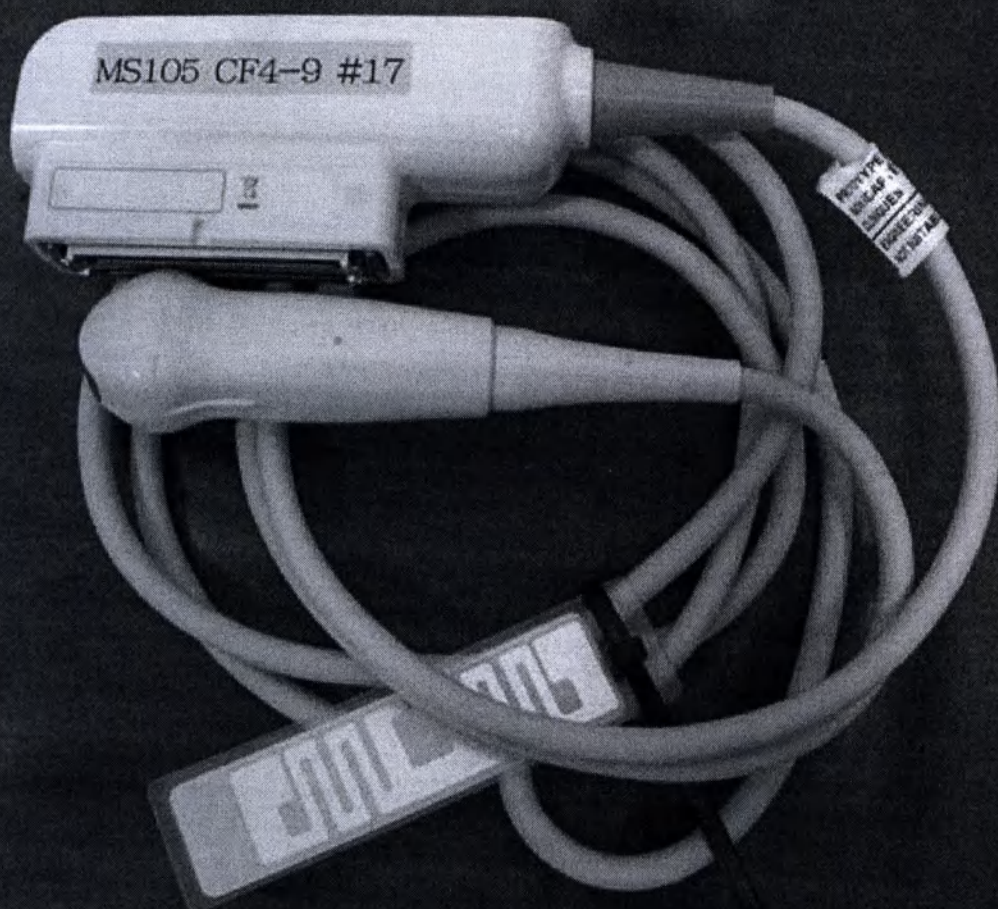


Датчики линейные:
LN5-12 МГц

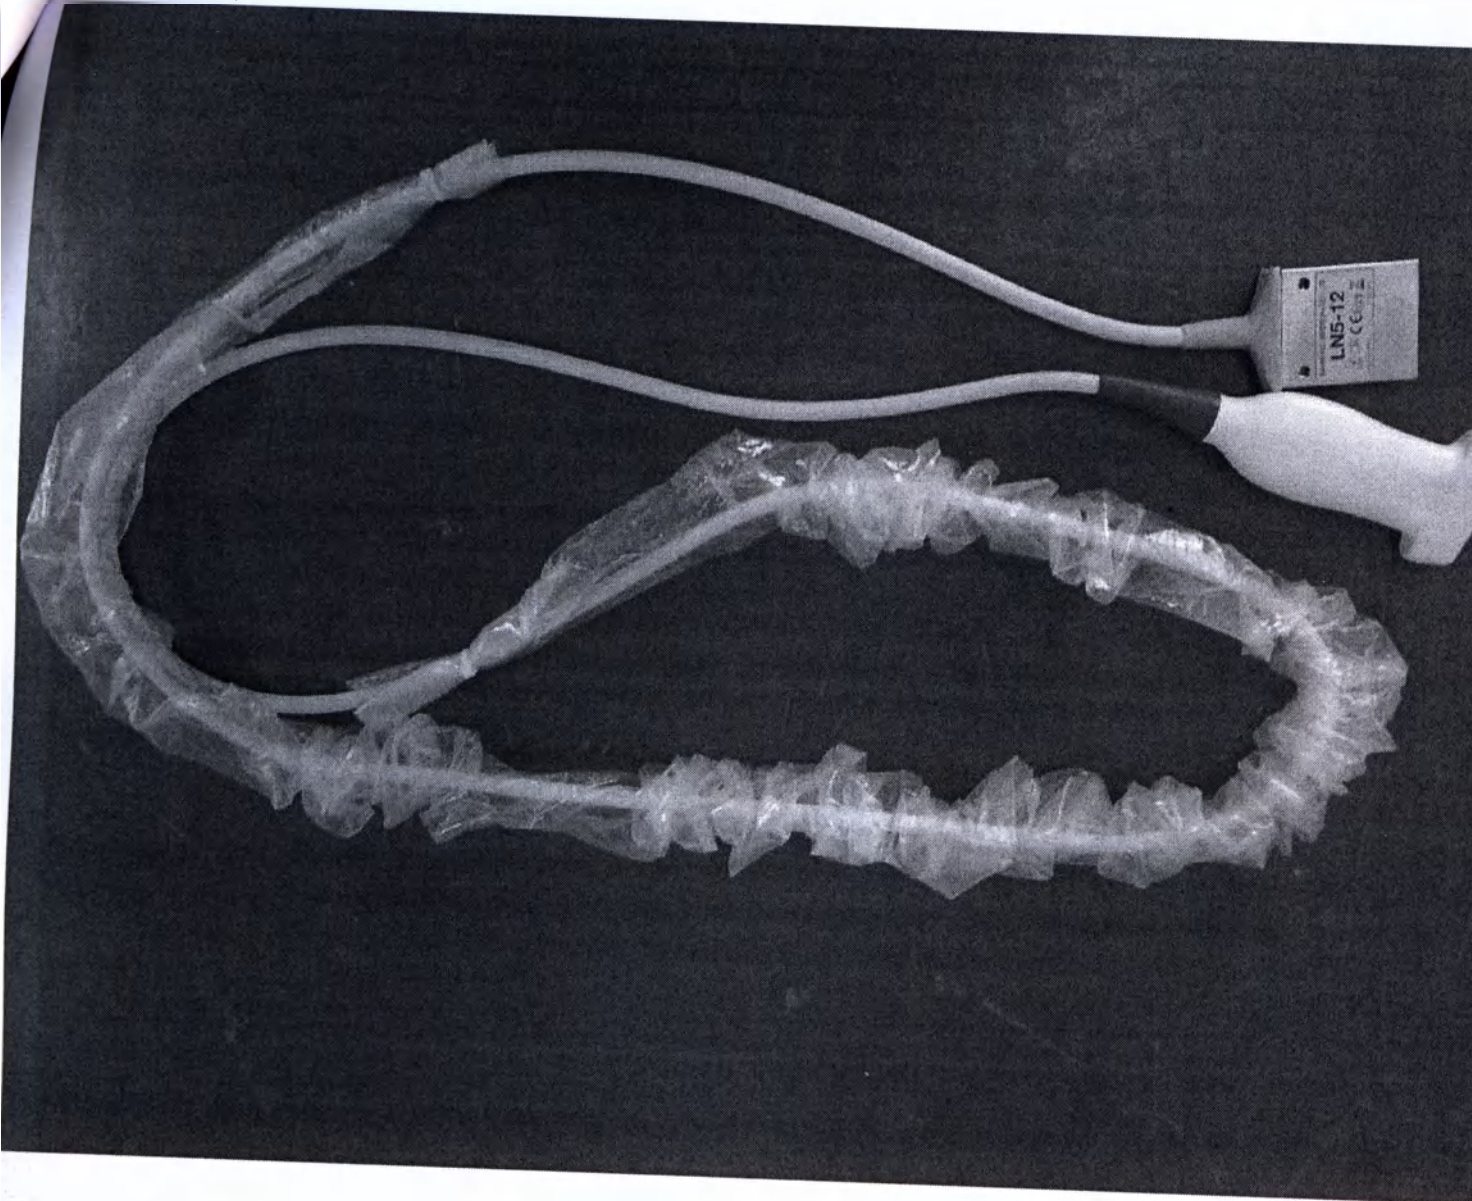

LS6-15 МГЦ

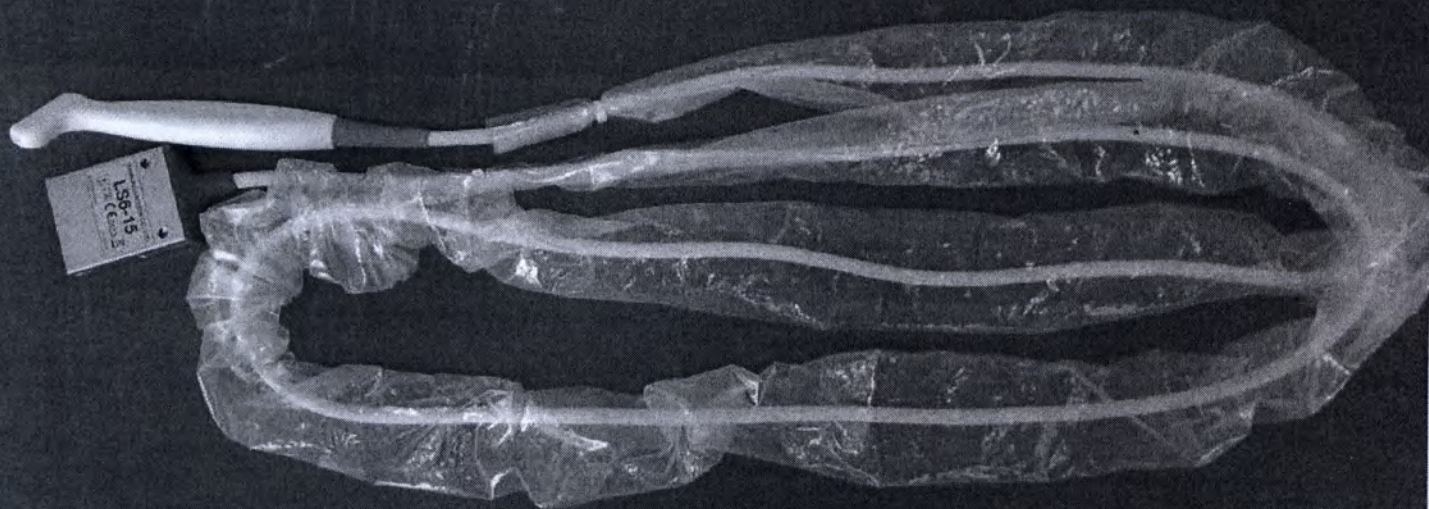

Датчики фазированные:
PN2-4 МГц

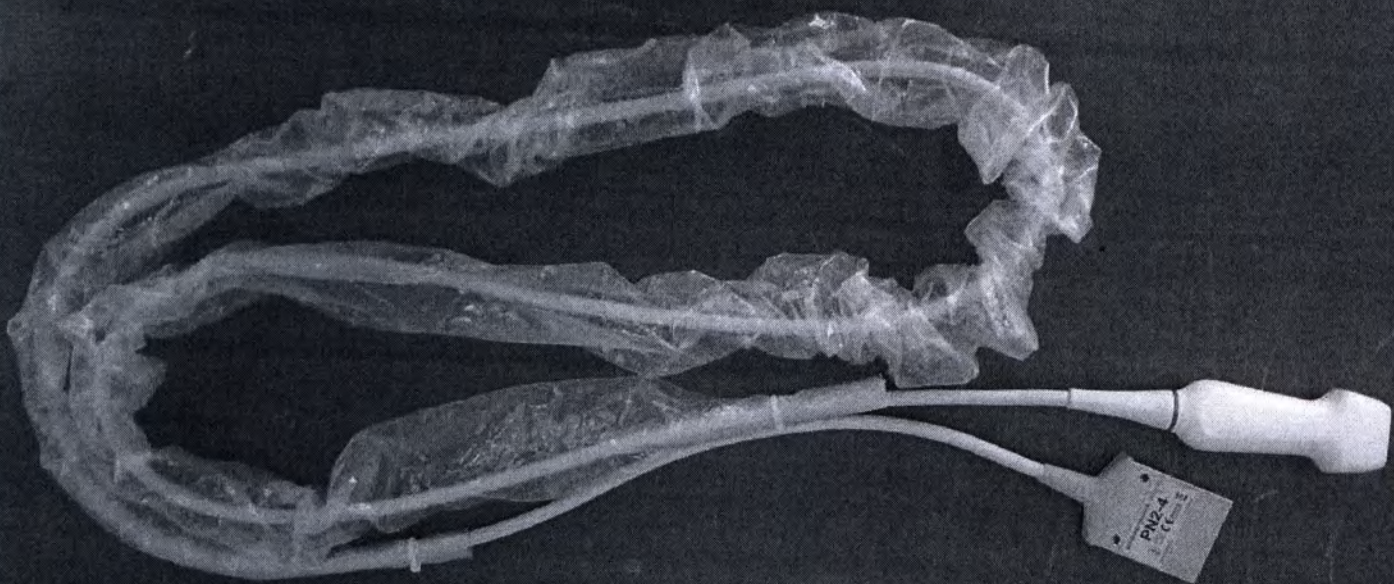

P4-12 МГц




Датчики постоянно-волновые:
DP2-2A




Набор для проведения биопсии:

направляющая иглы

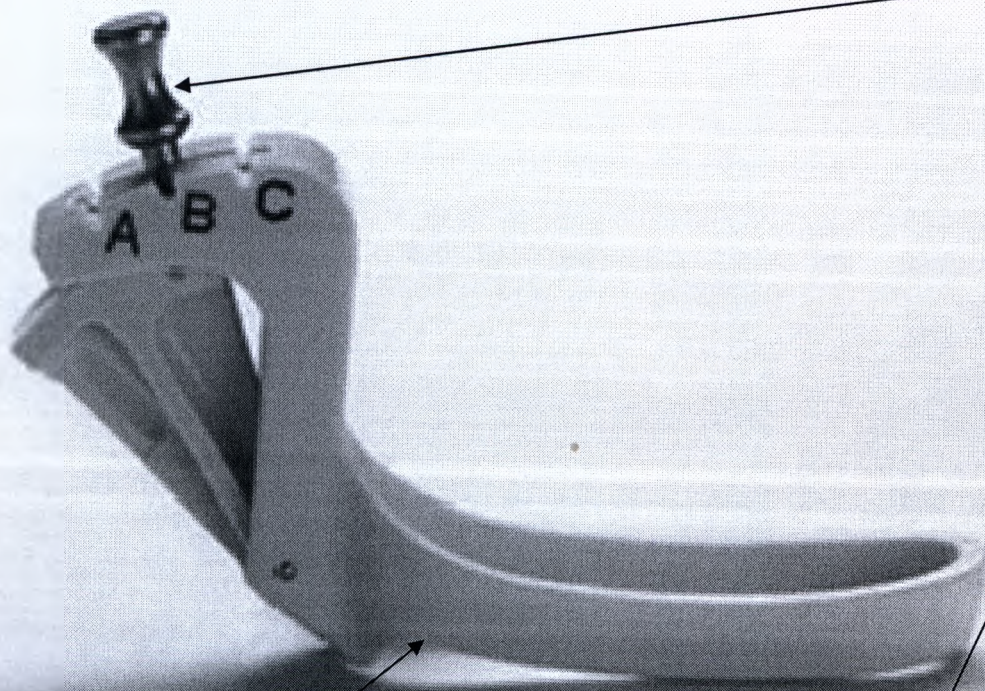


насадка для биопсии

Крепление

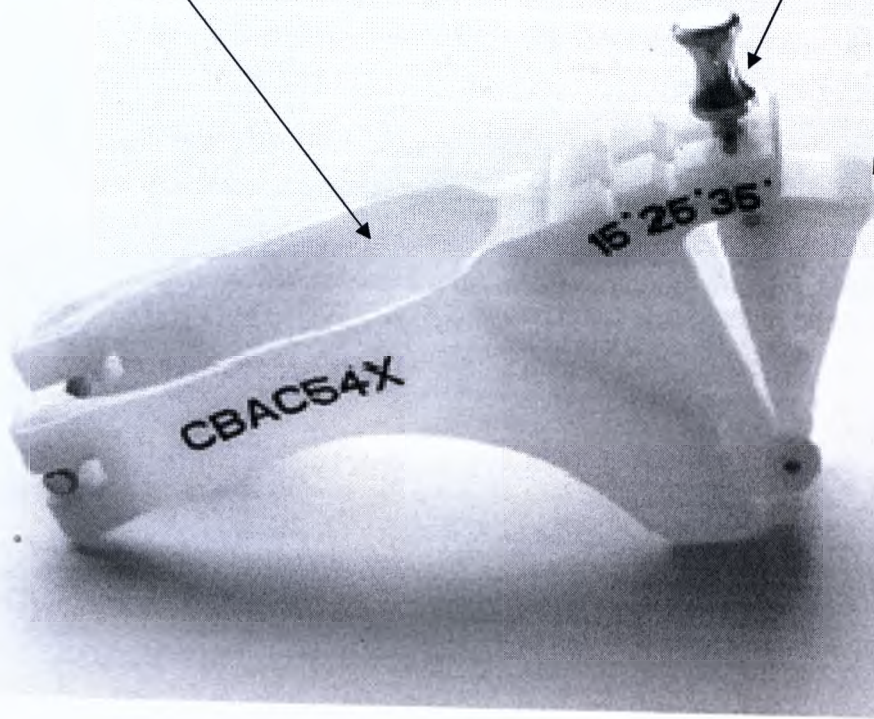

Набор для проведения биопсии:


Насадка для биопсии

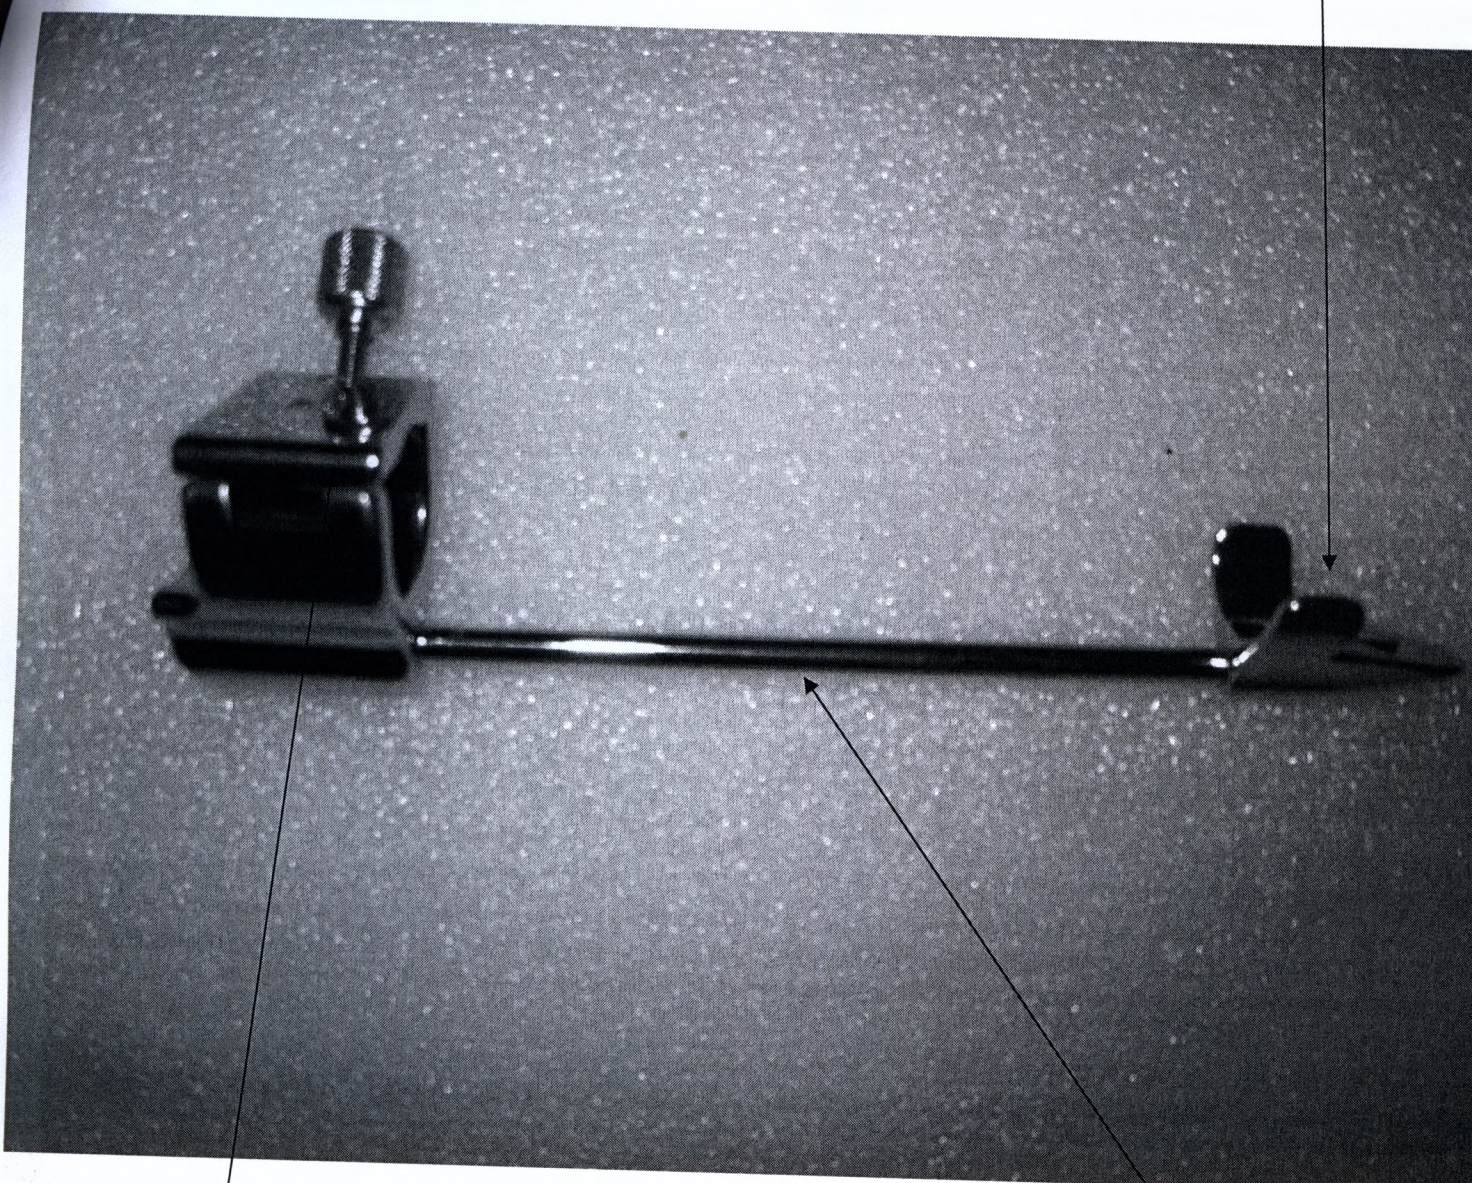

Крепление

Направляющая игла

Лицензионный ключ для активации функции определения комплекса Интима/Медиа
(Авто IMT);
Фотография экрана с активированной функцией:

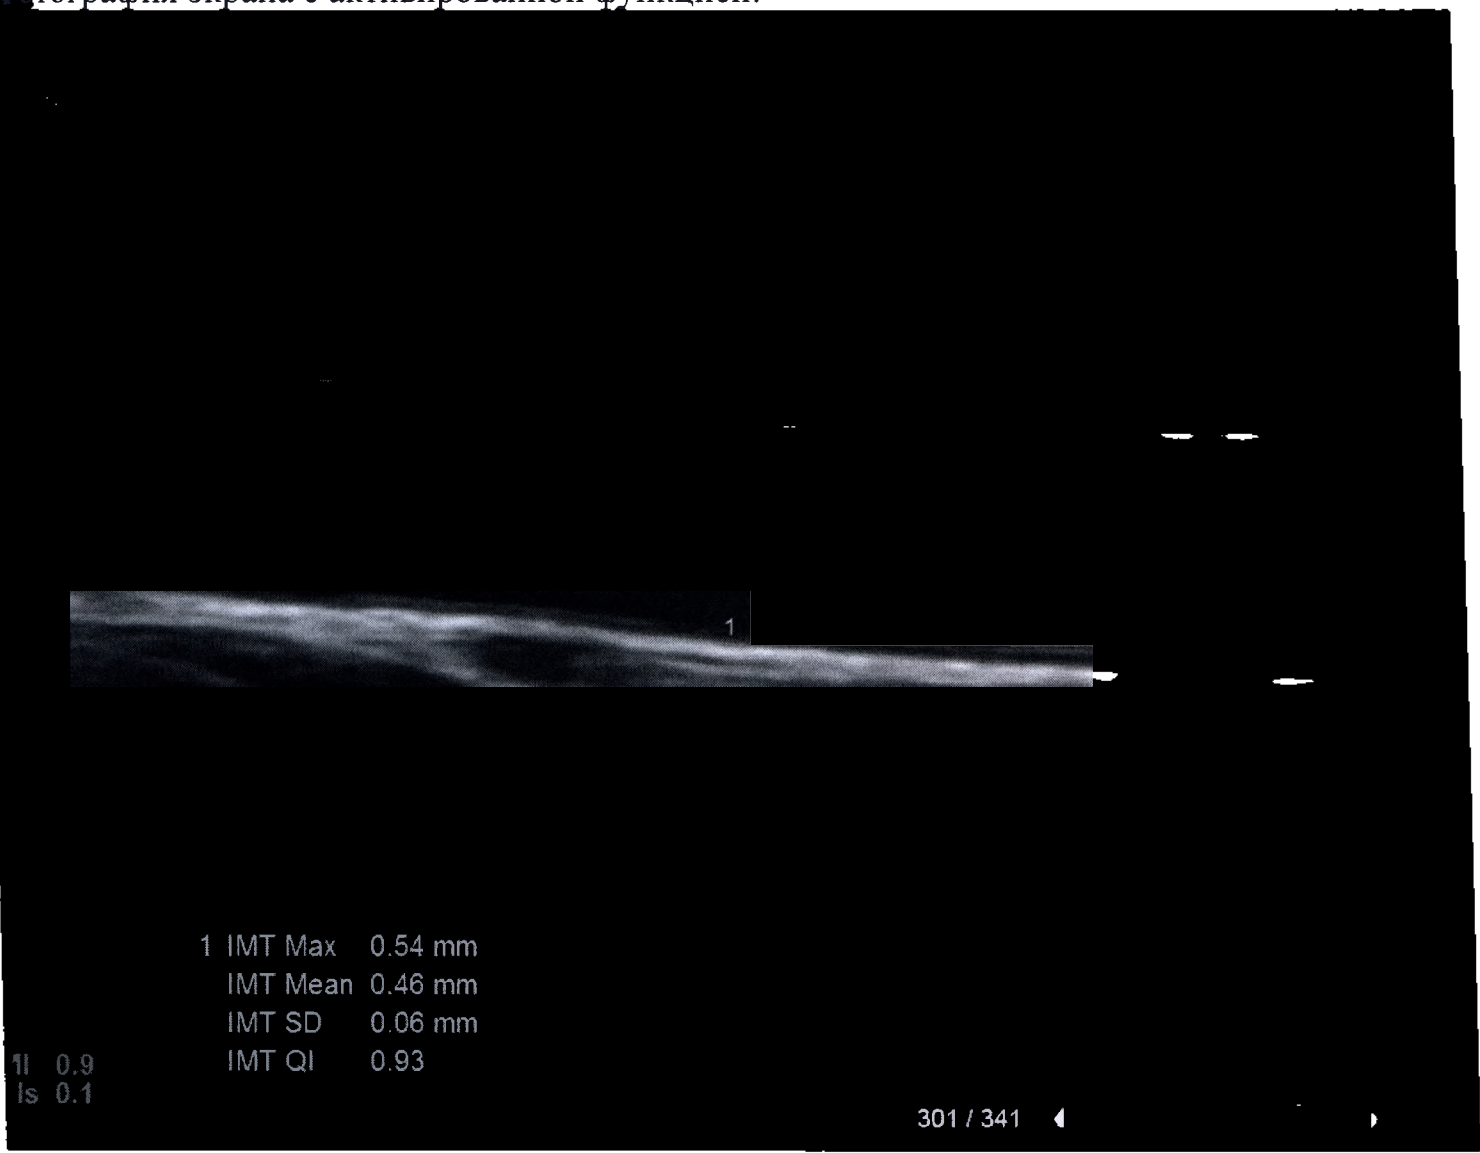

Лицензионный ключ для активации функции получения пространственного компаунди
'SCF;

Фотография экрана с активированной функцией:

PT60A

PT60A DEMO

2013-05-30 11:52:55

MI 1.0
s 0.1

tore complete

Лицензионный ключ для активации режима, обеспечения передачи данных в формате DICOM;
Фотографии экрана с активированной функцией:

Режим
визуализ

Измер

Сервис

Сохранит

Конфигурация системы

Назв. станции

Имя АЕ

№ порта

Форм. СтрОтч

Сохранить СтрОтч в конце осмотра

Имя службы

Псевдоним

Имя АЕ

РАБОЧИЙ СПИСОК

WORKLIST

JWORK

Добавить

Лицензионный ключ для активации функции повышения контрастности изображения SDI
Фотографии экрана с активированной функцией:

Режим
визуализ.

Конфигурация системы

Аннотация Измер

[SystemInfo]

Manufacturer : SAMSUNG MEDISON

ModelName : PT60A

SystemSerialNumber : 120424A01205170A1205170A????????

SystemVersion : 1.00

Периф. Сеть

PC : QMEN

CPU : Intel(R) Atom(TM) CPU Z530 @ 1.60GHz

DICOM Сервис

Graphic Card : Intel(R) Graphics Media Accelerator 500

[SoftwareInfo]

OSVersion : Microsoft Windows NT 6.1.7601 Service Pack 1

SWVersion : 1.00.02.3214

SWBuildDate : 2014-04-14

[DisplayInfo]

HasTouchDevice : True

[AtomFileInfo]

ID : 70 Name : LN5-12 Ver : RSTACHYONLN5123E


ID : 74 Name : C2-8 Ver : RSTACHYONC283E

ID : 7F Name : LS6-15 Ver : RSTACHYONLS6153E

Запись на устройство

Лицензионный ключ для активации программы анализа/обработки и сохранения изображений
SonoView

Фотографии экрана с активированным режимом:

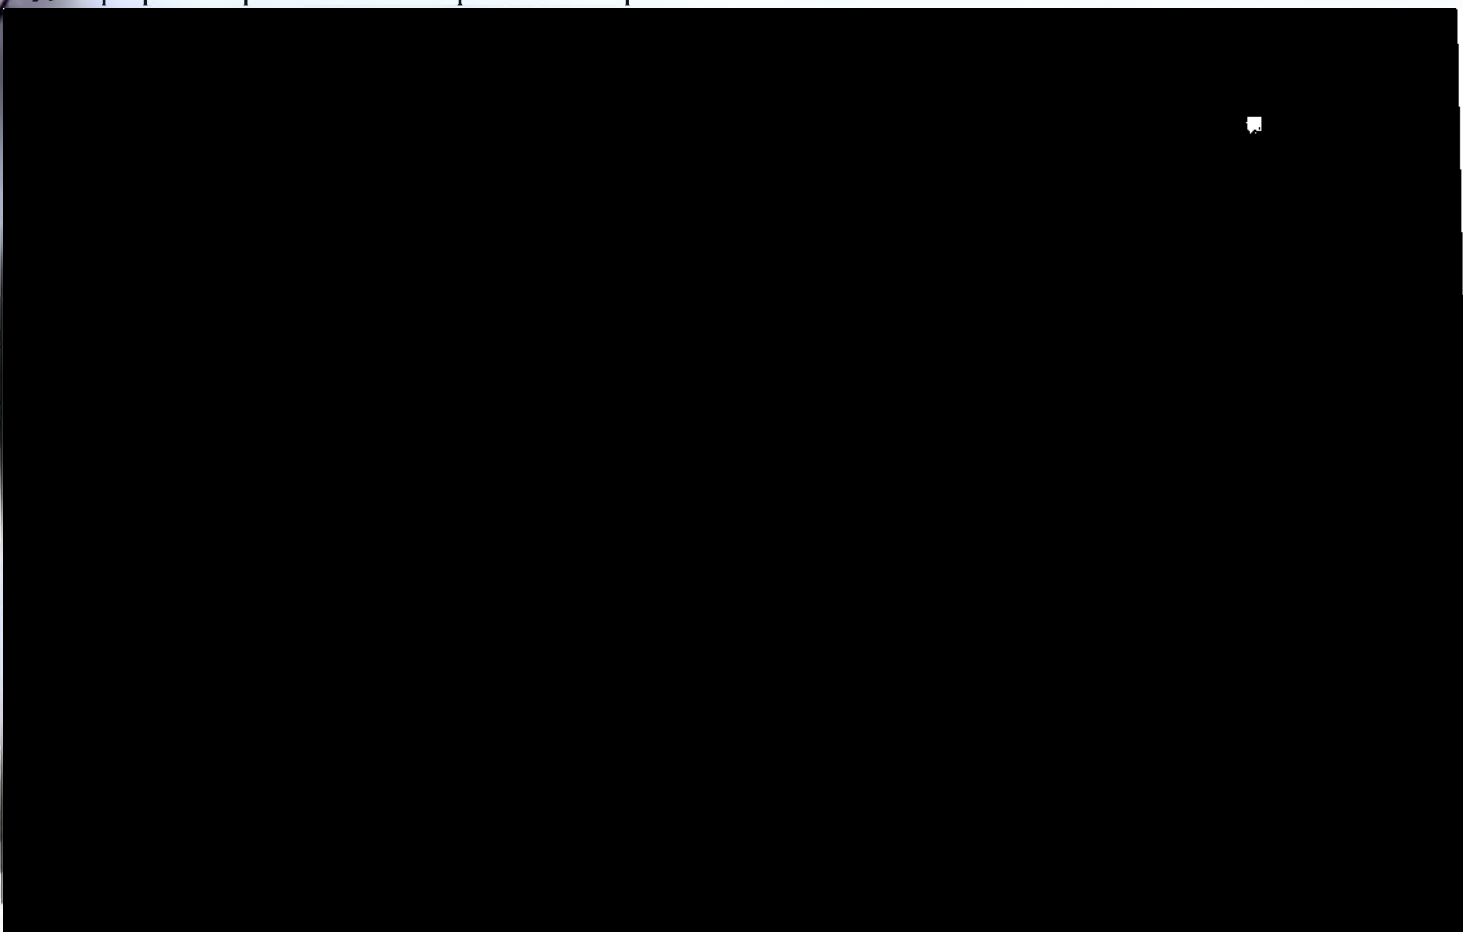

Лицензионный ключ для активации функции улучшения визуализации иглы при проведен
биопсии Needle Mate
Фотографии экрана с активированной функцией:

03-21-2013 02:20:38

Needle
Mate
Сним
LN5-12
3.0 см
30Hz

Усиление
[2D]
Разр
Ус. 3
ДД 3
Дав. 100%


ОИ иглы

Влево 5° Вправо 5°


Влево 10°


Центр Выход

сензионный ключ для программы кардиологических исследований
фотографии экрана с активированной функцией:

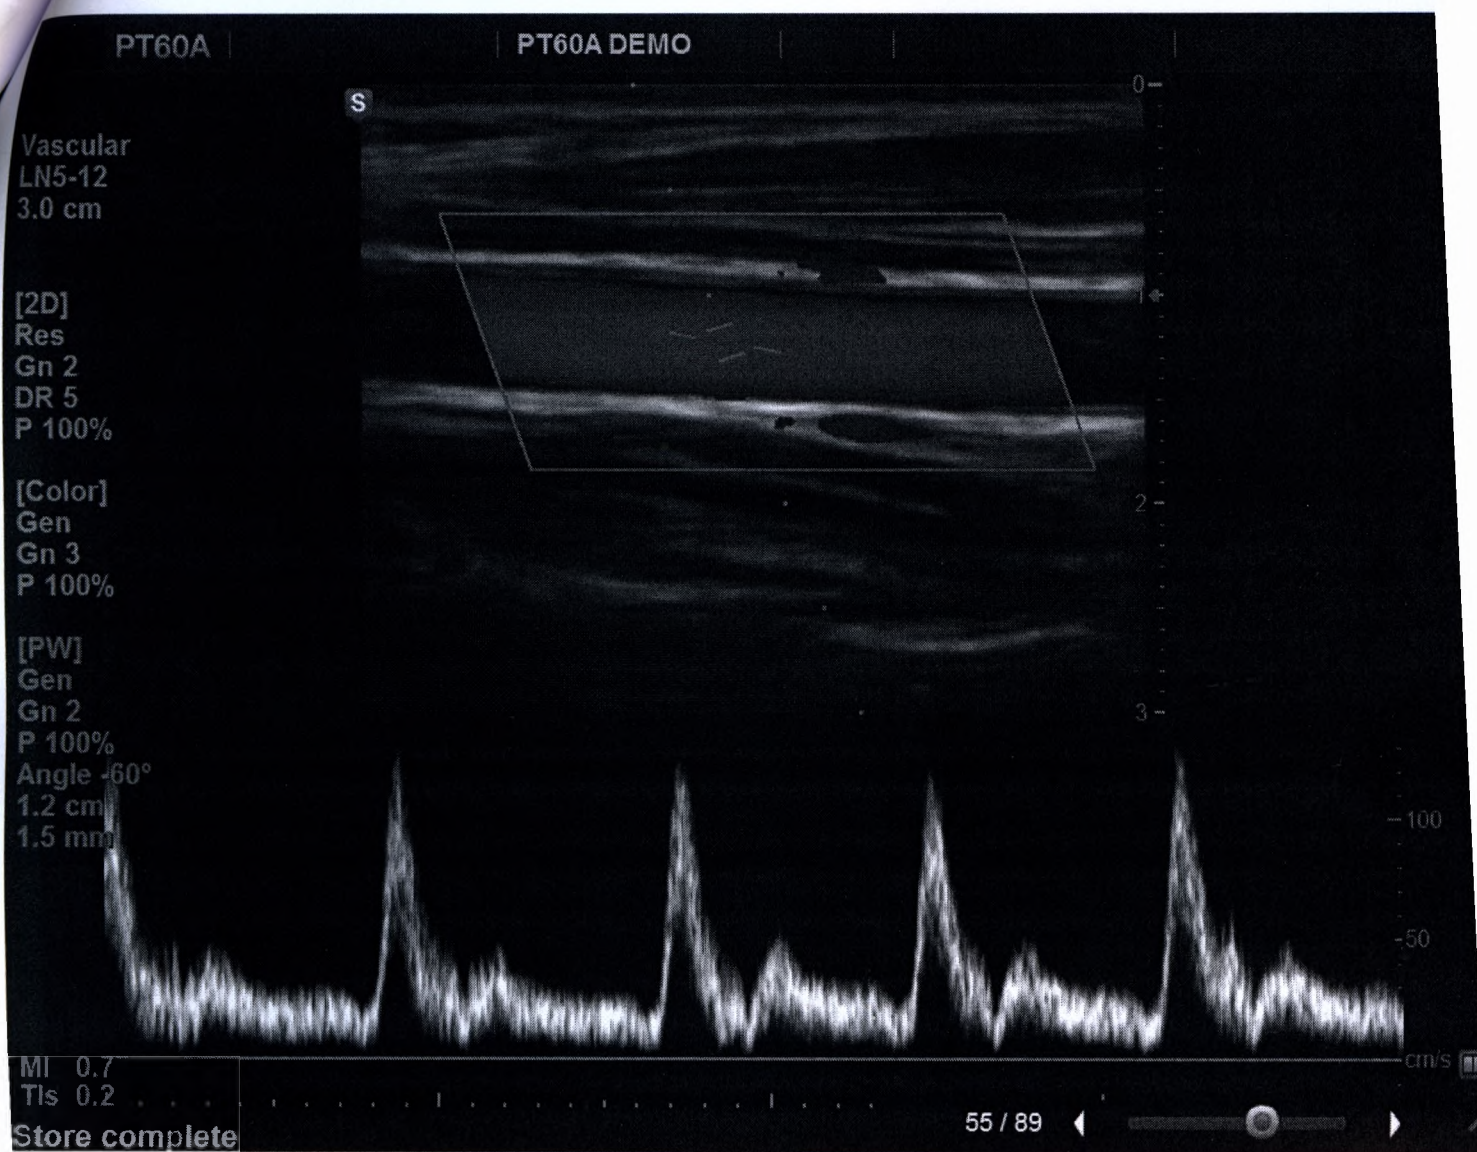

Двухпозиционный ключ для активации функции исследований в режиме постоянно-волновое доплера;
Фотографии экрана с активированной функцией:

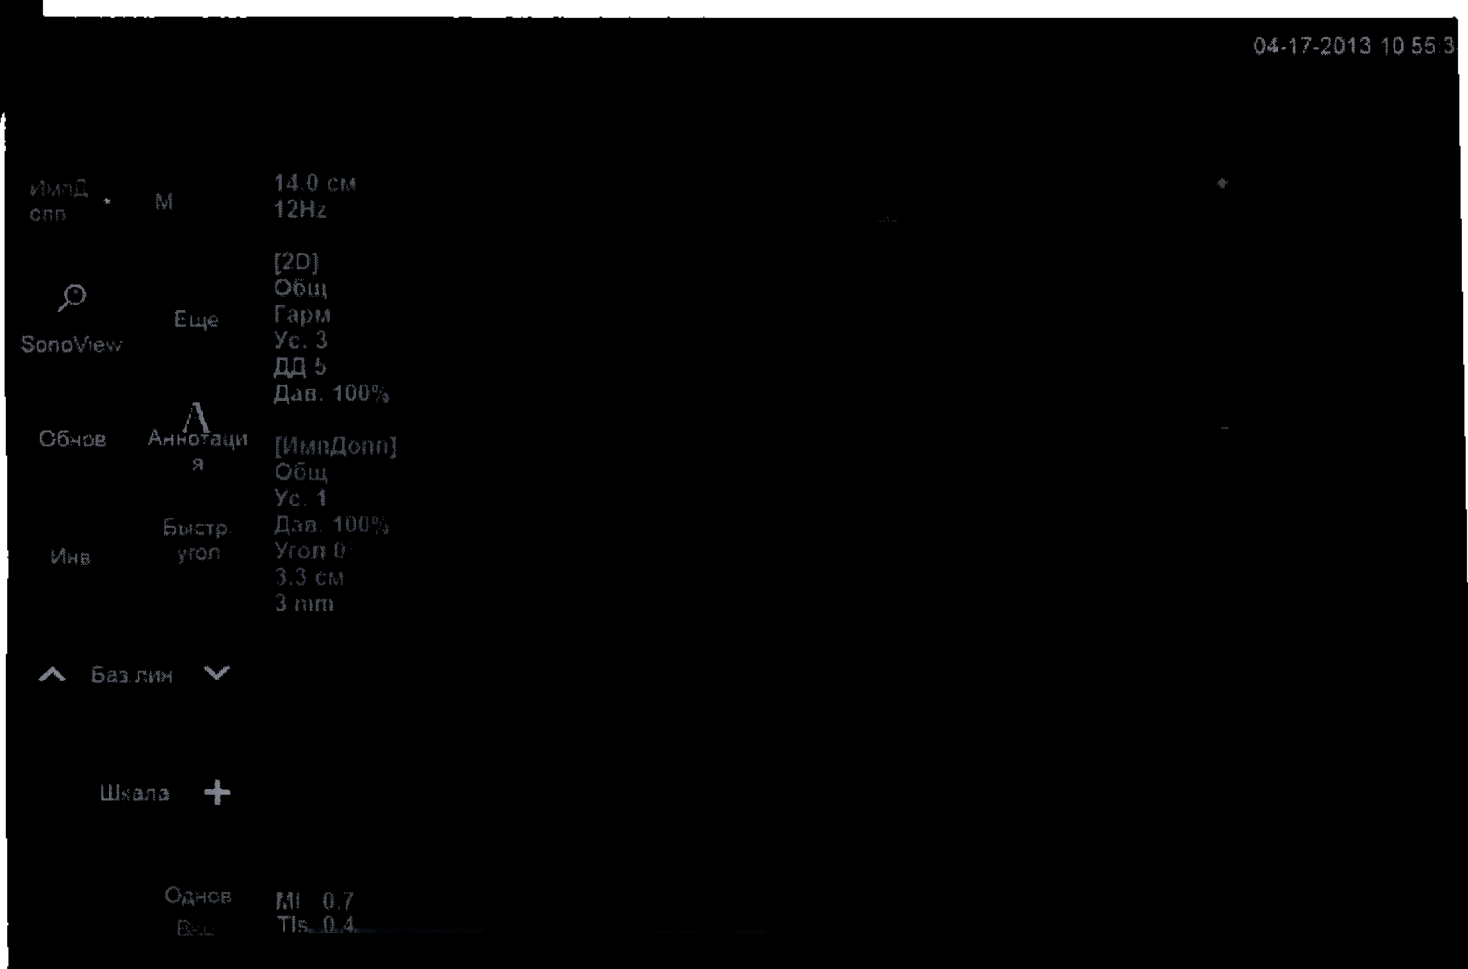

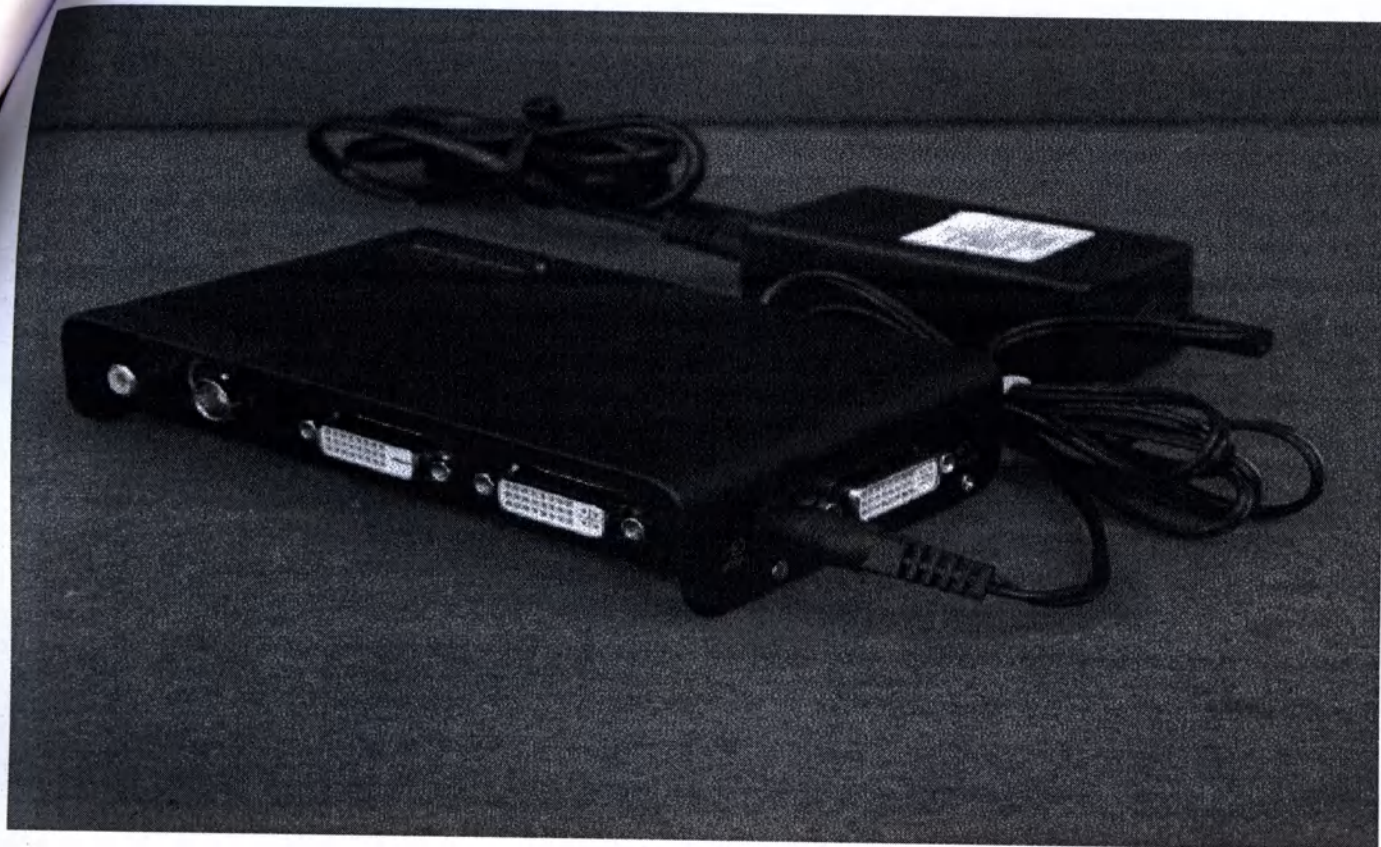


<Over view>




<SIP/SOP ports on the rear side>

ручной переключатель

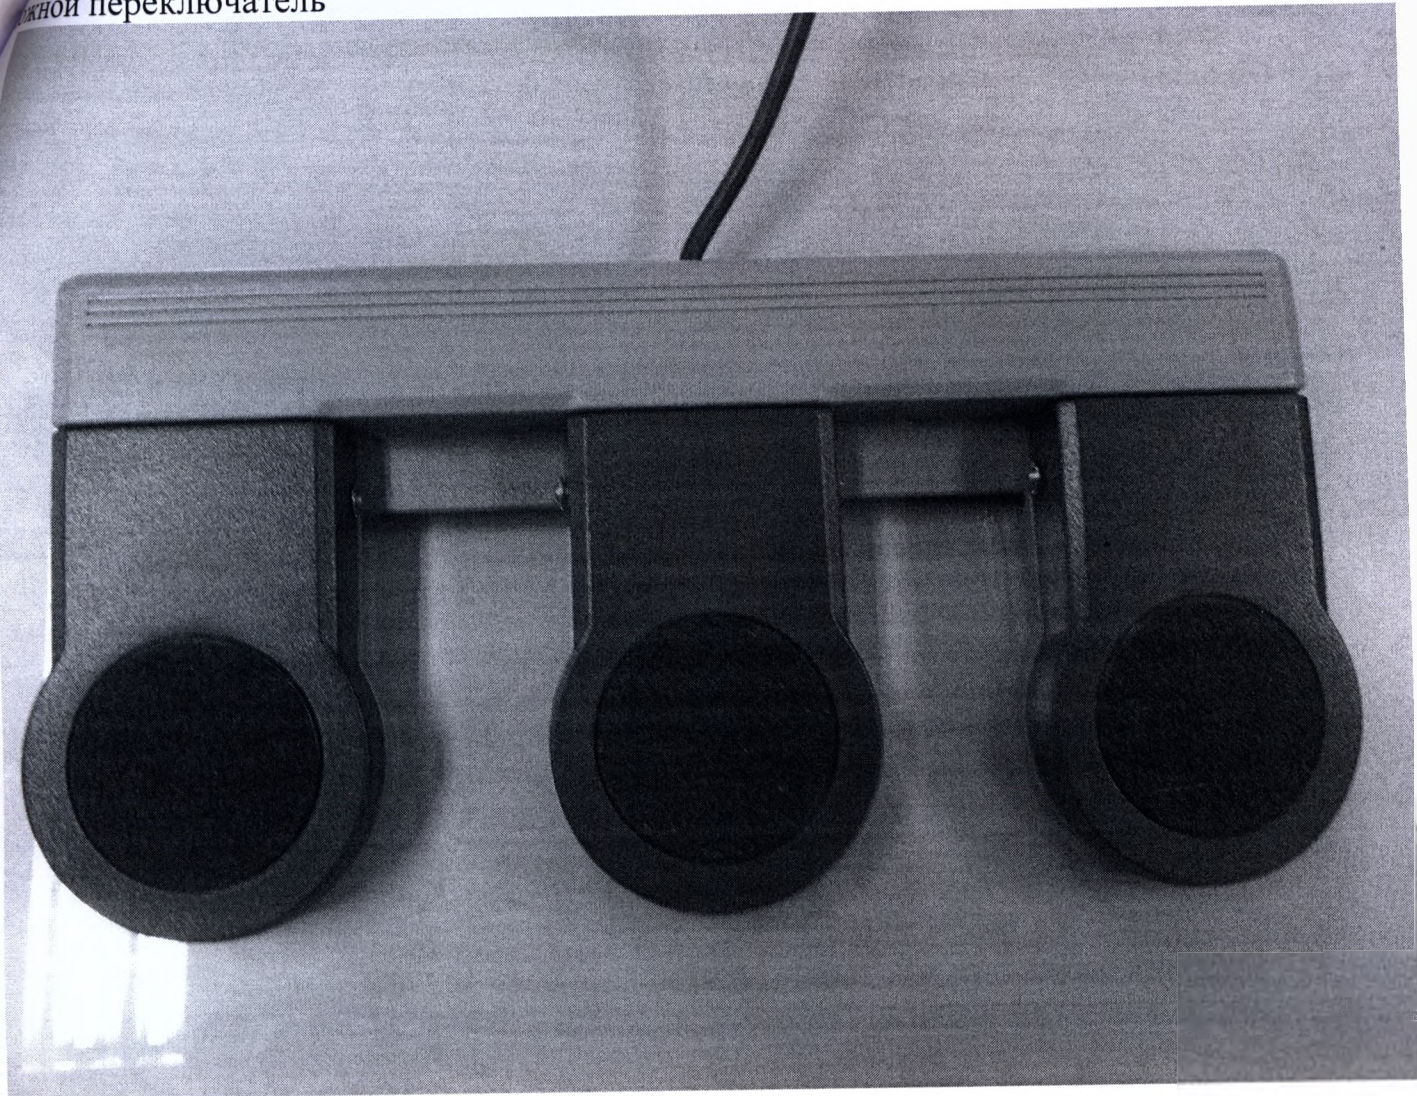




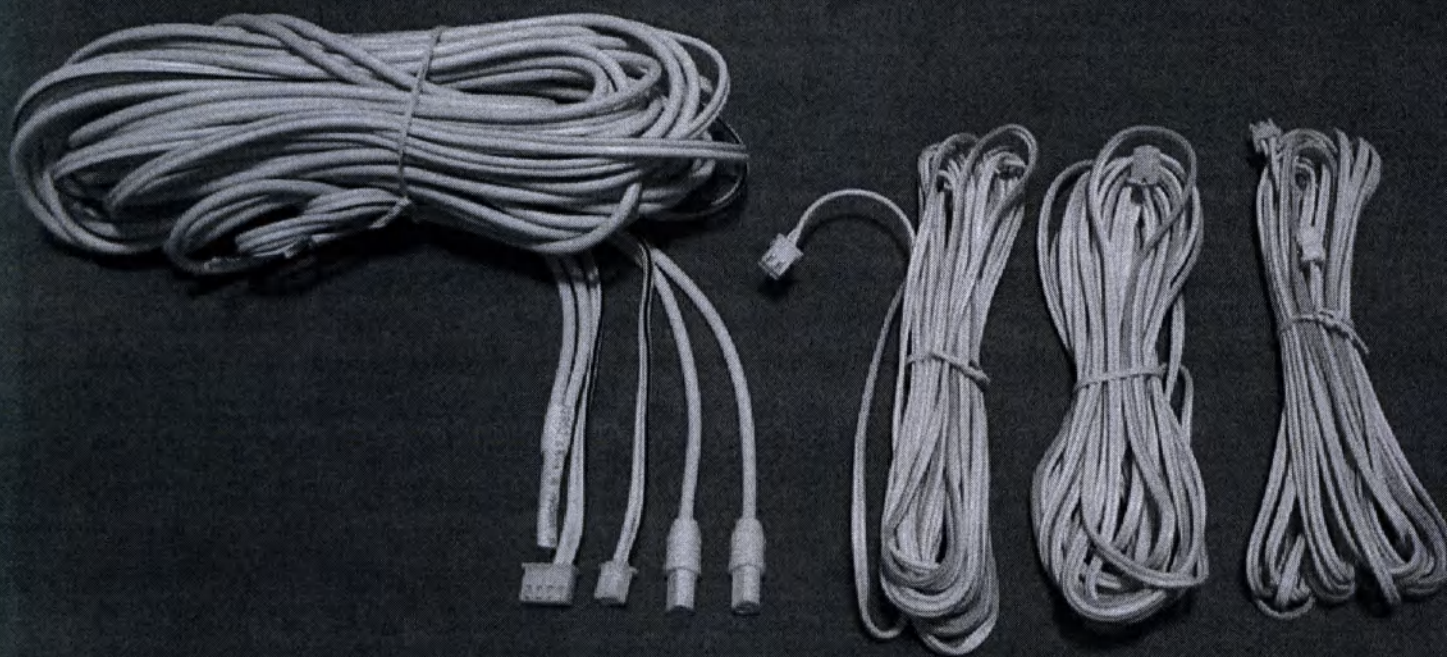



SAMSUNG MEDISON CO., LTD.
42, Teheran-ro 108-gil, Gangnam-gu, Seoul, Korea
www.samsungmedison.com



SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LTD.
Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

- MODEL/МОДЕЛЬ: PT60A-RUS
- POWER/ПИТАНИЕ: Connect to Adapter : 19V $\equiv$, 9.47A, 180VA
Connect to Cart : 18V $\equiv$, 11.12A, 200VA

for use with adapter model FSP180-ABAM1 (FSP Group Inc)
for use with Cart's SMPS model PM202-13-1B (FSP Group Inc)



ВНИМАНИЕ

- Do not remove the system's covers; hazardous voltages are present inside. The cabinet panels must be in place while the system is in use.

- Внутри системы опасное для жизни высокое напряжение. Никогда не включайте в сеть УЗ сканер со снятыми панелями корпуса. Всегда используйте защитное заземление при работе системы.

MI68-02380A
(RUS)



UL60601-1/CAN/CSA
C22.2 No. 601.1
92DJ



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 82
листов.

