


Фотографические изображения  
медицинского изделия

**Лампы щелевые офтальмологические  
диагностические, в вариантах исполнения  
Z-Series, H-Series с принадлежностями**

Производства : KEELER LIMITED (КИЛЕР ЛИМИТЕД)

Clewer Hill Road, Windsor, Berkshire, SL4 4AA, United Kingdom

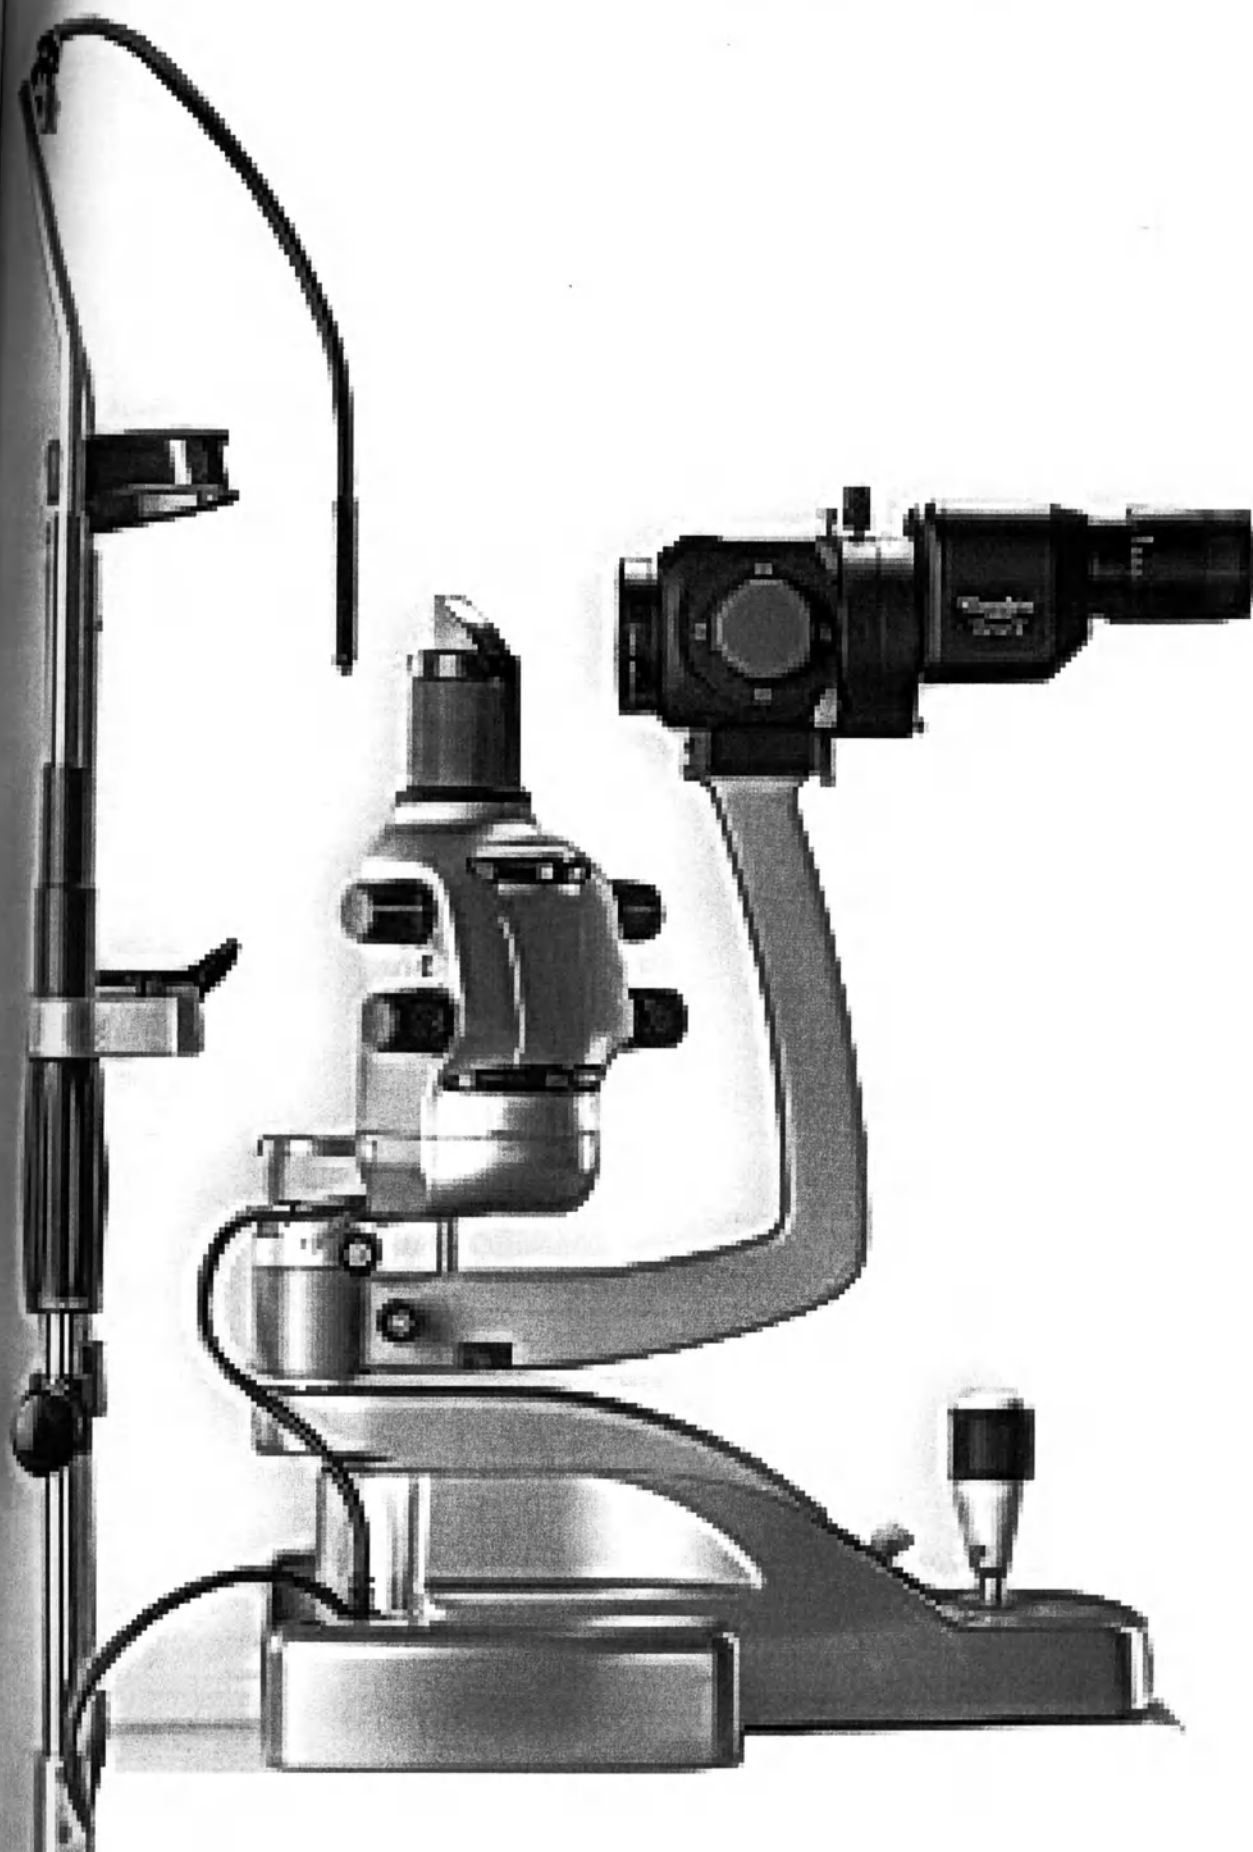











**Keeler**

HSeries Slitlamp

REF 3020Z

SN 02523




Keeler Ltd,  
SL4 4AA. UK





1. Базовый состав № 1: 1.1 Основание щелевой лампы – 1 шт.

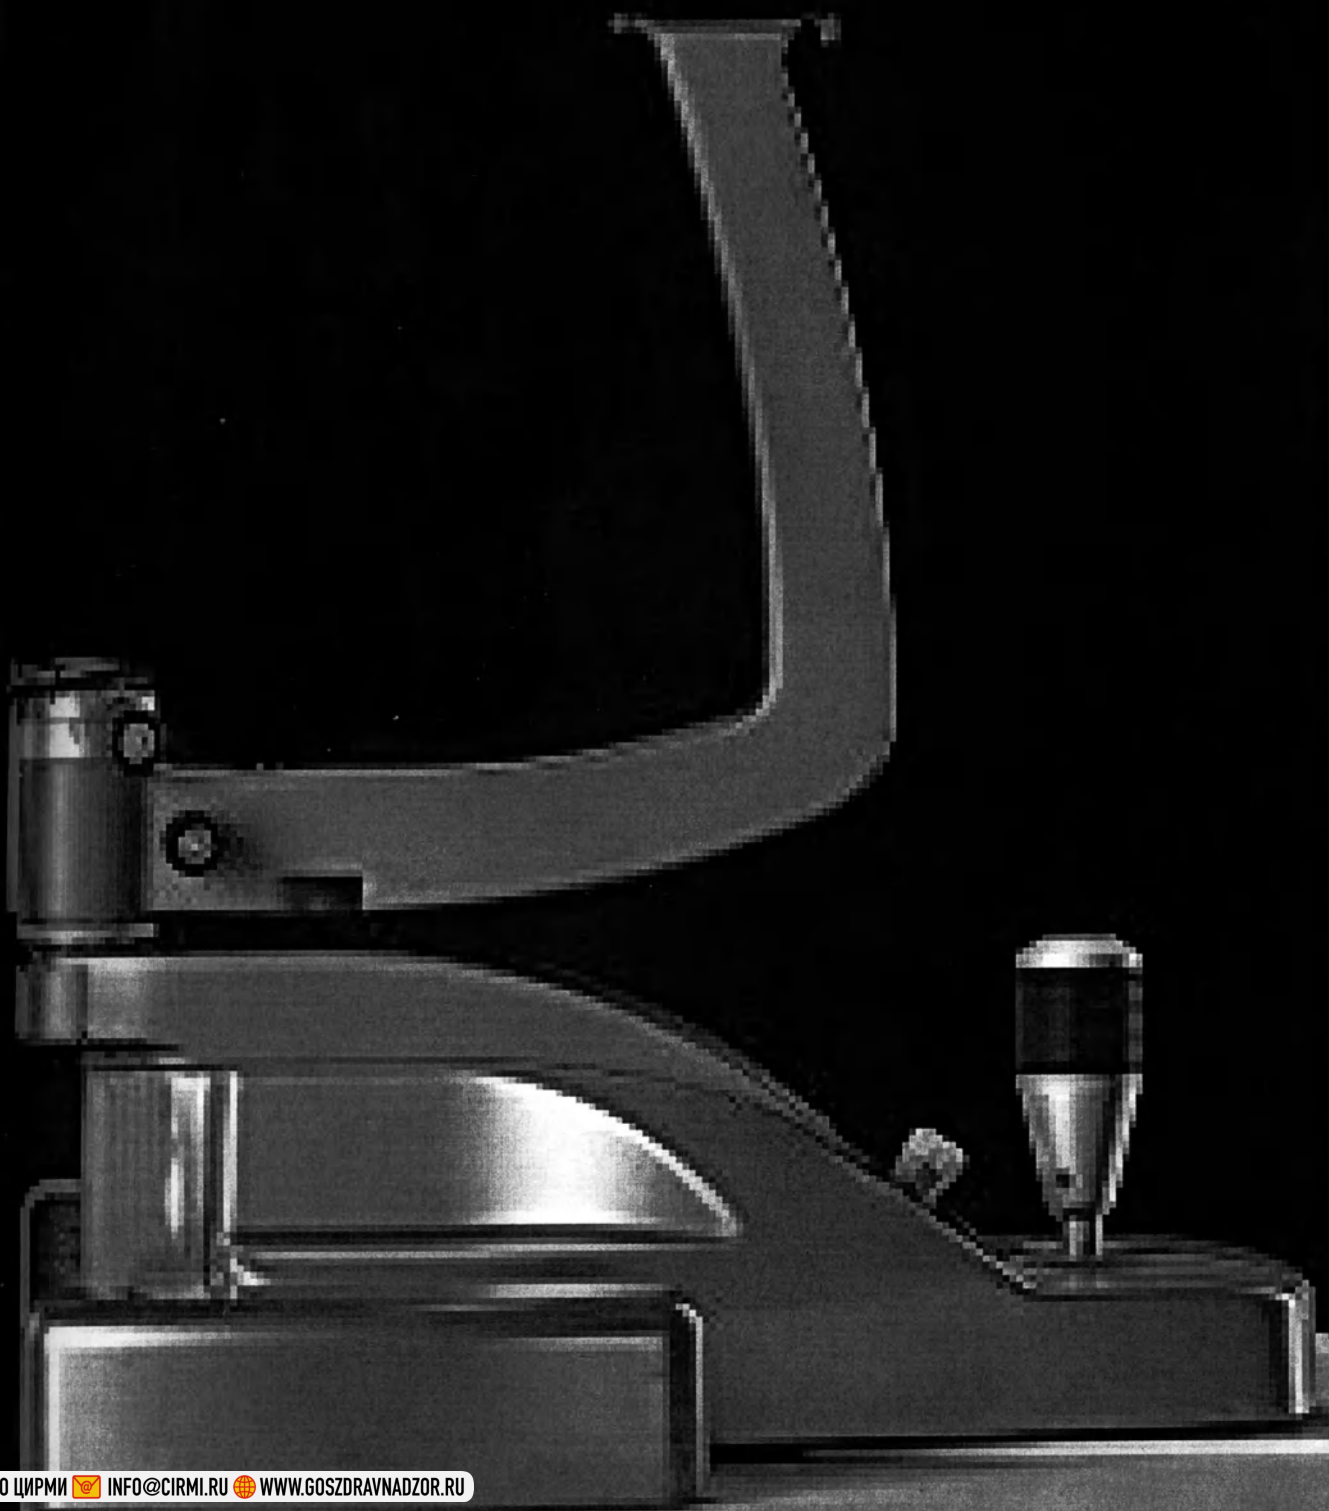



1. Базовый состав № 1: 1.2 Микроскоп щелевой лампы, в составе: - Блок микроскопа с параллельной оптикой и 3-х ступенчатым увеличением – 1 шт.; - Бинокуляр – 1 шт.; - Окуляры – 2 шт.






Базовый состав № 1: 1.3 Башня осветительная – 1 шт.





1. Базовый состав № 1: 1.4 Упор для головы пациента – 1 шт.

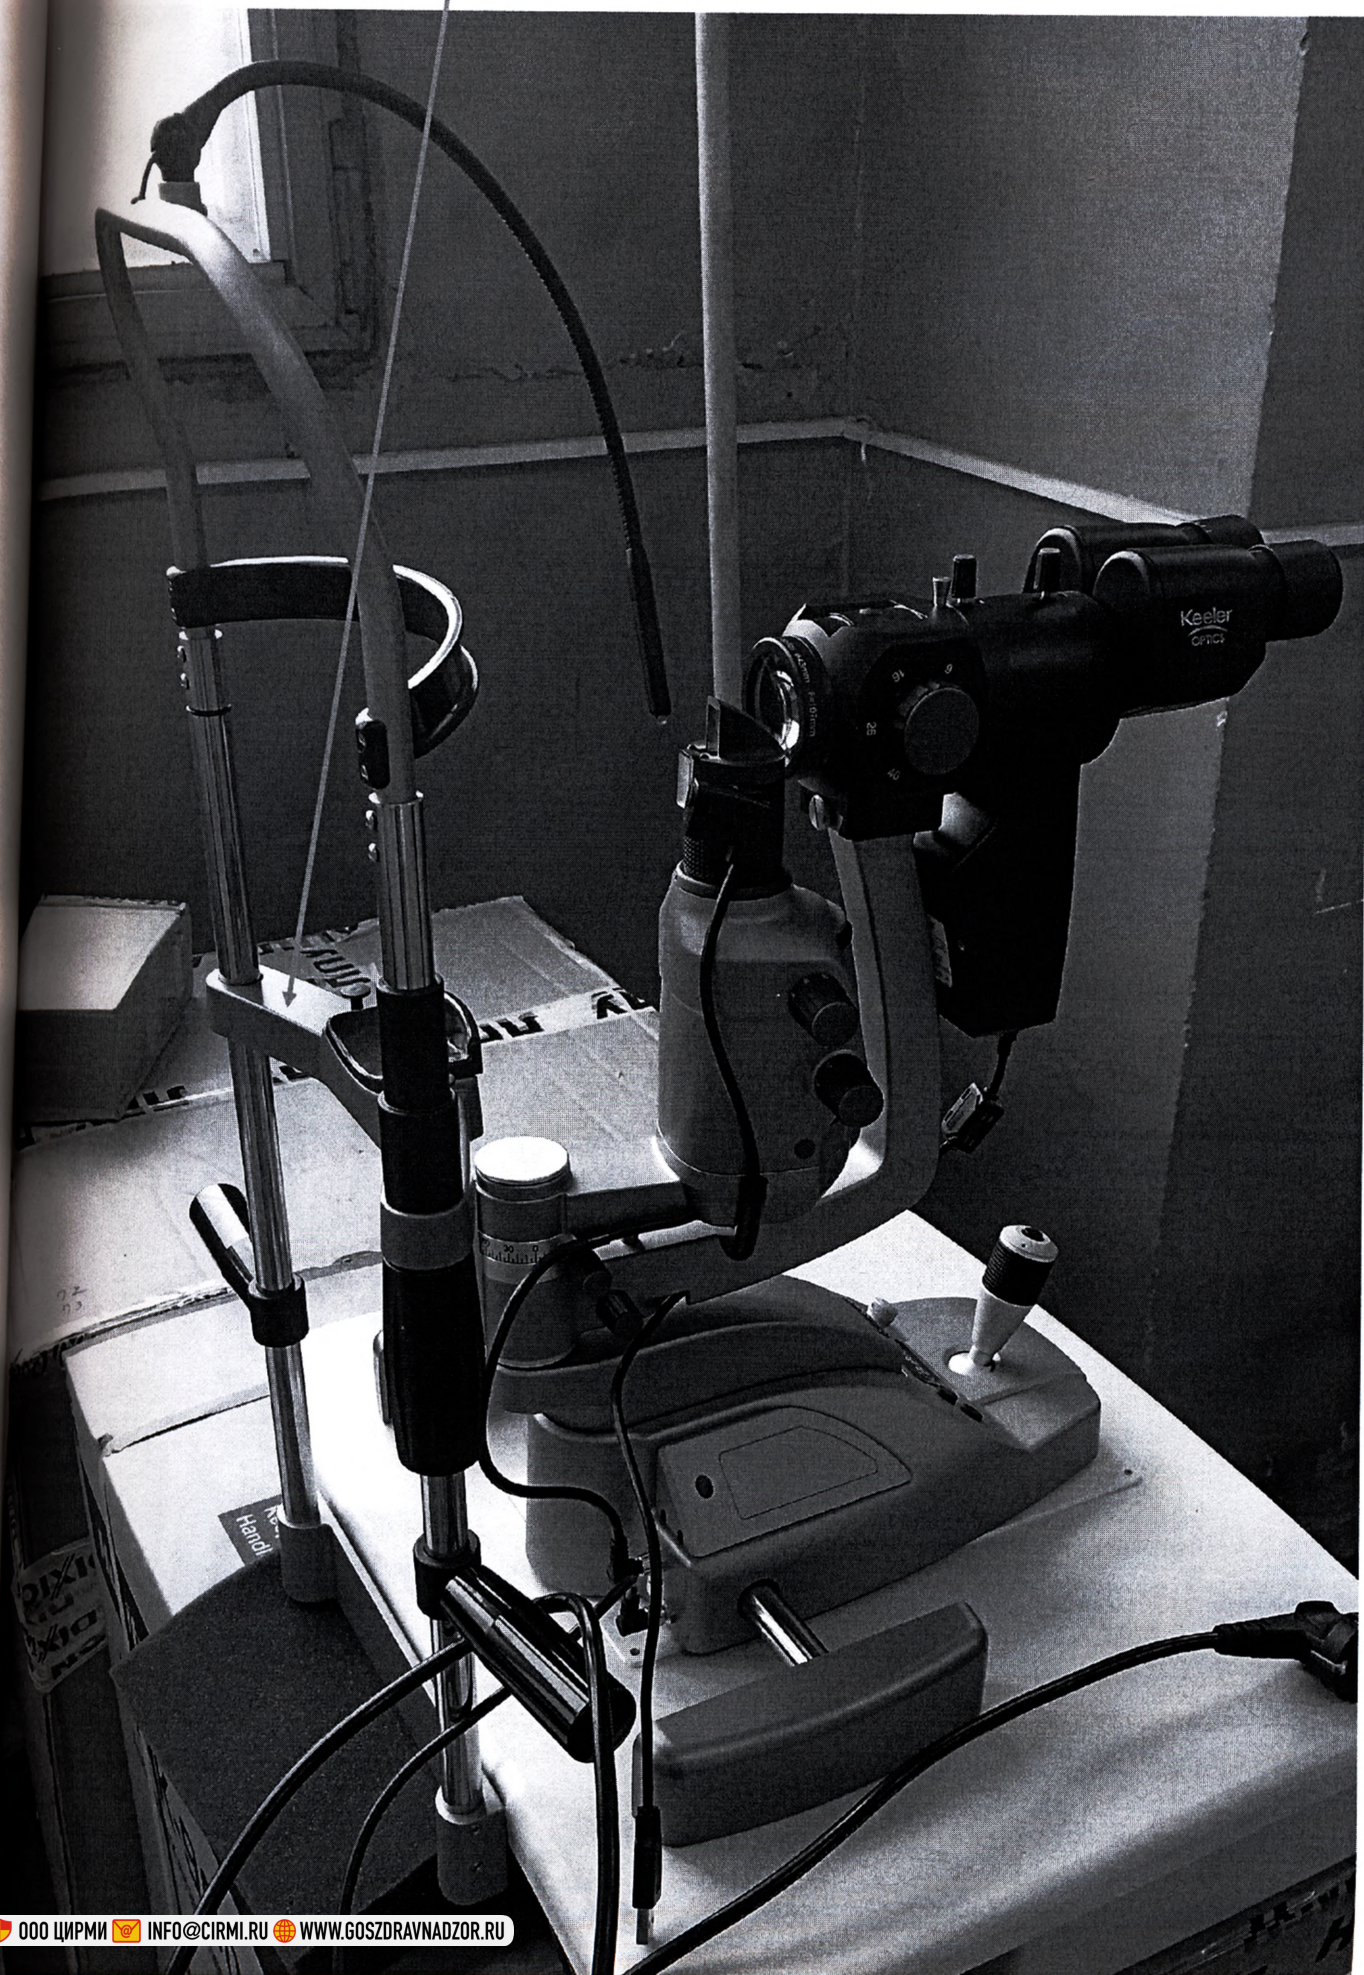



Комплект № 1: 1.5 Блок питания – 1 шт.





1. Базовый состав № 1: 1.6 Кабель подключения основания щелевой лампы к столешнице – 1 шт.





1. Базовый состав № 1: 1.7 Кабель питания – 1 шт.





овый состав № 1: 1.8 Кабель башни освещения – 1 шт.





состав № 1: 1.8 Кабель башни освещения – 1 шт.






Базовый состав № 1: 1.8 Кабель башни освещения – 1 шт.





Базовый состав № 1: 1.9 Кабель упора для головы пациента – 1 шт.

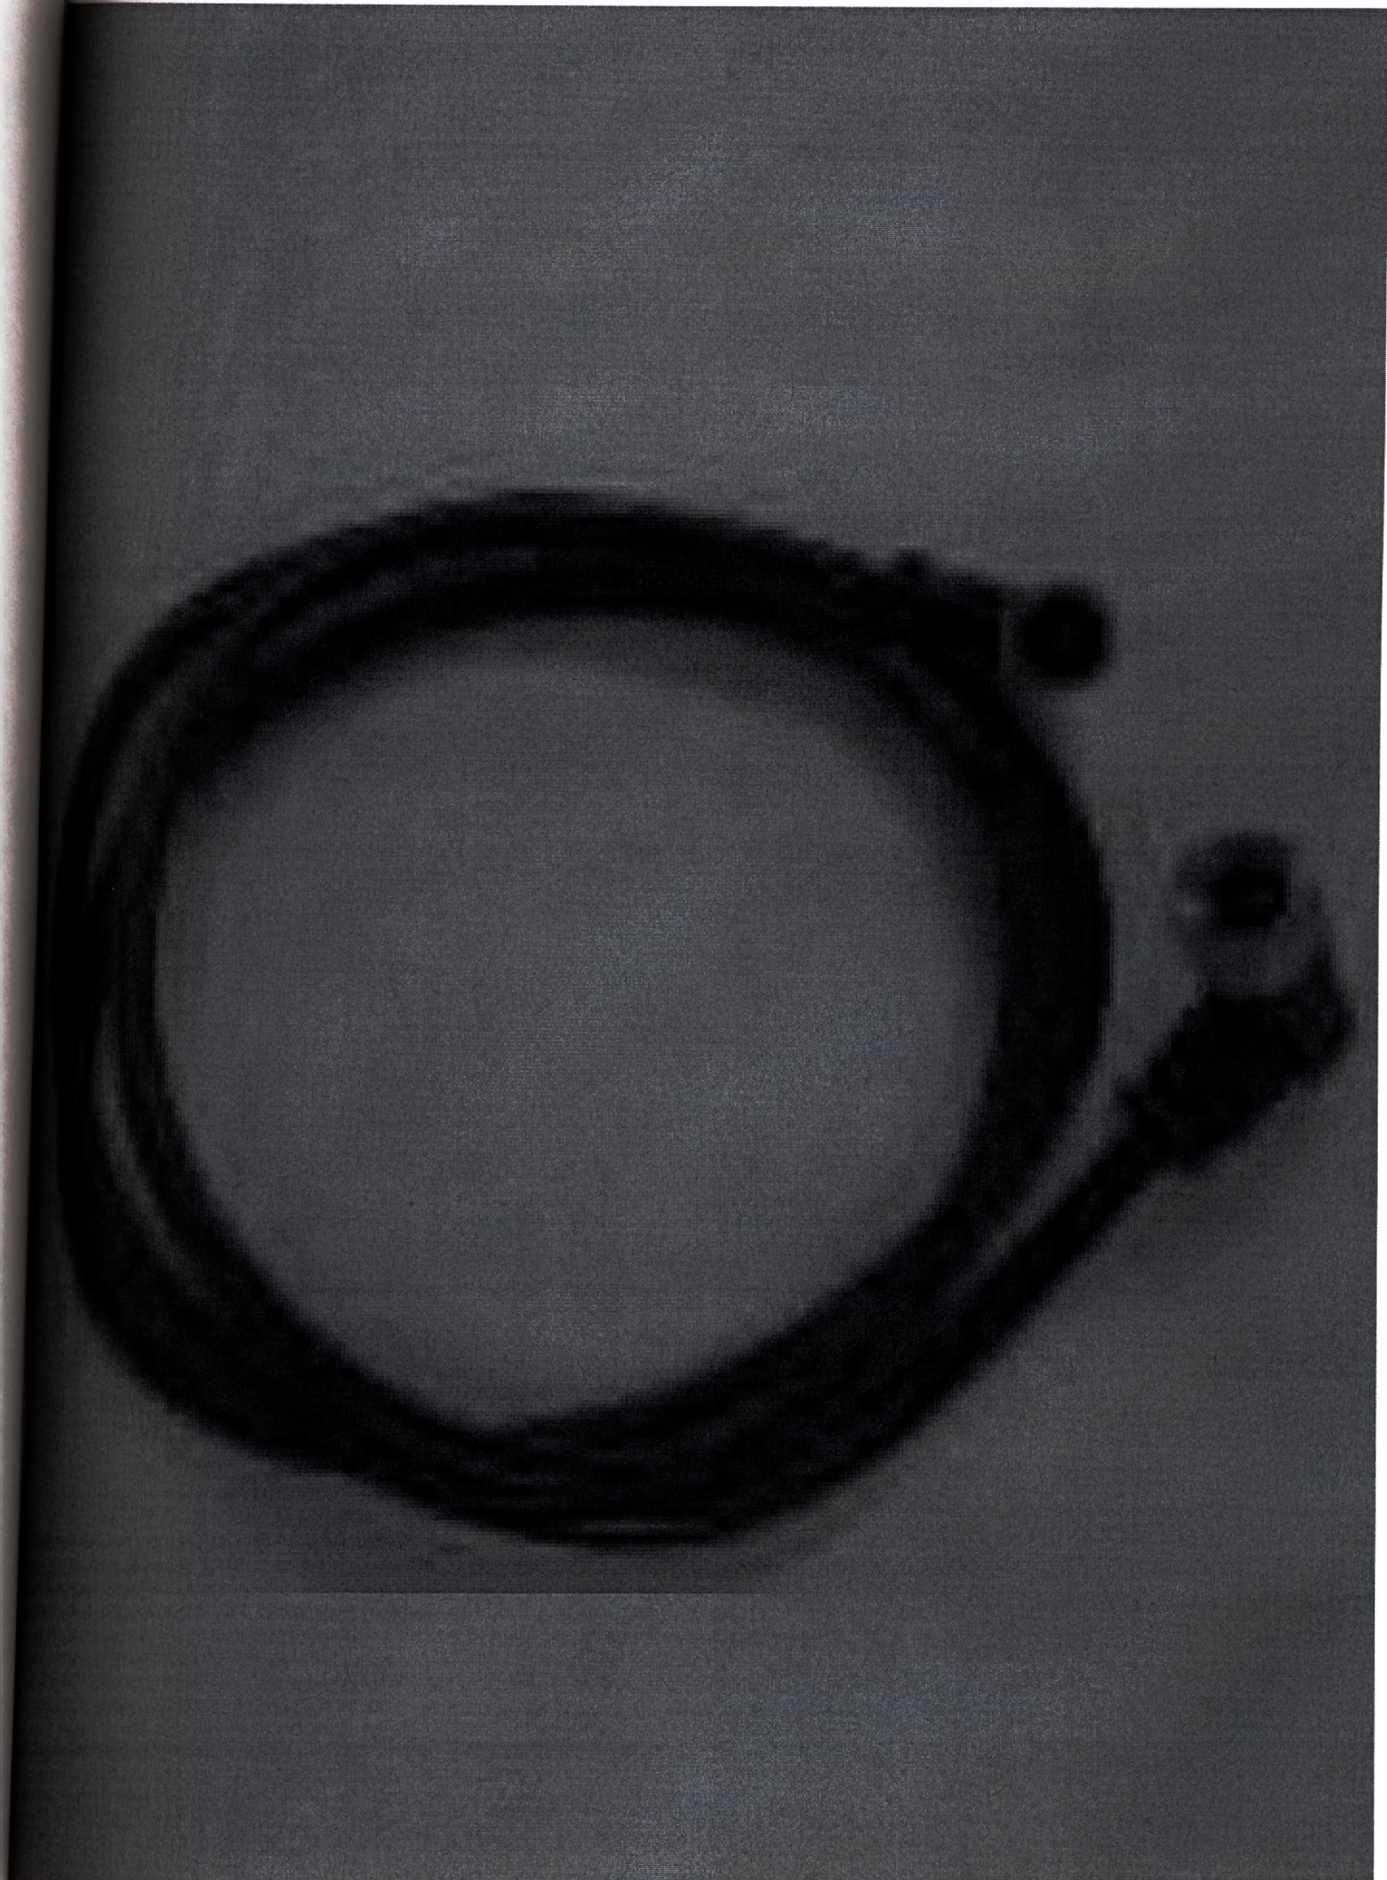



Базовый состав № 1: 1.10 Чехол пылезащитный – 1 шт.






состав № 2: 2.1 Основание щелевой лампы – 1 шт.





2. Базовый состав № 2: 2.2 Микроскоп щелевой лампы, в составе: - Блок микроскопа с параллельной оптикой и 5-ти ступенчатым увеличением – 1 шт.; - Бинокляр – 1 шт.; - Окуляры – 2 шт.

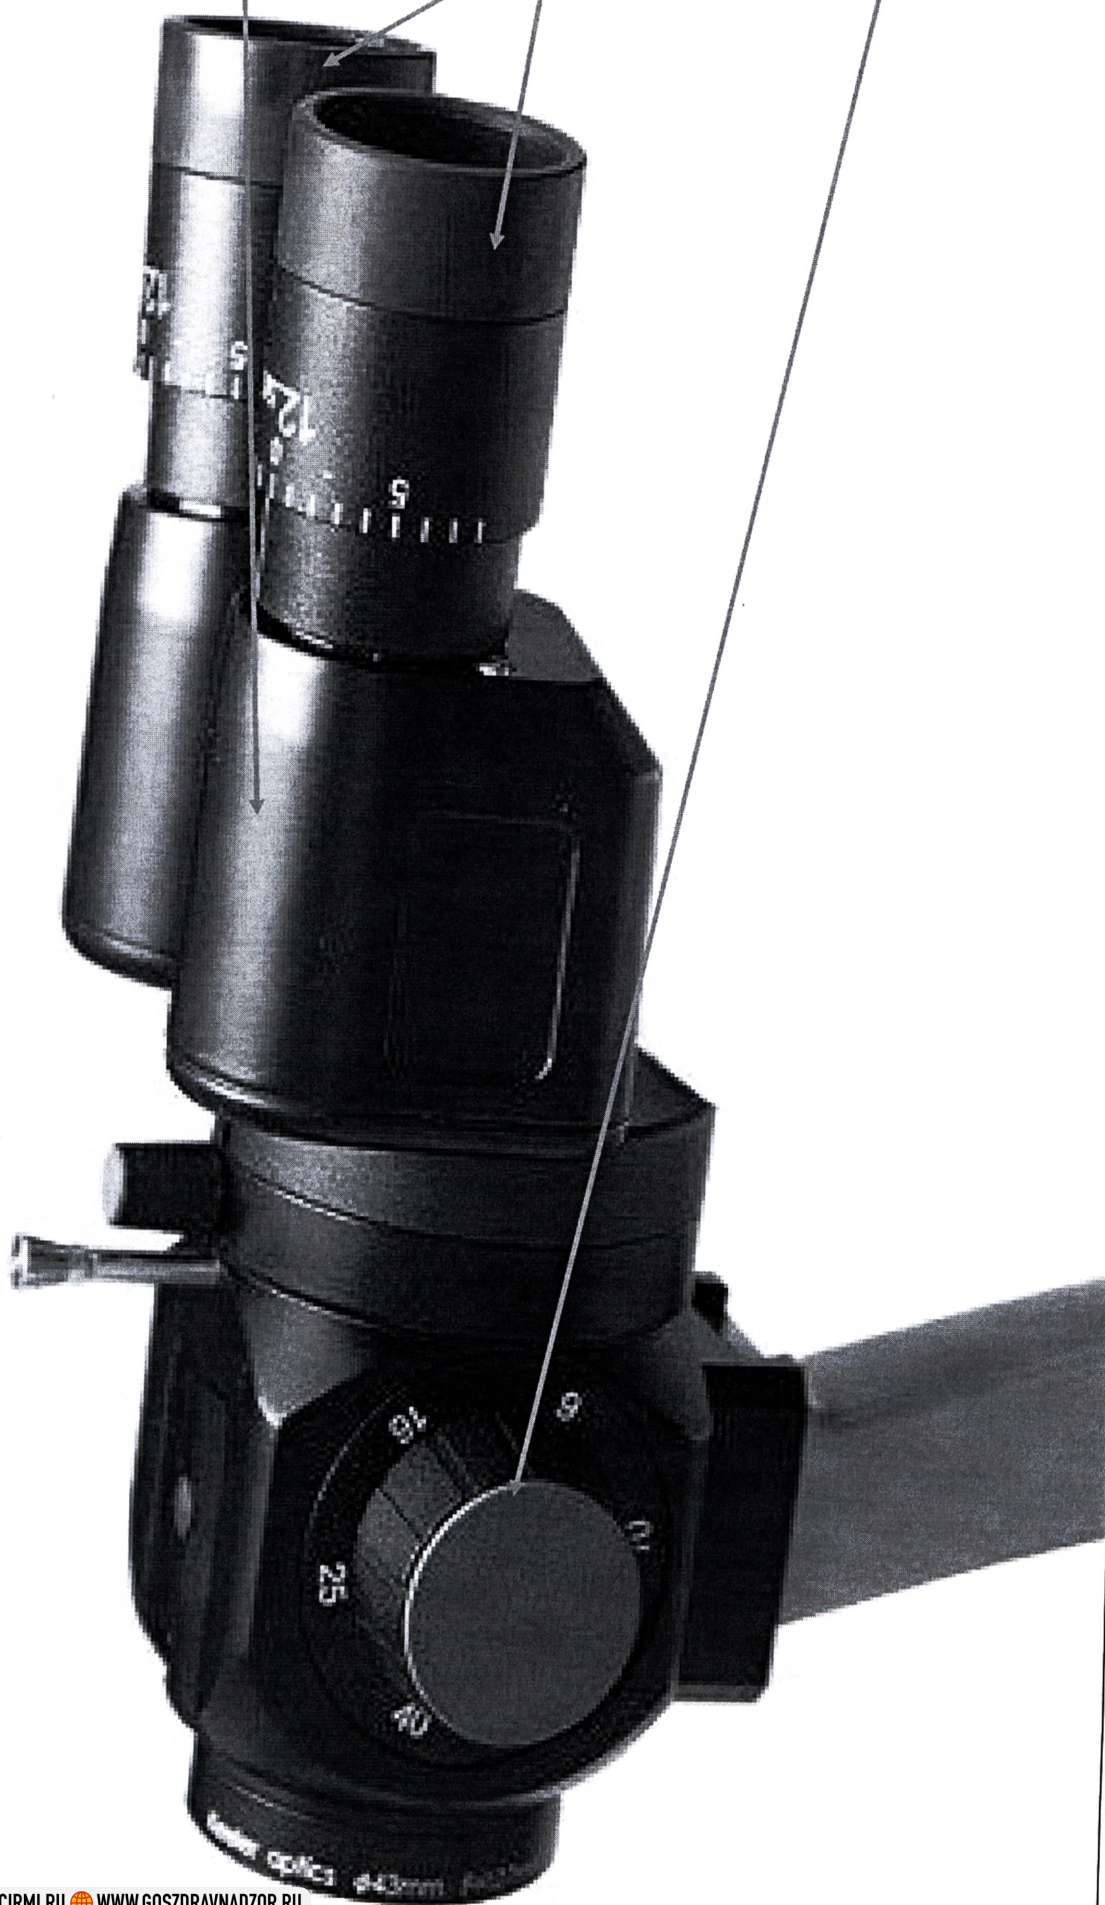




2. Базовый состав № 2: 2.3 Башня осветительная – 1 шт.





Базовый состав № 2: 2.4 Упор для головы пациента – 1 шт.

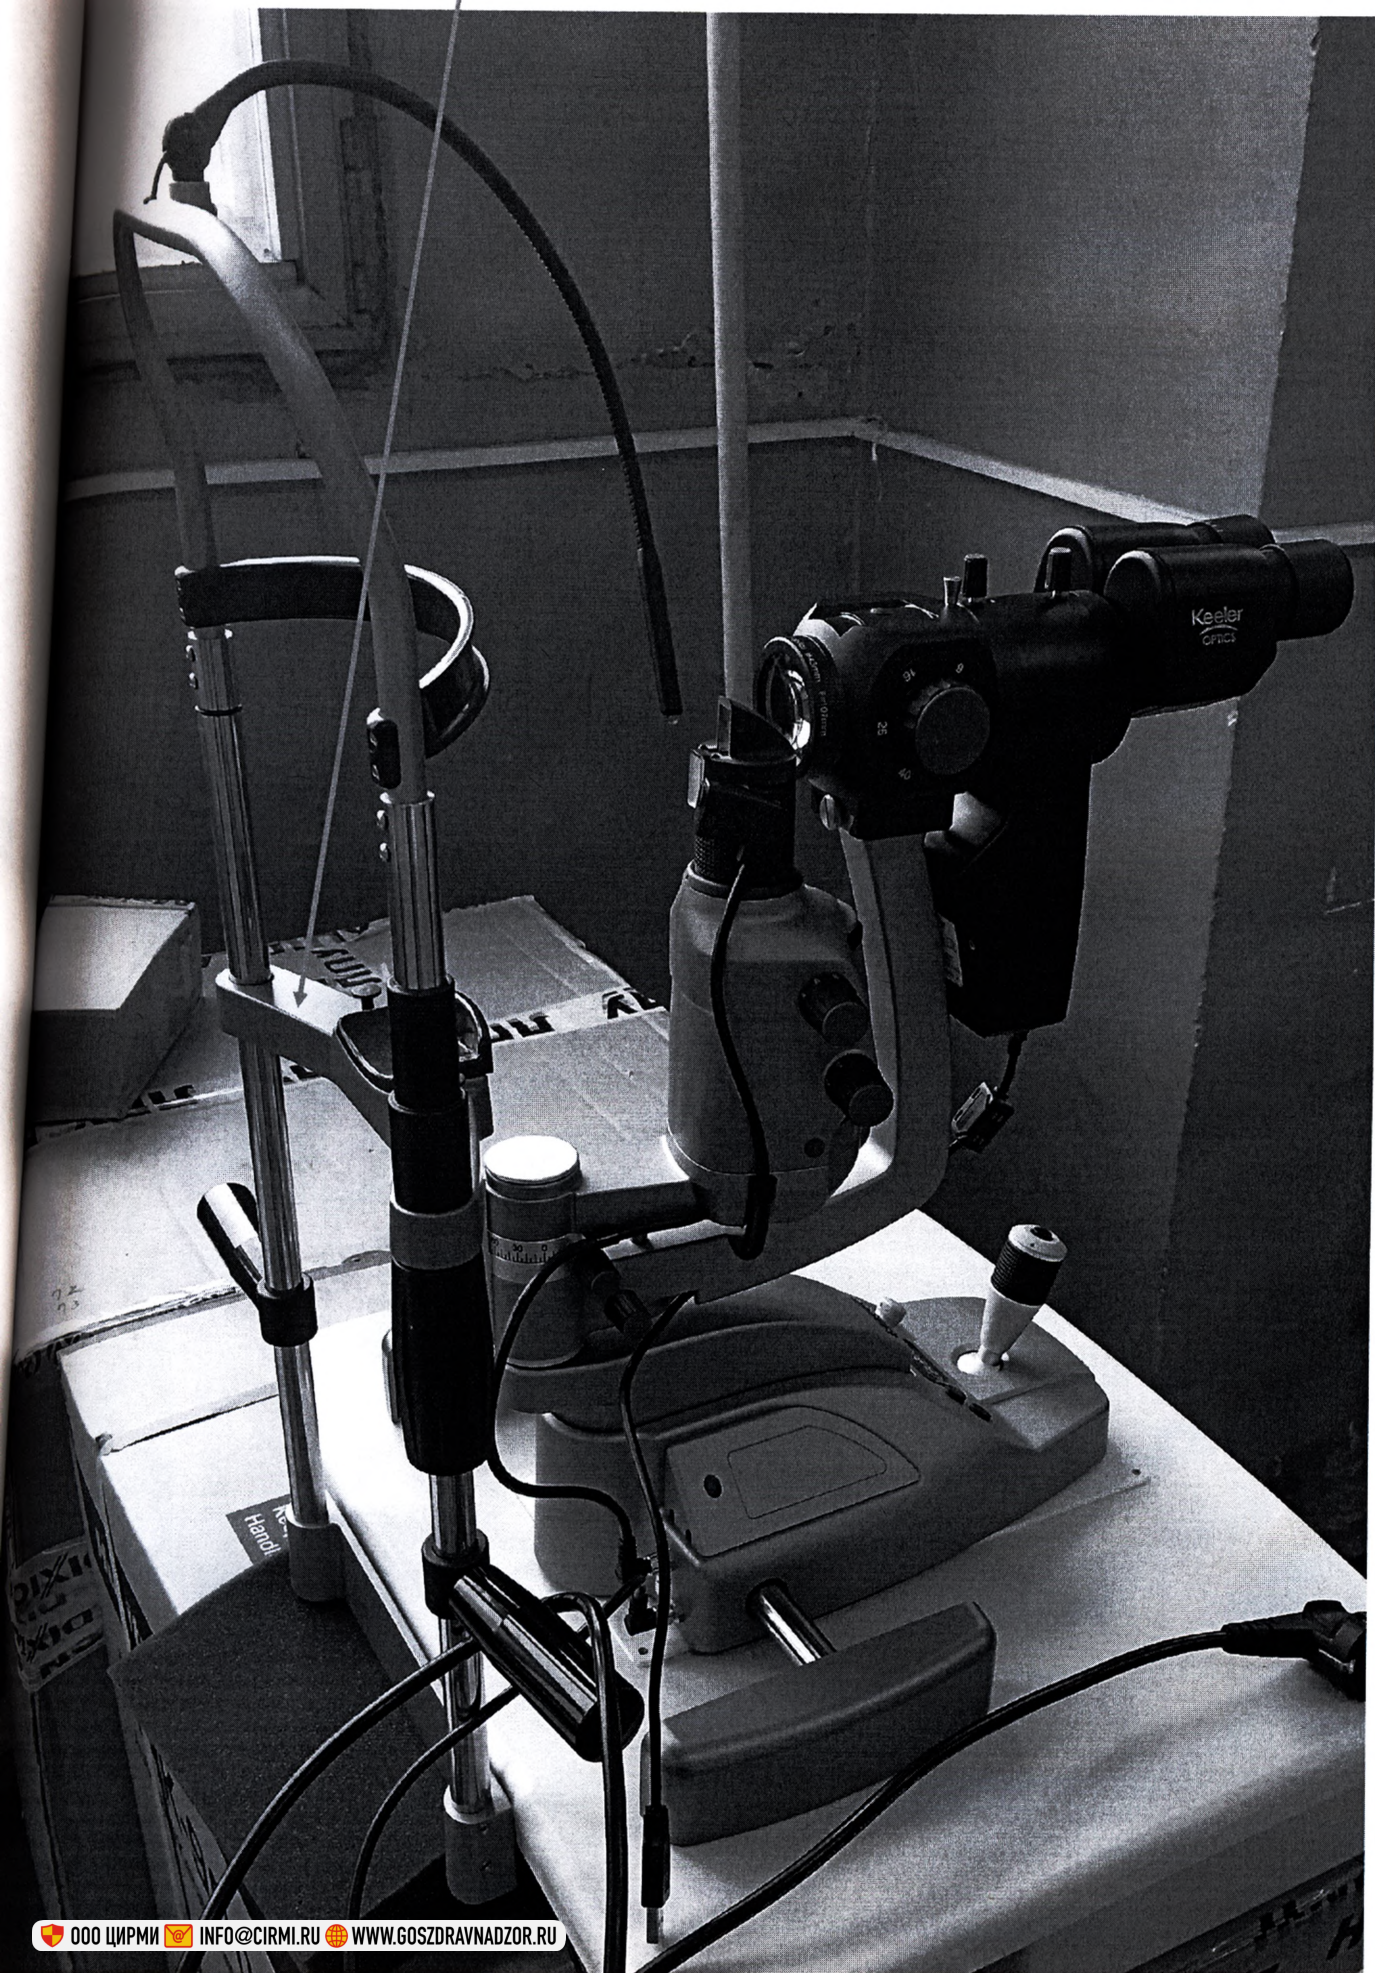



Базовый состав № 2: 2.5 Блок питания – 1 шт.





Базовый состав № 2: 2.6 Кабель подключения основания щелевой лампы к столешнице – 1 шт.





1 Батарейный состав № 2: 2.7 Кабель питания – 1 шт.





1. Базовый состав № 2: 2.8 Кабель башни освещения – 1 шт.





Базовый состав № 2: 2.9 Кабель упора для головы пациента – 1 шт.





2. Базовый состав № 2: 2.10 Чехол пылезащитный – 1 шт.





Щелевая офтальмологическая диагностическая вариант исполнения Z-Series с принадлежностями:

Базовый состав № 3: 3.1 Основание щелевой лампы – 1 шт.





Базовый состав: № 3: 3.2 Микроскоп щелевой лампы, в составе: - Блок микроскопа с конвергентной оптикой и бесступенчатым увеличением – 1 шт.; - Бинокуляр – 1 шт.; - Окуляры – 2 шт.






Состав № 3: 3.3 Башня осветительная – 1 шт.





Базовый состав № 3: 3.4 Упор для головы пациента – 1 шт.

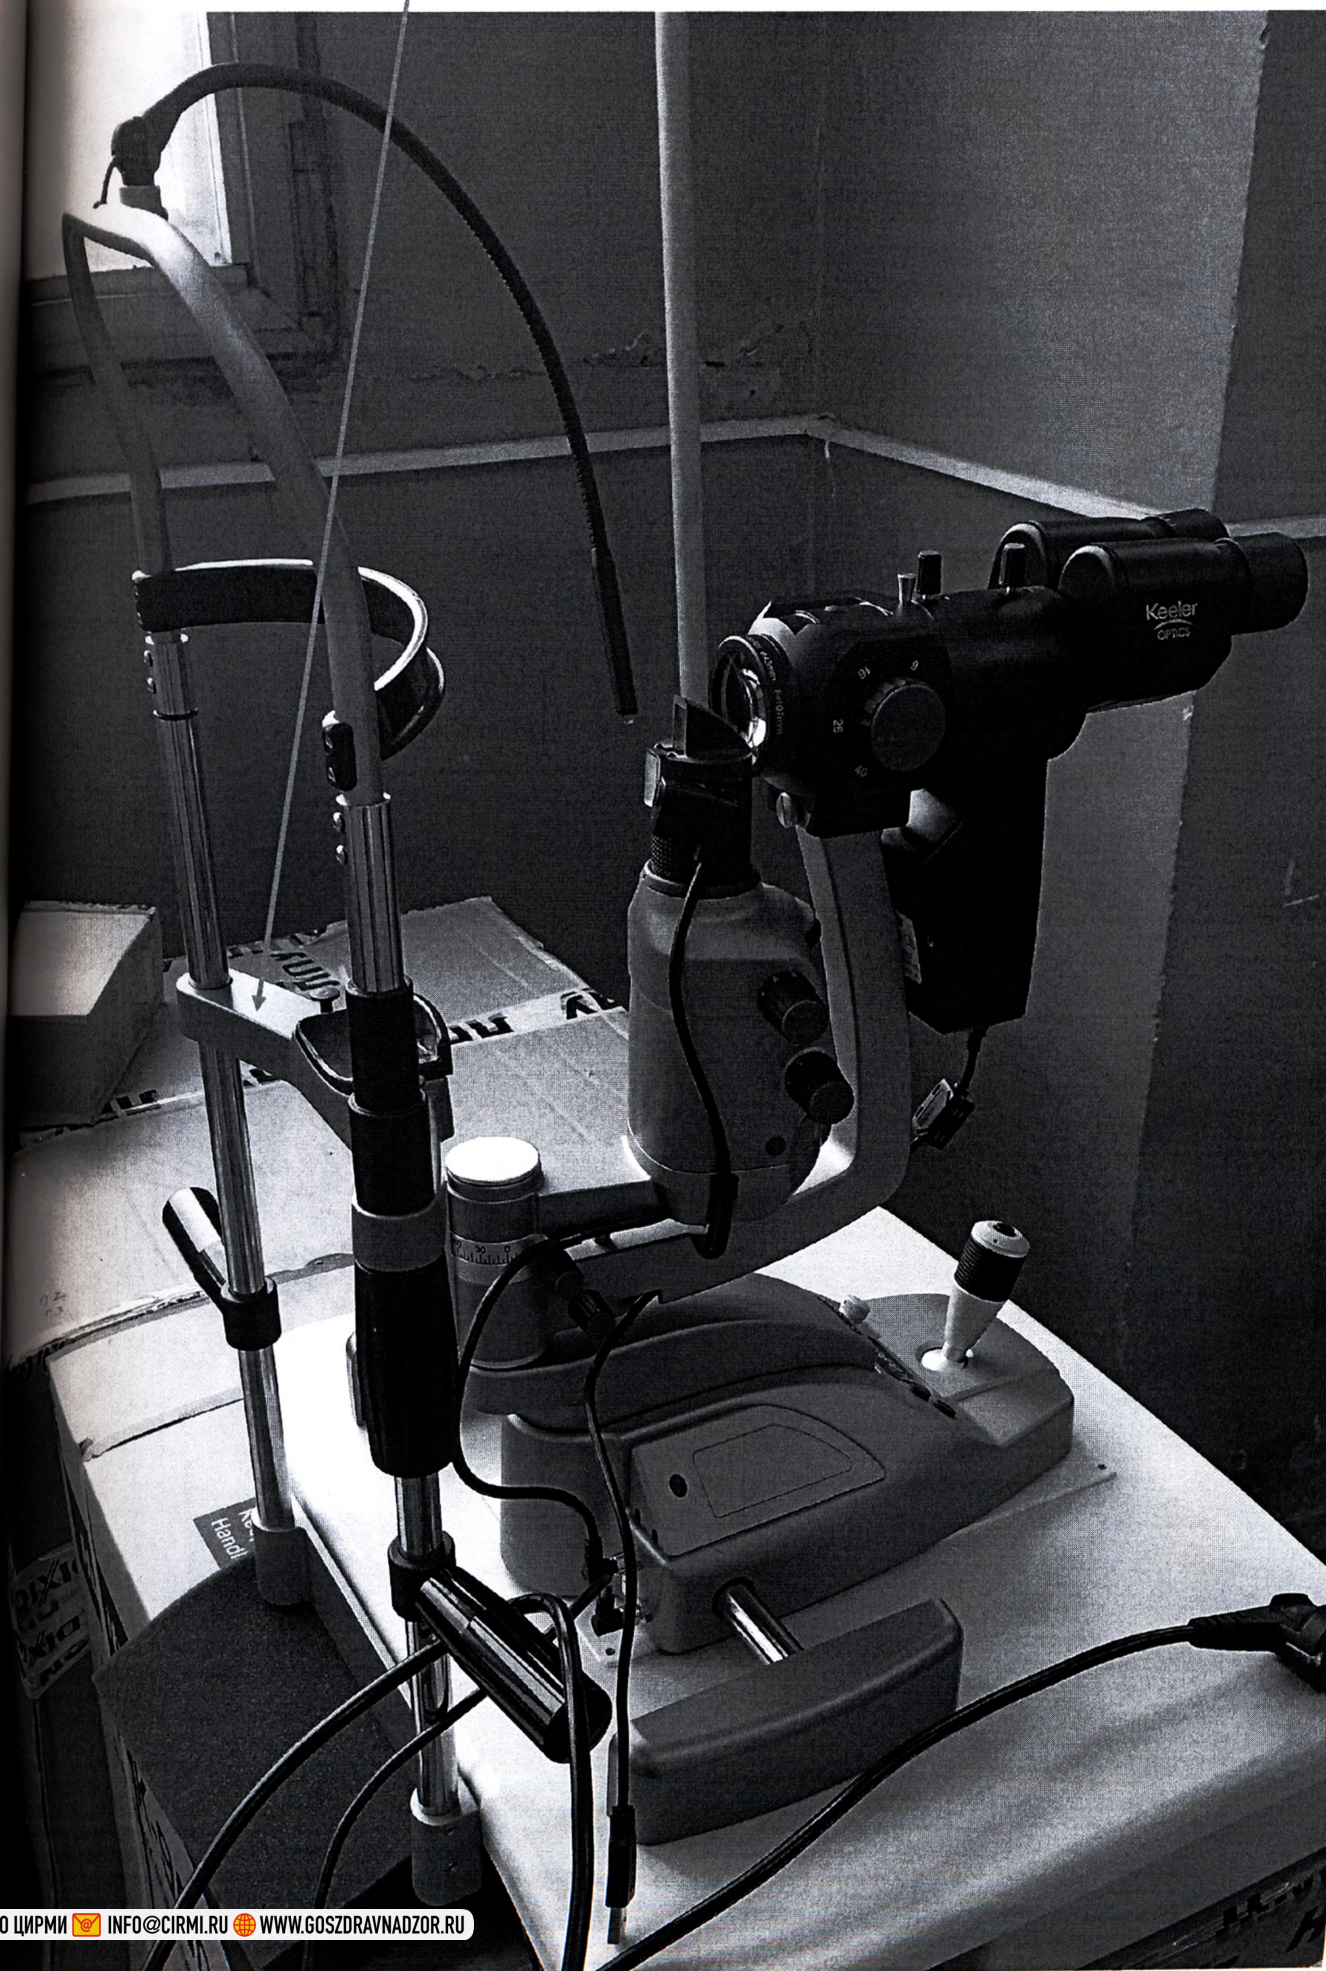



1 Базовый состав № 3: 3.5 Блок питания – 1 шт.





Базовый состав № 3: 3.5 Блок питания – 1 шт.





Основной состав № 3: 3.6 Кабель подключения основания щелевой лампы к столешнице – 1 шт.





Базовый состав № 3: 3.7 Кабель питания – 1 шт.






Базовый состав № 3: 3.8 Кабель башни освещения – 1 шт.





Базовый состав № 3: 3.9 Кабель упора для головы пациента – 1 шт.

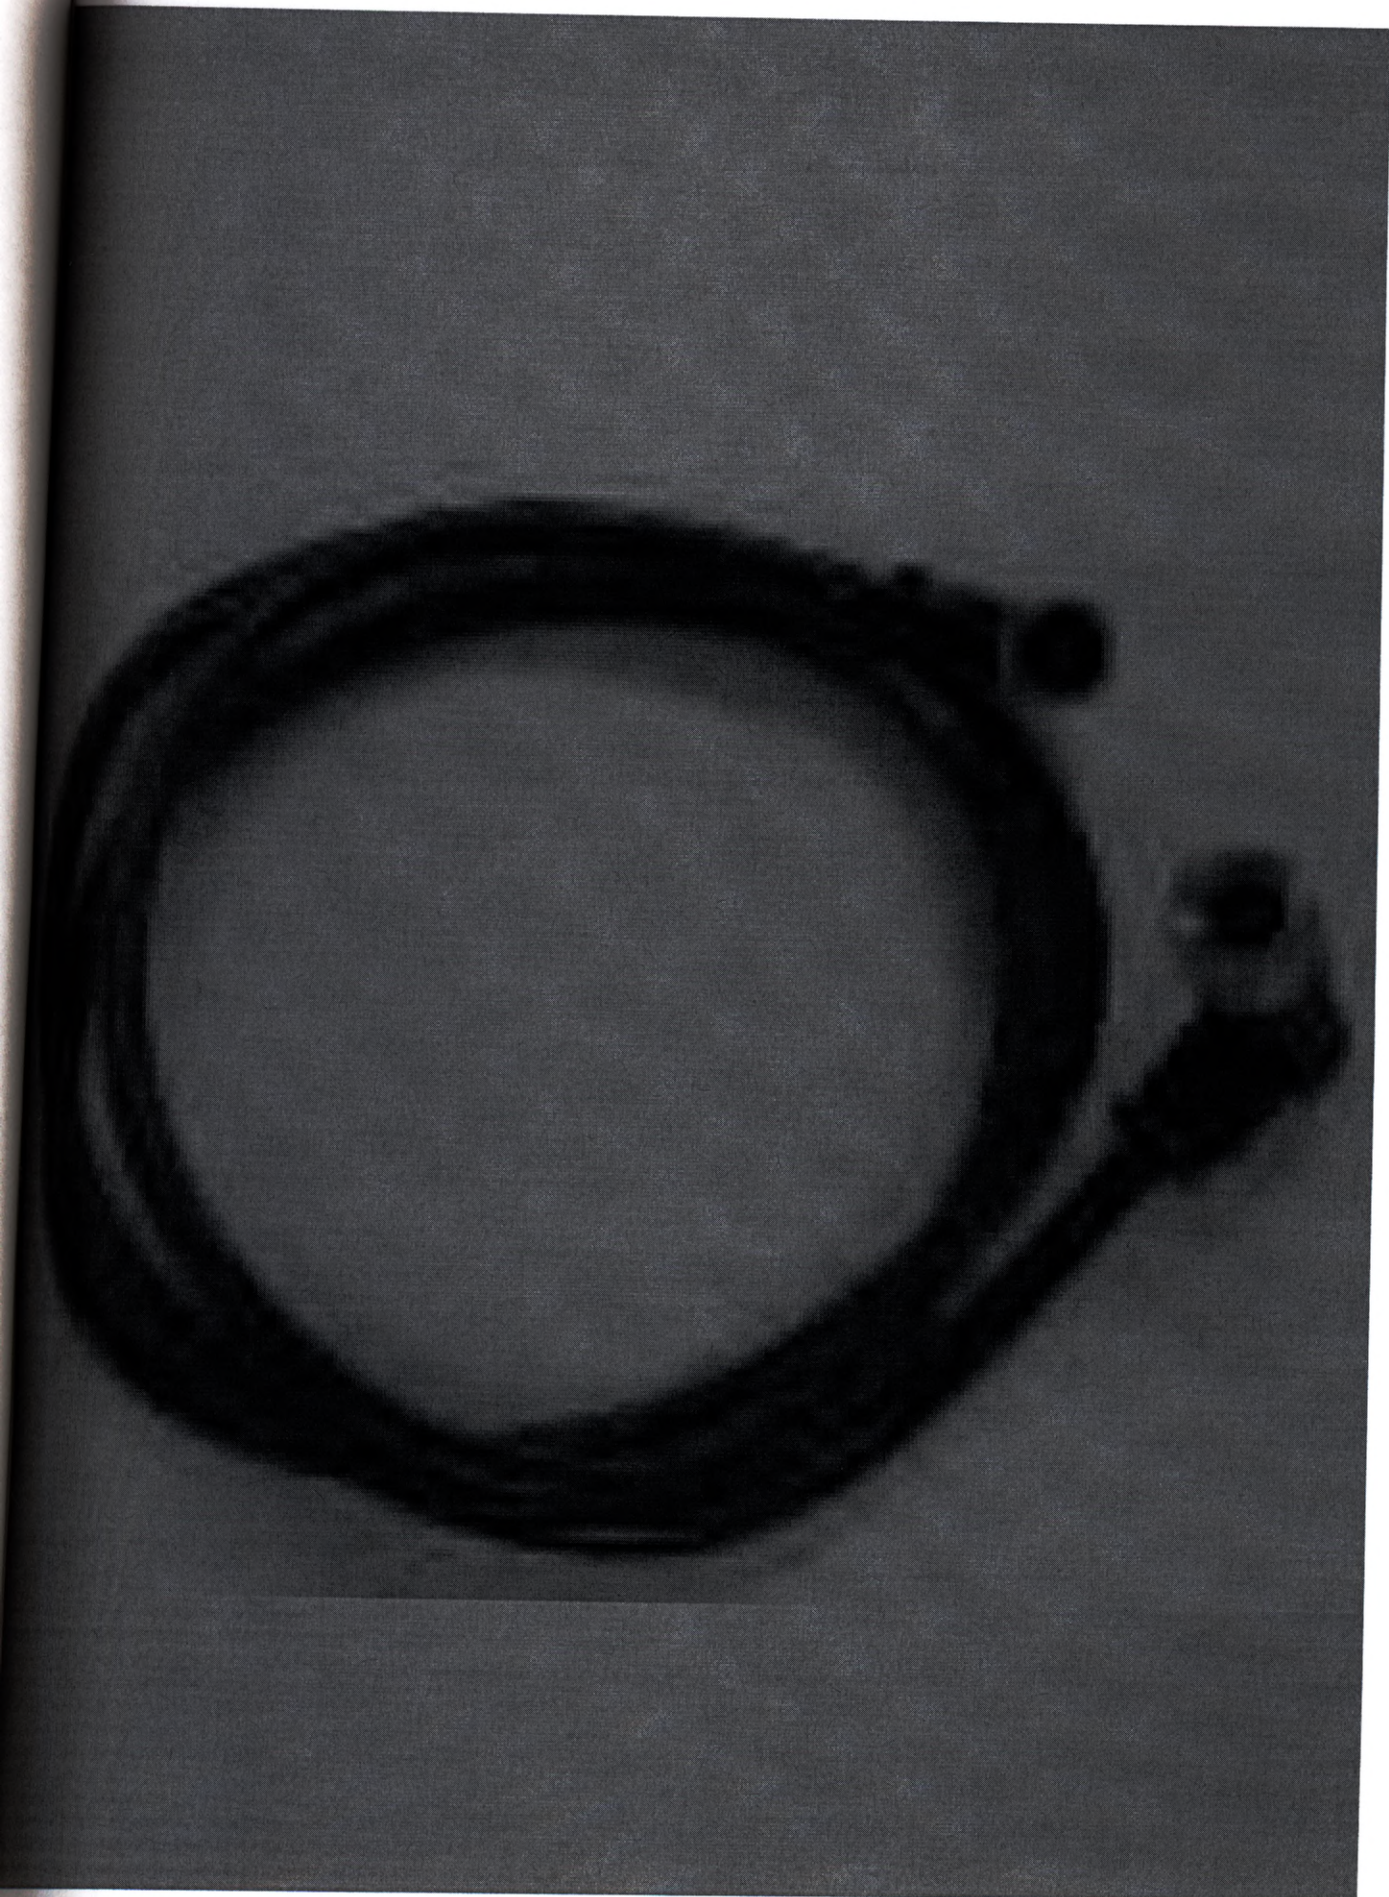



й состав № 3: 3.10 Чехол пылезащитный – 1 шт.






4. Базовый состав № 4: 4.1 Основание щелевой лампы – 1 шт.





4. Базовый состав № 4: 4.2 Микроскоп щелевой лампы, в составе: - Блок микроскопа с конвергентной оптикой и ступенчатым увеличением – 1 шт.; - Бинокляр – 1 шт.; - Окуляры – 2 шт.

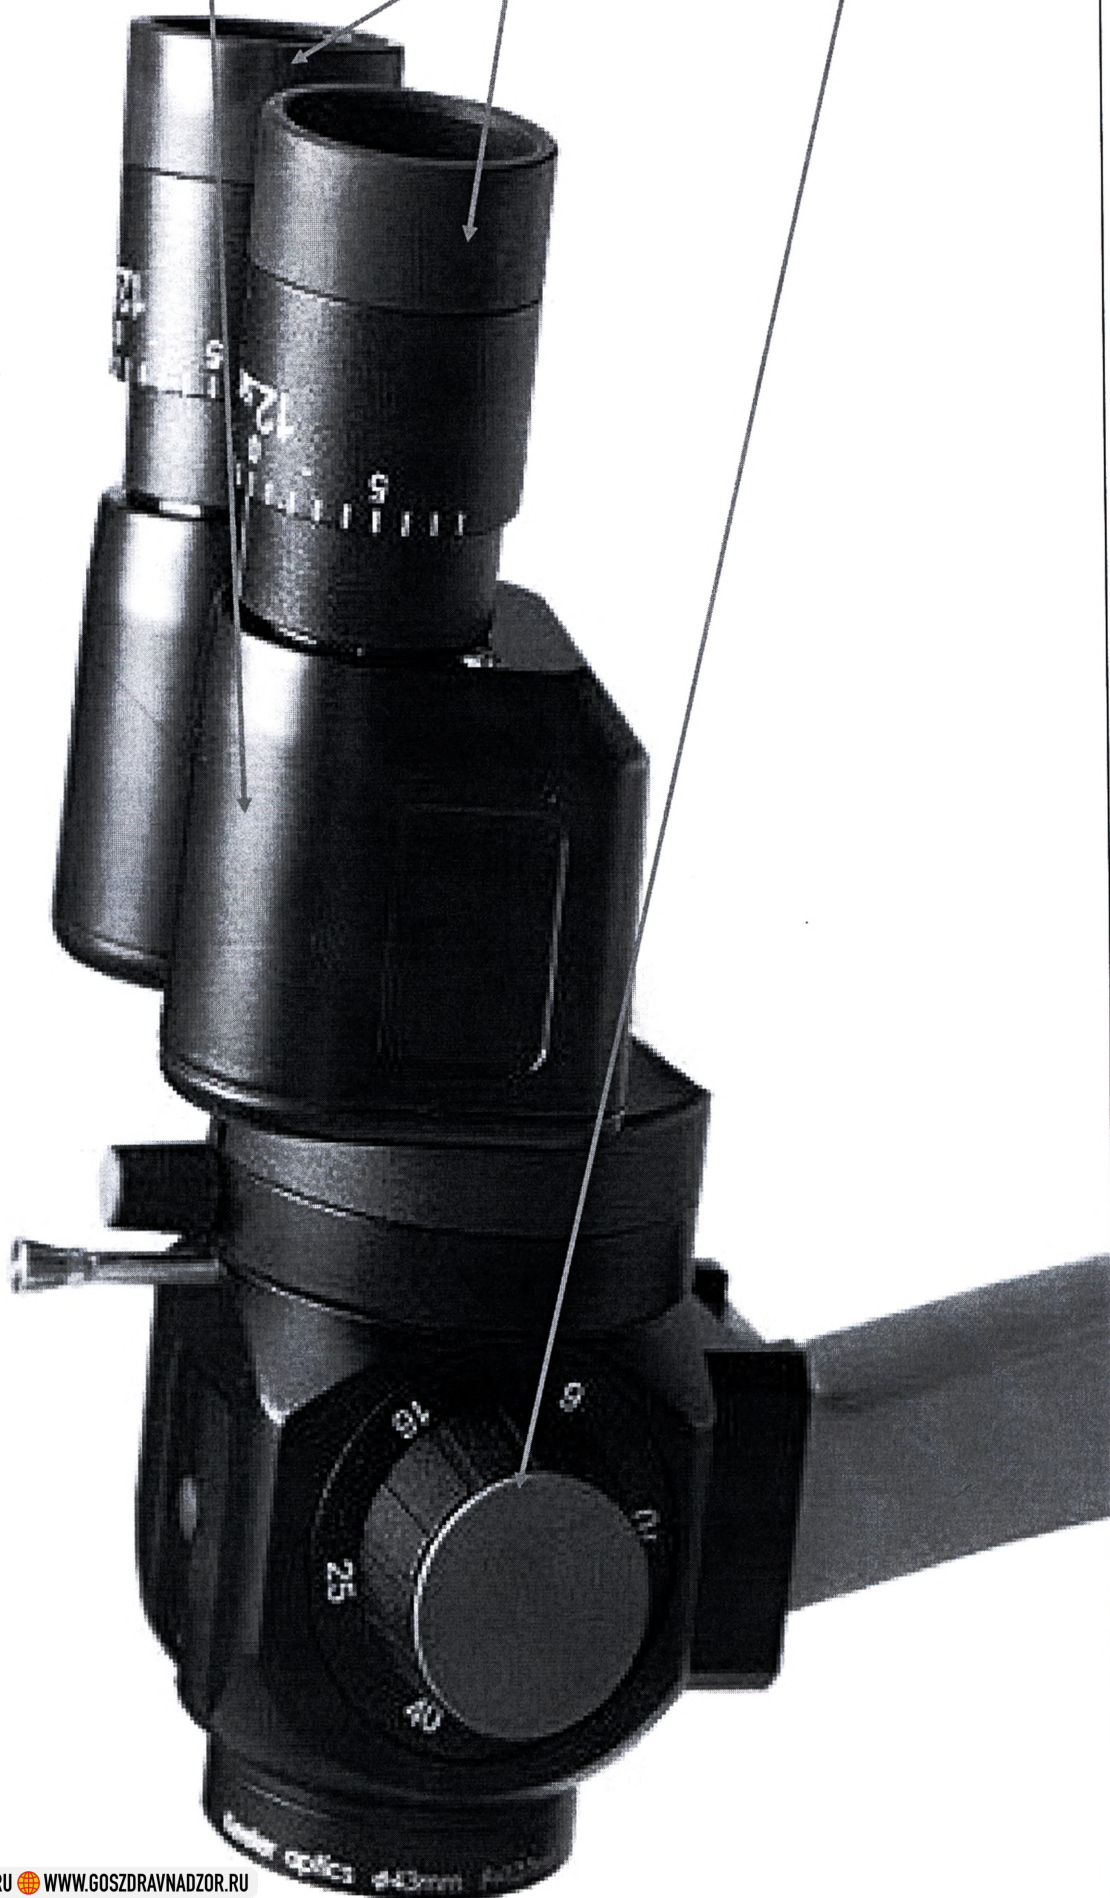




новый состав № 4: 4.3 Башня осветительная – 1 шт.





состав № 4: 4.4 Упор для головы пациента – 1 шт.

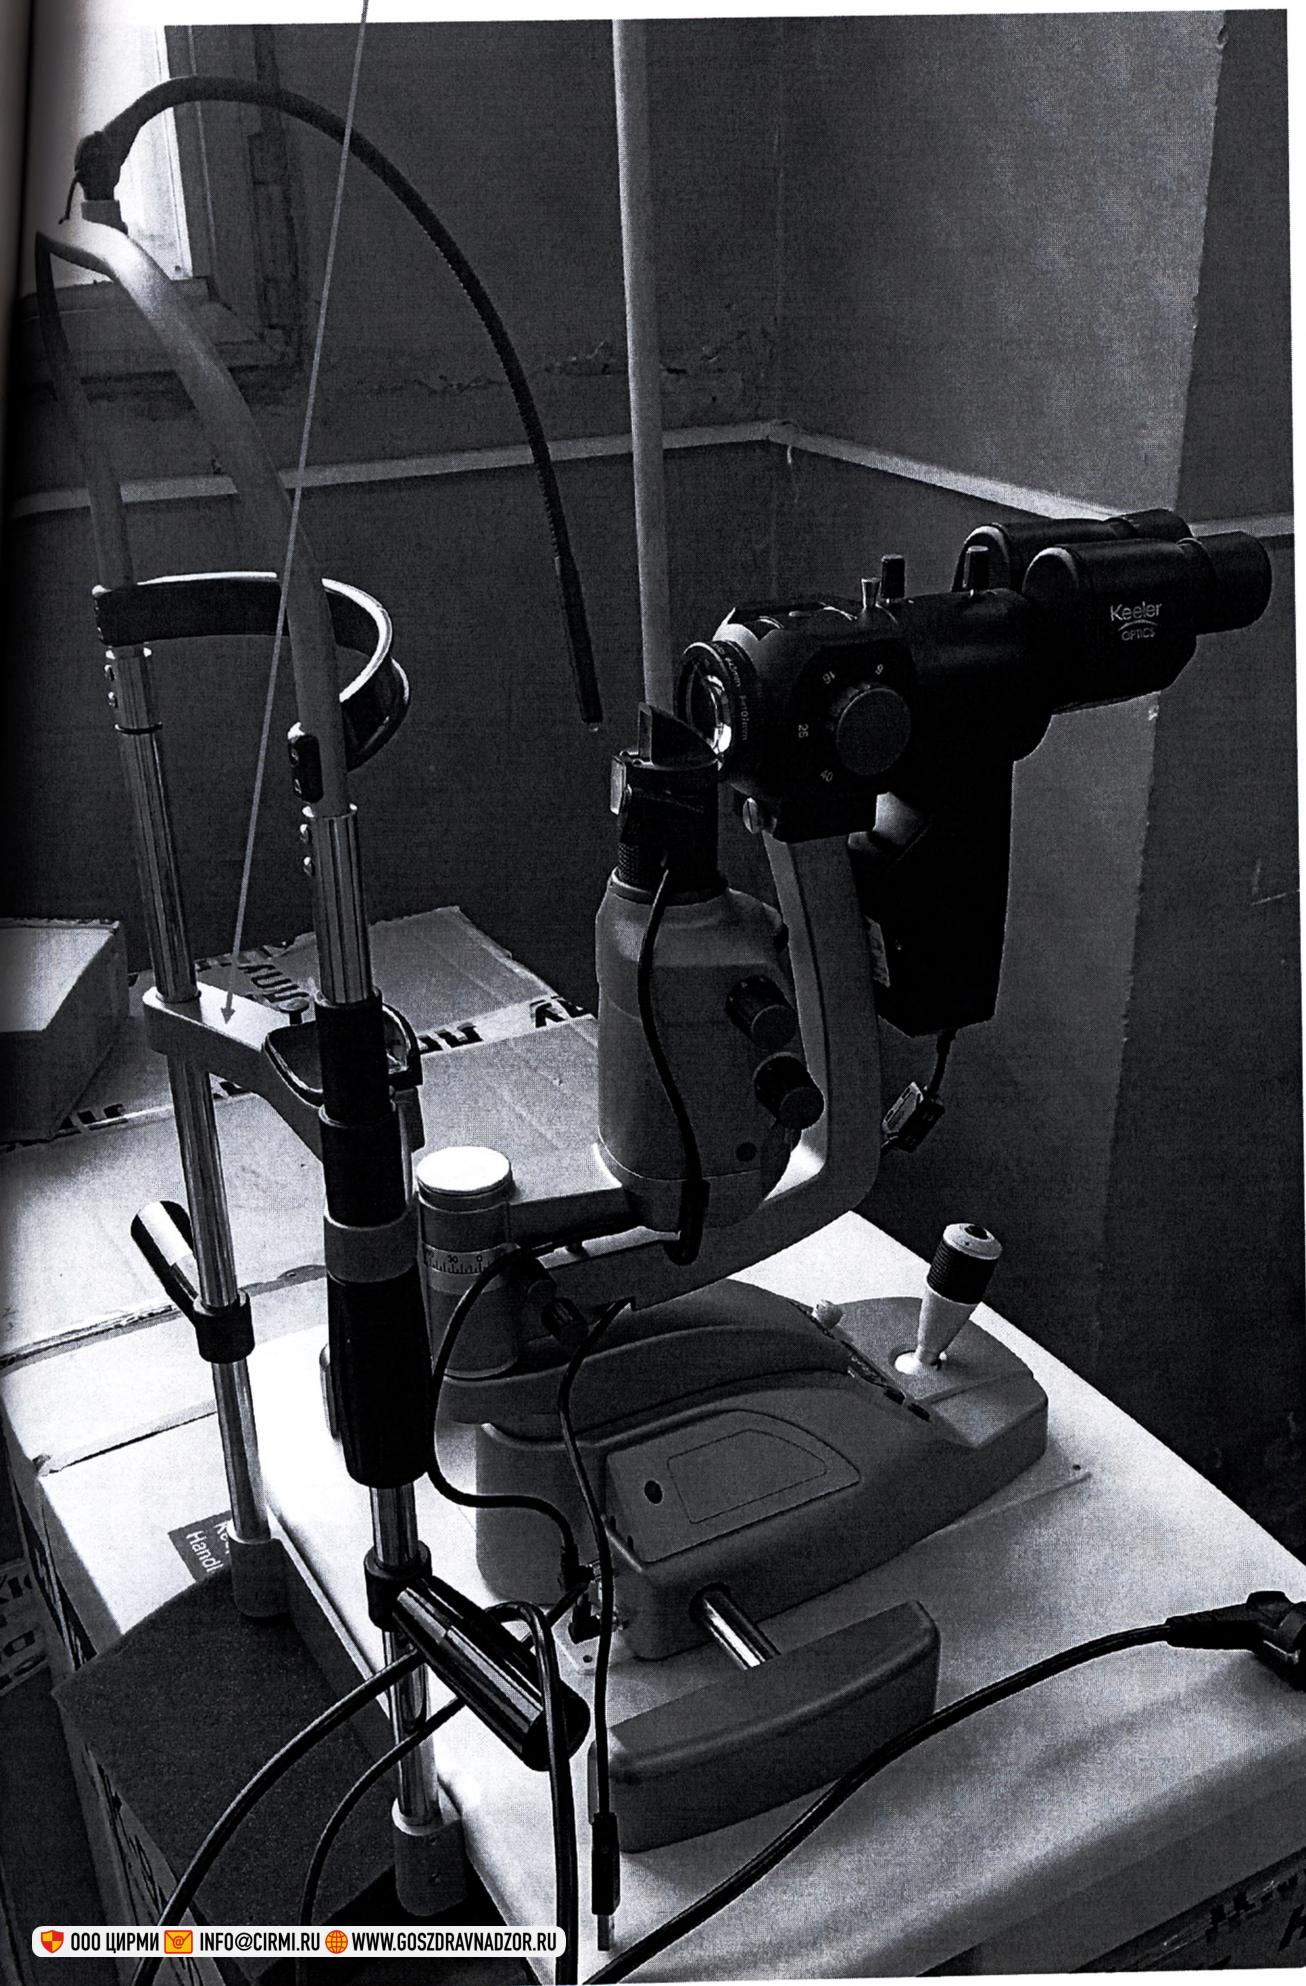




состав № 4: 4.5 Блок питания – 1 шт.





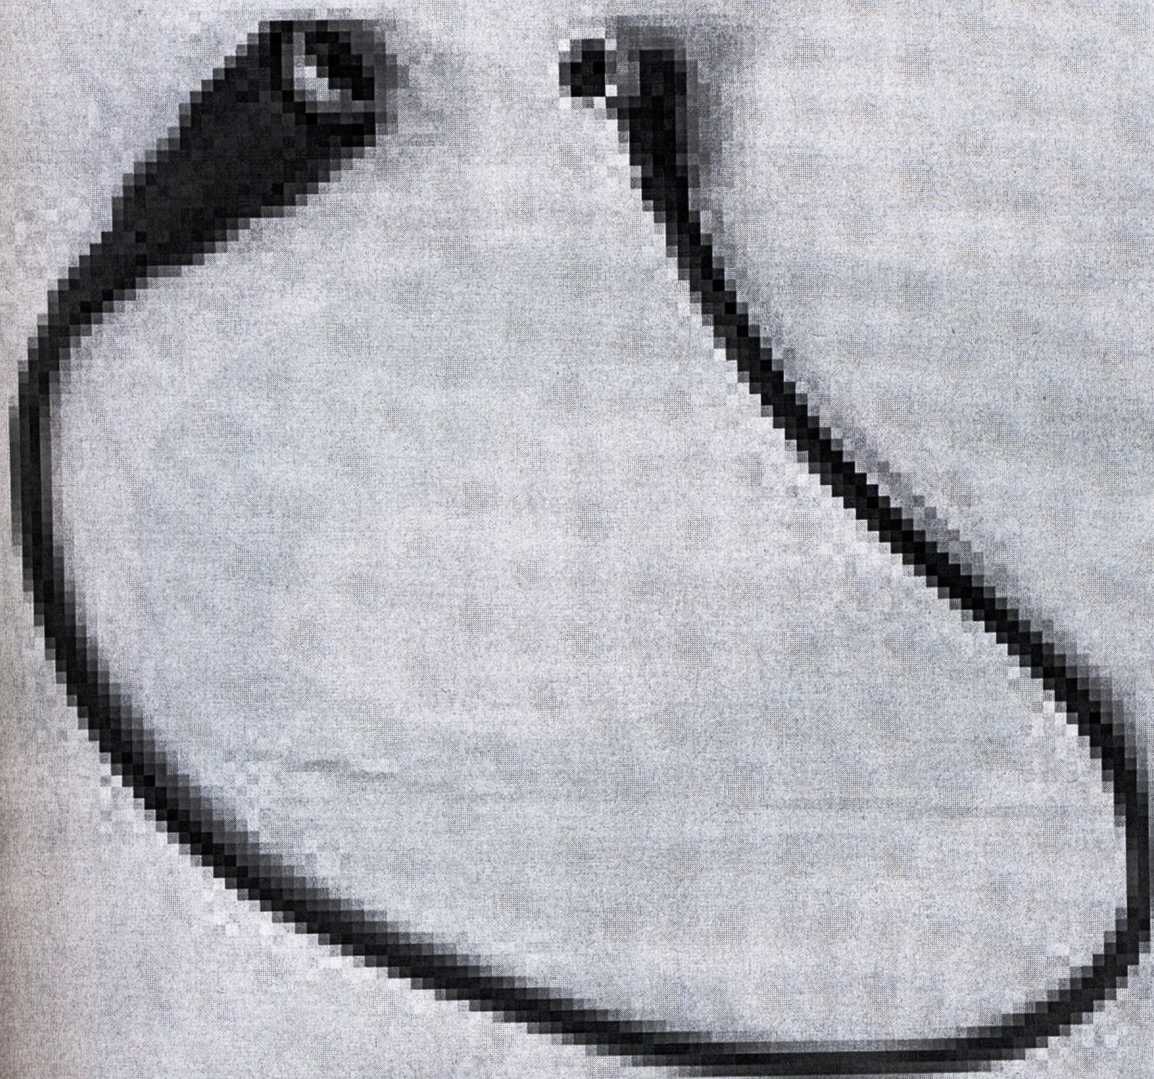



4. Базовый состав № 4: 4.7 Кабель питания – 1 шт.





4. Базовый состав № 4: 4.7 Кабель питания – 1 шт.





Базовый состав № 4: 4.8 Кабель башни освещения – 1 шт.





Композитный состав № 4: 4.9 Кабель упора для головы пациента – 1 шт.






целевая офтальмологическая диагностическая вариант исполнения Z-Series с принадлежностями:

состав № 4: 4.10 Чехол пылезащитный – 1 шт.





Принадлежности: 1. Рукоятки для пациента – 2 шт.

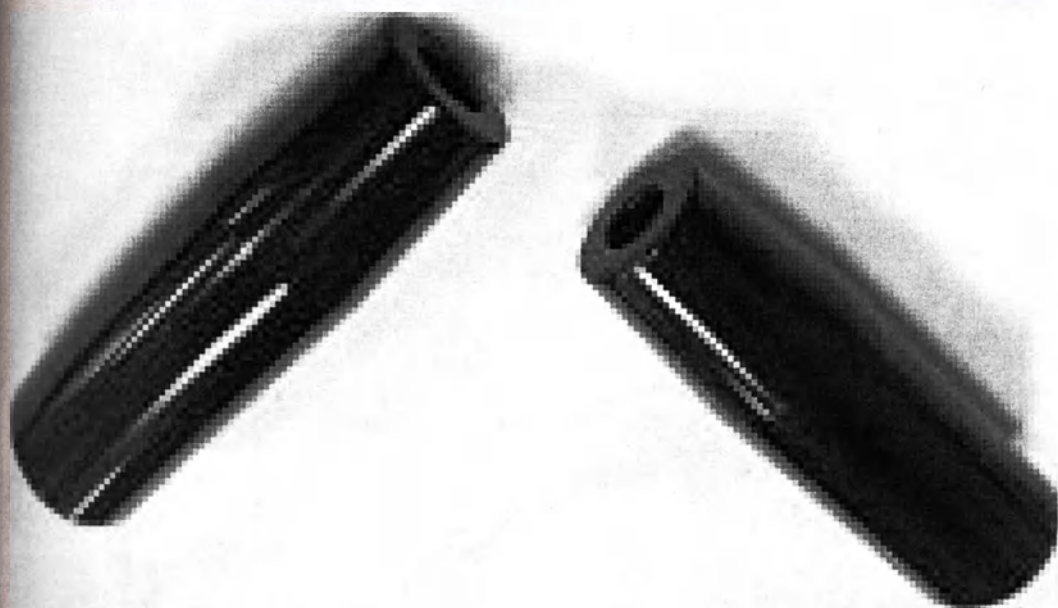



Вкладыш: 2. Вкладыш для подбородка – 1 шт.





ности: 3. Пластина лобная – 1 шт.






3. Пластина лобная – 1 шт.






Принадлежности: 4. Прокладки бумажные на вкладыш для подбородка – не более 5 уп. (100 шт./уп.)

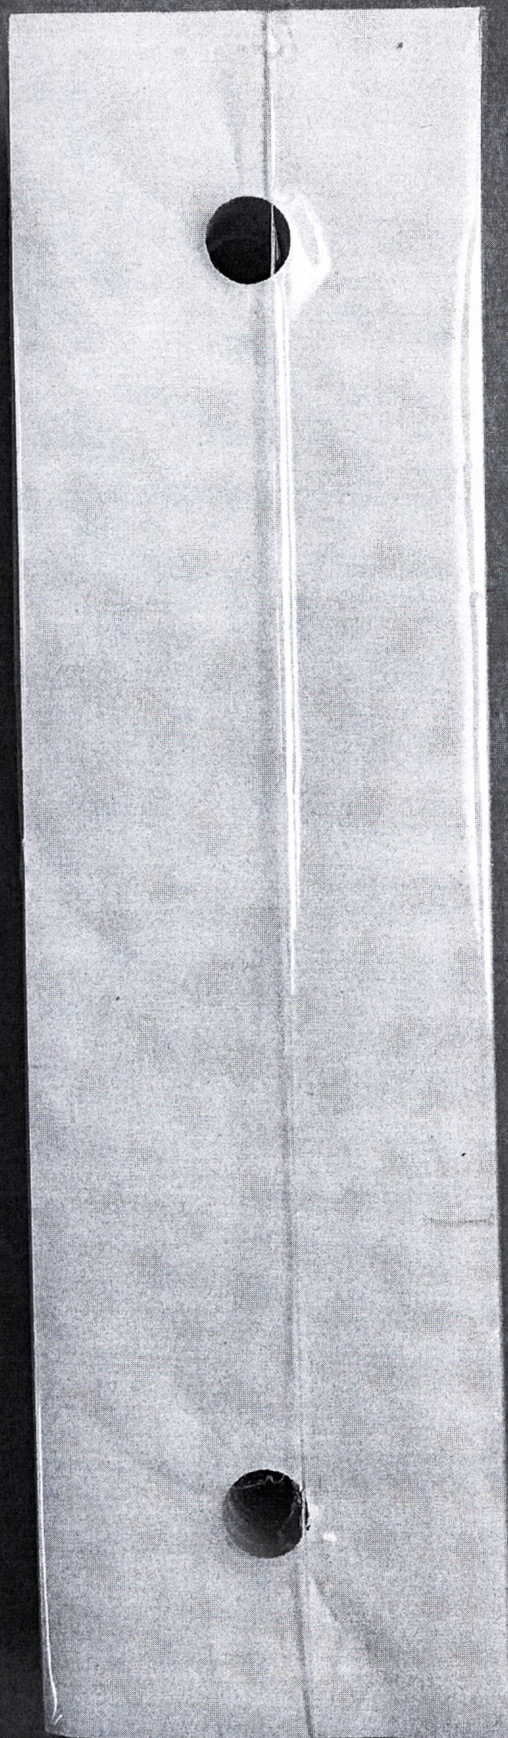



Принадлежности: 5. Клипсы фиксирующие – 2 шт.

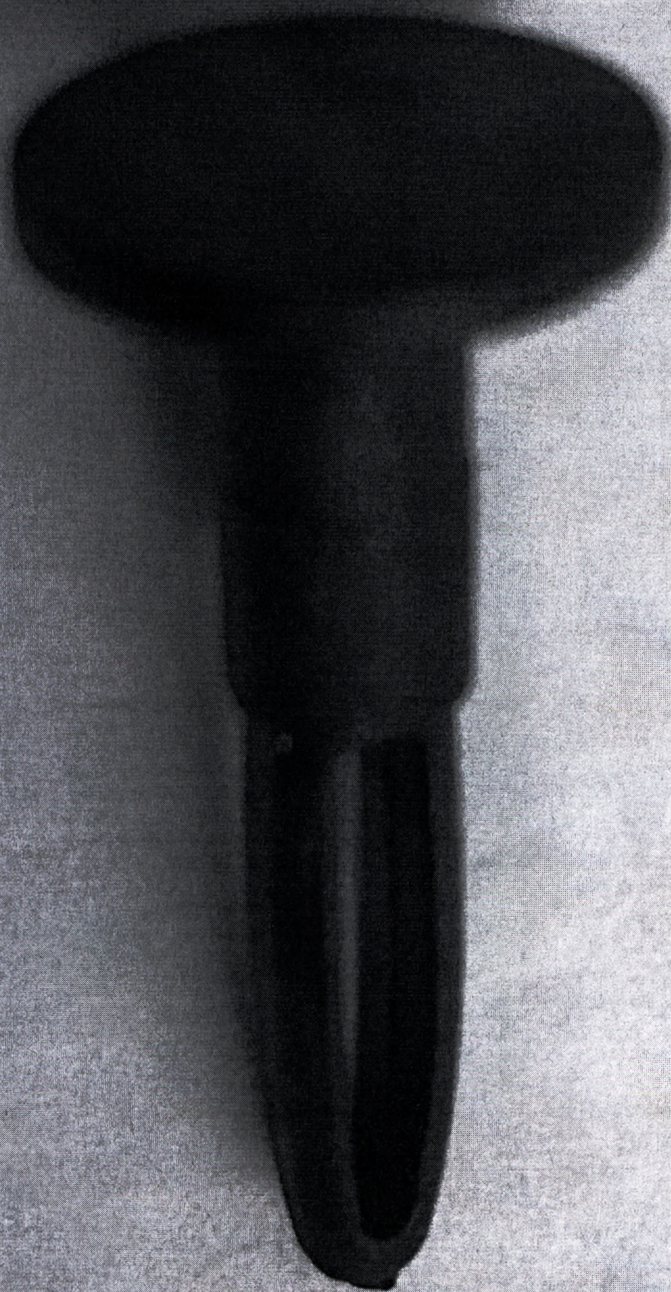



Принадлежности: 6. Индикатор внутриглазного давления типа Т – 1 шт.











Принадлежности: 8. Призмы индикатора внутриглазного давления – не более 30 уп. (в упаковке 20, 100, 500 шт.)

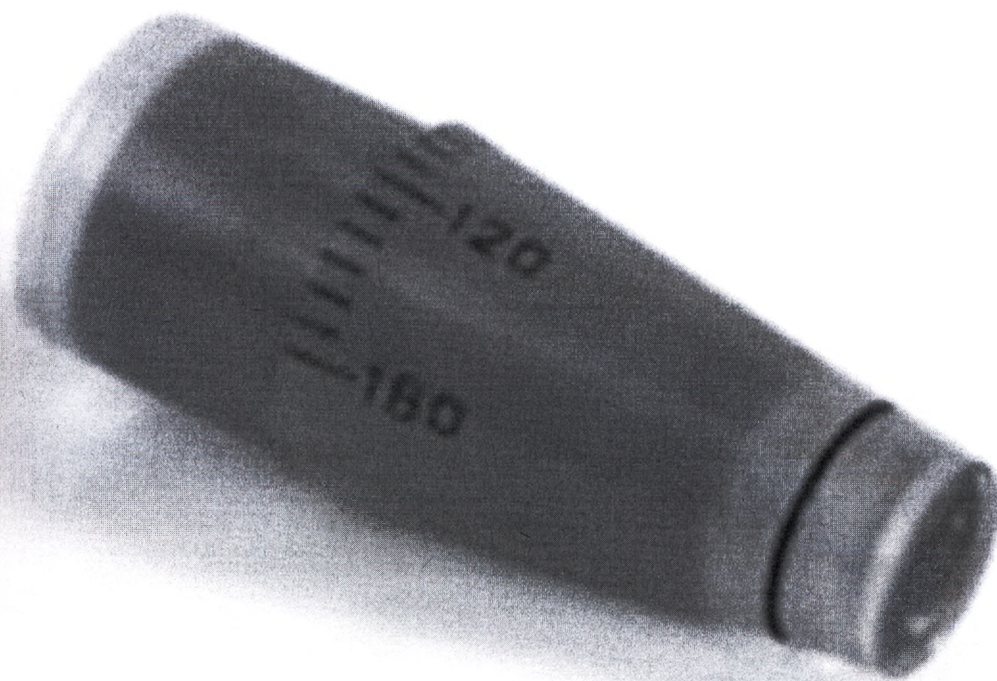




принадлежности: 9. Стержень юстировочный индикатора внутриглазного давления – 1 шт.

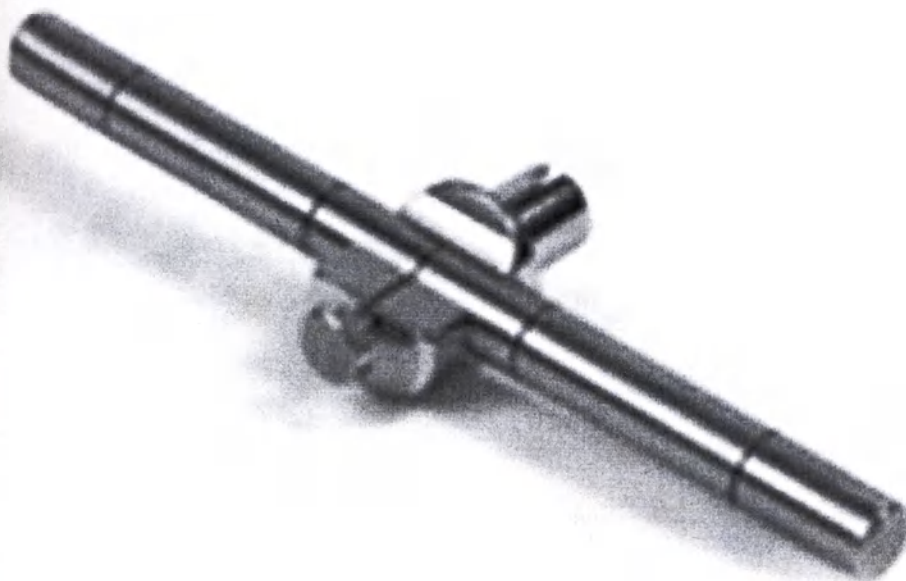




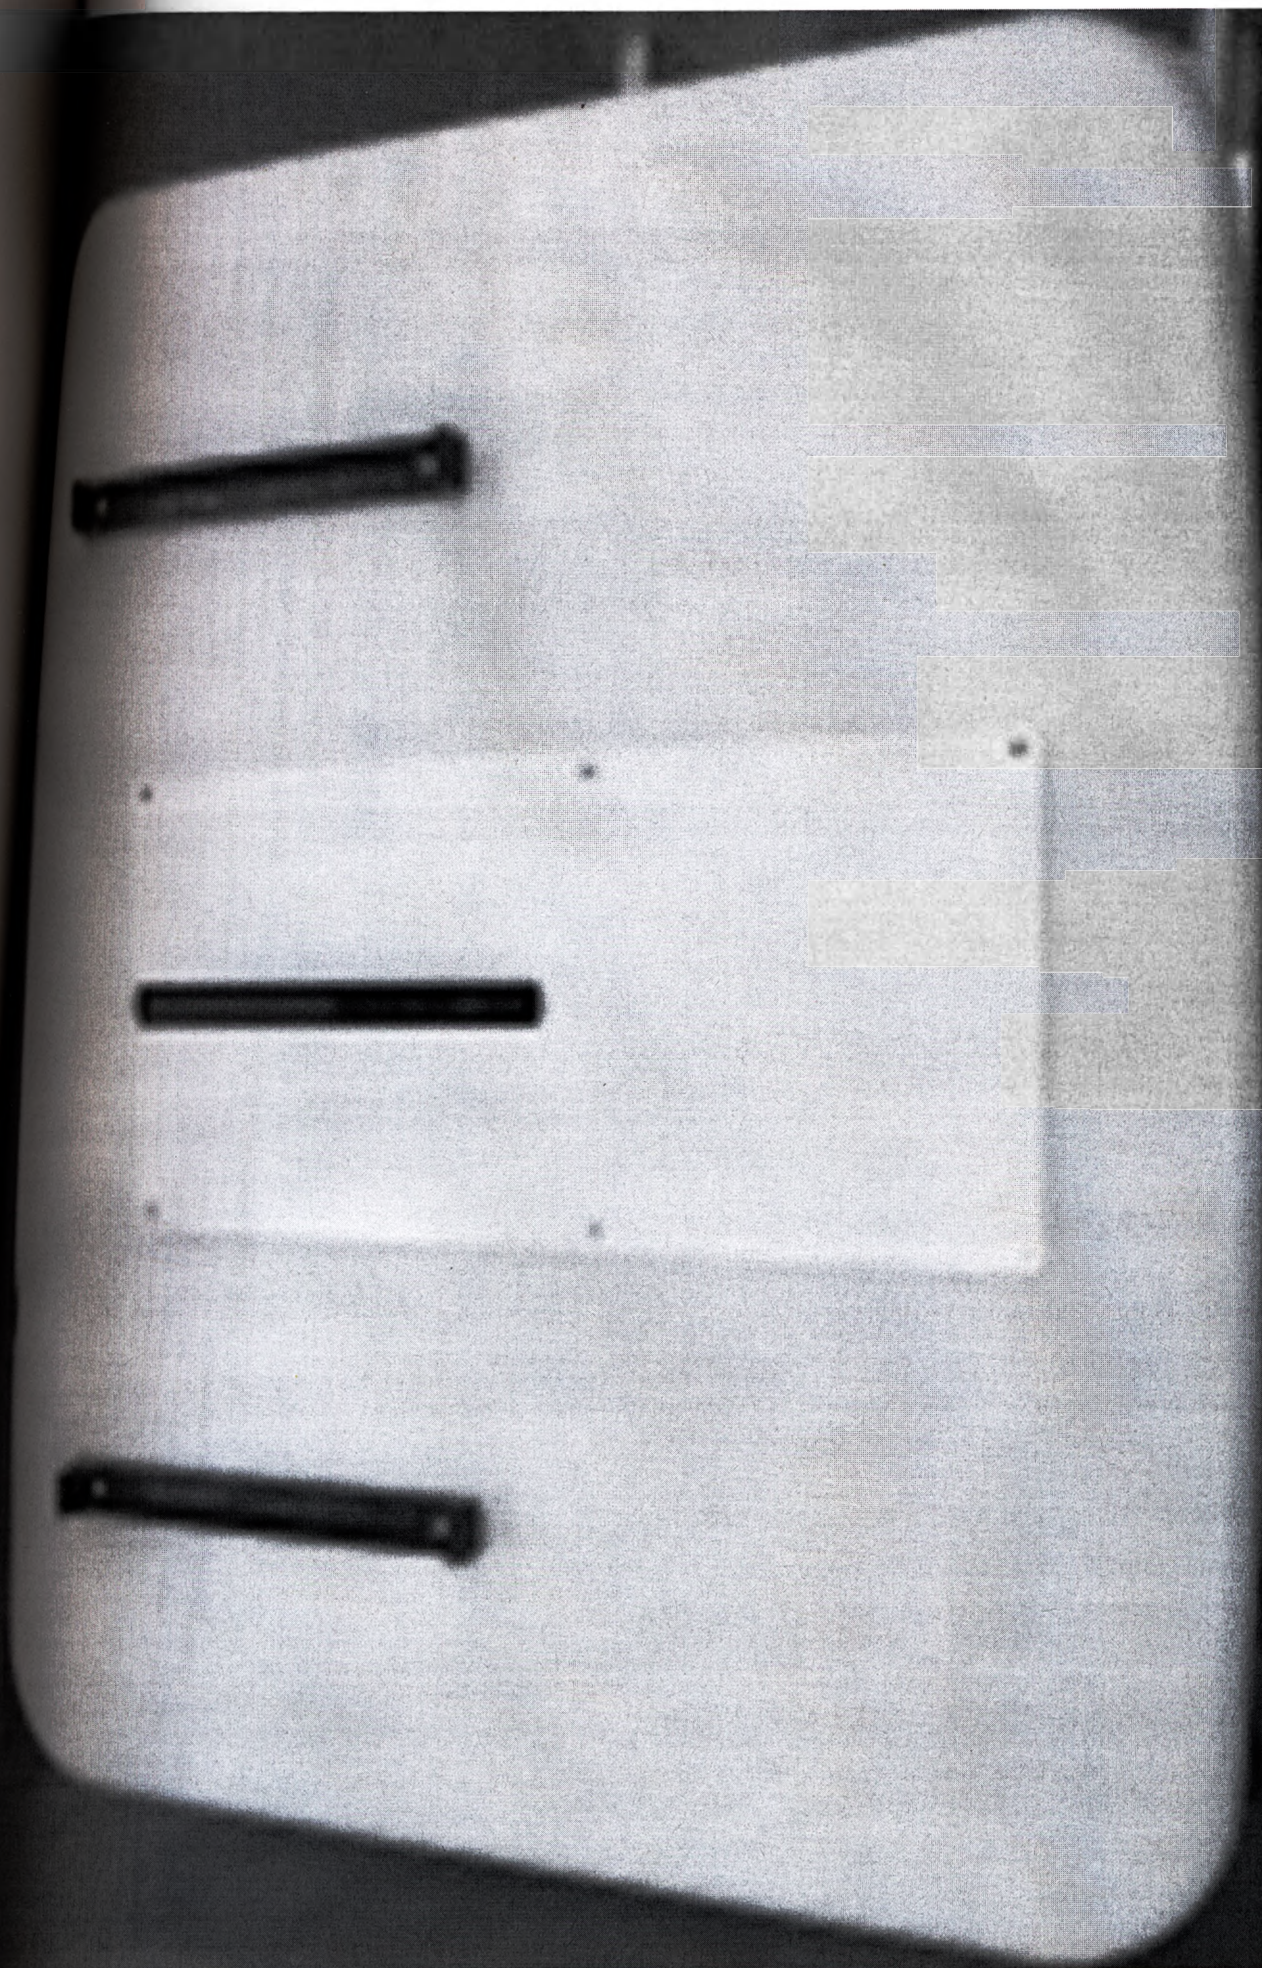




ности: 10. Столешница стола-подставки – 1 шт.

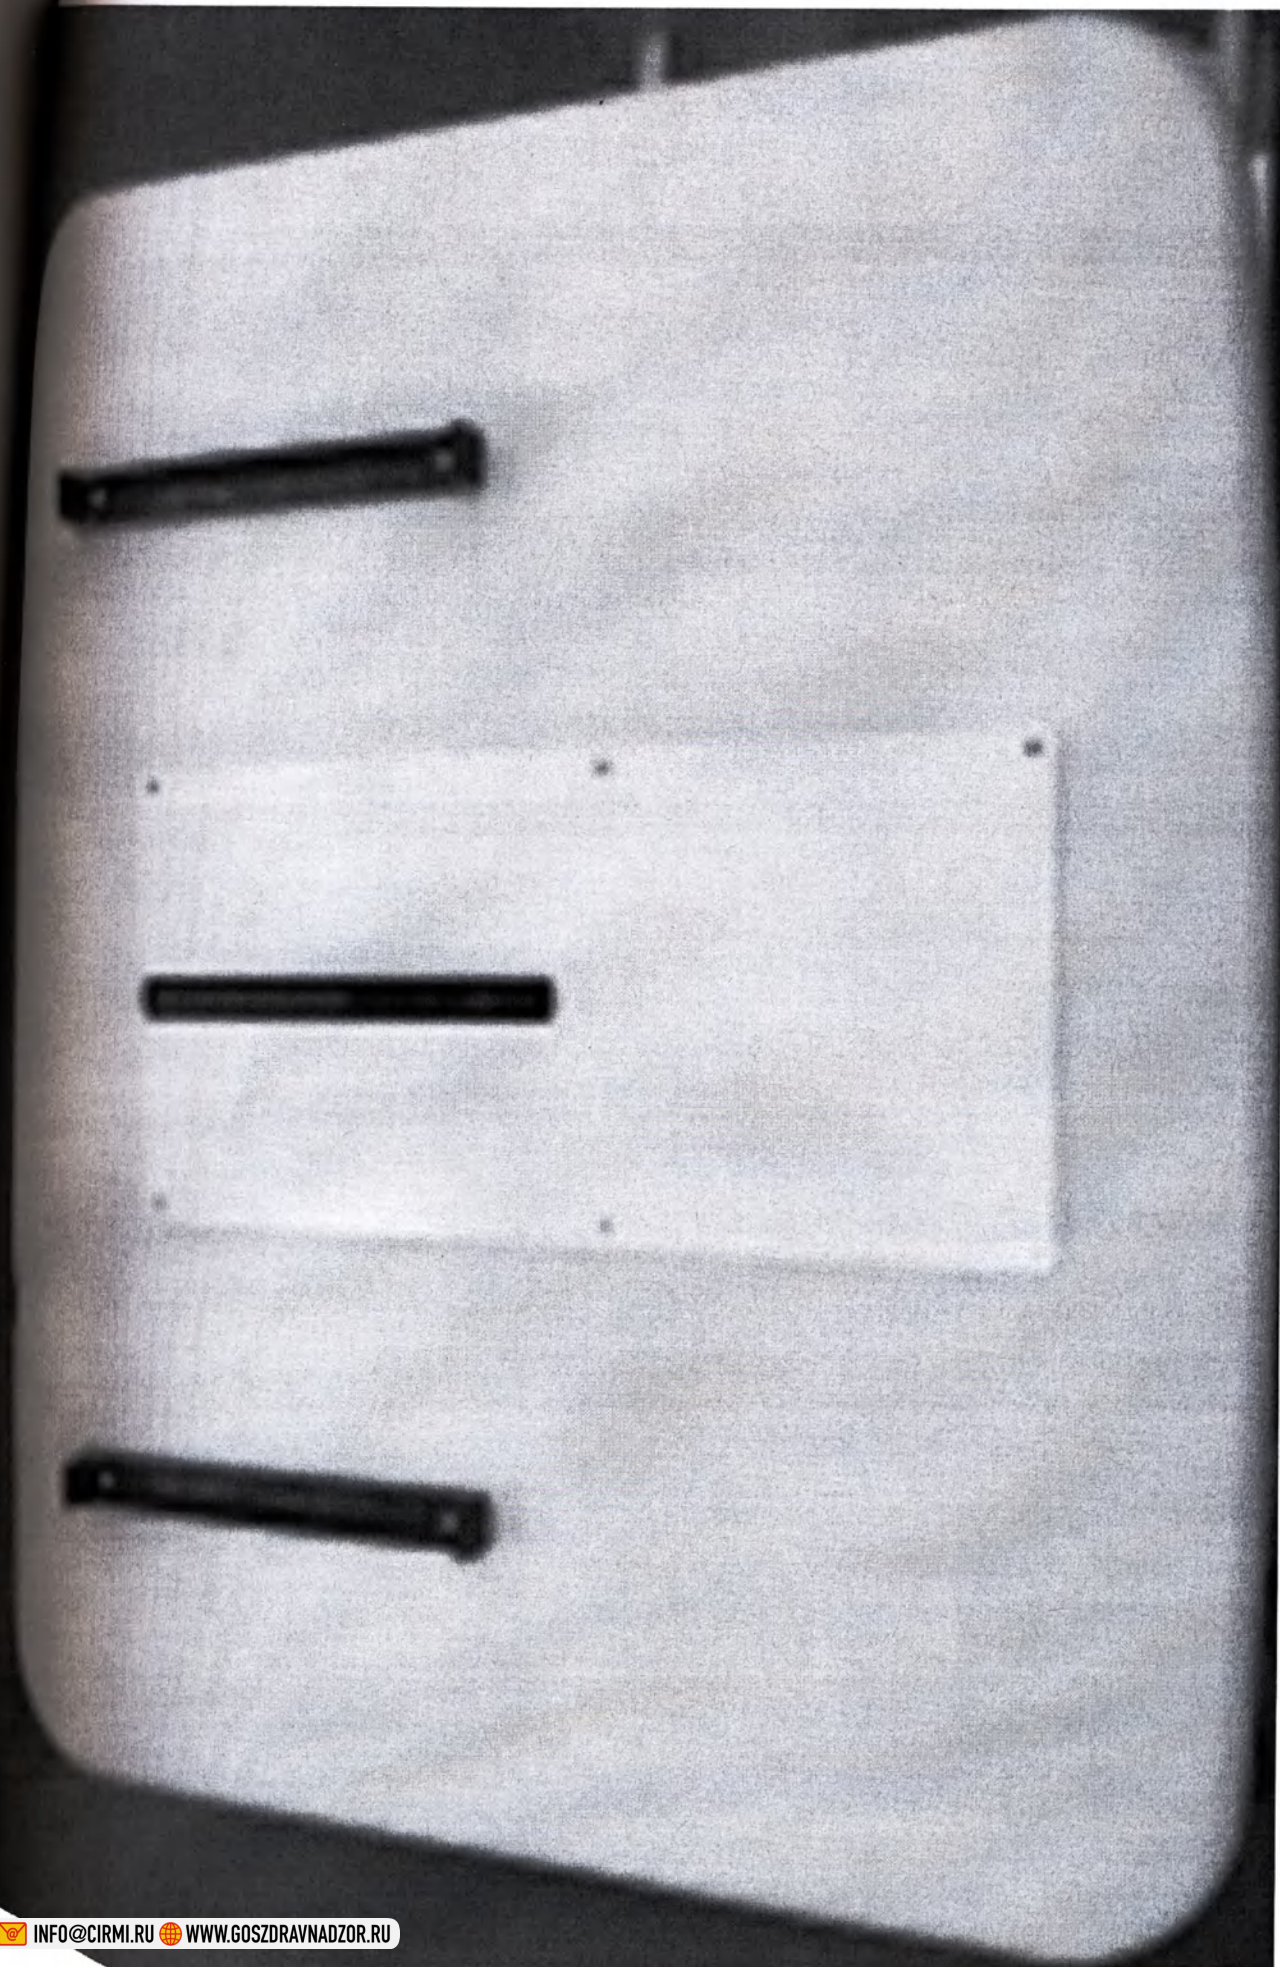




Принадлежности: 11. Ножка стола-подставки электроподъемная малая – 1 шт.

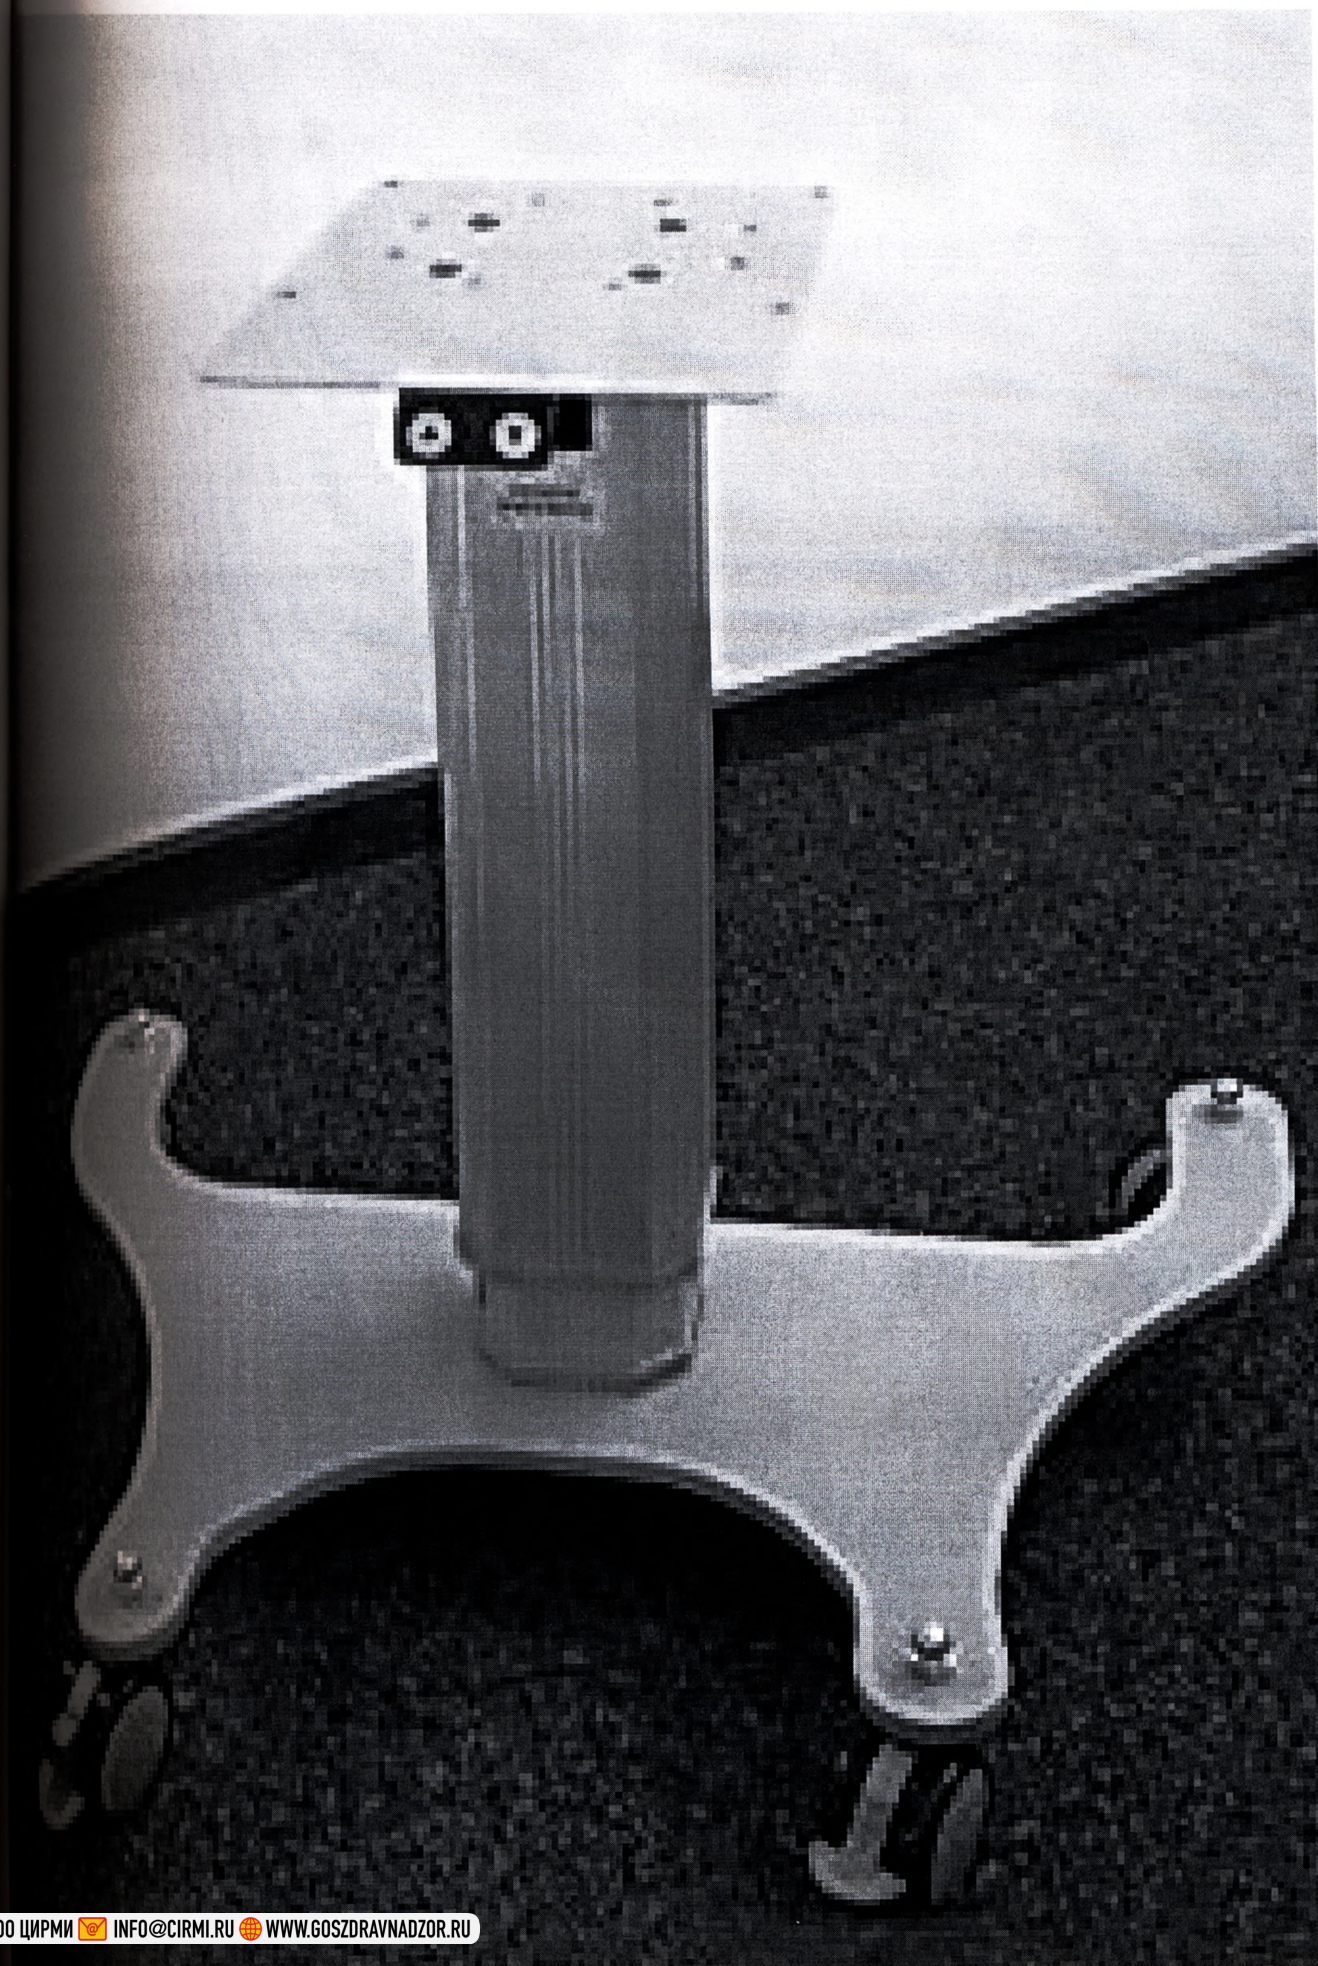




Принадлежности: 12. Пластина листовая – 1 шт.

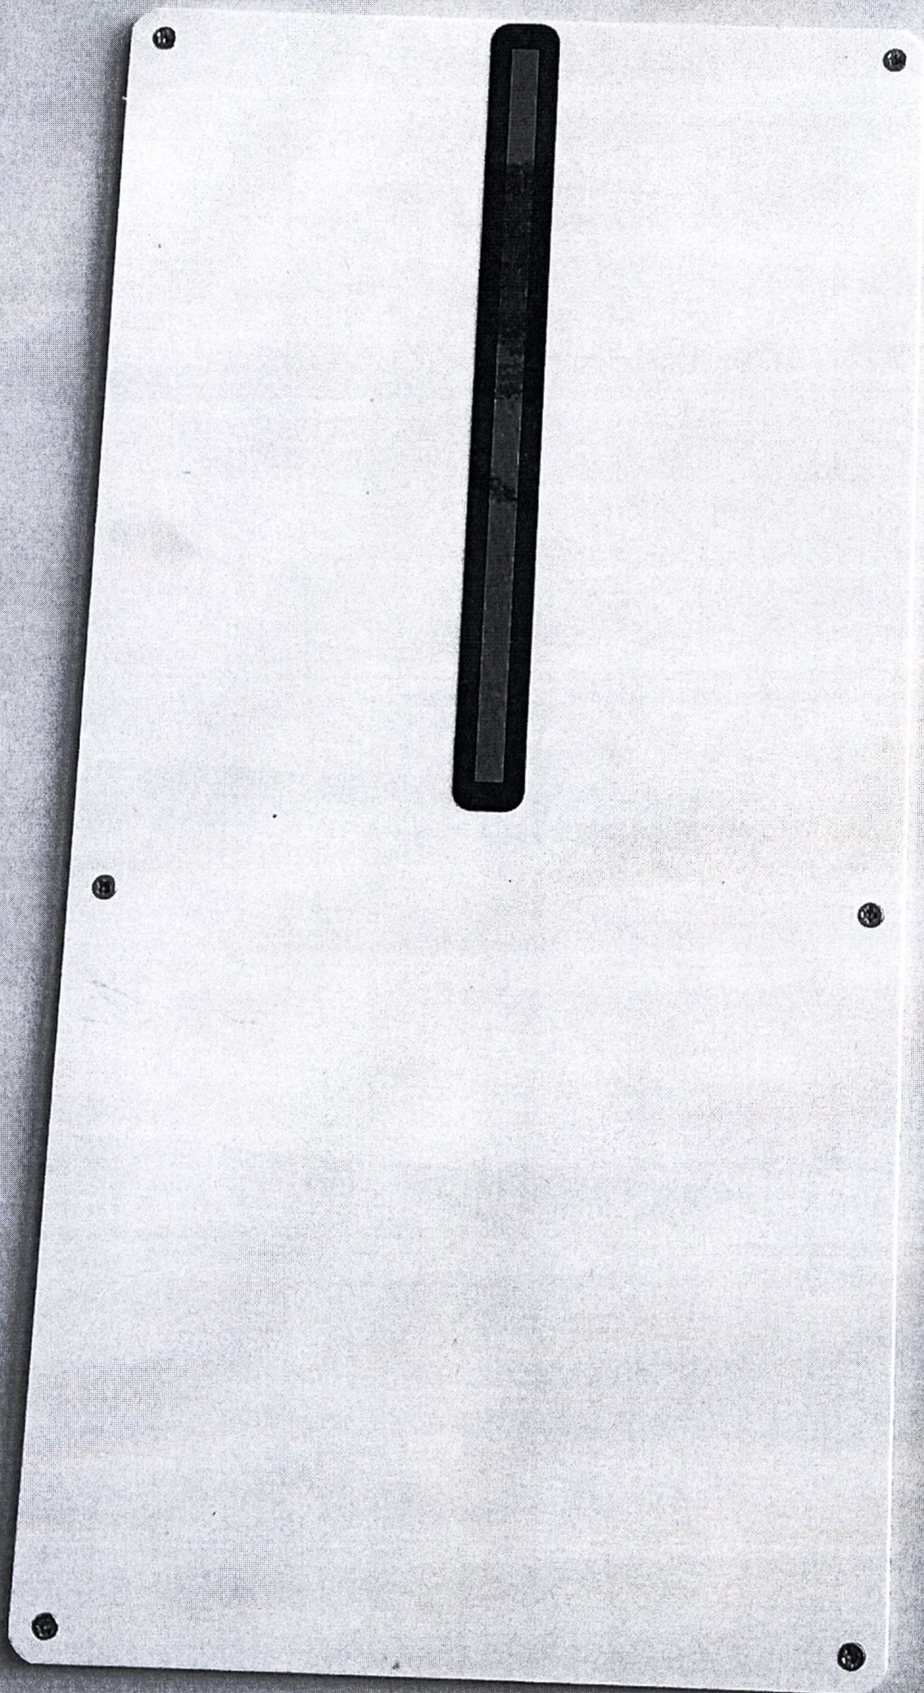




принадлежности: 13. Рельсы зубчатые – 2 шт.

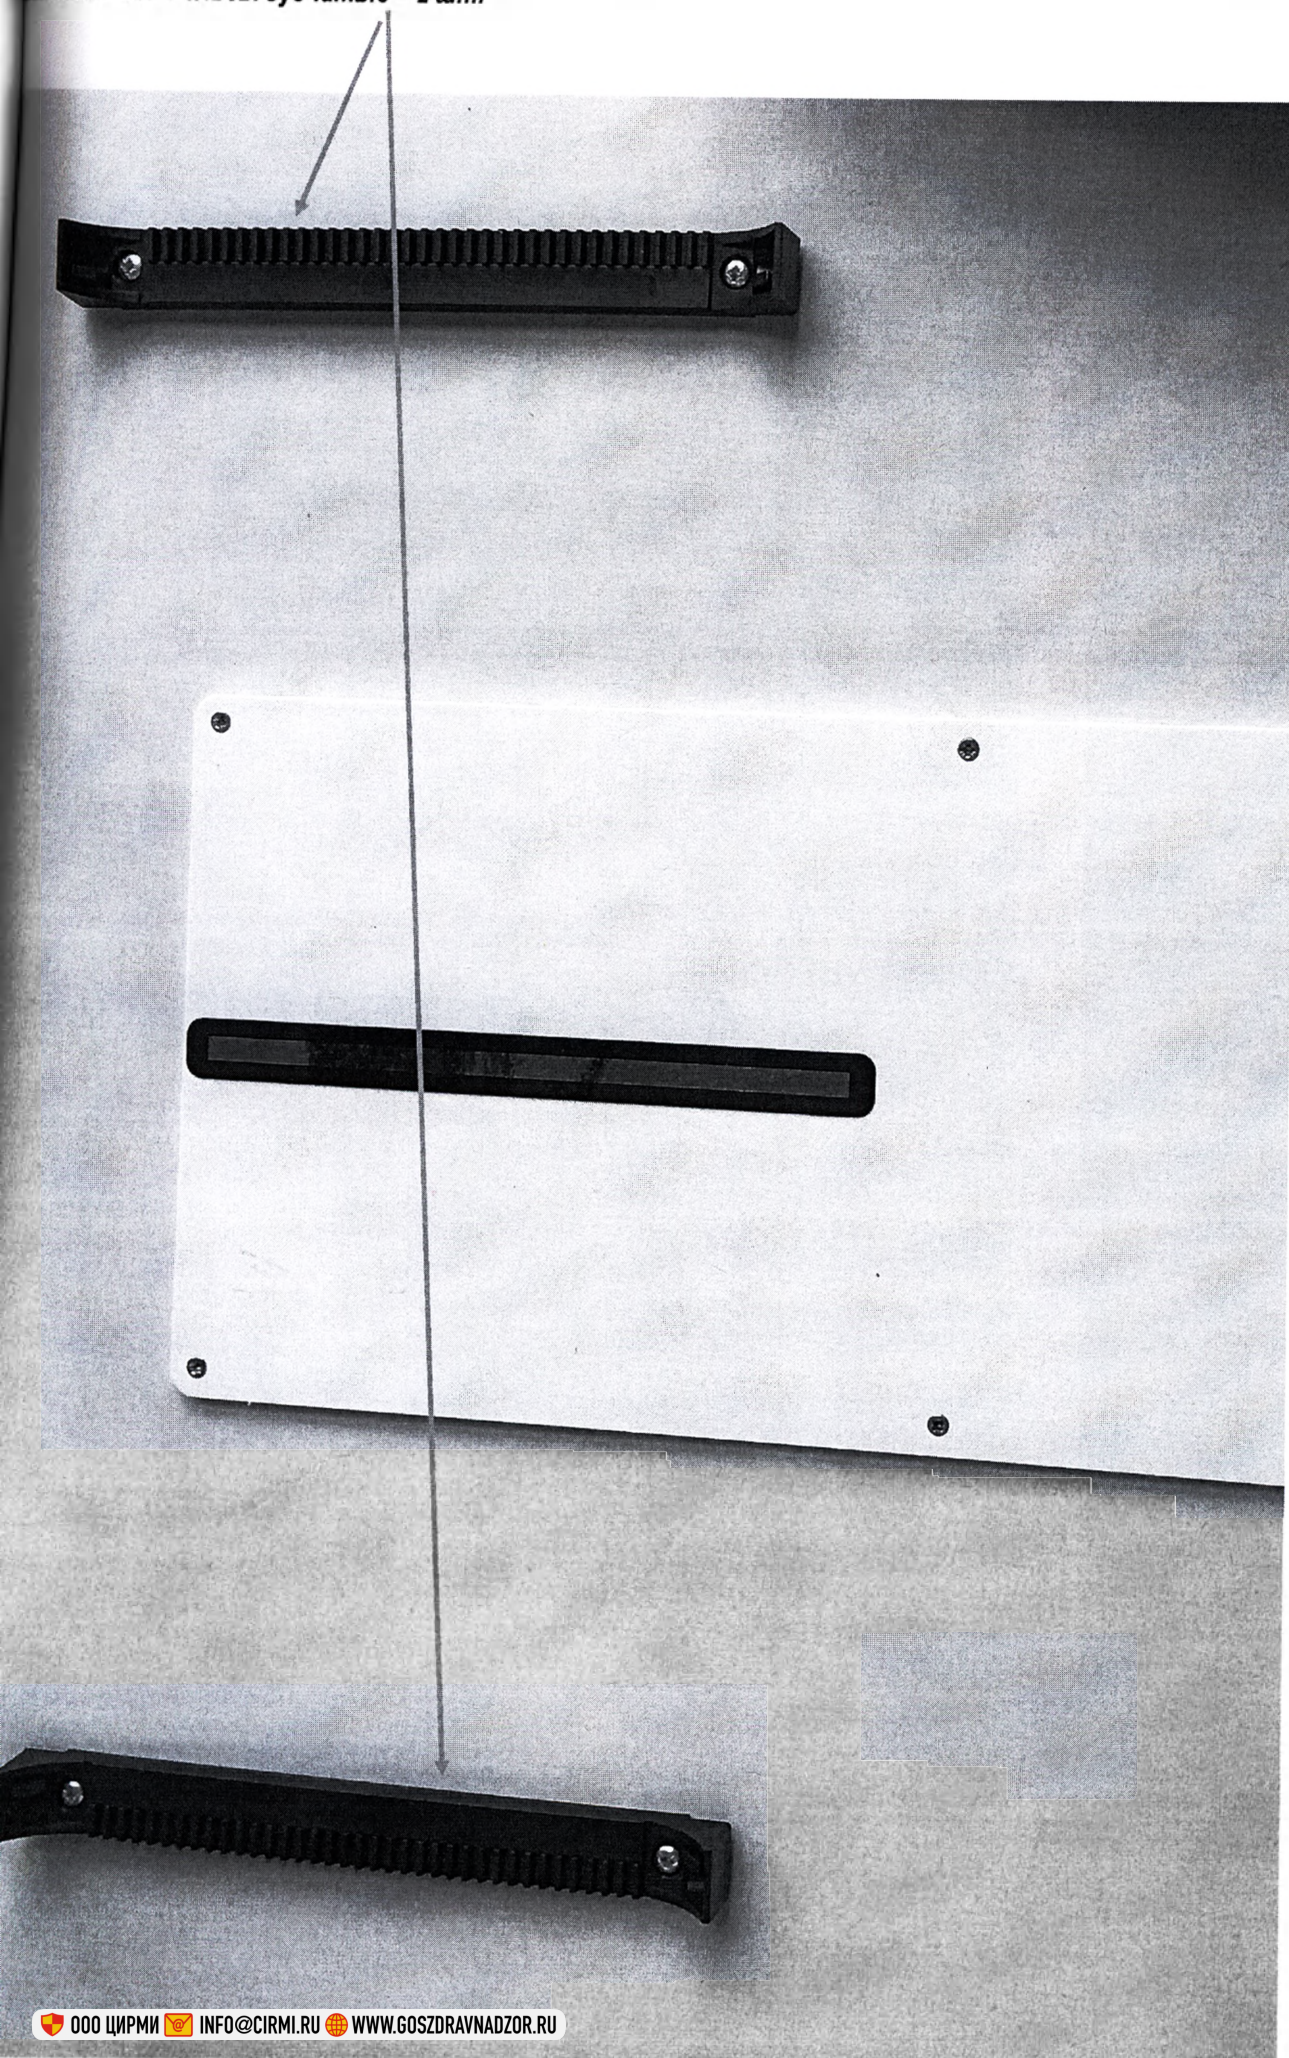



принадлежностями: 14. Ящик для принадлежностей – 1 шт.

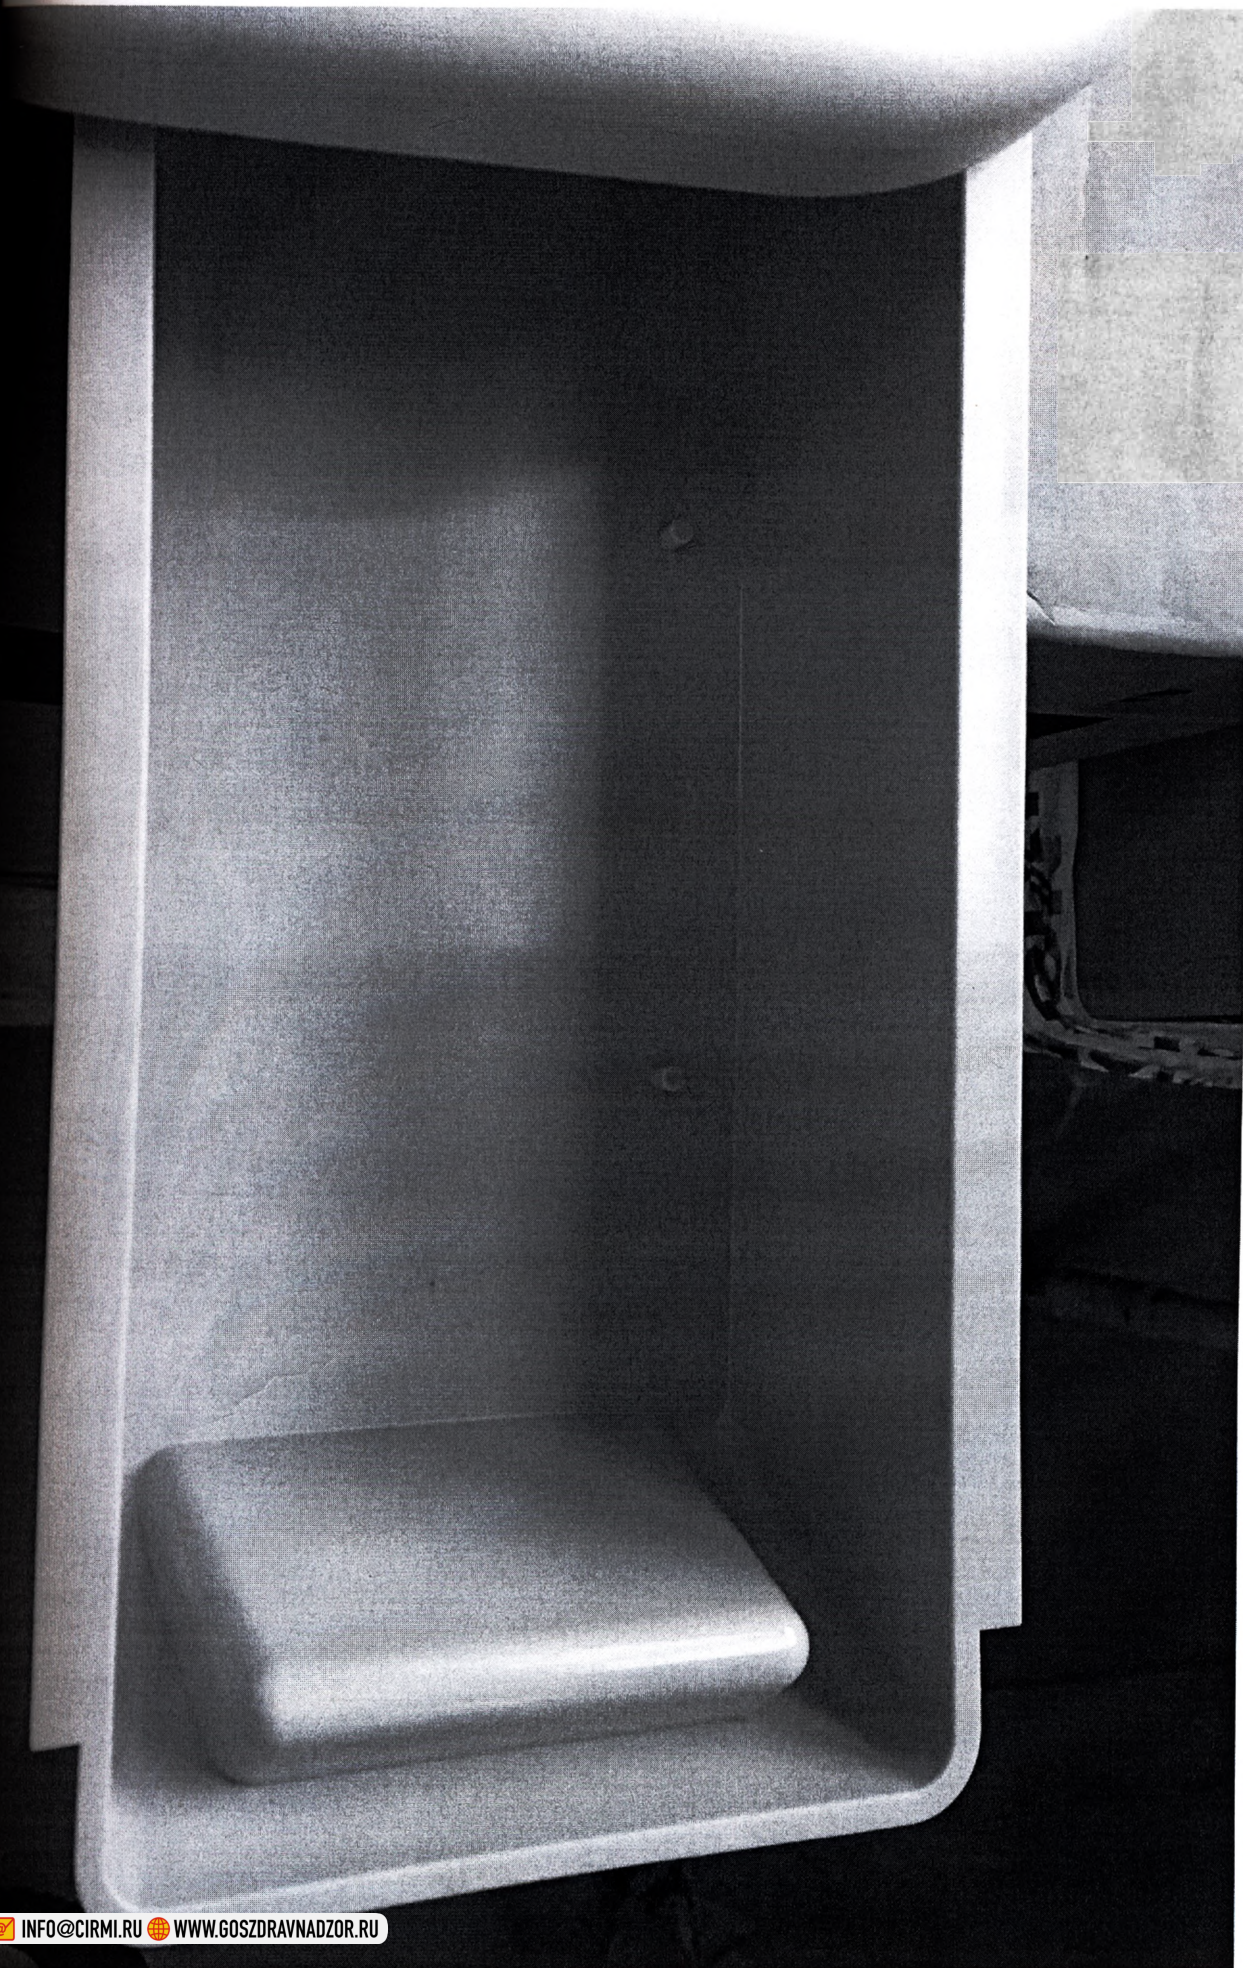



принадлежности: 15. Блок питания – 1 шт.





принадлежности: 16. Кабель подключения основания целевой лампы к столешнице – 1 шт.





принадлежности: 17. Кабель питания – 1 шт.





ности: 18. Кабель башни освещения – 1 шт.





принадлежности: 19. Кабель упора для головы пациента – 1 шт.





принадлежности: 20. USB кабель – 1 шт.





принадлежности: 21. USB кабель высокоскоростной – 1 шт.





принадлежности: 21. USB кабель высокоскоростной – 1 шт.






принадлежности: 22. Окуляры – 2 шт.






23. Резиновые накладки на окуляр – 2 шт.

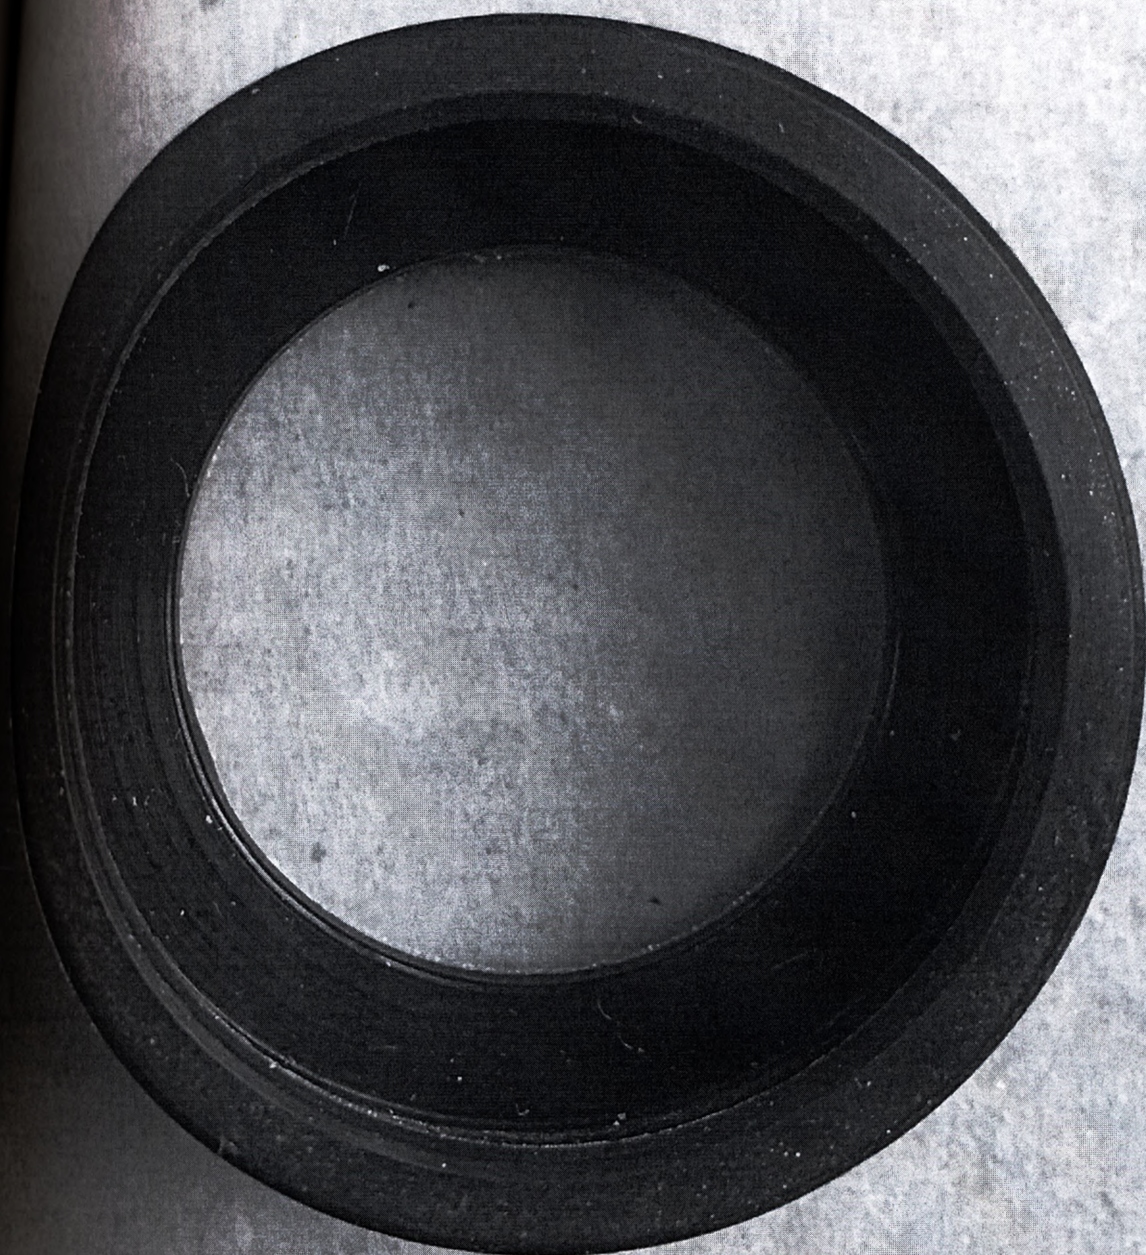



принадлежности: 24. Делитель луча – 1 шт.

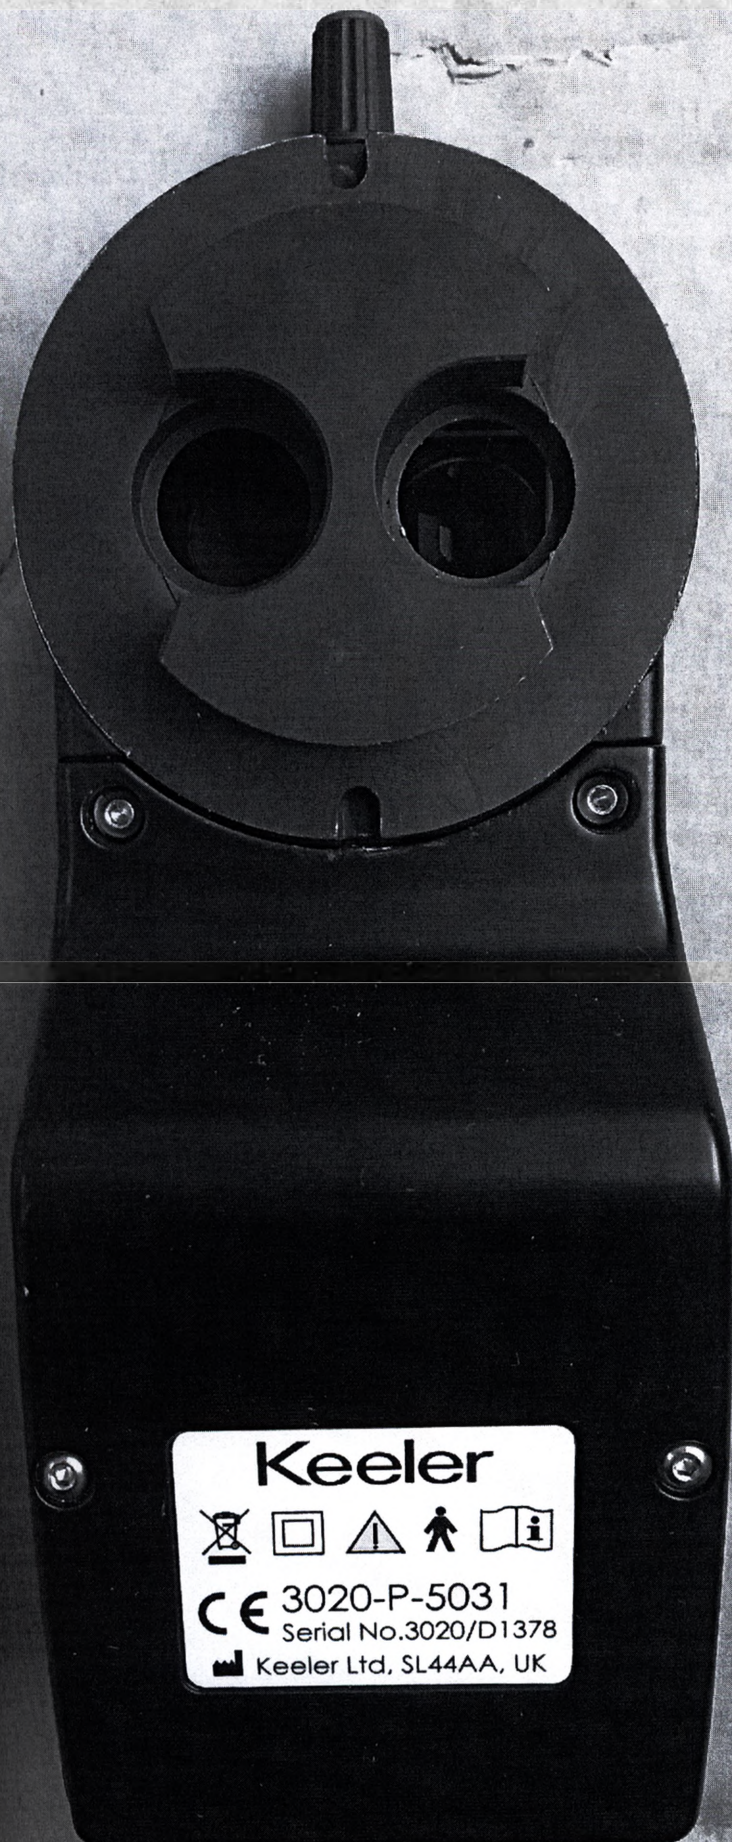

**Keeler**




**CE** 3020-P-5031  
Serial No.3020/D1378

 Keeler Ltd, SL44AA, UK




26. Колеса зубчатые – 2 шт.

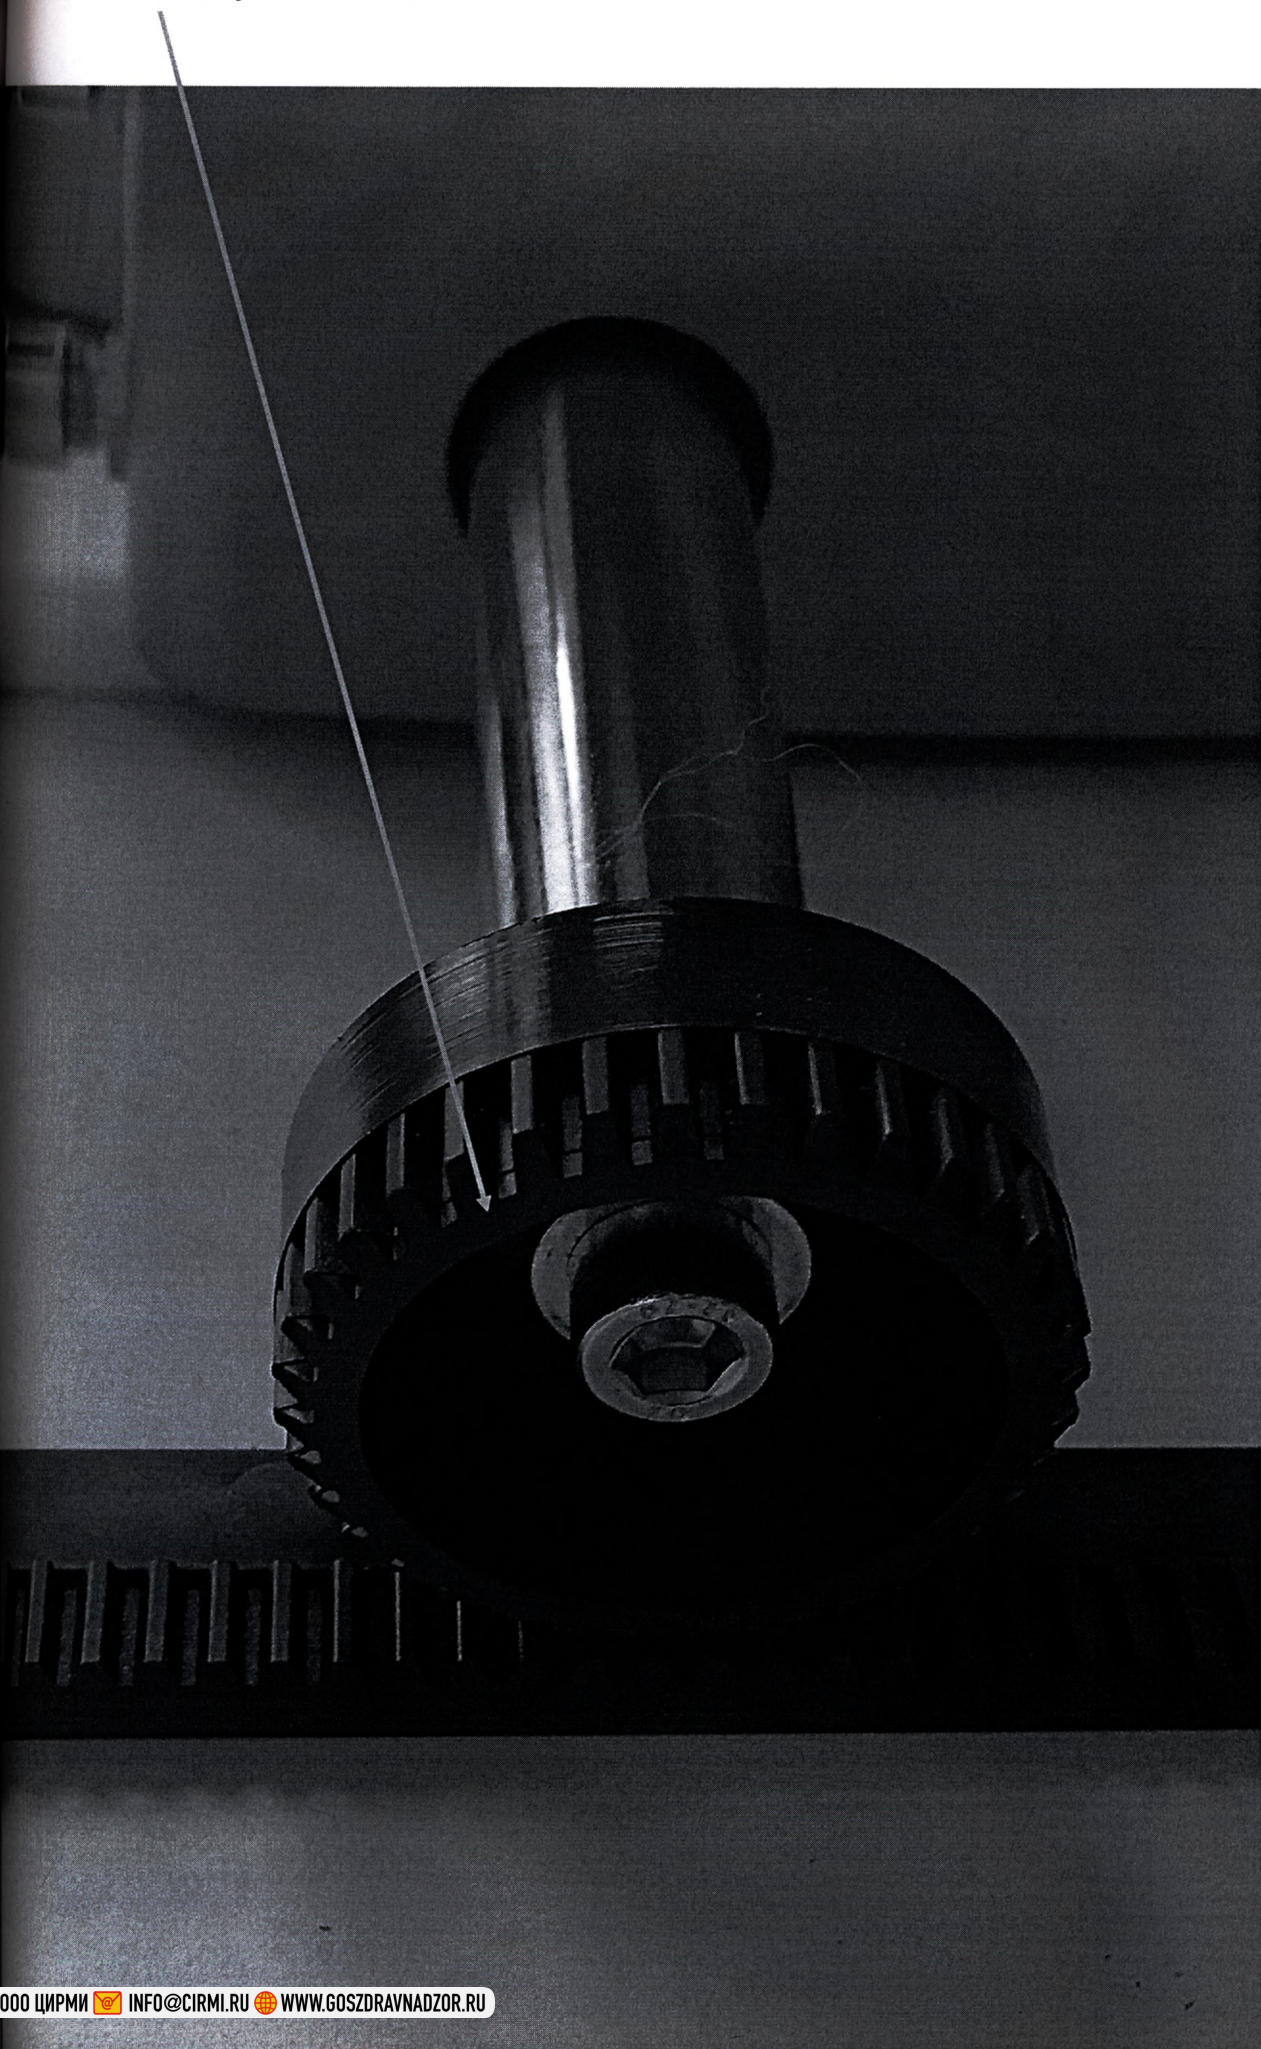




...ности: 27. Накладка джойстика – 1 шт.

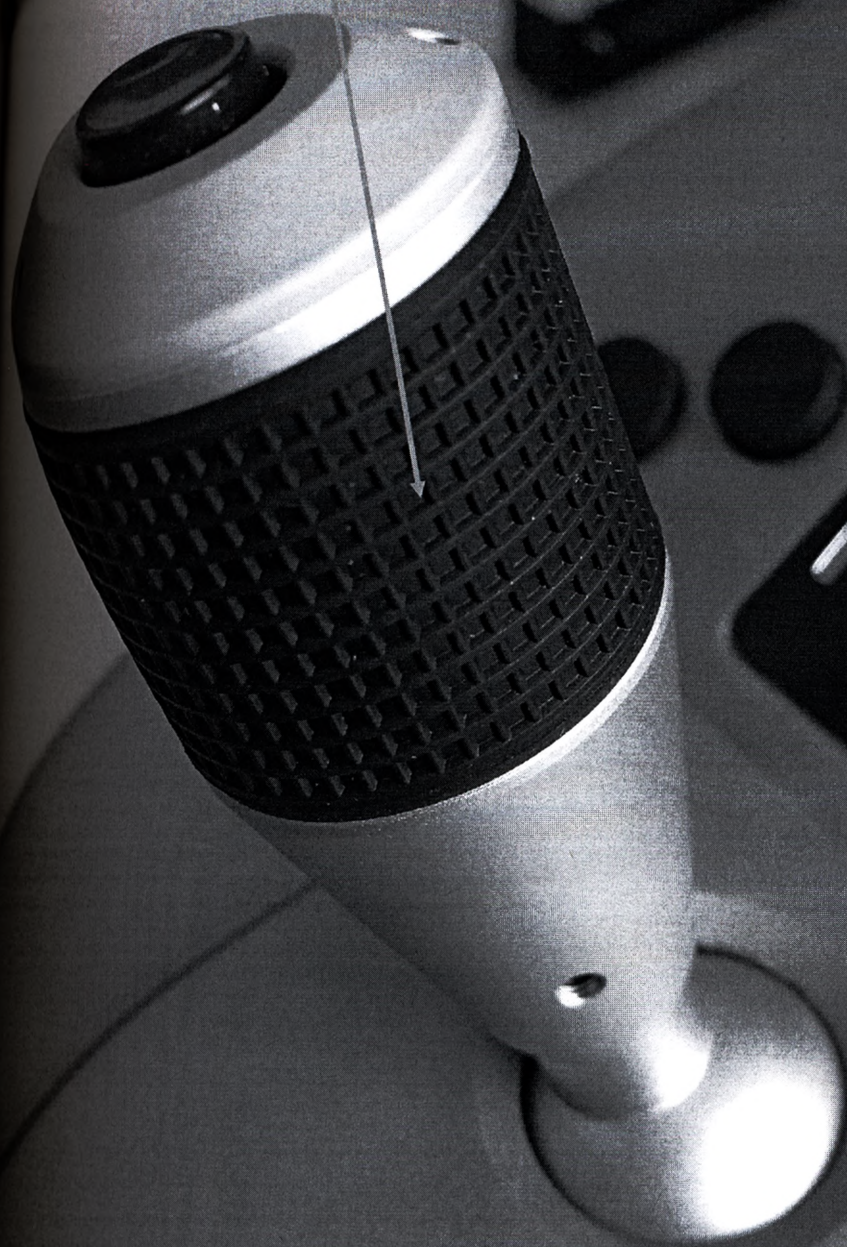



принадлежности: 28. Крышки зубчатых рельс – 2 шт.

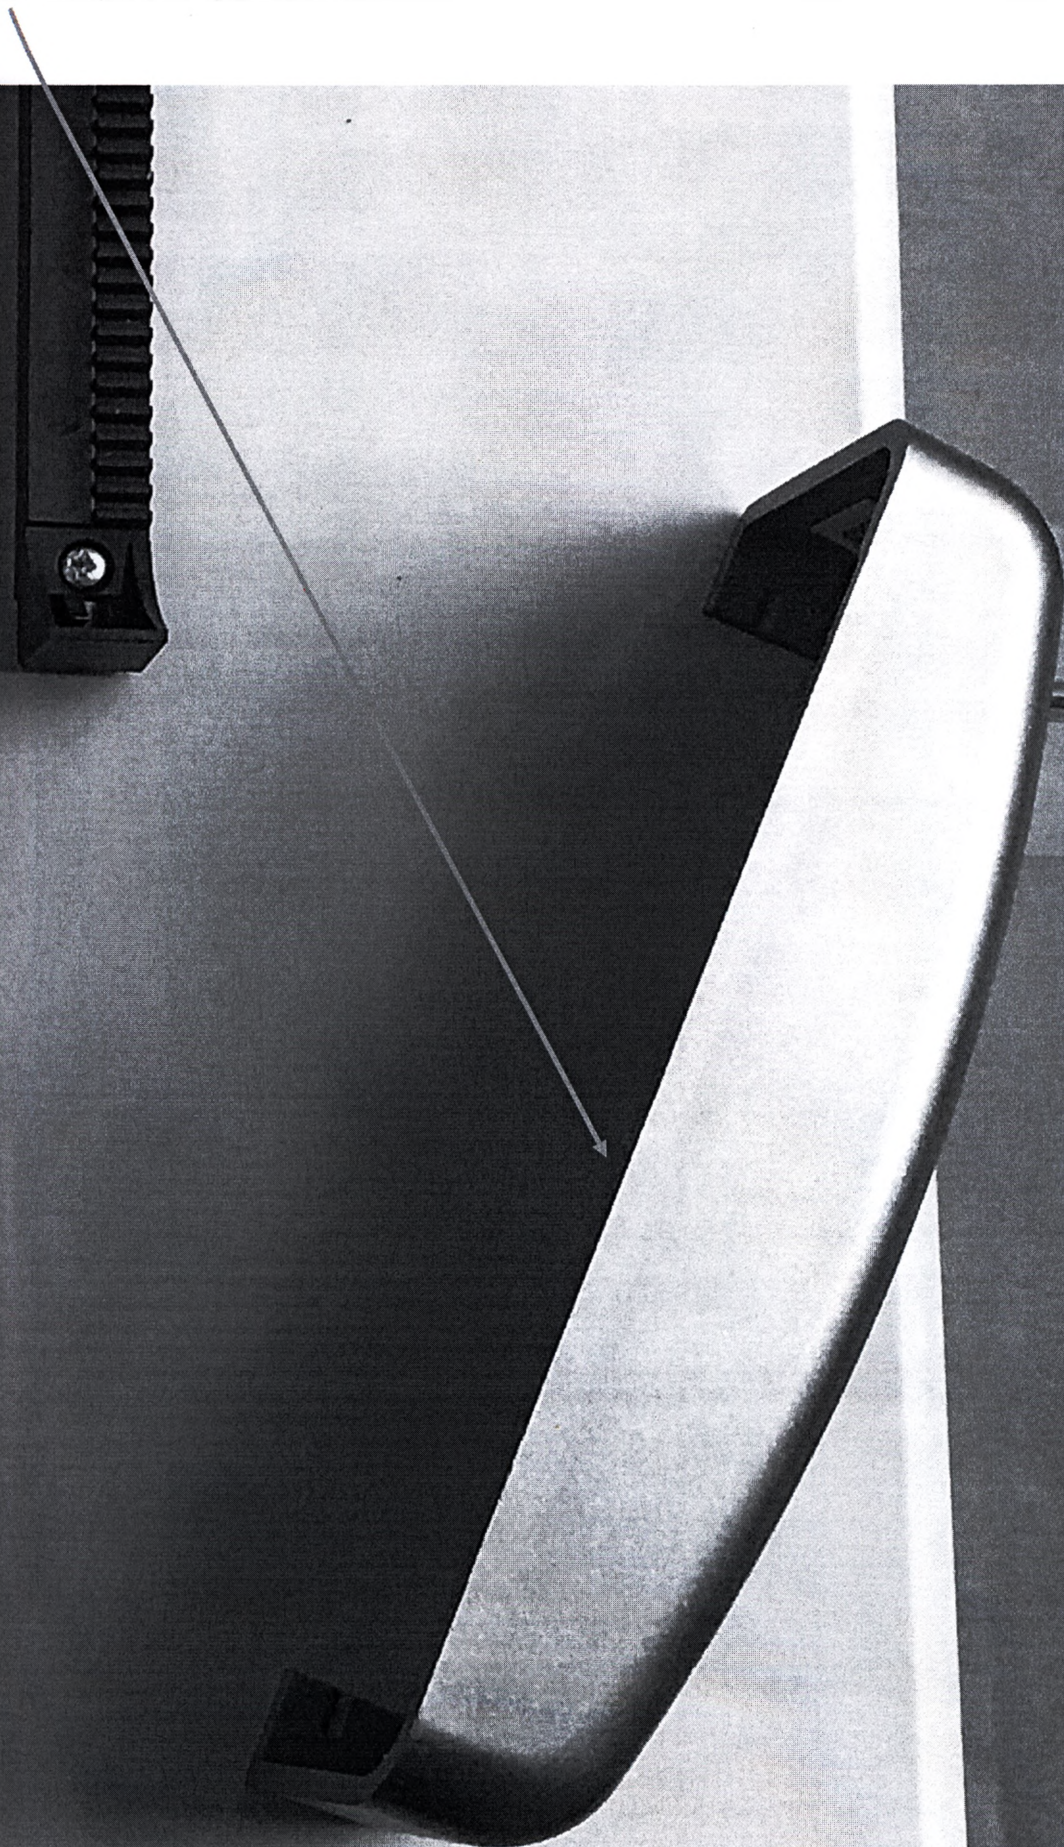



29. Диффузор осветительной башни – 1 шт.





Принадлежности: 30. Призма осветительная – 1 шт.






ежности: 31. Зеркало дыхания – 1 шт.






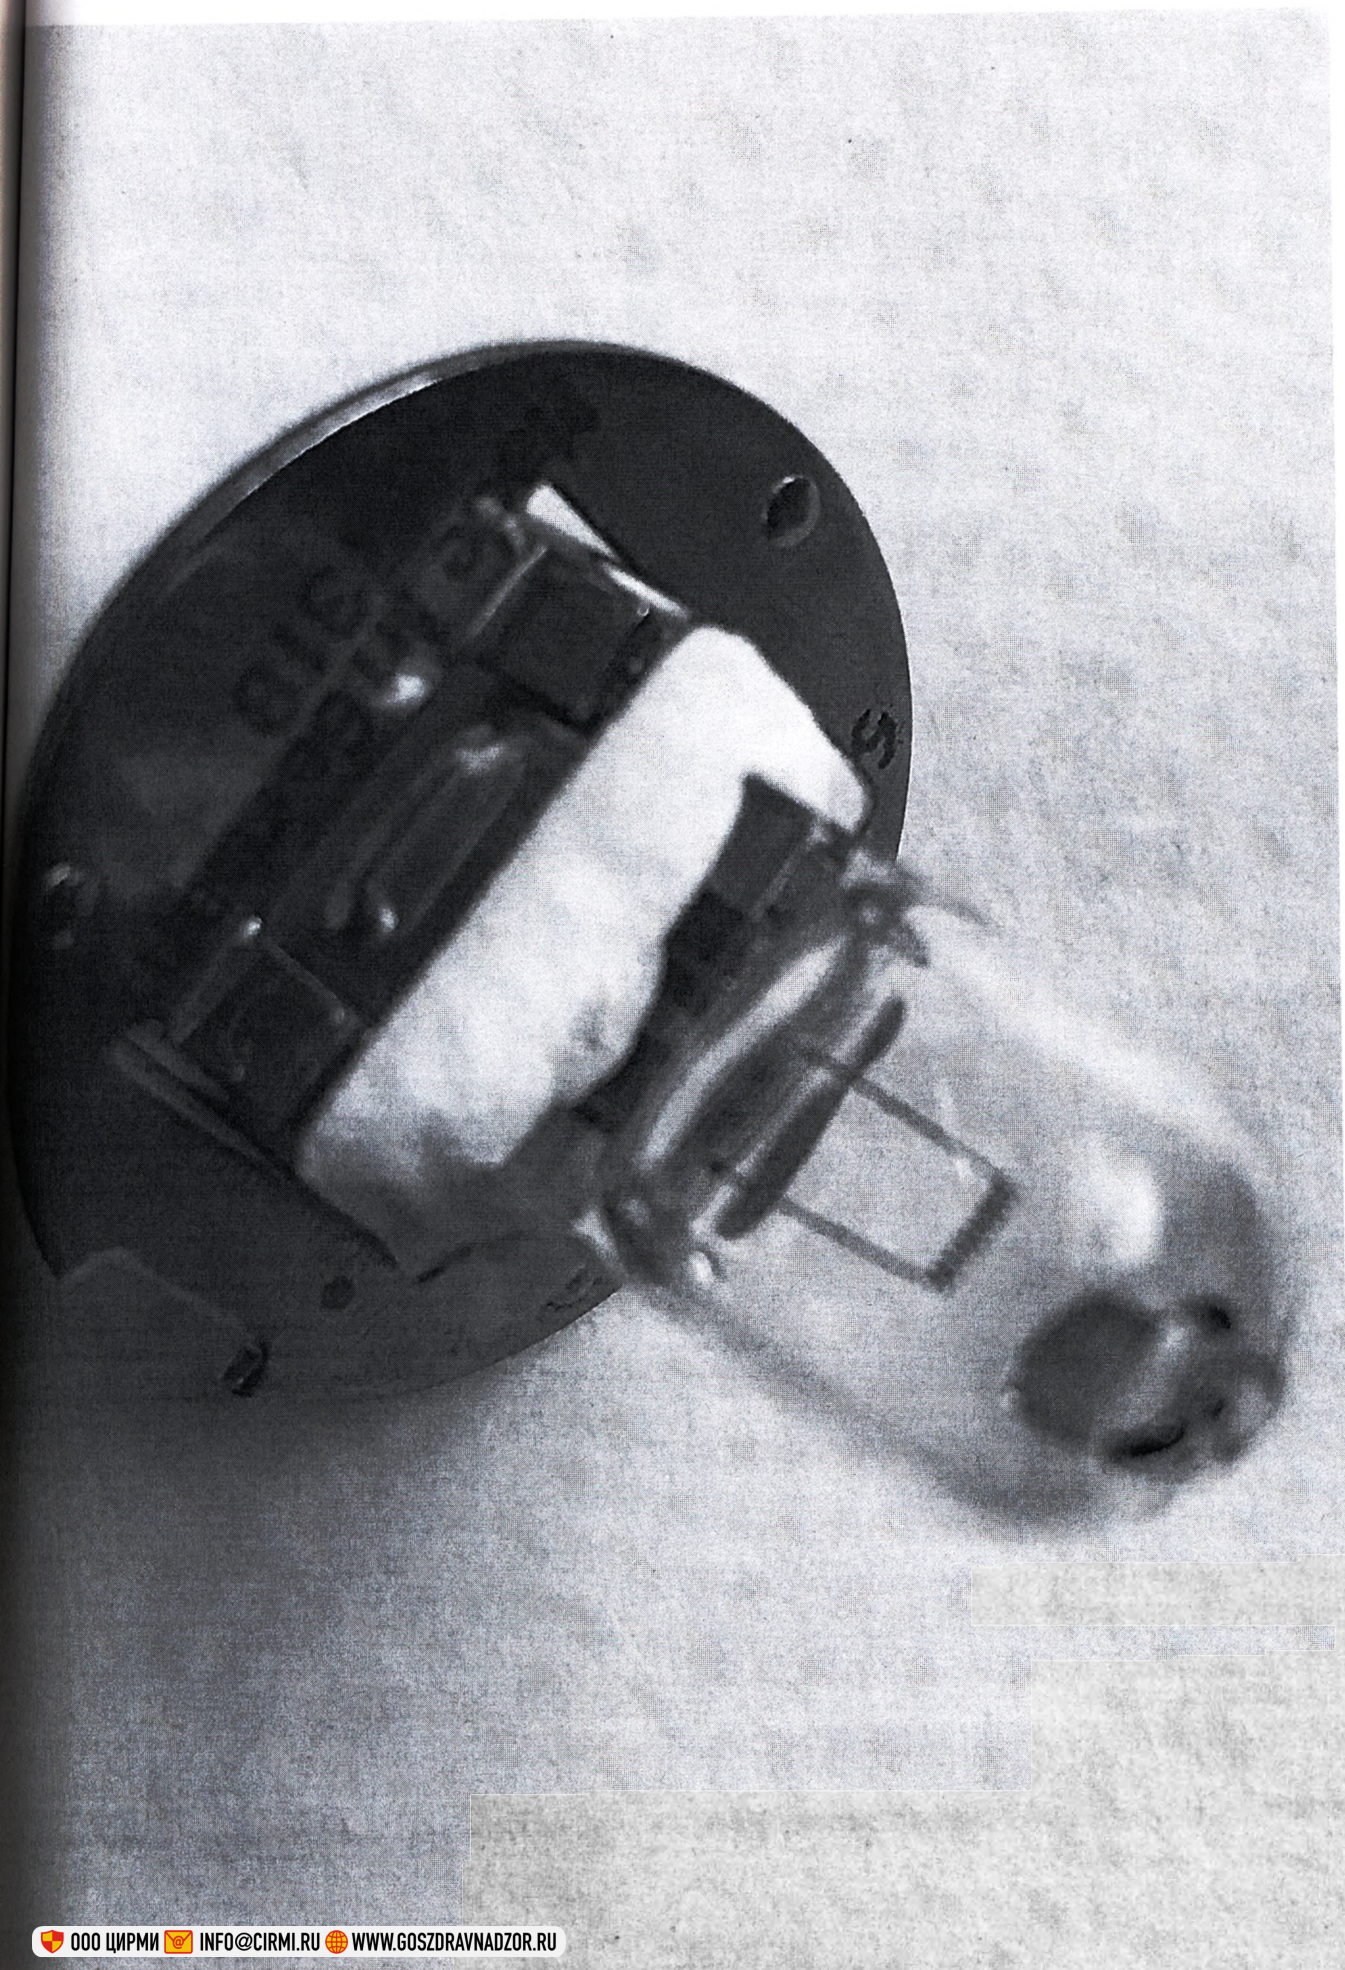




принадлежности: 33. Галогеновая лампа 12В 30Вт – не более 5 шт.

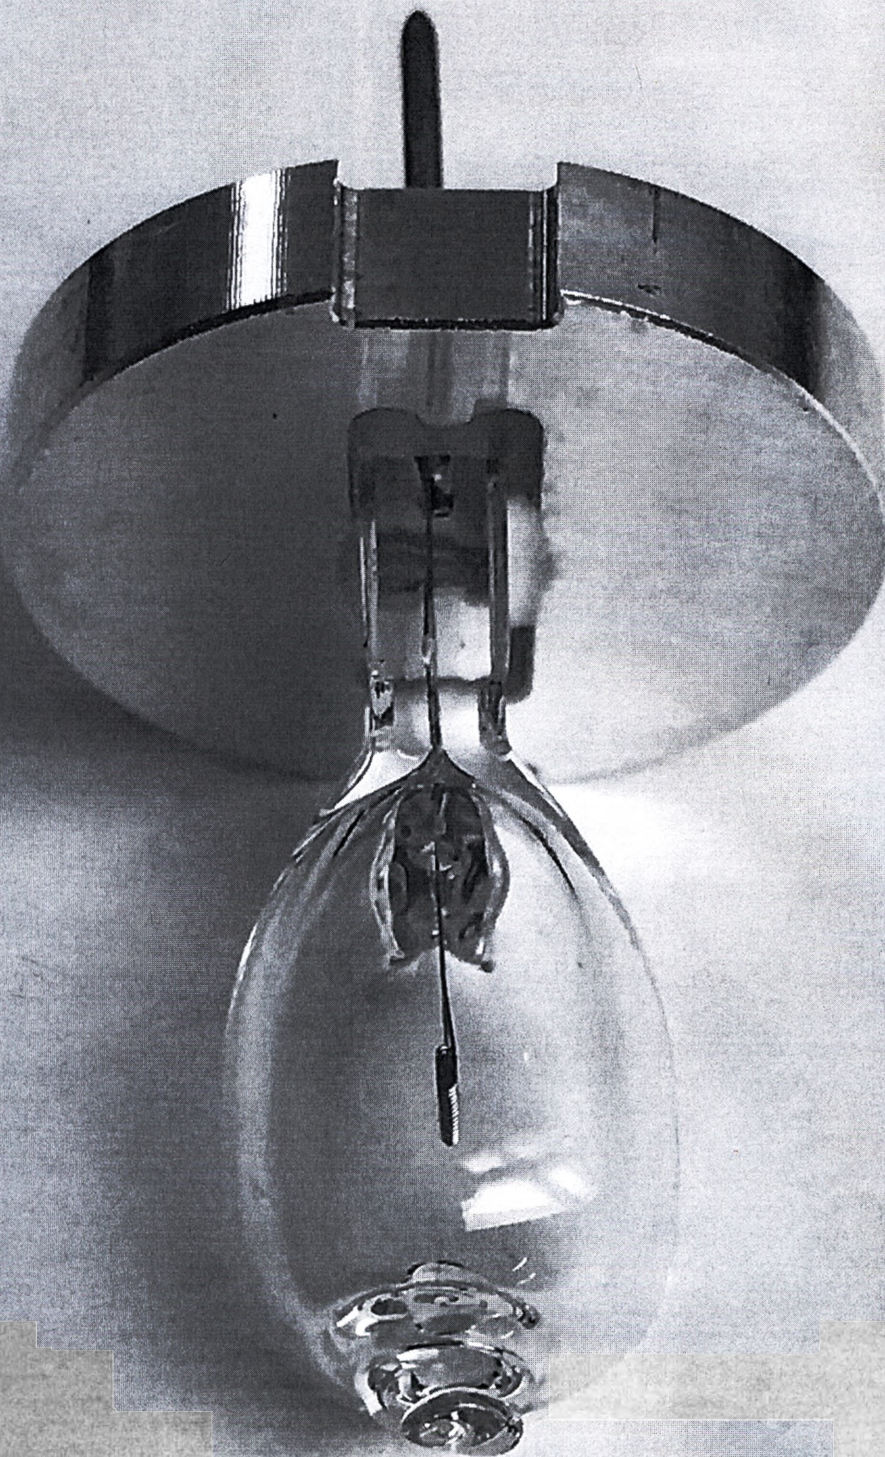



принадлежности: 34. Палочка юстированная – 1 шт.

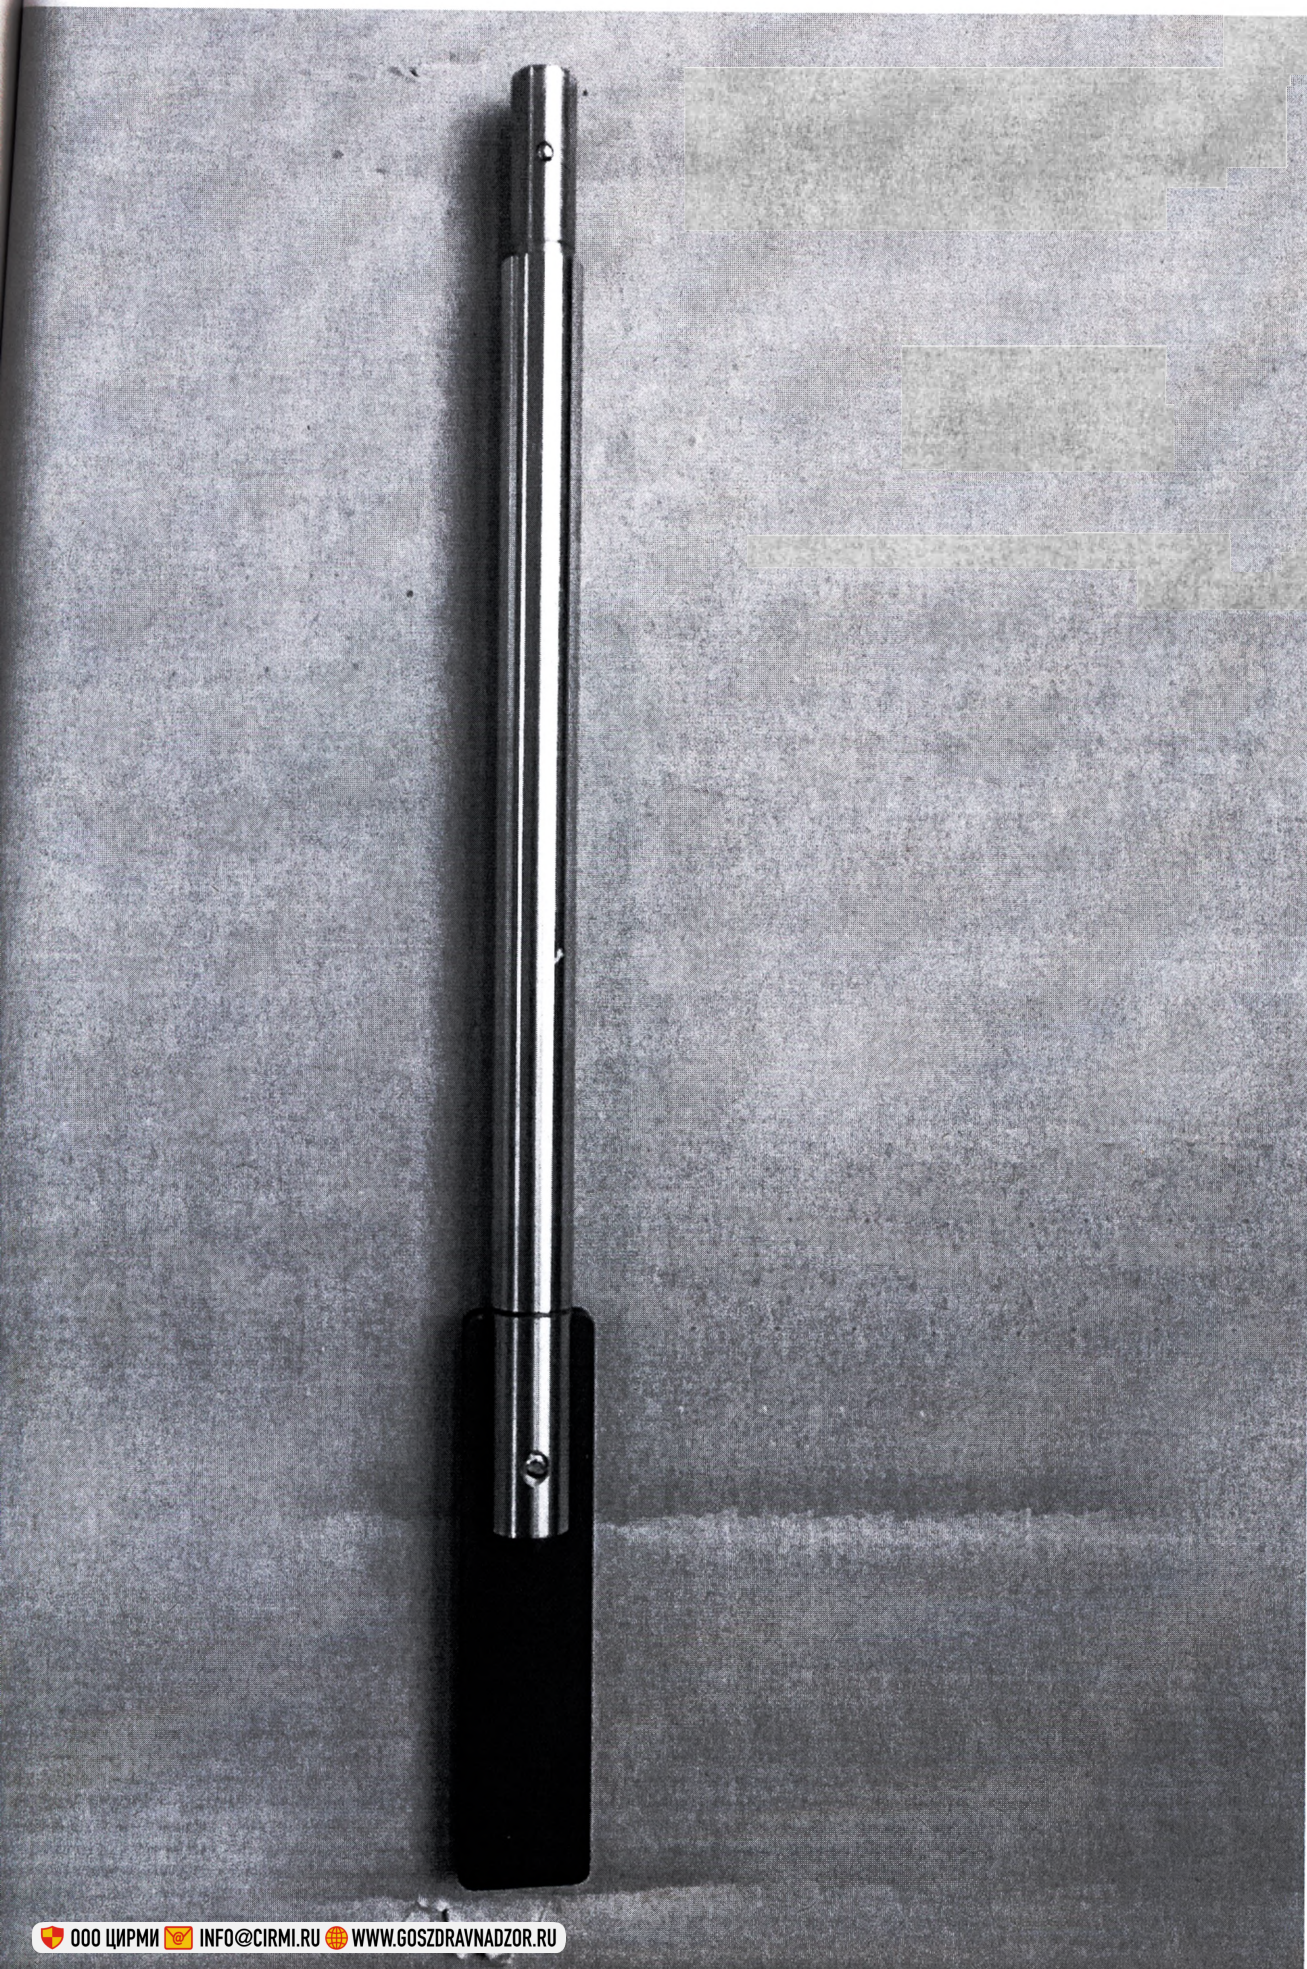



Принадлежности: 35. Адаптер для подключения фотокамеры – 1 шт.





ности: 36. Фотокомплект специальный – 1 шт.





принадлежности: 37. Видеокомплект специальный – 1 шт.





принадлежности: 38. Кабель фотокомплекта интерфейсный – 1 шт.






принадлежности: 39. Кабель видеокомплекта интерфейсный – 1 шт.






Принадлежности: 40. Блок питания фотокомплекта – 1 шт.

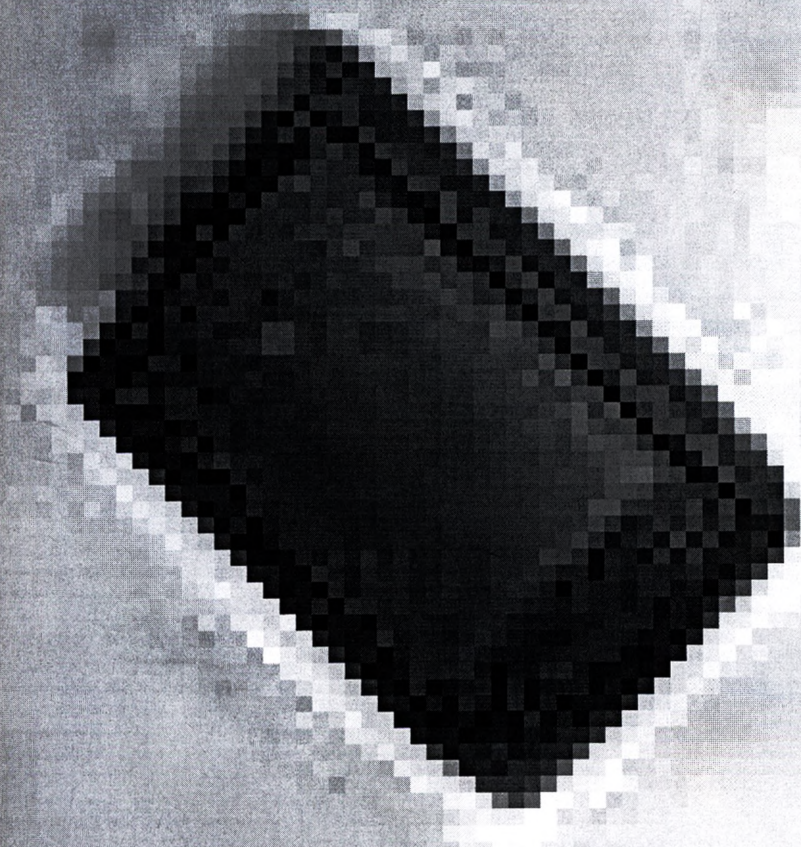



Принадлежности: 41. Блок питания видеокомплекта – 1 шт.

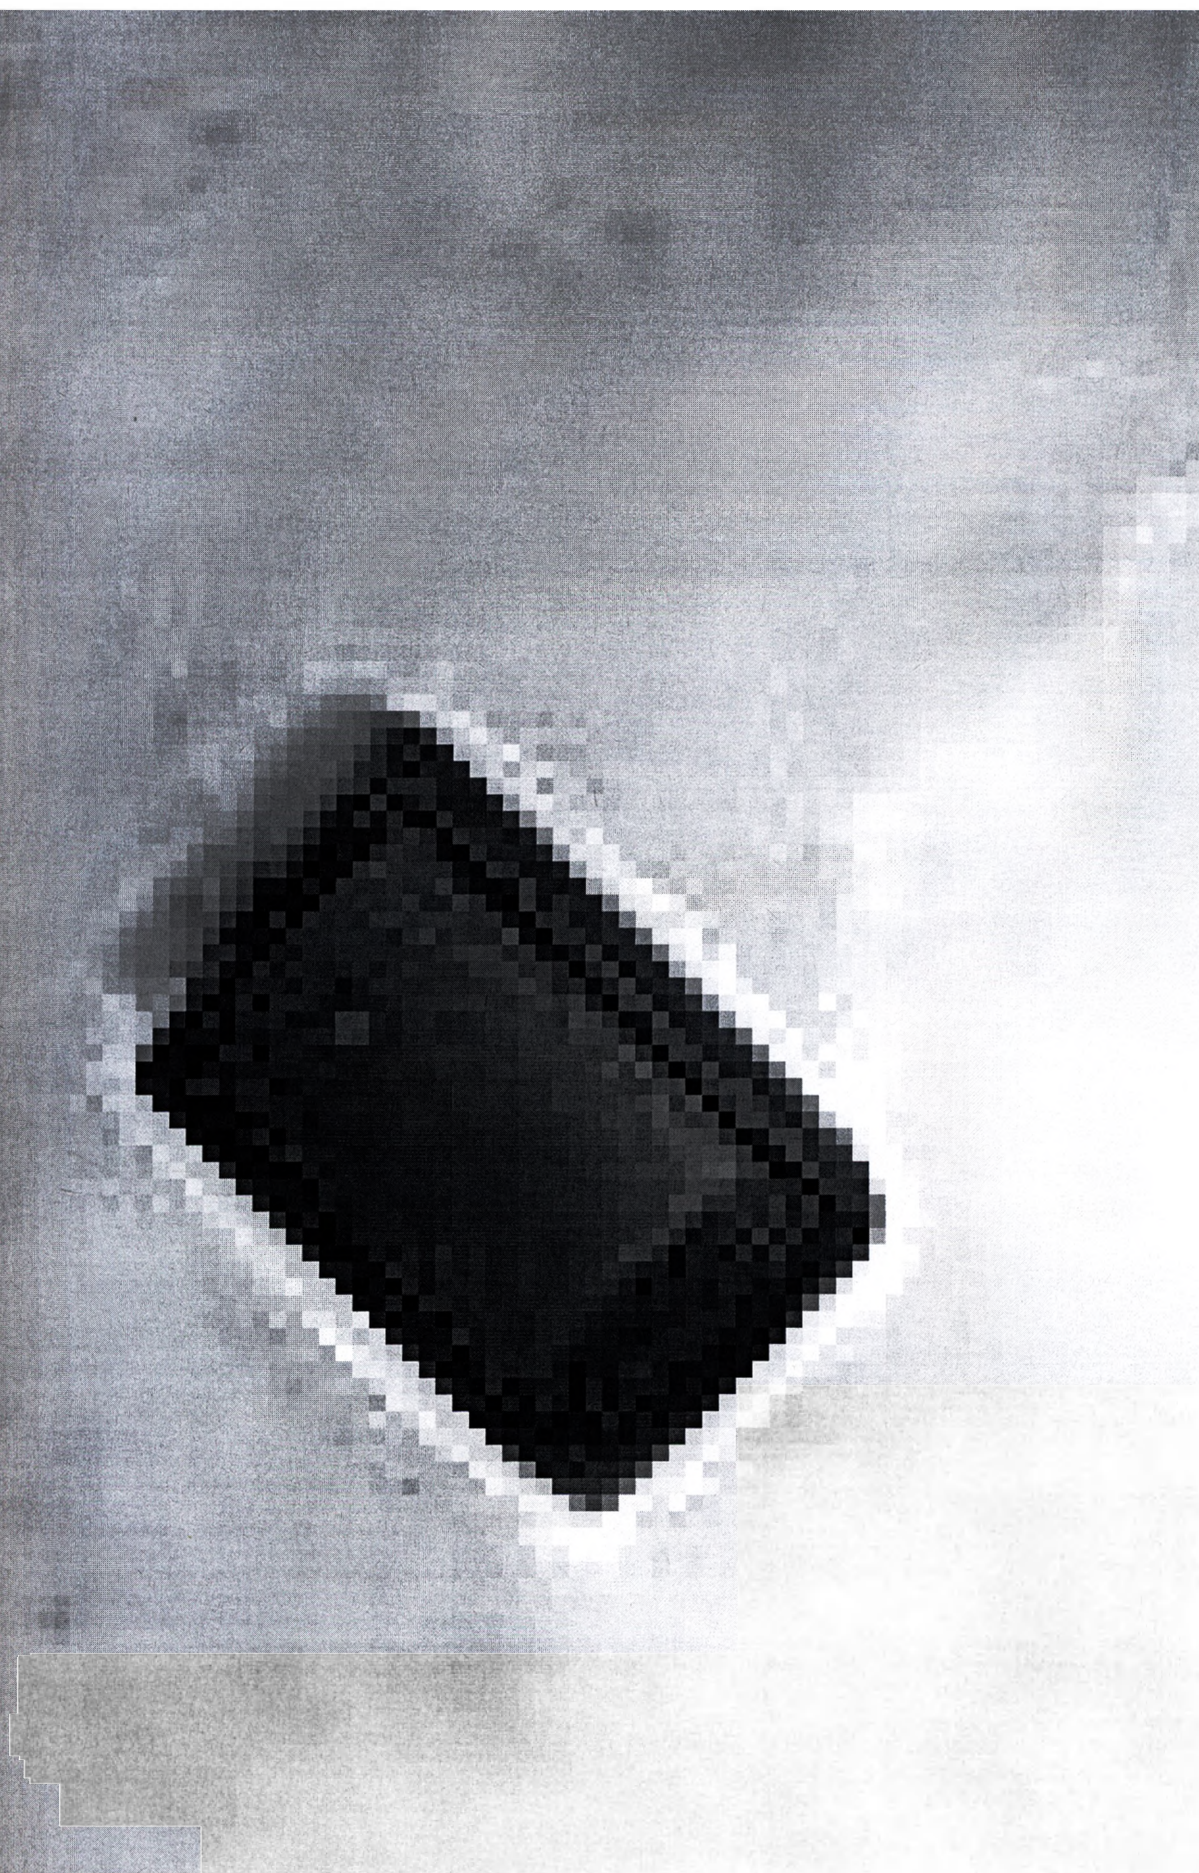



принадлежности: 42. Устройство фоновой подсветки – 1 шт.






Принадлежности: 43. Линза для обзора сетчатки глаза – 1 шт.






принадлежности: 44. Предохранители – 2 шт.

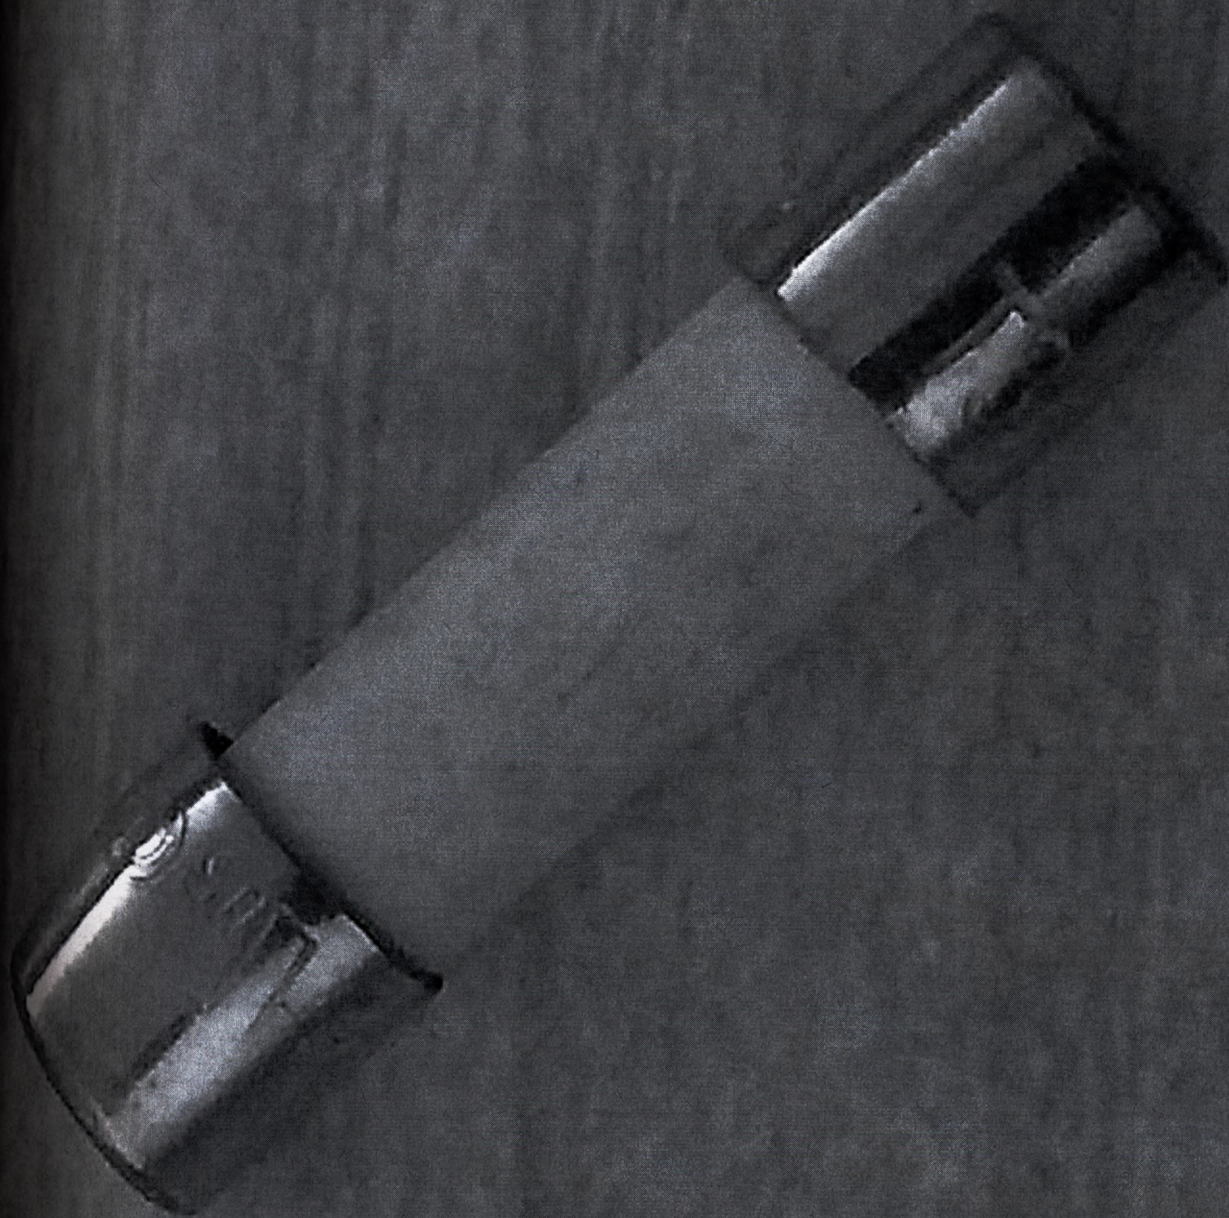




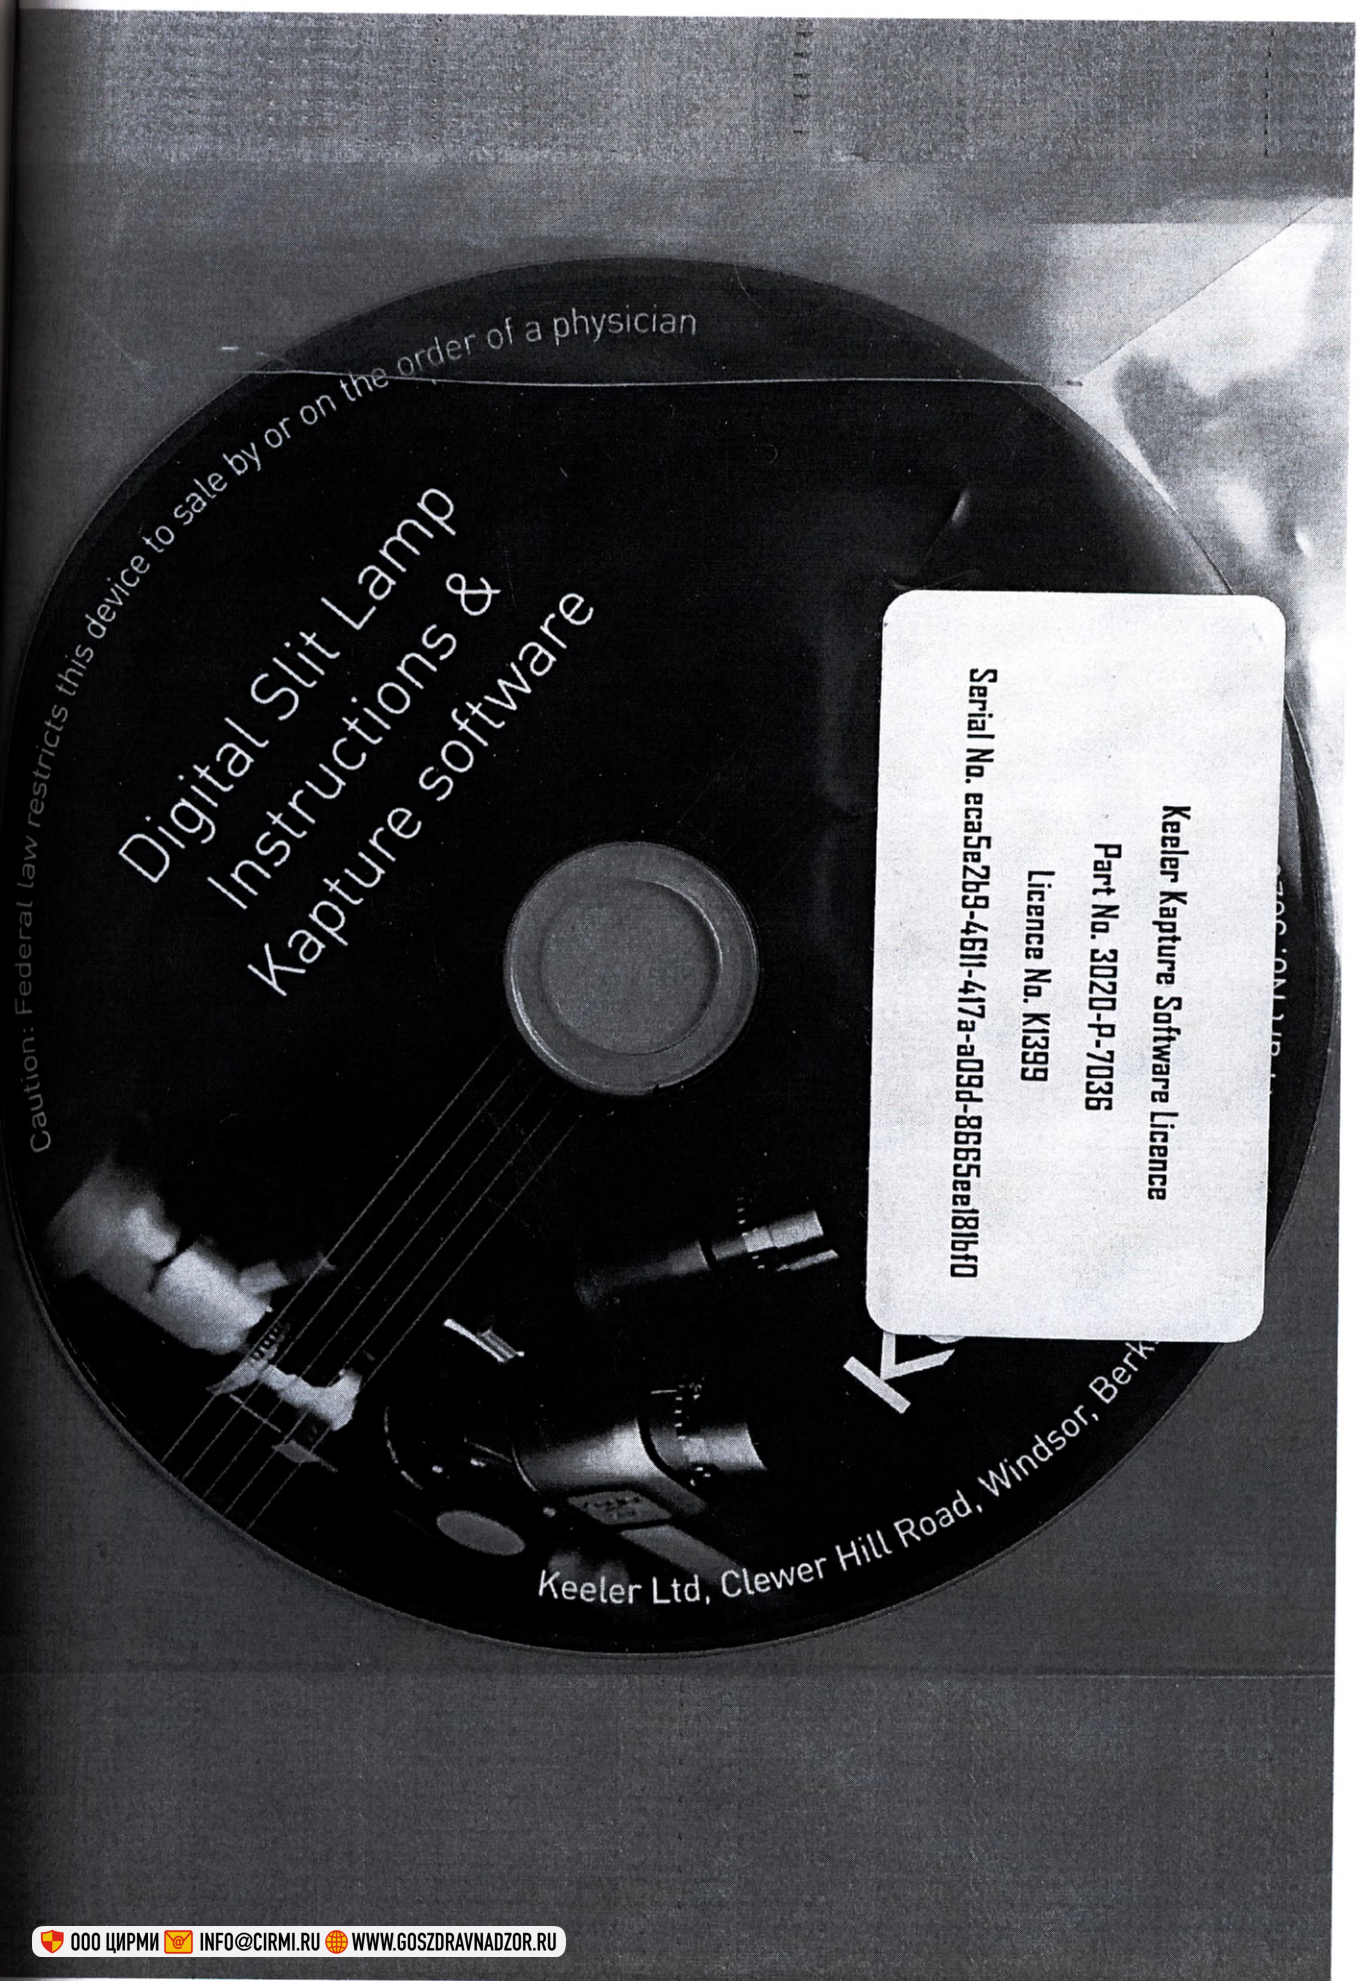



Принадлежности: 46. Комплект монтажных принадлежностей, в составе:


Болт крепления пластины листовой – 10 шт.

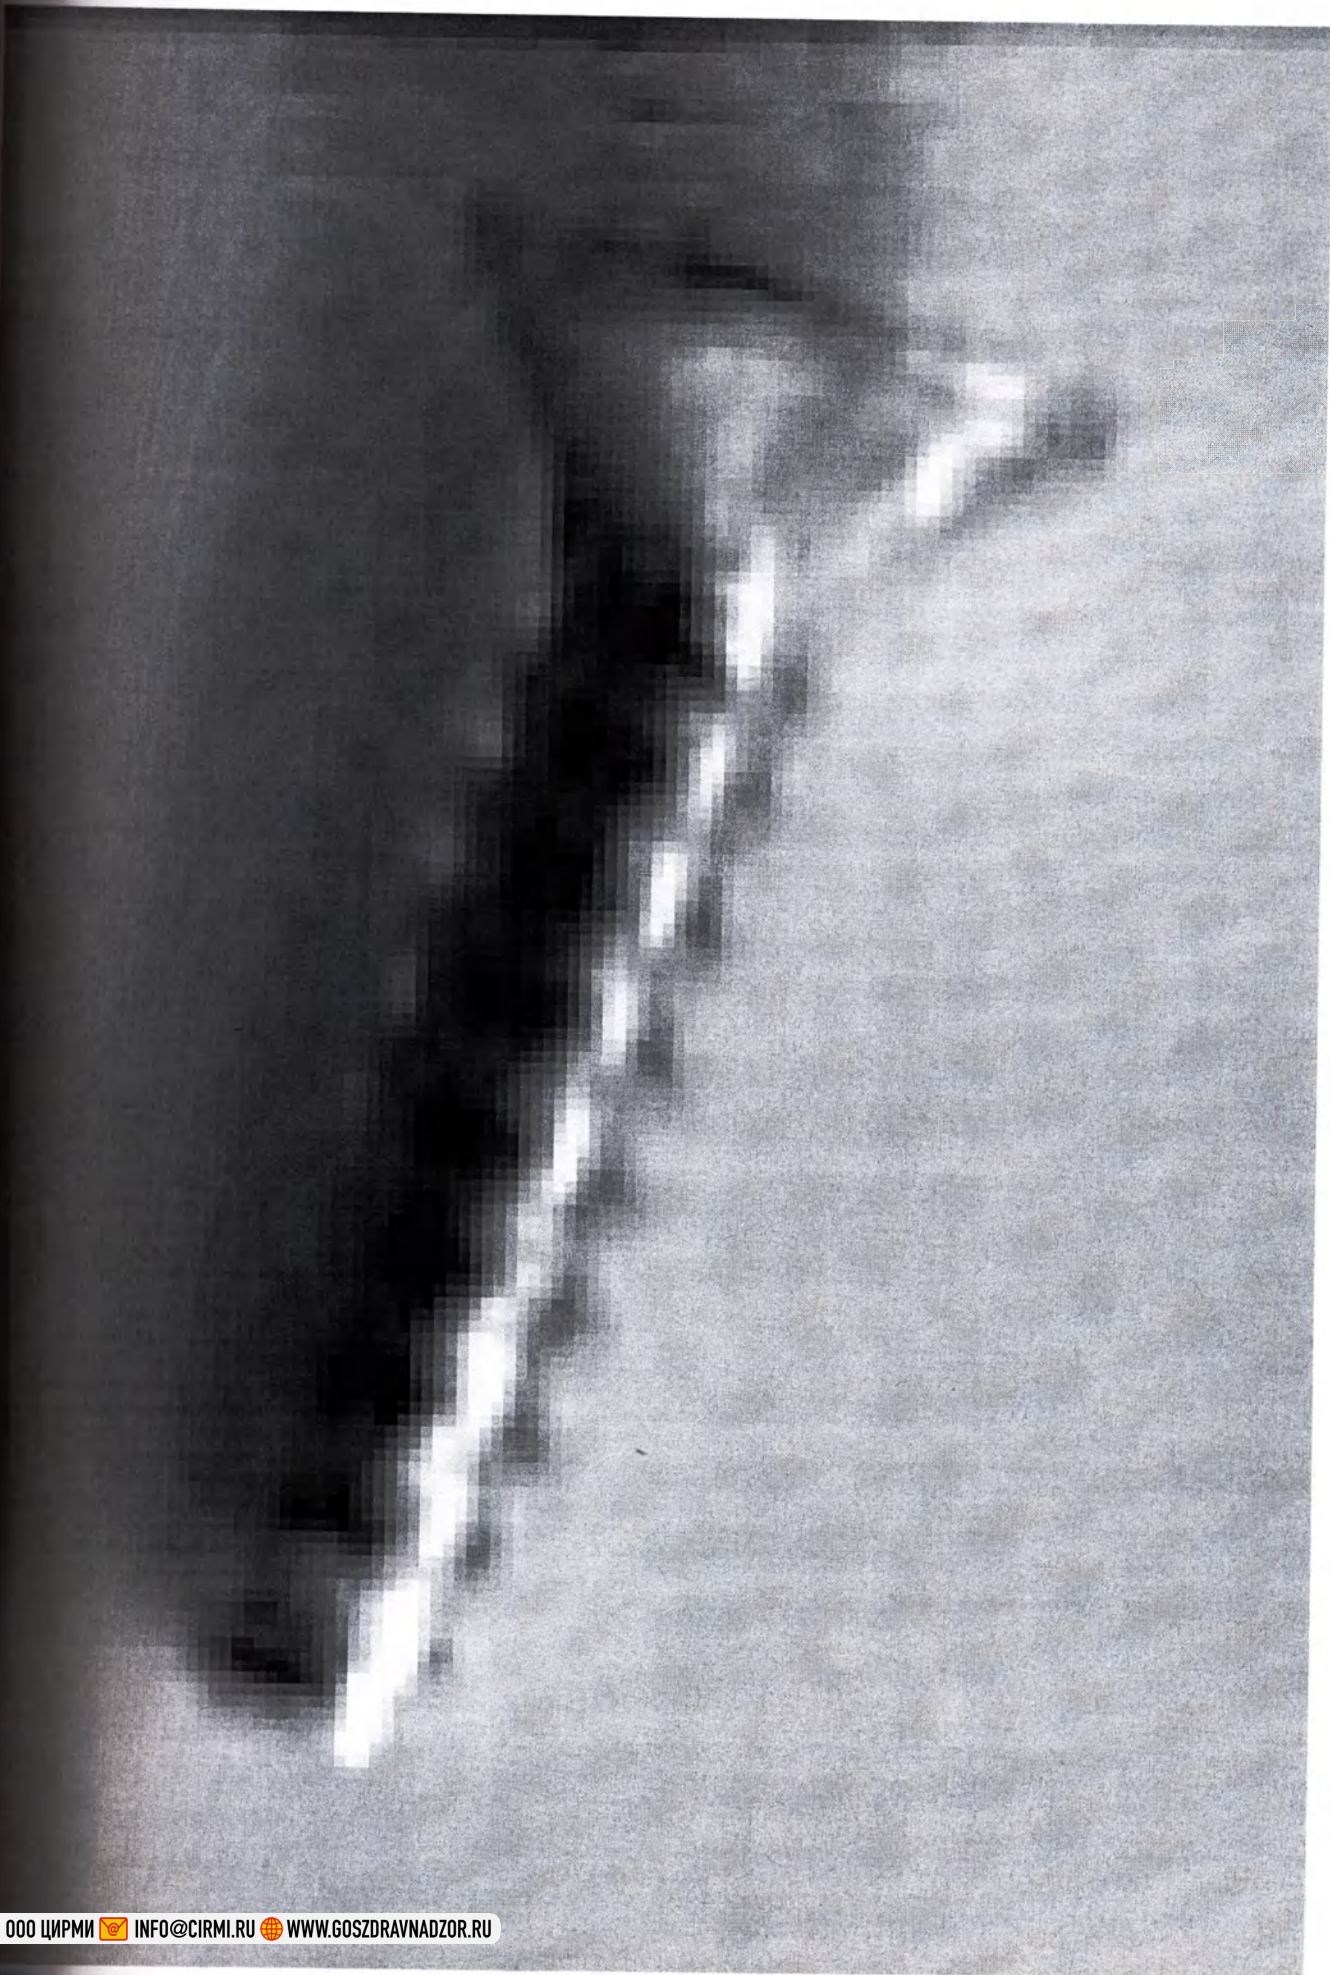



принадлежности: 46. Комплект монтажных принадлежностей, в составе:

болт крепления осветительной башни – 10 шт.

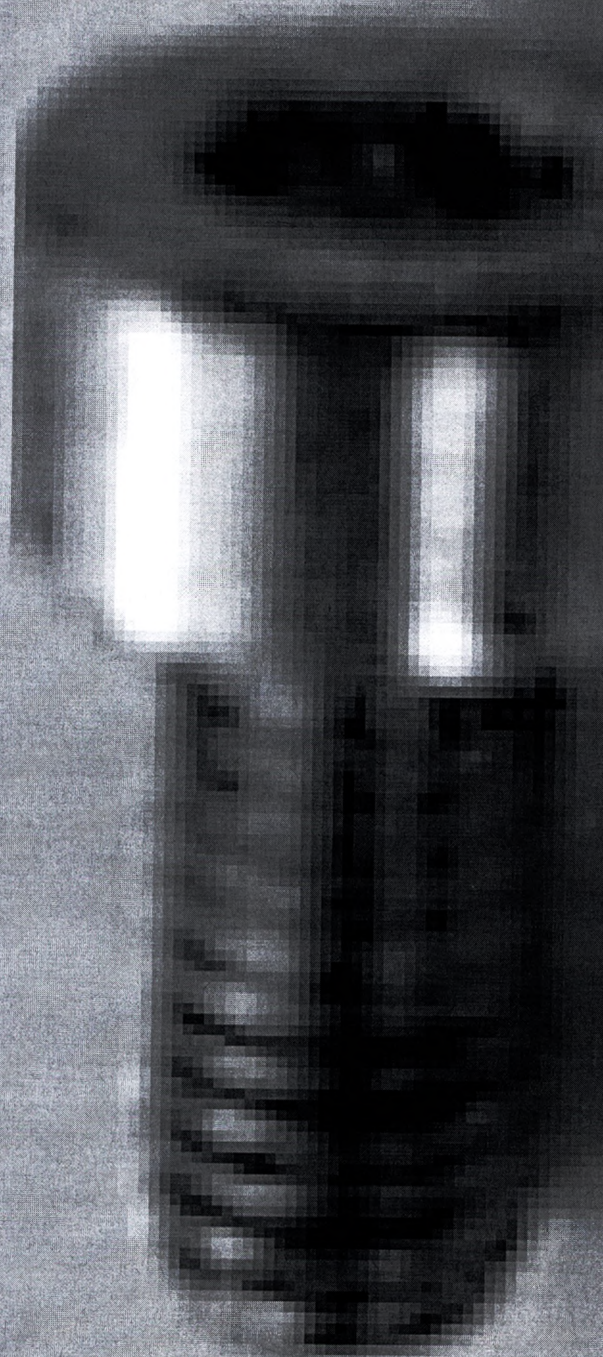



принадлежности: 46. Комплект монтажных принадлежностей, в составе:


болт крепления микроскопа – 10 шт.





Принадлежности: 46. Комплект монтажных принадлежностей, в составе:

Болт М3х5 – 10 шт.

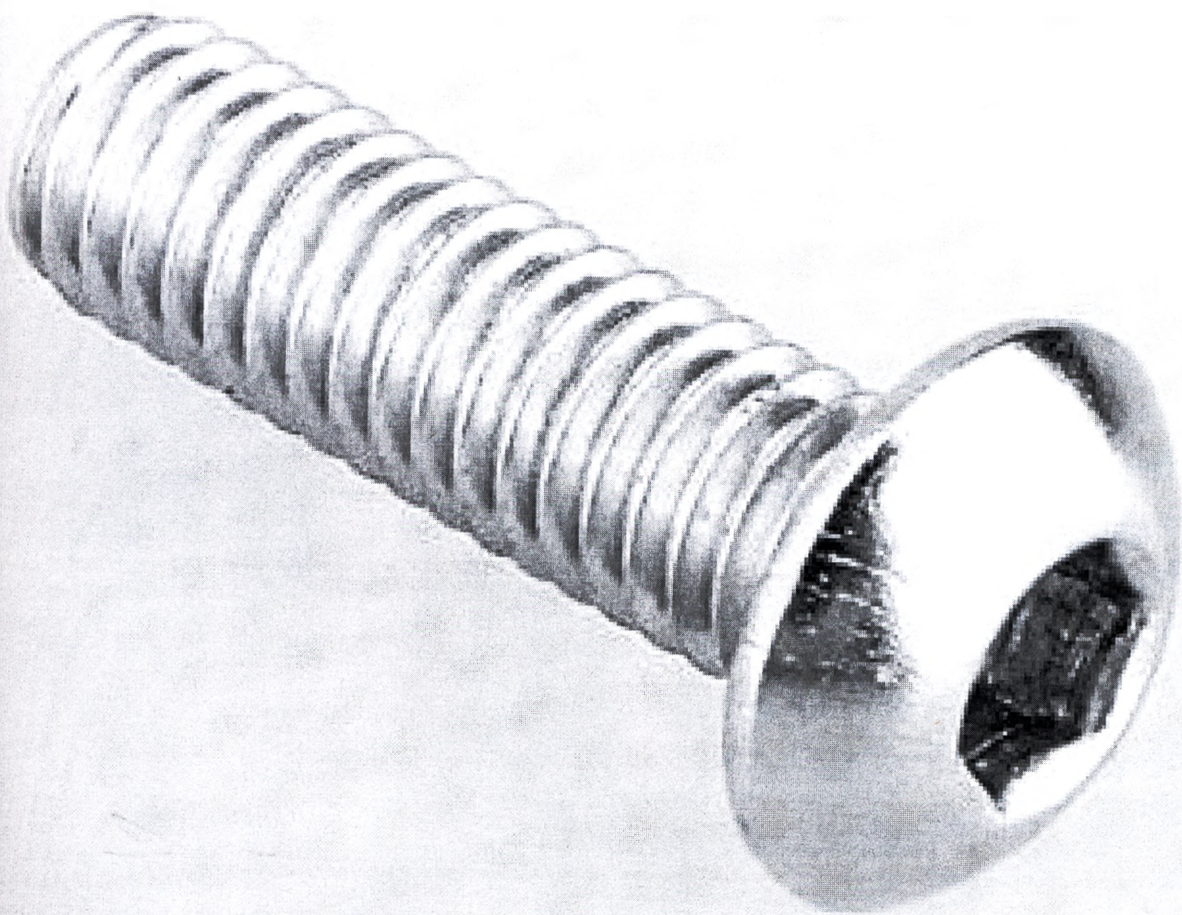



Принадлежности: 46. Комплект монтажных принадлежностей, в составе:  
Болт М2.5 – 10 шт.





Принадлежности: 46. Комплект монтажных принадлежностей, в составе:

Болт М6 – 10 шт.





принадлежности: 46. Комплект монтажных принадлежностей, в составе:


шт М3х18 – 10 шт.





принадлежности: 46. Комплект монтажных принадлежностей, в составе:


винт 2.5x12 – 10 шт.

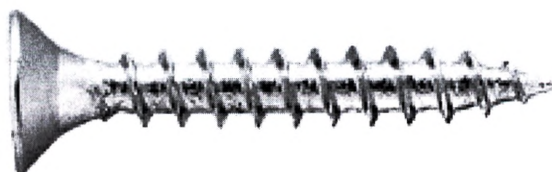



принадлежности: 46. Комплект монтажных принадлежностей, в составе:


Вит 2x3/8 – 10 шт.

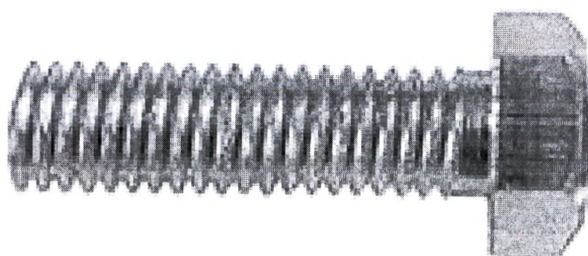



Принадлежности: 46. Комплект монтажных принадлежностей, в составе:

Гайка специализированная – 5 шт.

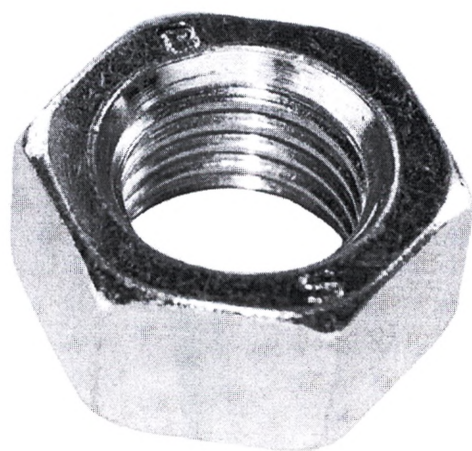



принадлежности: 46. Комплект монтажных принадлежностей, в составе:

ключ специализированный – 1 шт.





Базовый состав № 1: 1.1 Основание щелевой лампы – 1 шт.






Комплект № 1: 1.2 Микроскоп щелевой лампы, в составе: - Блок микроскопа с параллельной оптикой и 3-кратным увеличением – 1 шт.; - Бинокуляр – 1 шт.; - Окуляры – 2 шт.





Базовый состав № 1: 1.3 Башня осветительная – 1 шт.

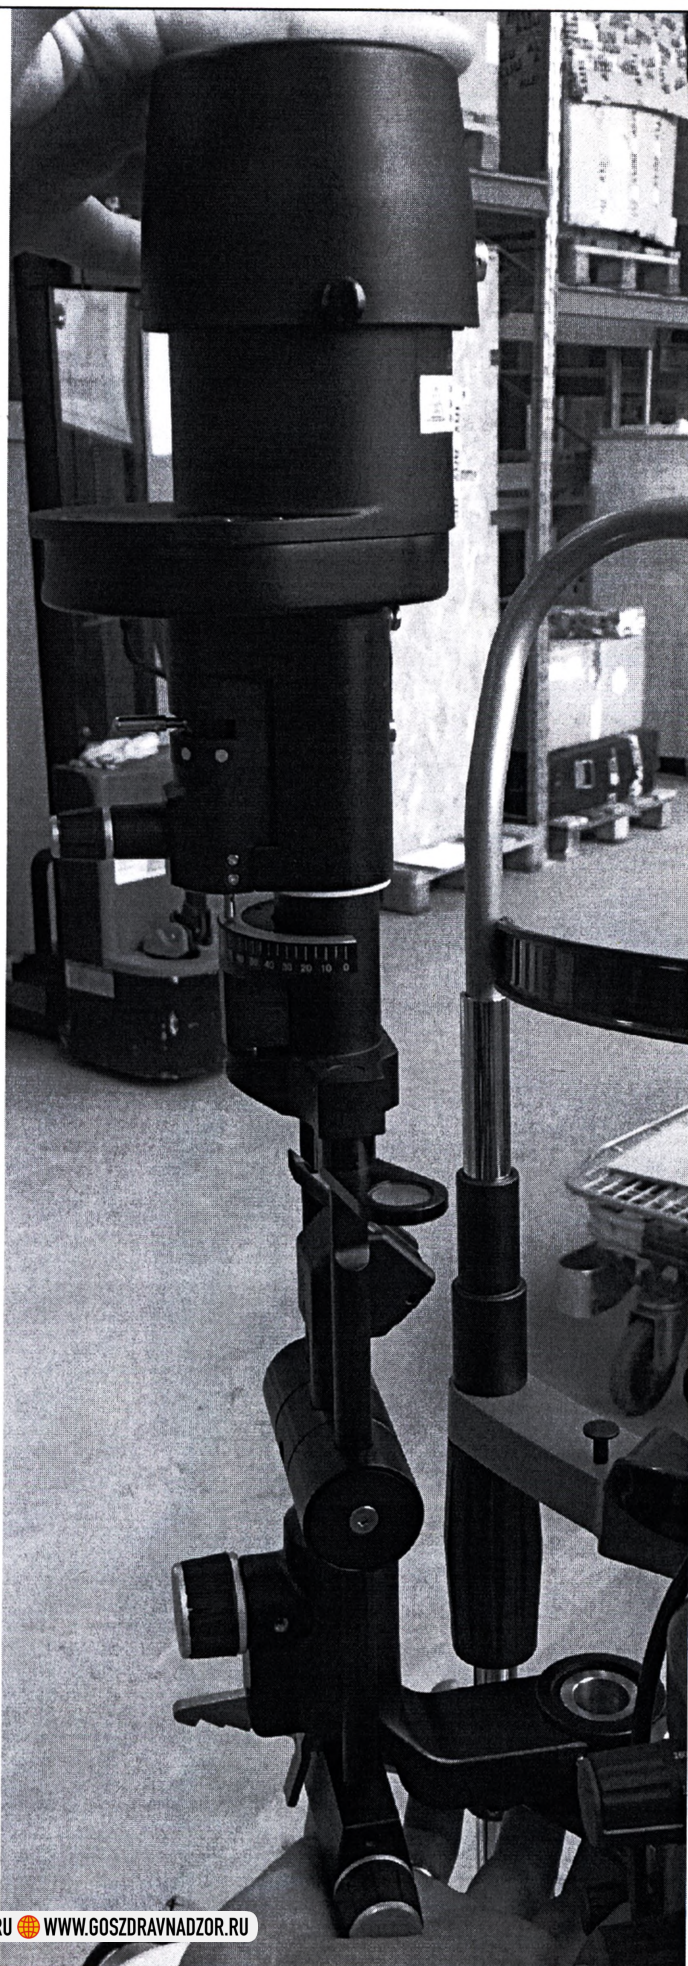



Базовый состав № 1: 1.4 Упор для головы пациента – 1 шт.


















ый состав № 1: 1.8 Кабель упора для головы пациента – 1 шт.

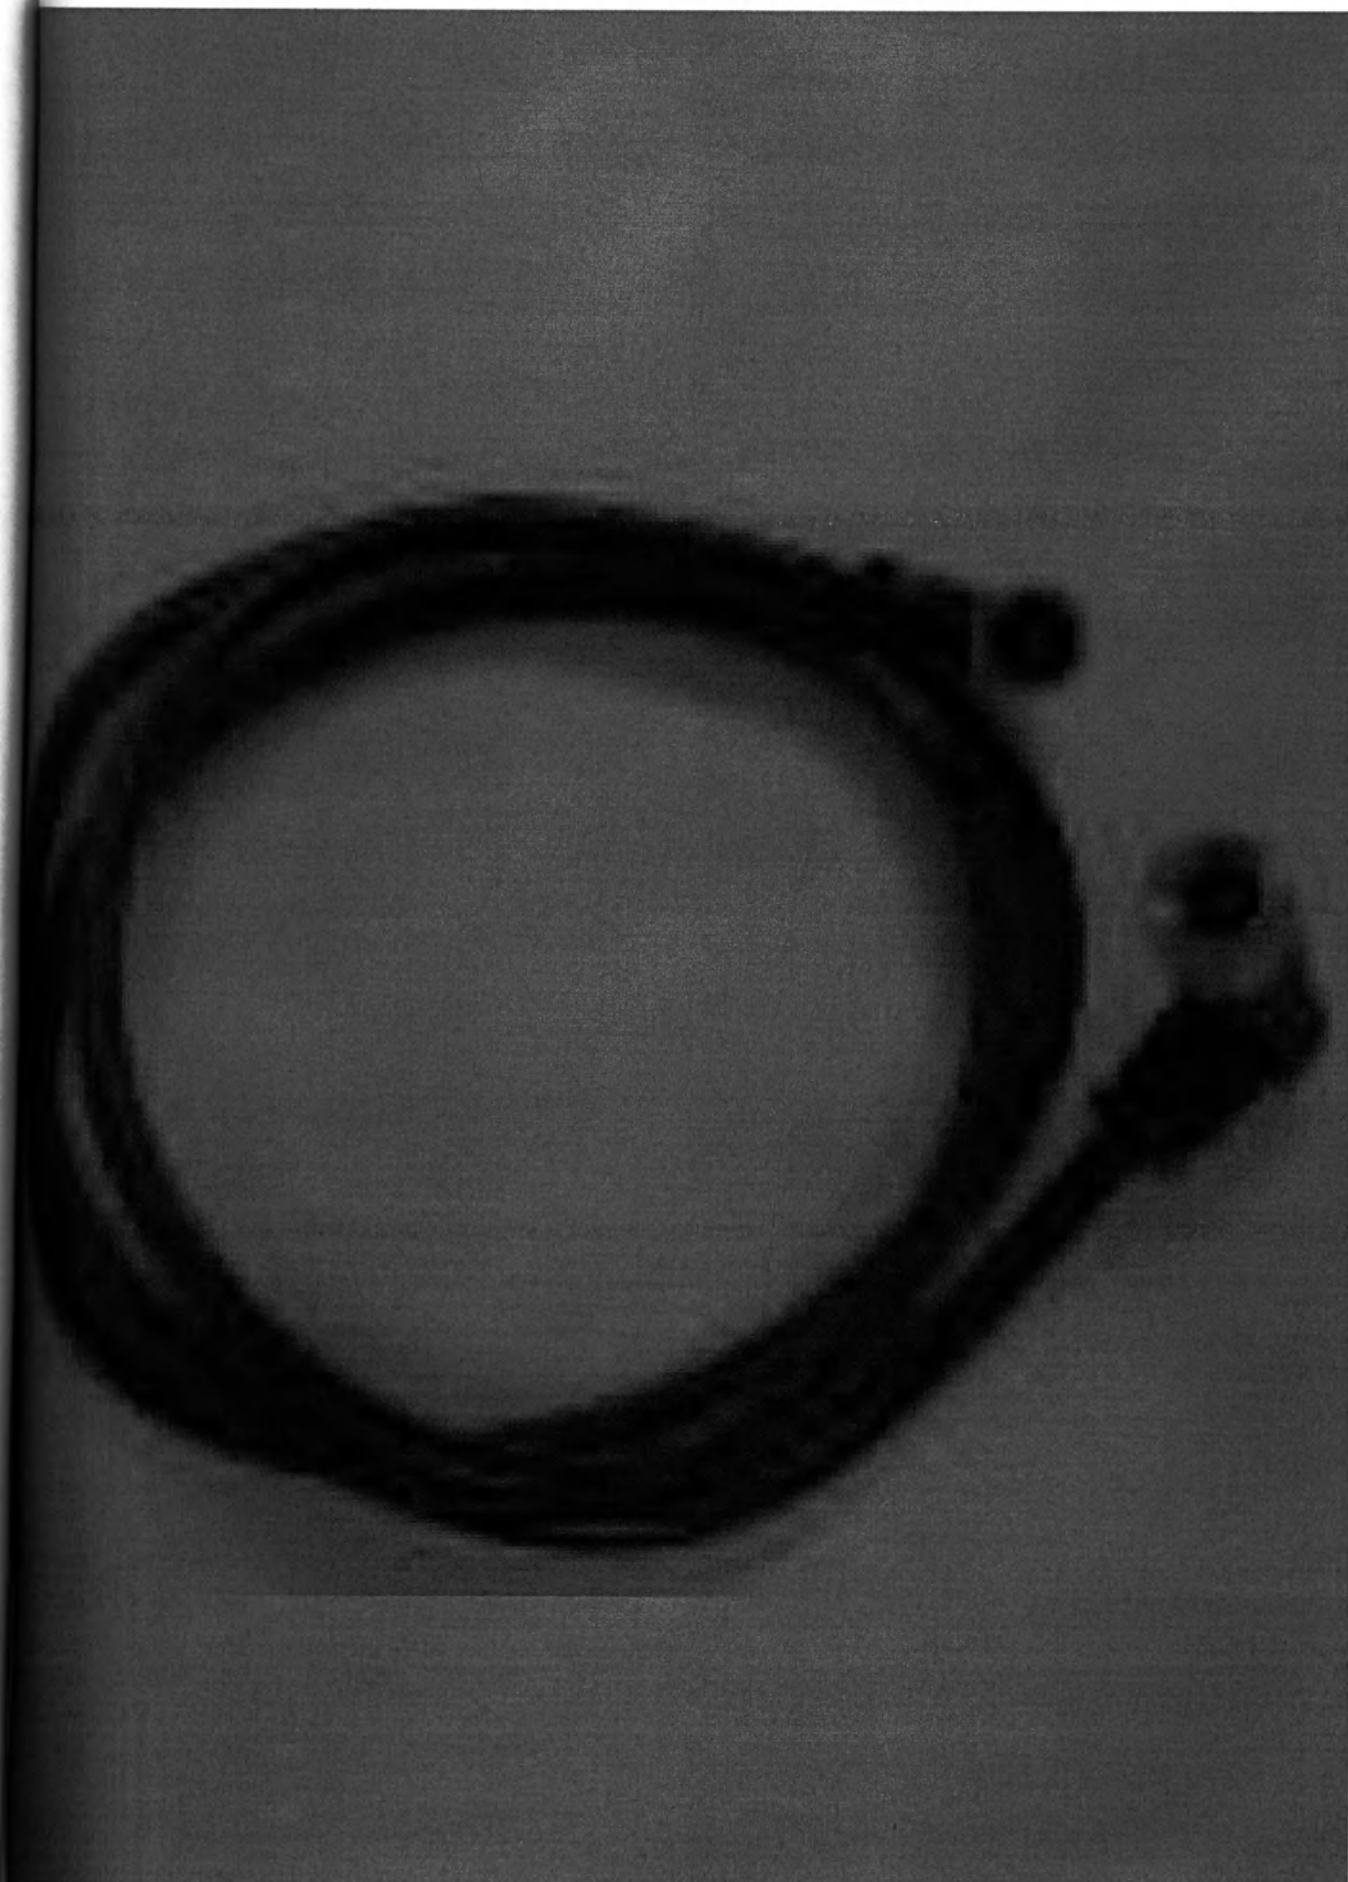








ый состав № 2: 2.1 Основание щелевой лампы – 1 шт.






Состав № 2: 2.2 Микроскоп щелевой лампы, в составе: - Блок микроскопа с параллельной оптикой и 5 ступенчатым увеличением – 1 шт.; - Бинокуляр – 1 шт.; - Окуляры – 2 шт.

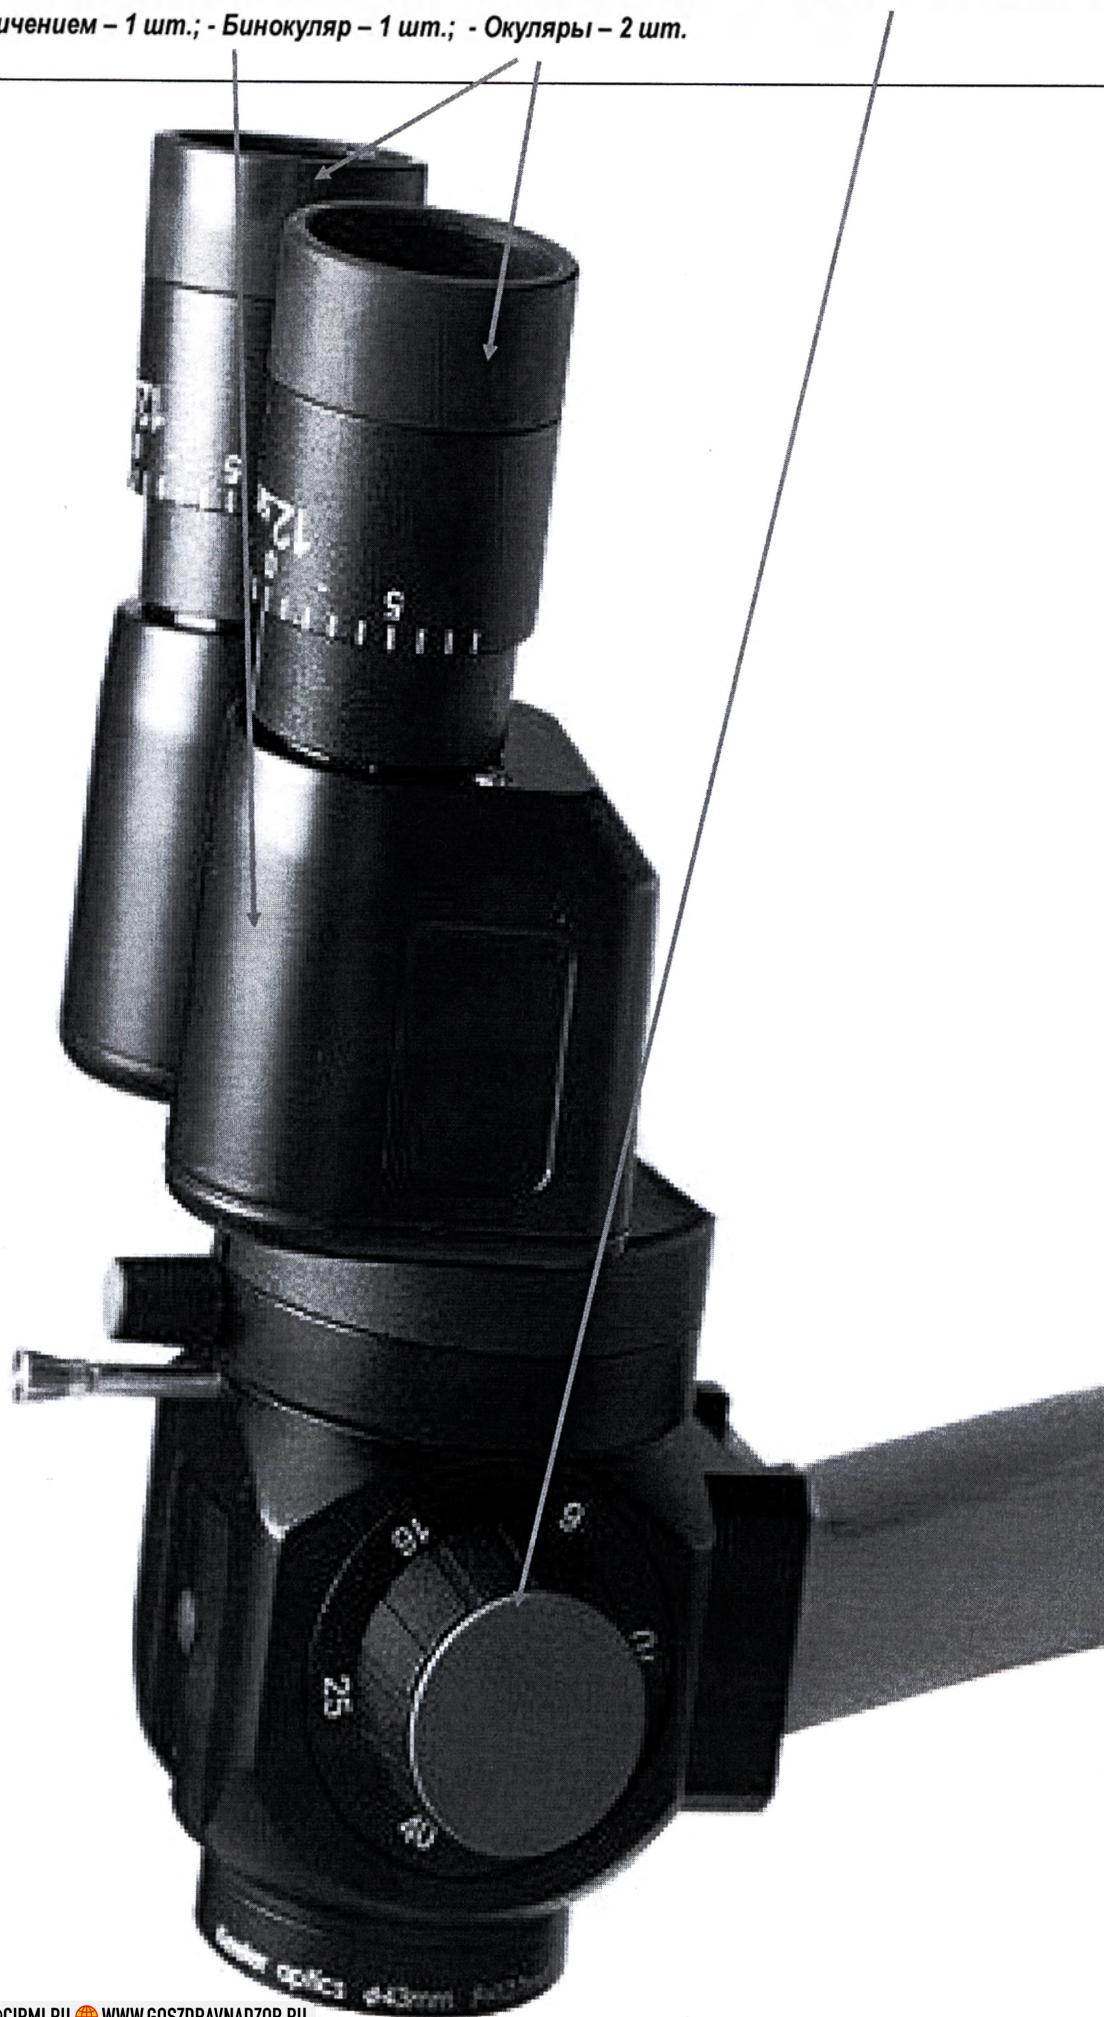



овый состав № 2: 2.3 Башня осветительная – 1 шт.

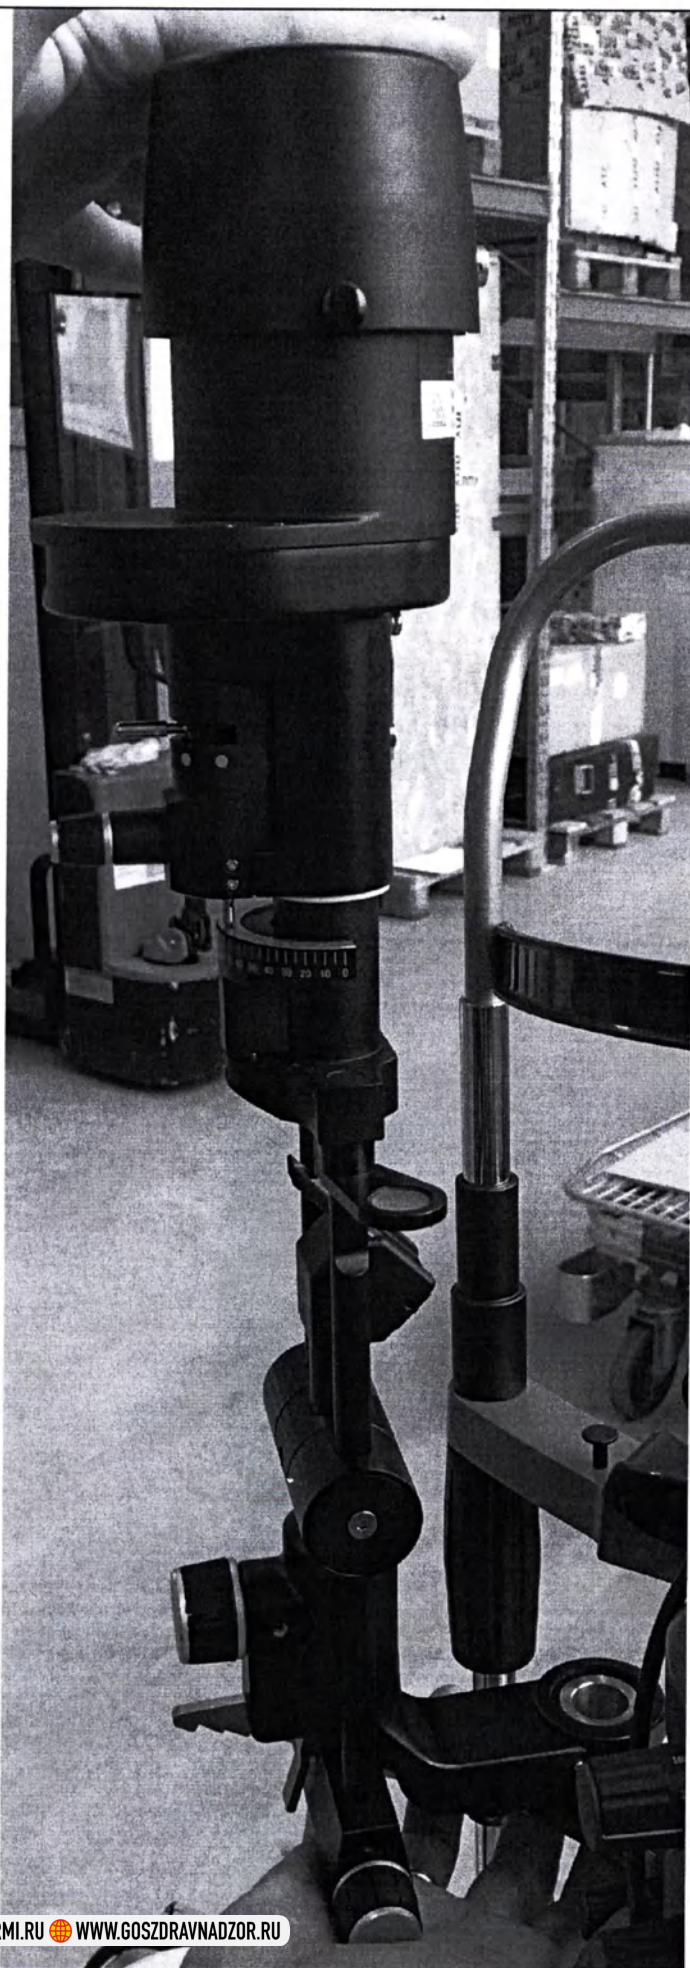



Состав № 2: 2.4 Упор для головы пациента – 1 шт.





комплектный состав № 2: 2.5 Блок питания – 1 шт.





Базовый состав № 2: 2.6 Кабель подключения основания щелевой лампы к столешнице – 1 шт.






состав № 2: 2.7 Кабель питания – 1 шт.





Базовый состав № 2: 2.8 Кабель упора для головы пациента – 1 шт.

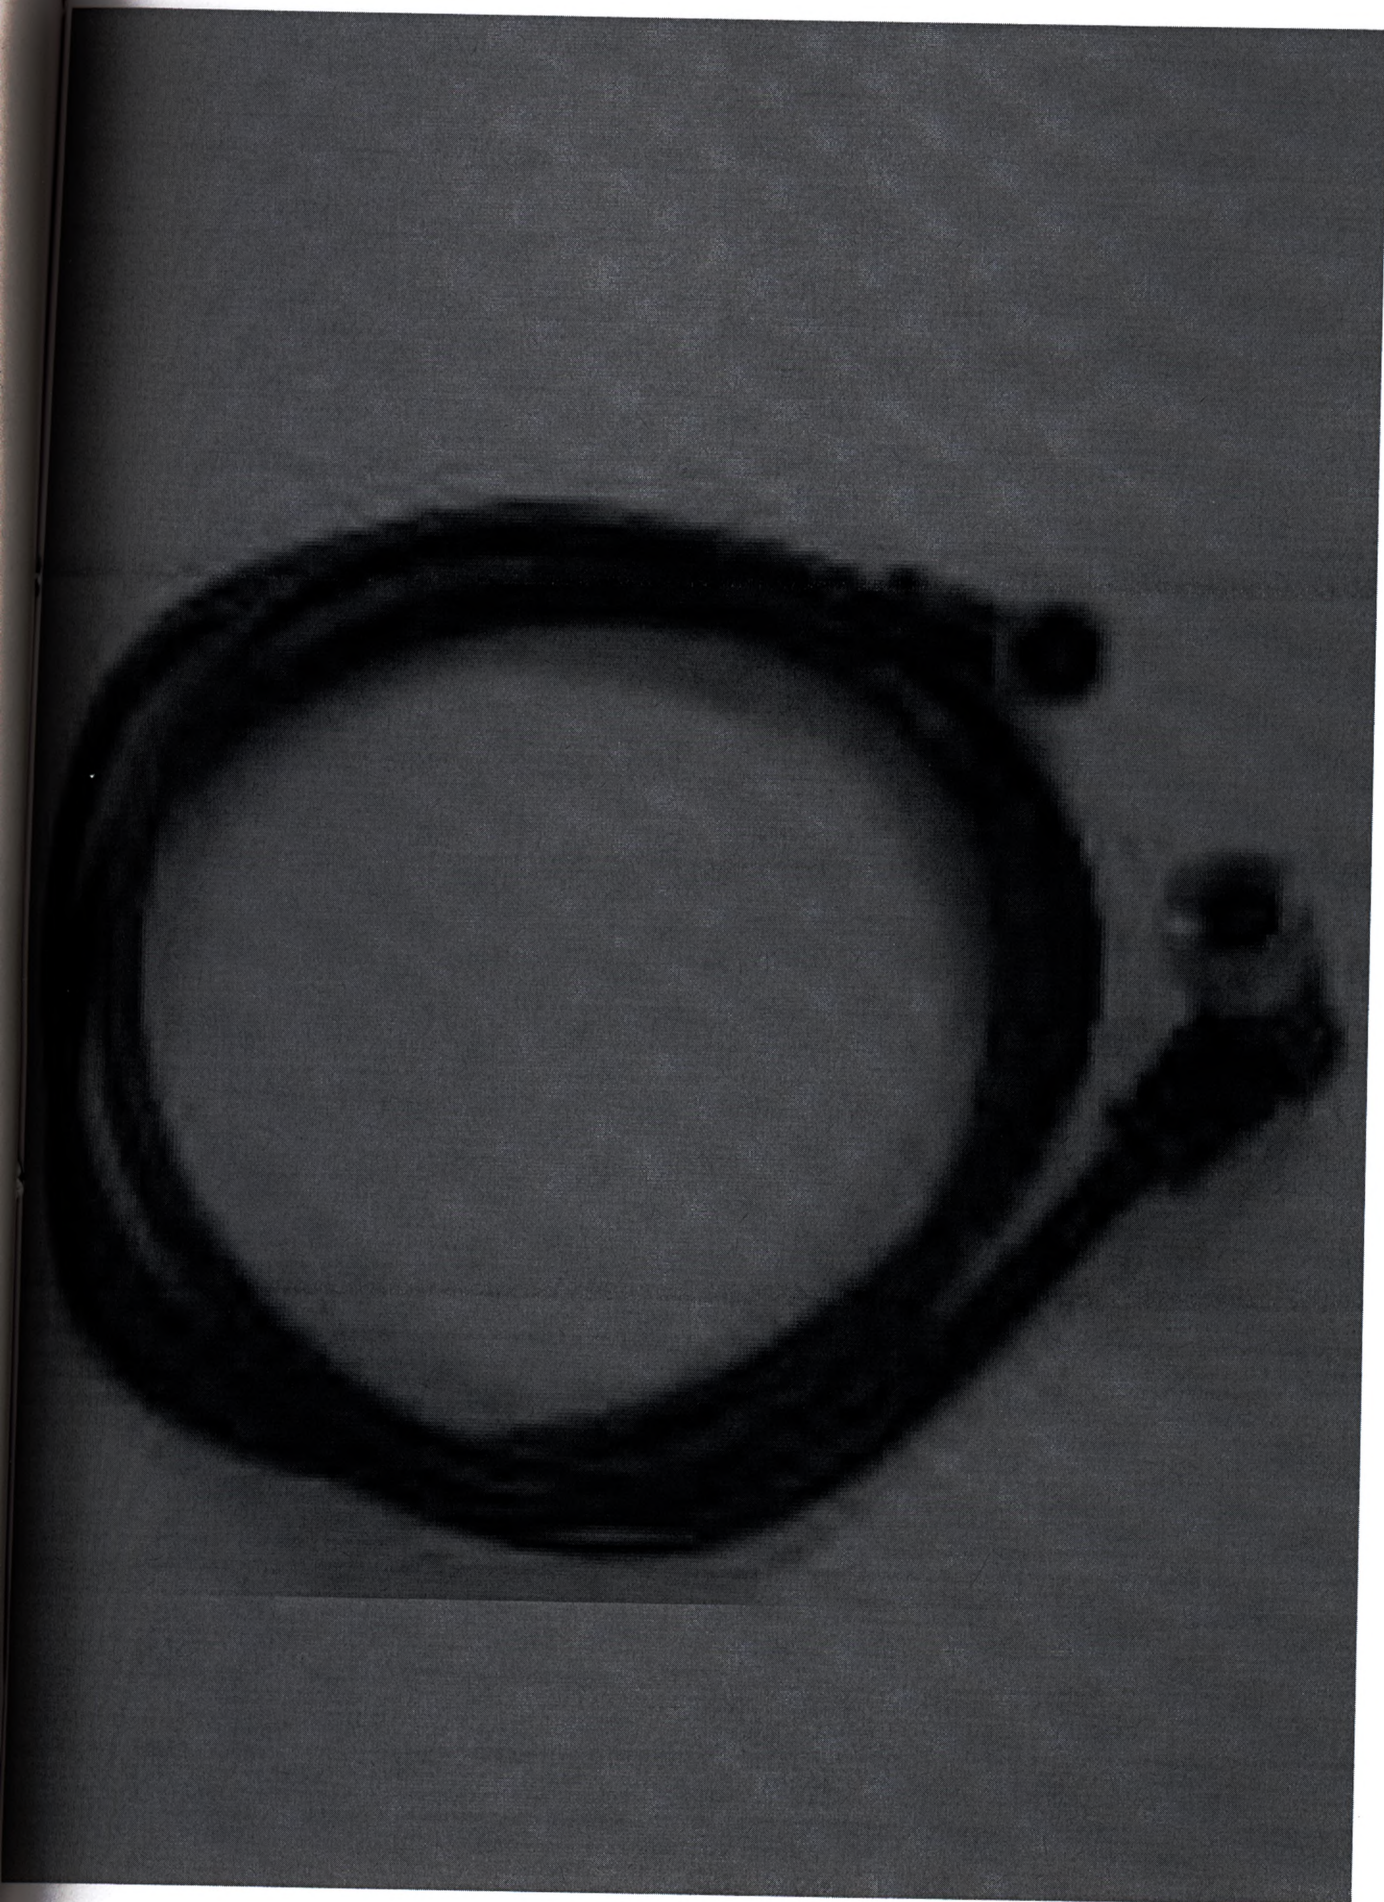



состав № 2: 2.9 Чехол пылезащитный – 1 шт.














Базовый состав № 3: 3.3 Башня осветительная – 1 шт.

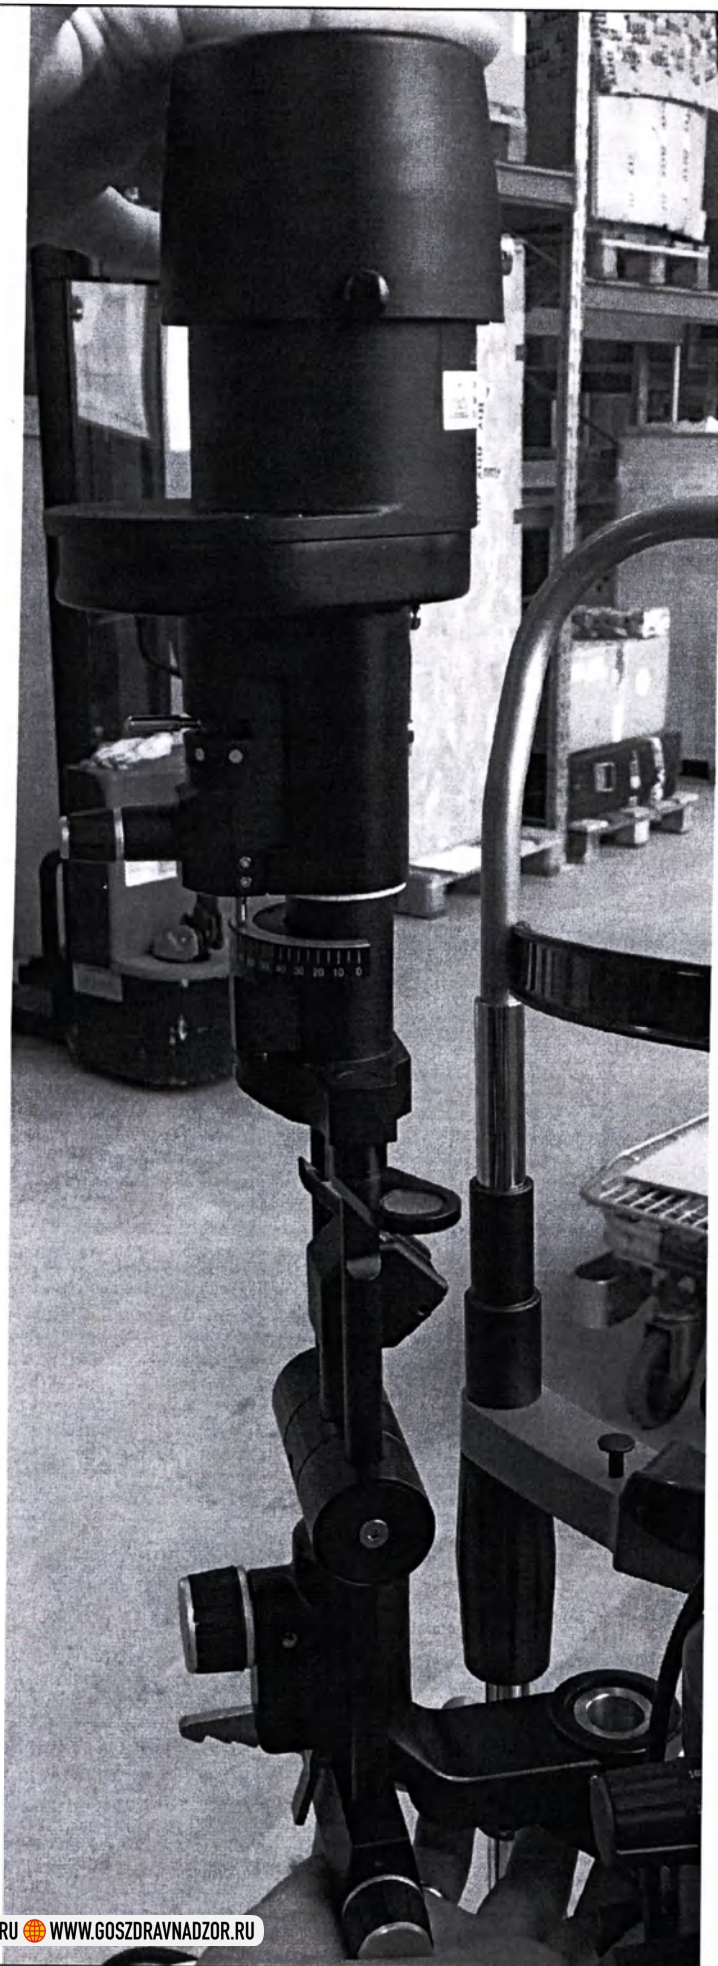



комплектный состав № 3: 3.4 Упор для головы пациента – 1 шт.





Базовый состав № 3: 3.5 Блок питания – 1 шт.













овый состав № 3: 3.8 Кабель упора для головы пациента – 1 шт.





состав № 3: 3.9 Чехол пылезащитный – 1 шт.






Базовый состав № 4: 4.1 Основание щелевой лампы – 1 шт.





состав № 4: 4.2 Микроскоп щелевой лампы, в составе: - Блок микроскопа с конвергентной оптикой и ступенчатым увеличением – 1 шт.; - Бинокуляр – 1 шт.; - Окуляры – 2 шт.

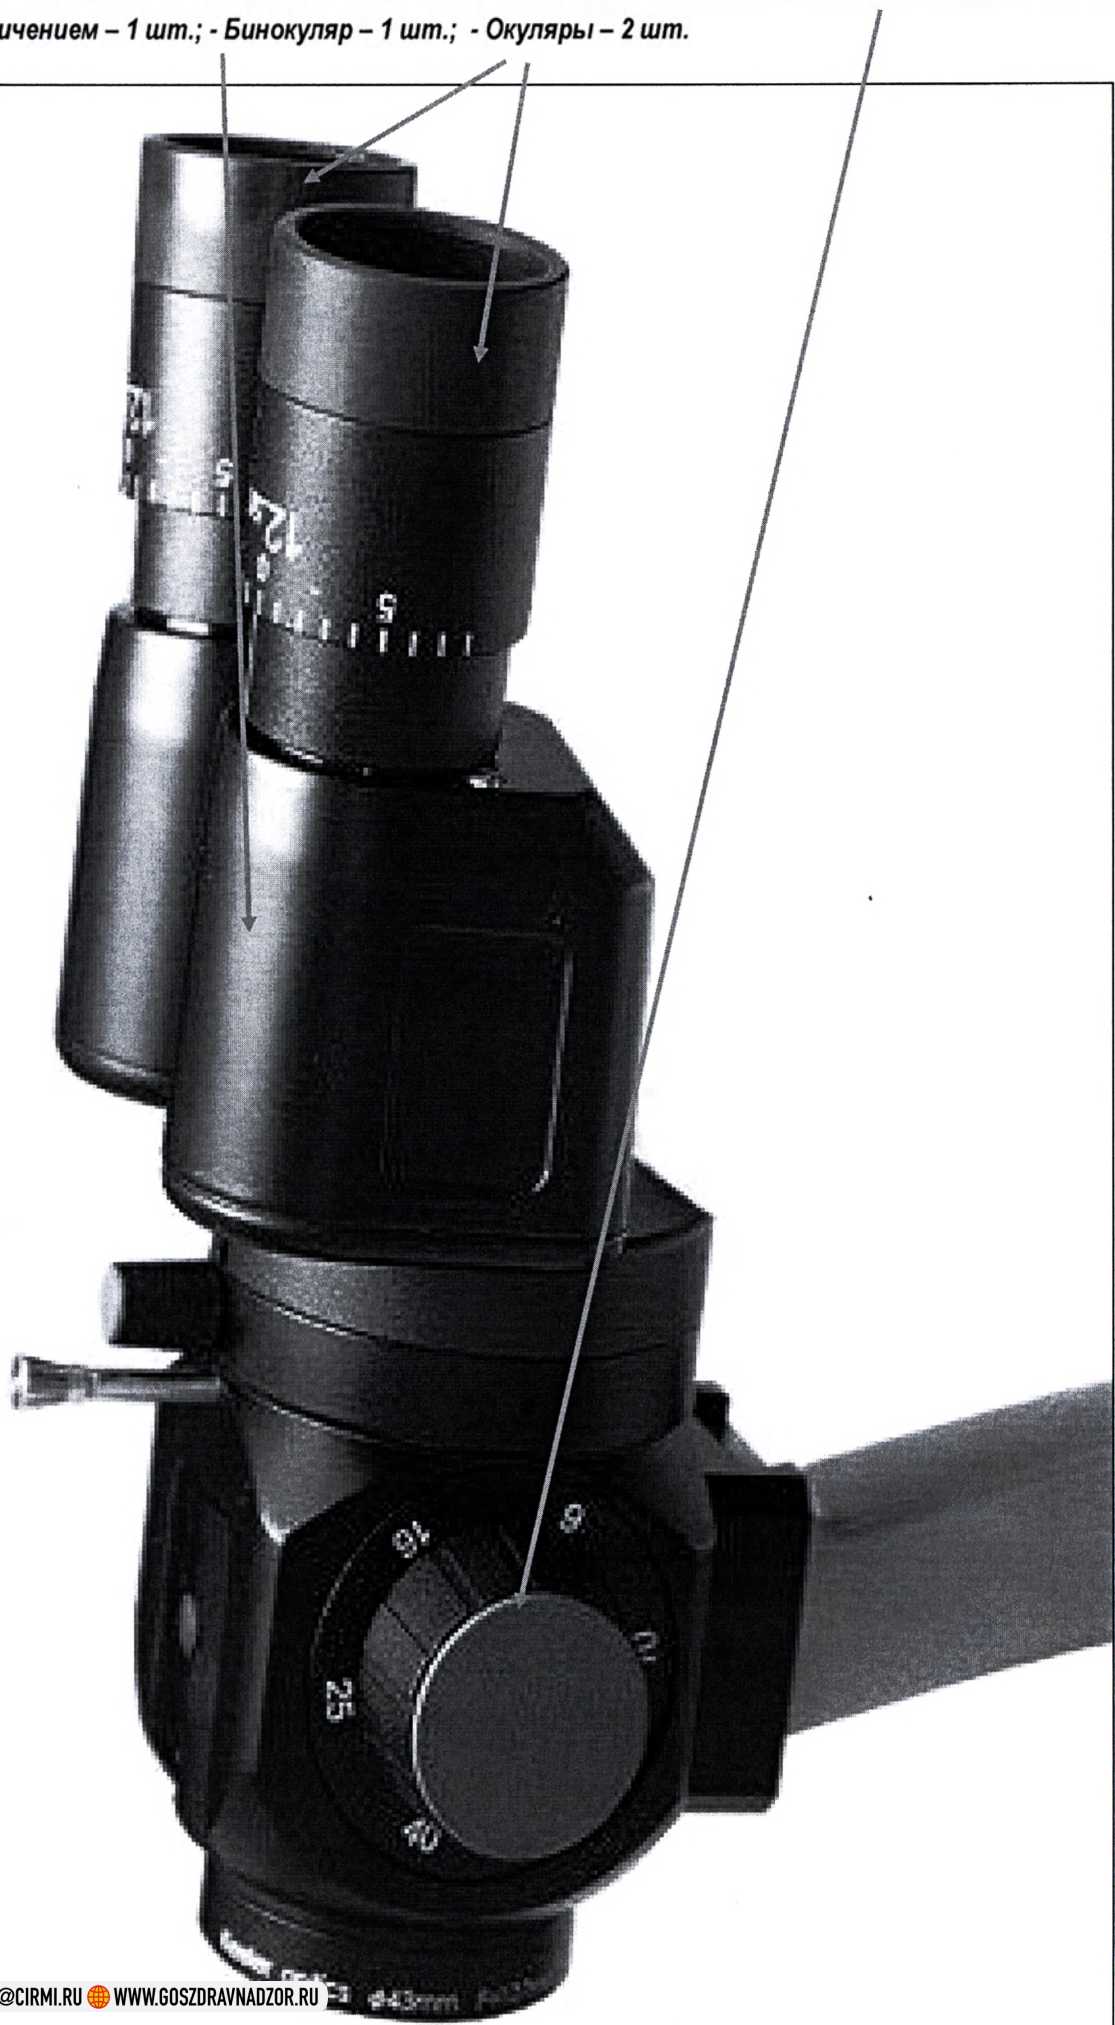



овый состав № 4: 4.3 Башня осветительная – 1 шт.





Состав № 4: 4.4 Упор для головы пациента – 1 шт.





Базовый состав № 4: 4.5 Блок питания – 1 шт.





ый состав № 4: 4.6 Кабель подключения основания щелевой лампы к столешнице – 1 шт.





Основной состав № 4: 4.7 Кабель питания – 1 шт.





ый состав № 4: 4.8 Кабель упора для головы пациента – 1 шт.






состав № 4: 4.9 Чехол пылезащитный – 1 шт.






...ности: 1. Рукоятки для пациента – 2 шт.

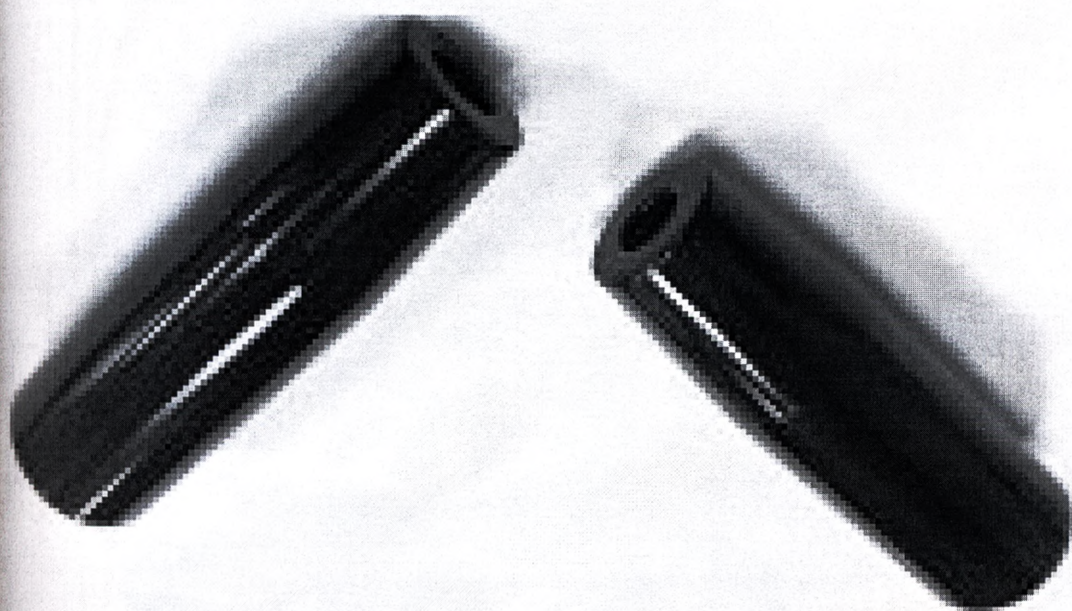



жности: 2. Вкладыш для подбородка – 1 шт.

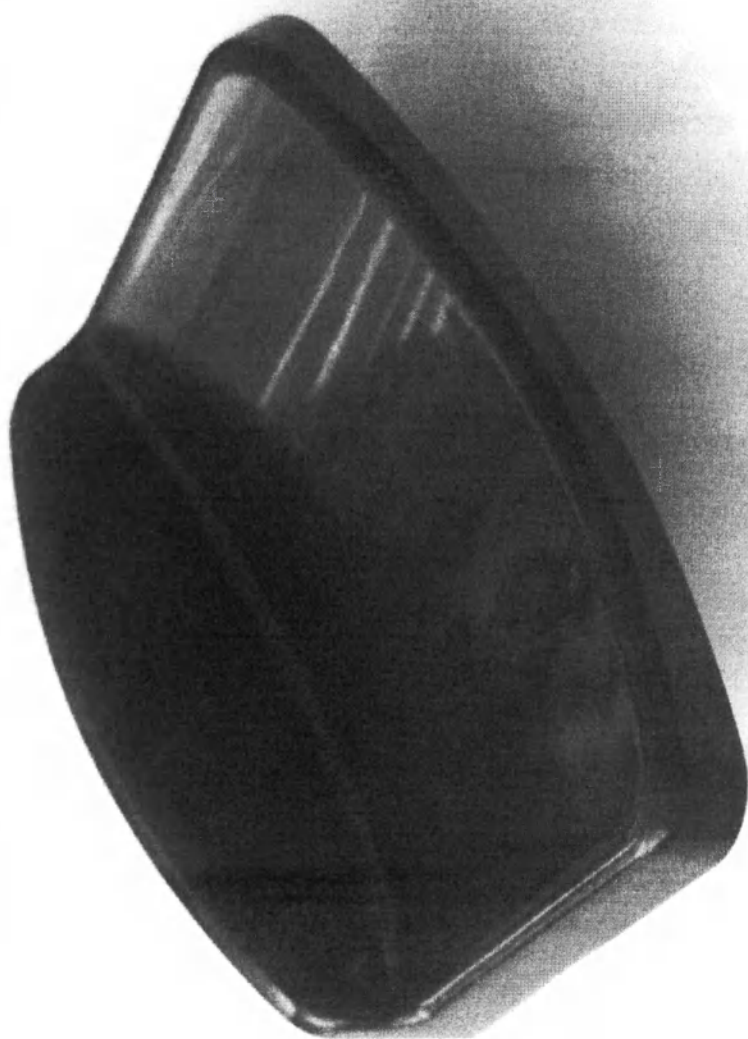








принадлежности: 4. Прокладки бумажные на вкладыш для подбородка – не более 5 уп. (100 шт./уп.)

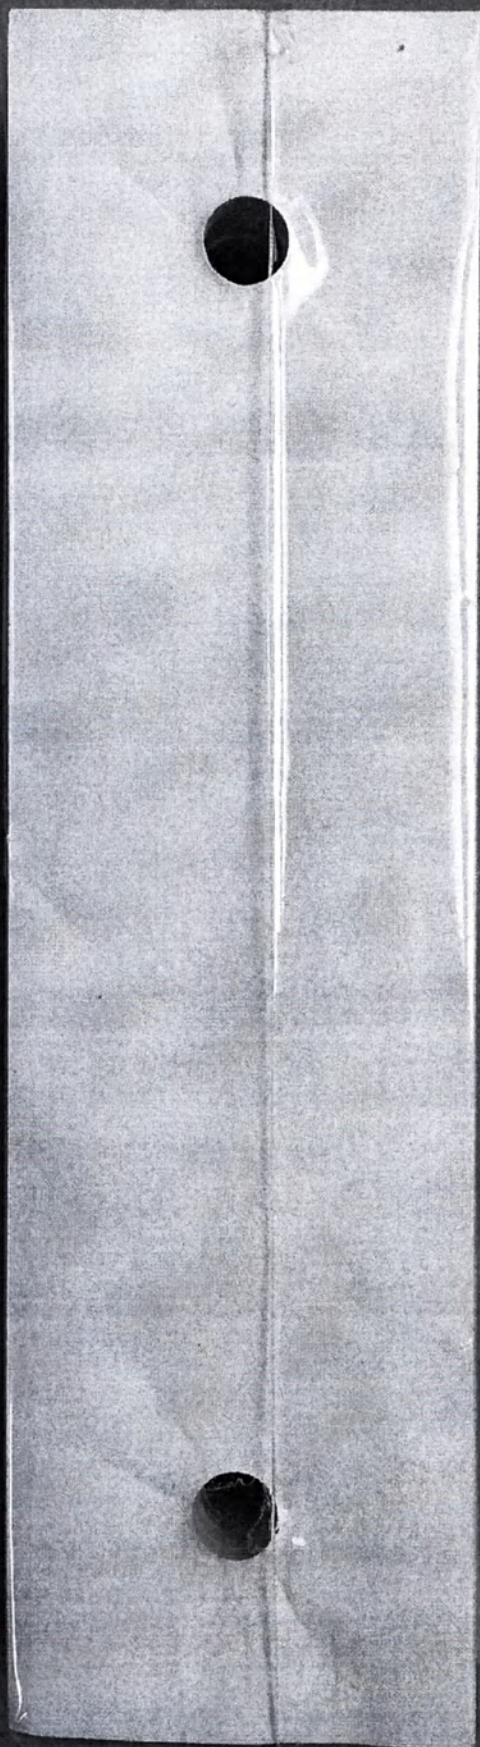







принадлежности: 6. Индикатор внутриглазного давления типа Т – 1 шт.






принадлежности: 6. Индикатор внутриглазного давления типа R – 1 шт.






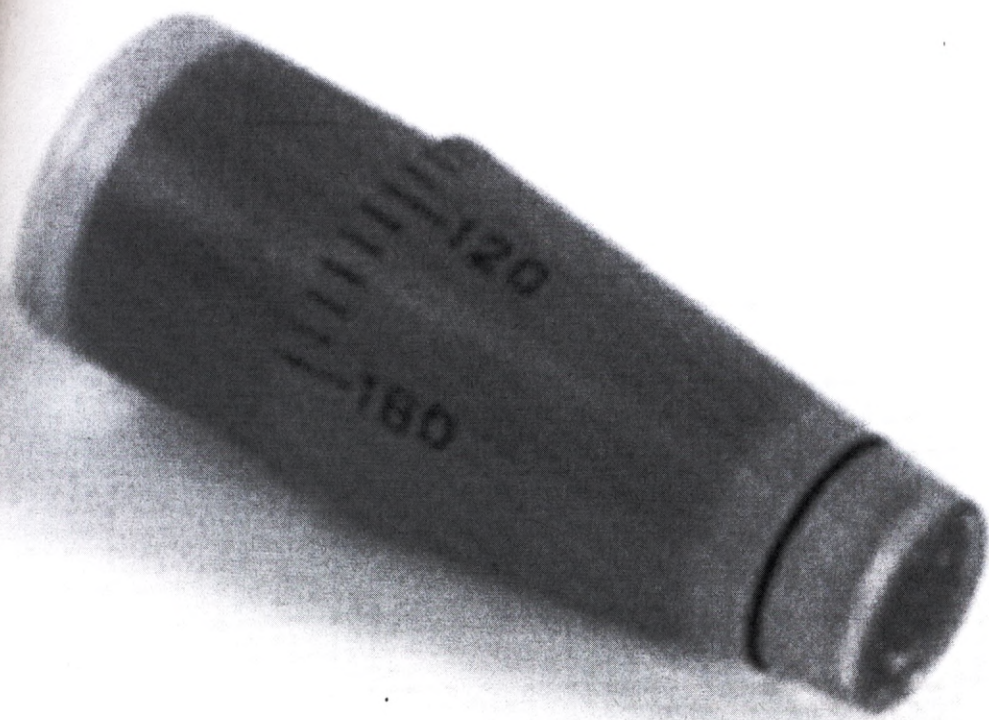




принадлежности: 9. Стержень юстировочный индикатора внутриглазного давления – 1 шт.

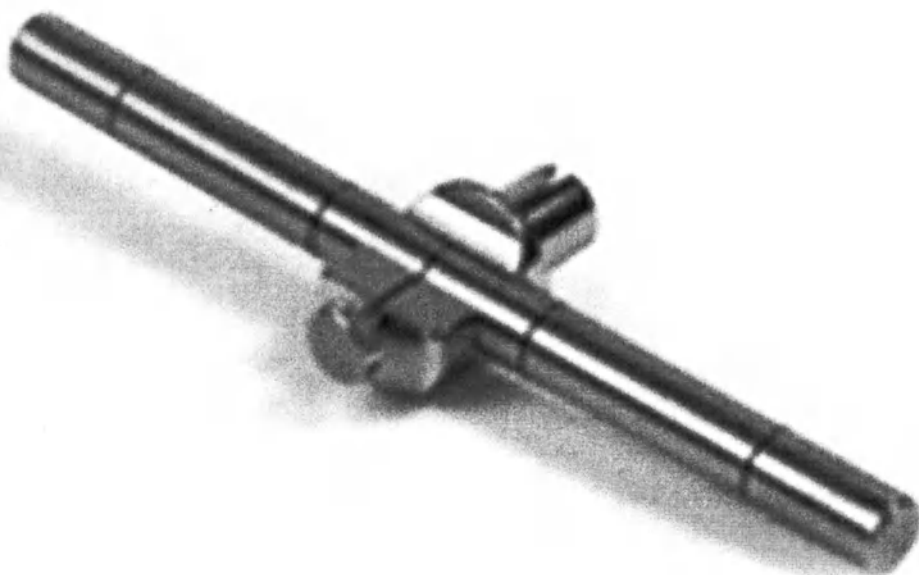




принадлежности: 10. Столешница стола-подставки – 1 шт.

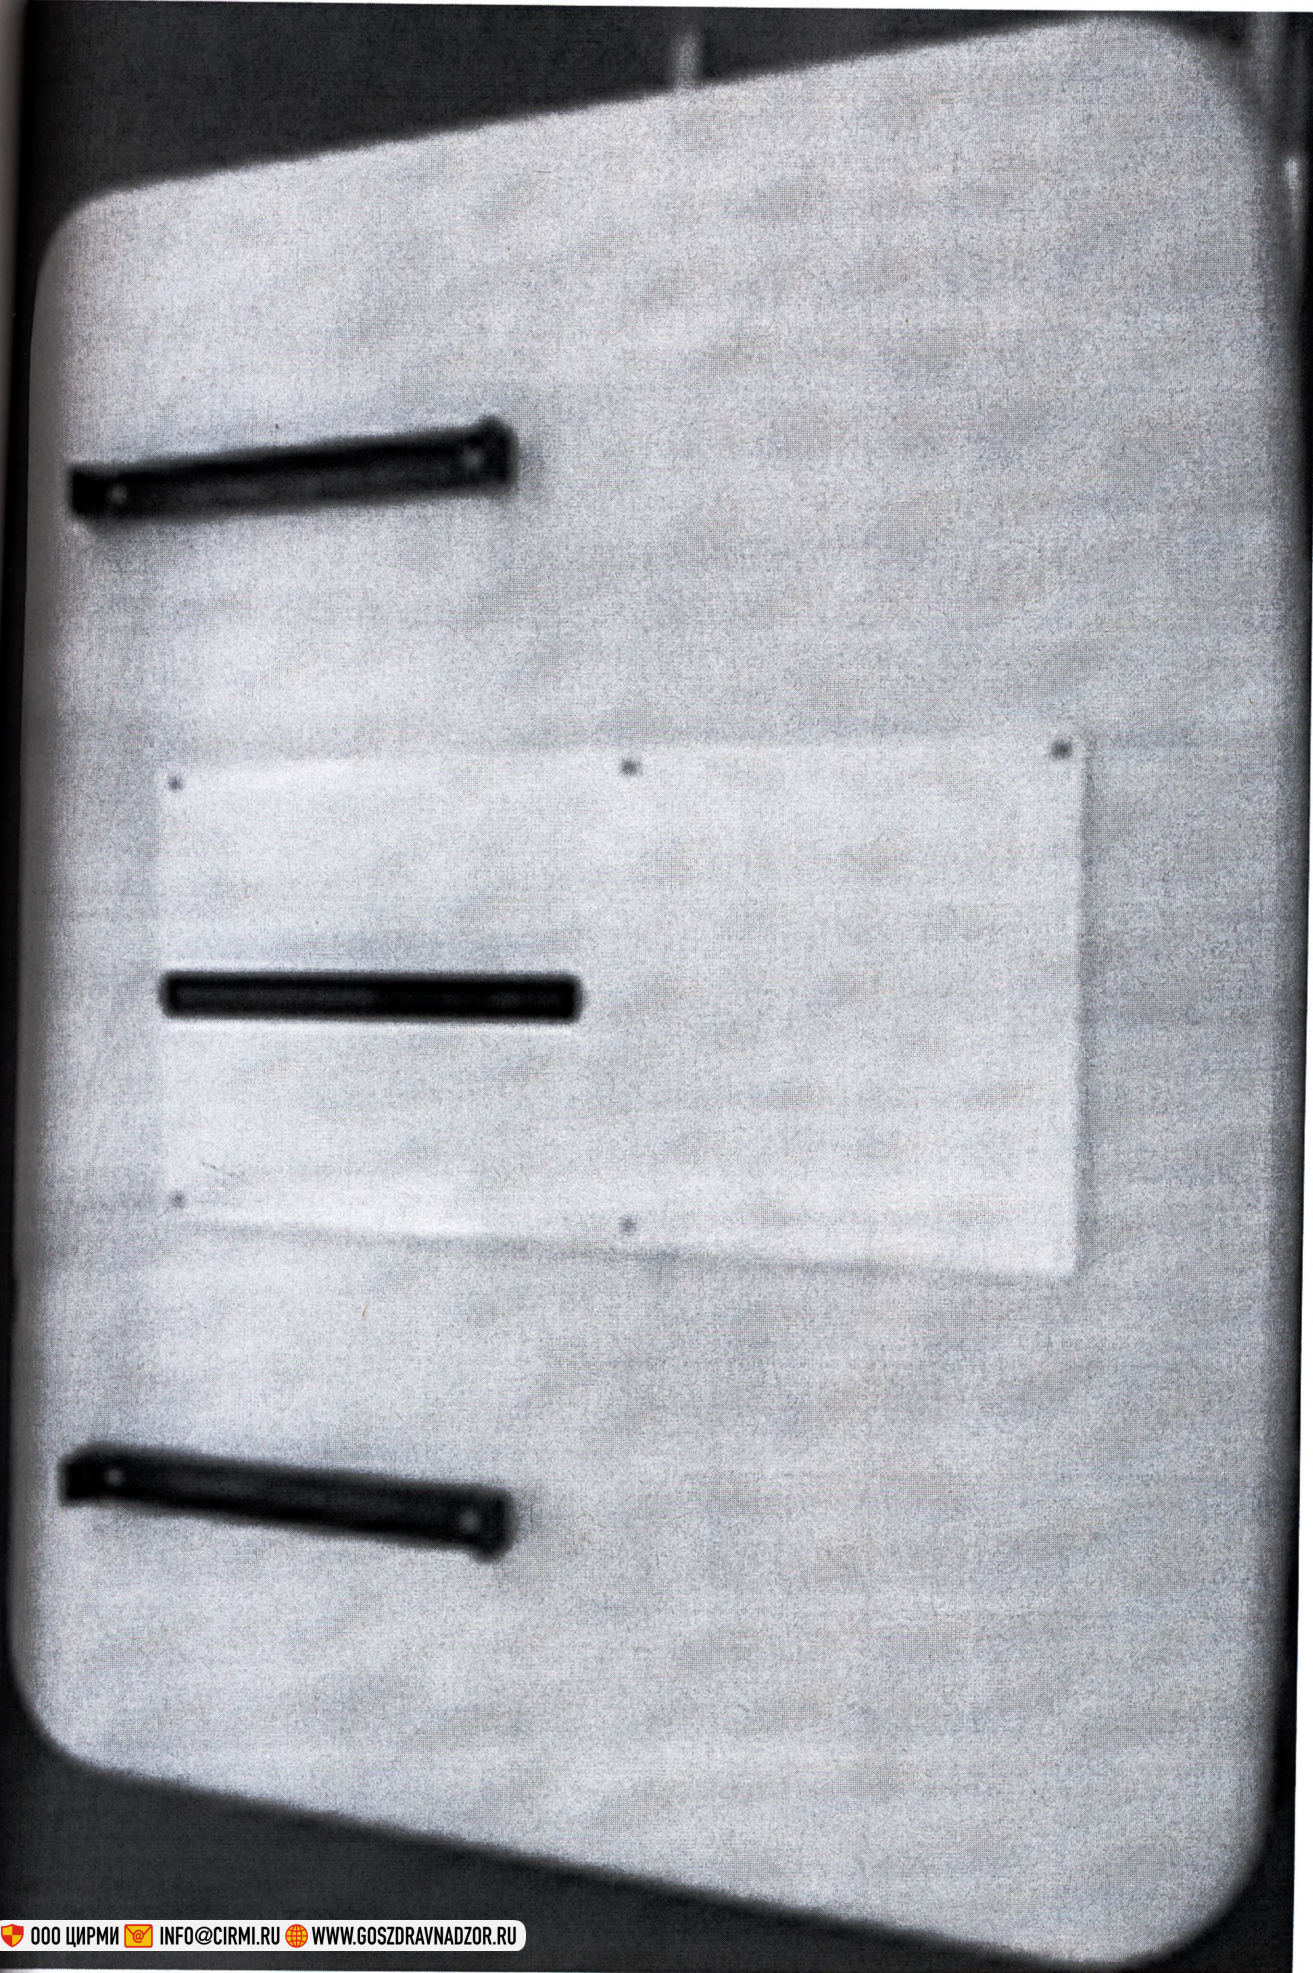




Принадлежности: 10. Столешница стола-подставки – 1 шт.

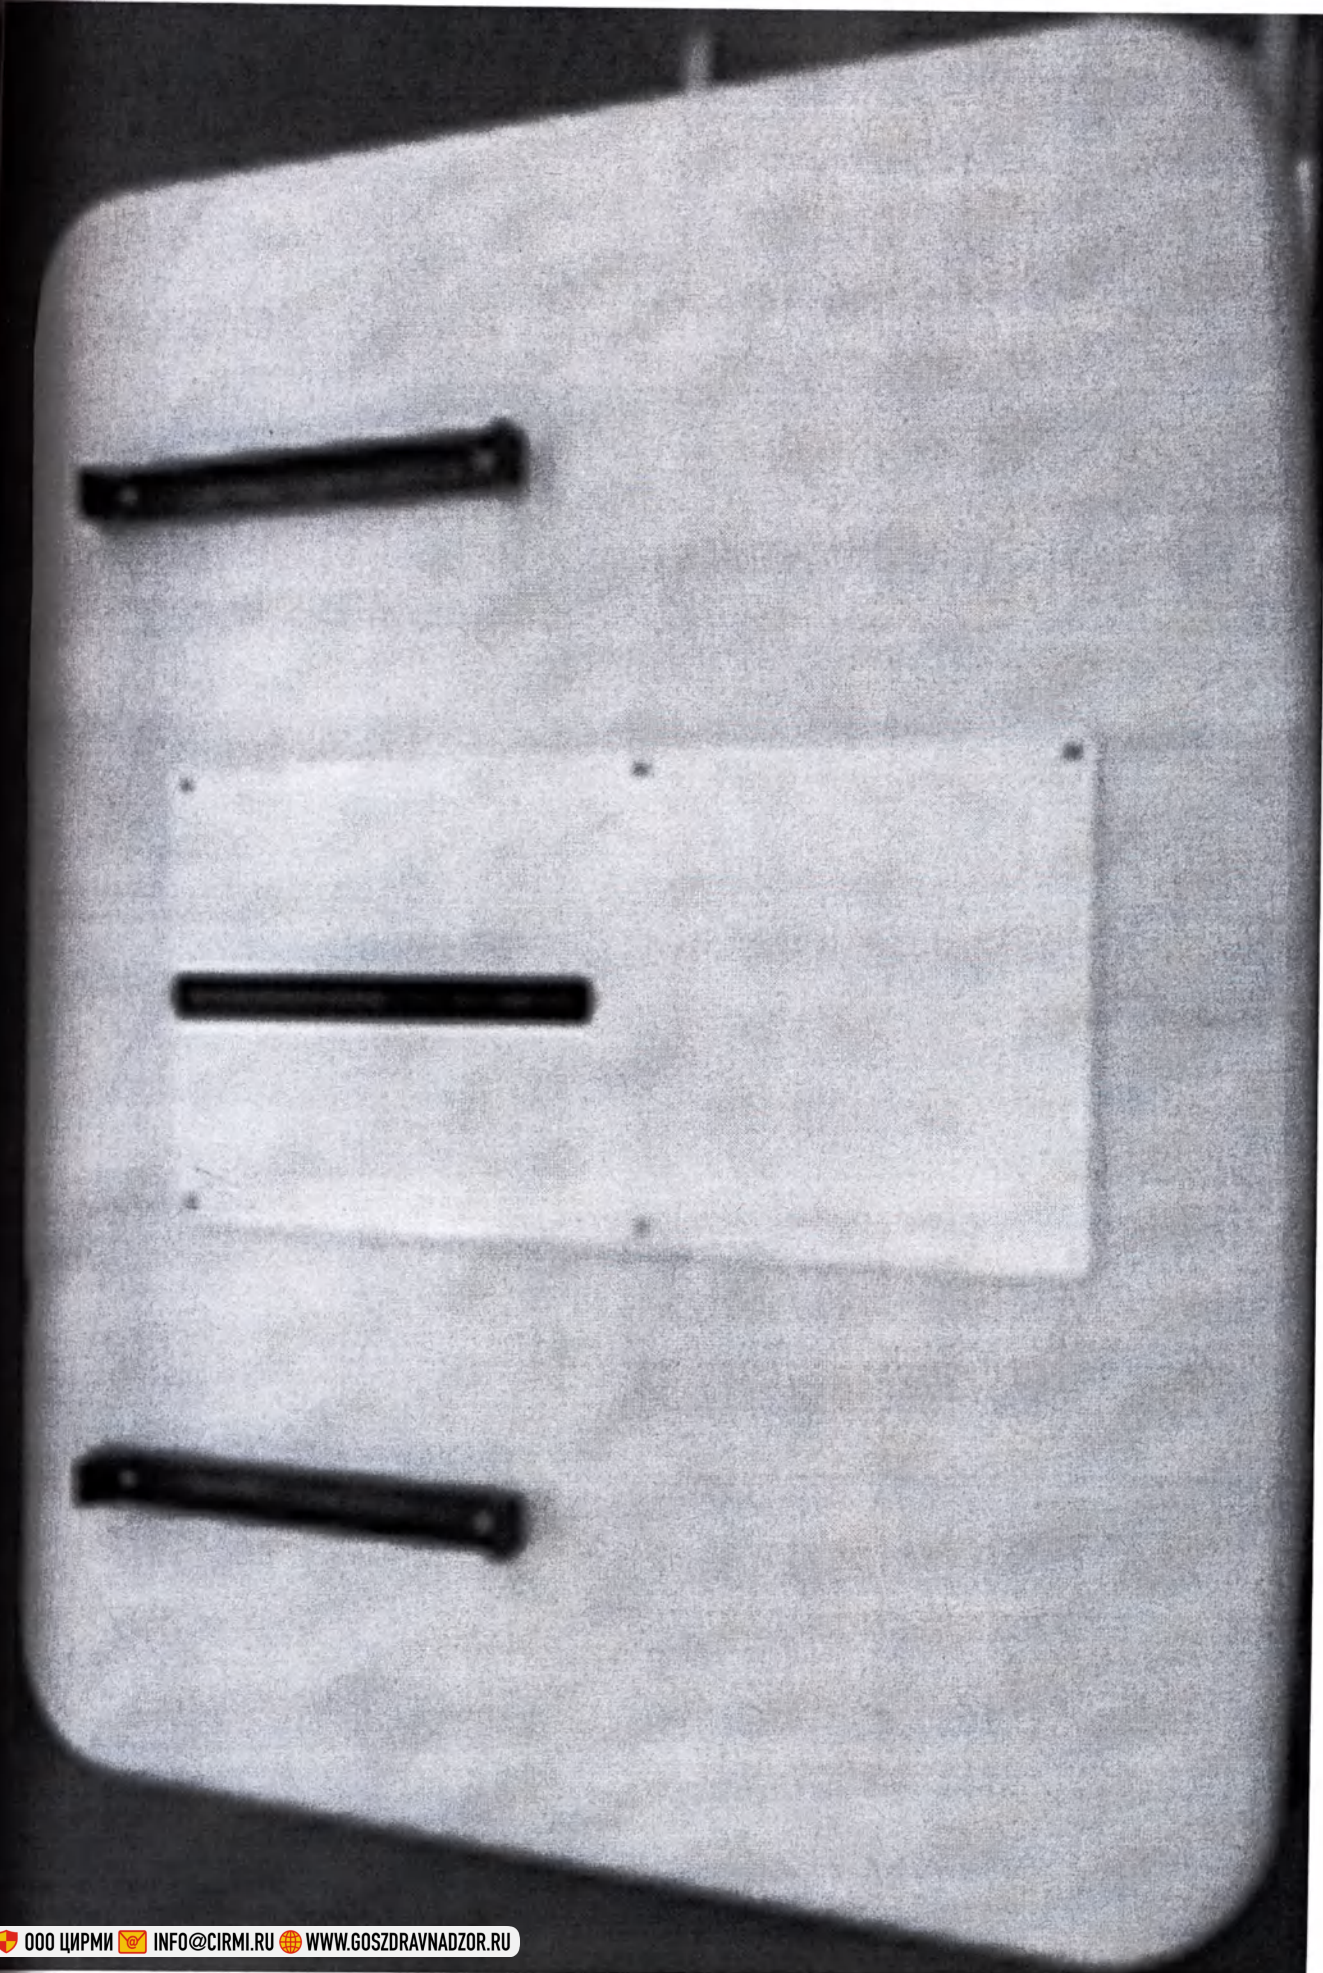




принадлежности: 11. Ножка стола-подставки электроподъемная малая – 1 шт.

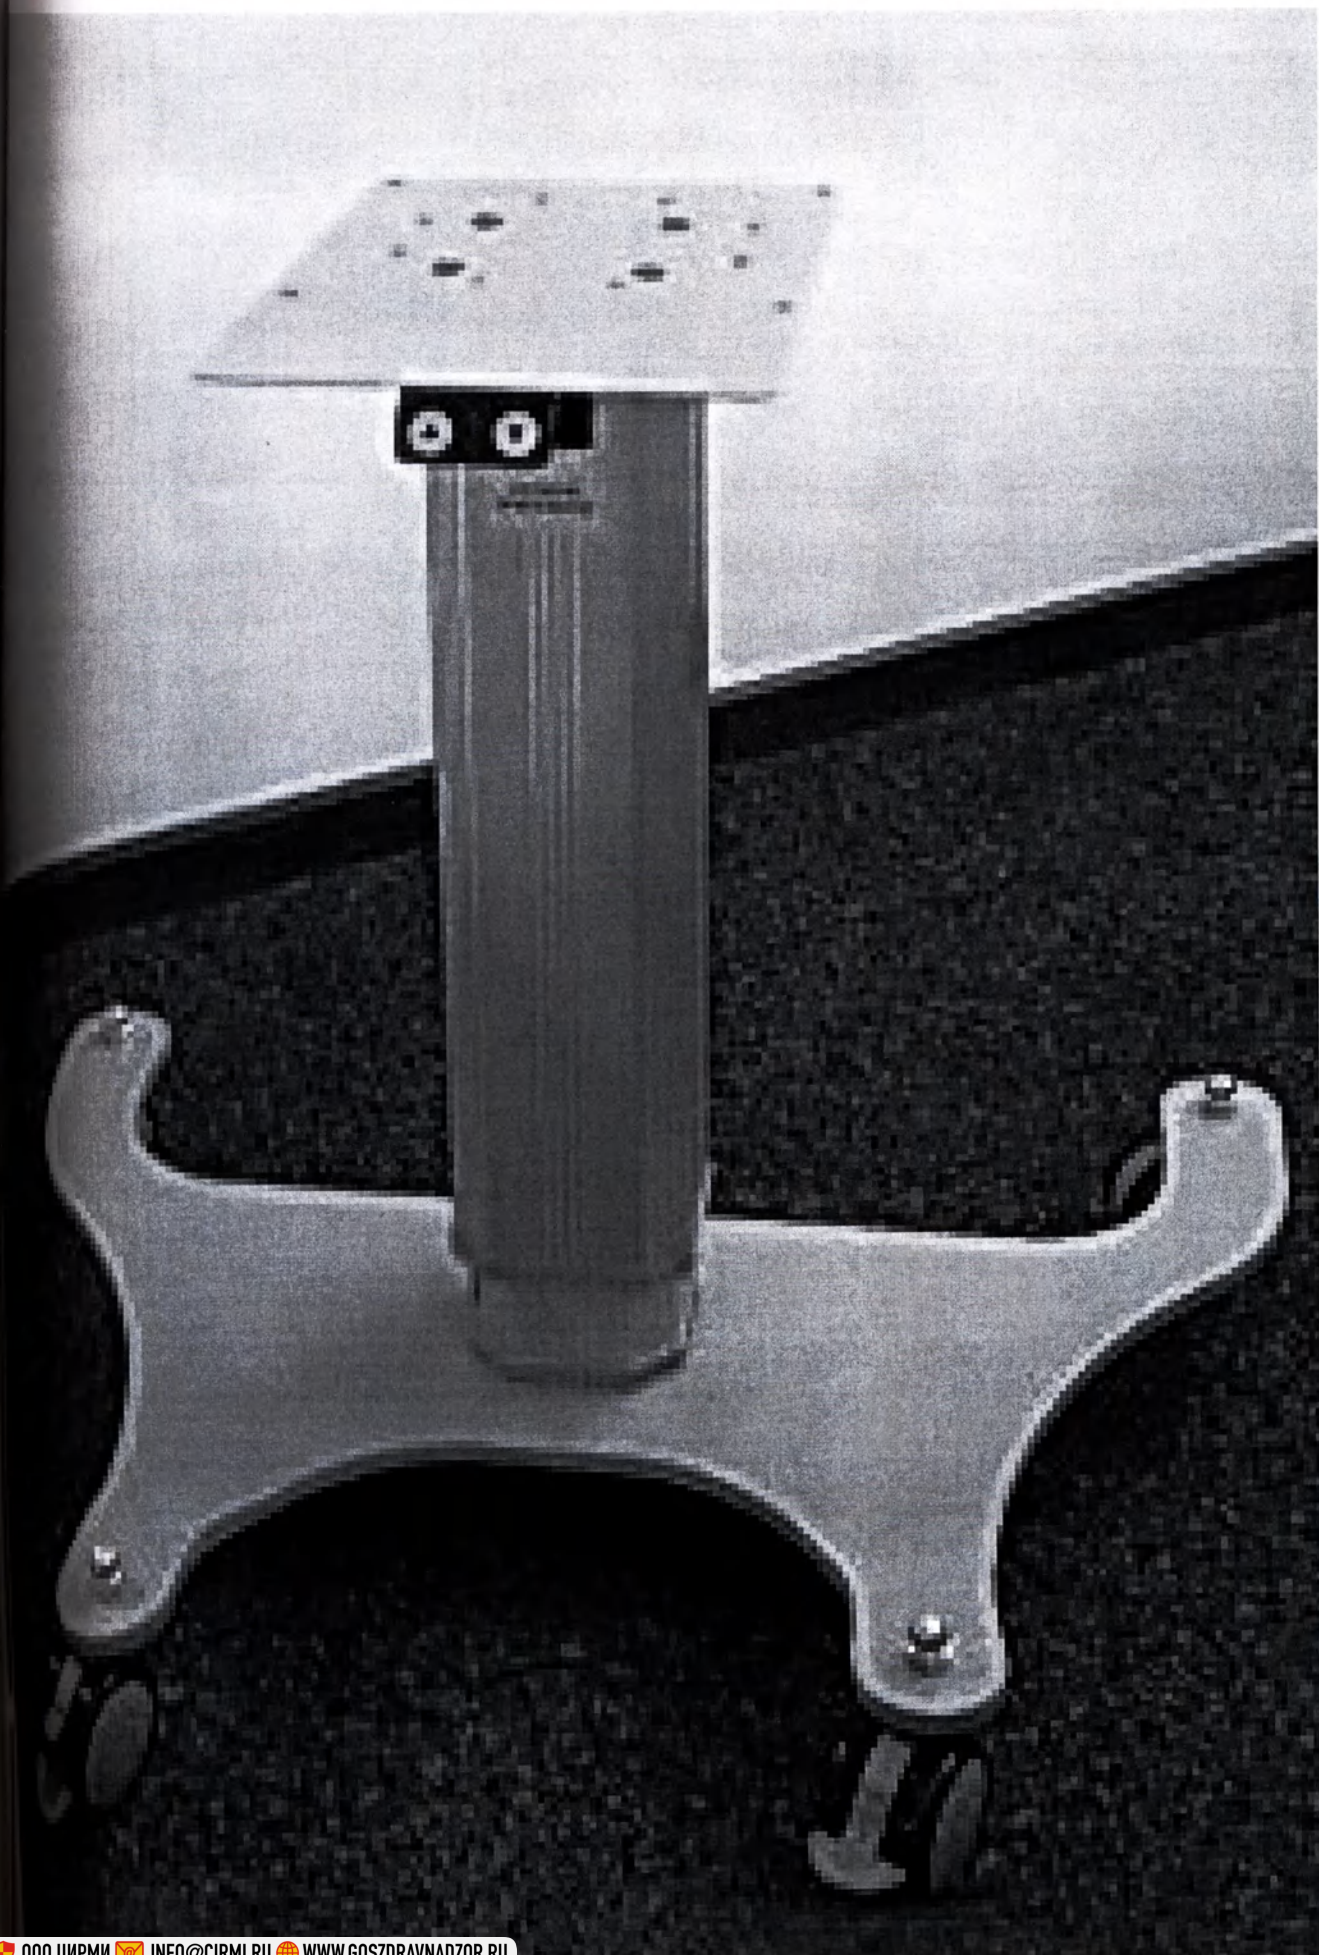




принадлежности: 12. Пластина листовая – 1 шт.

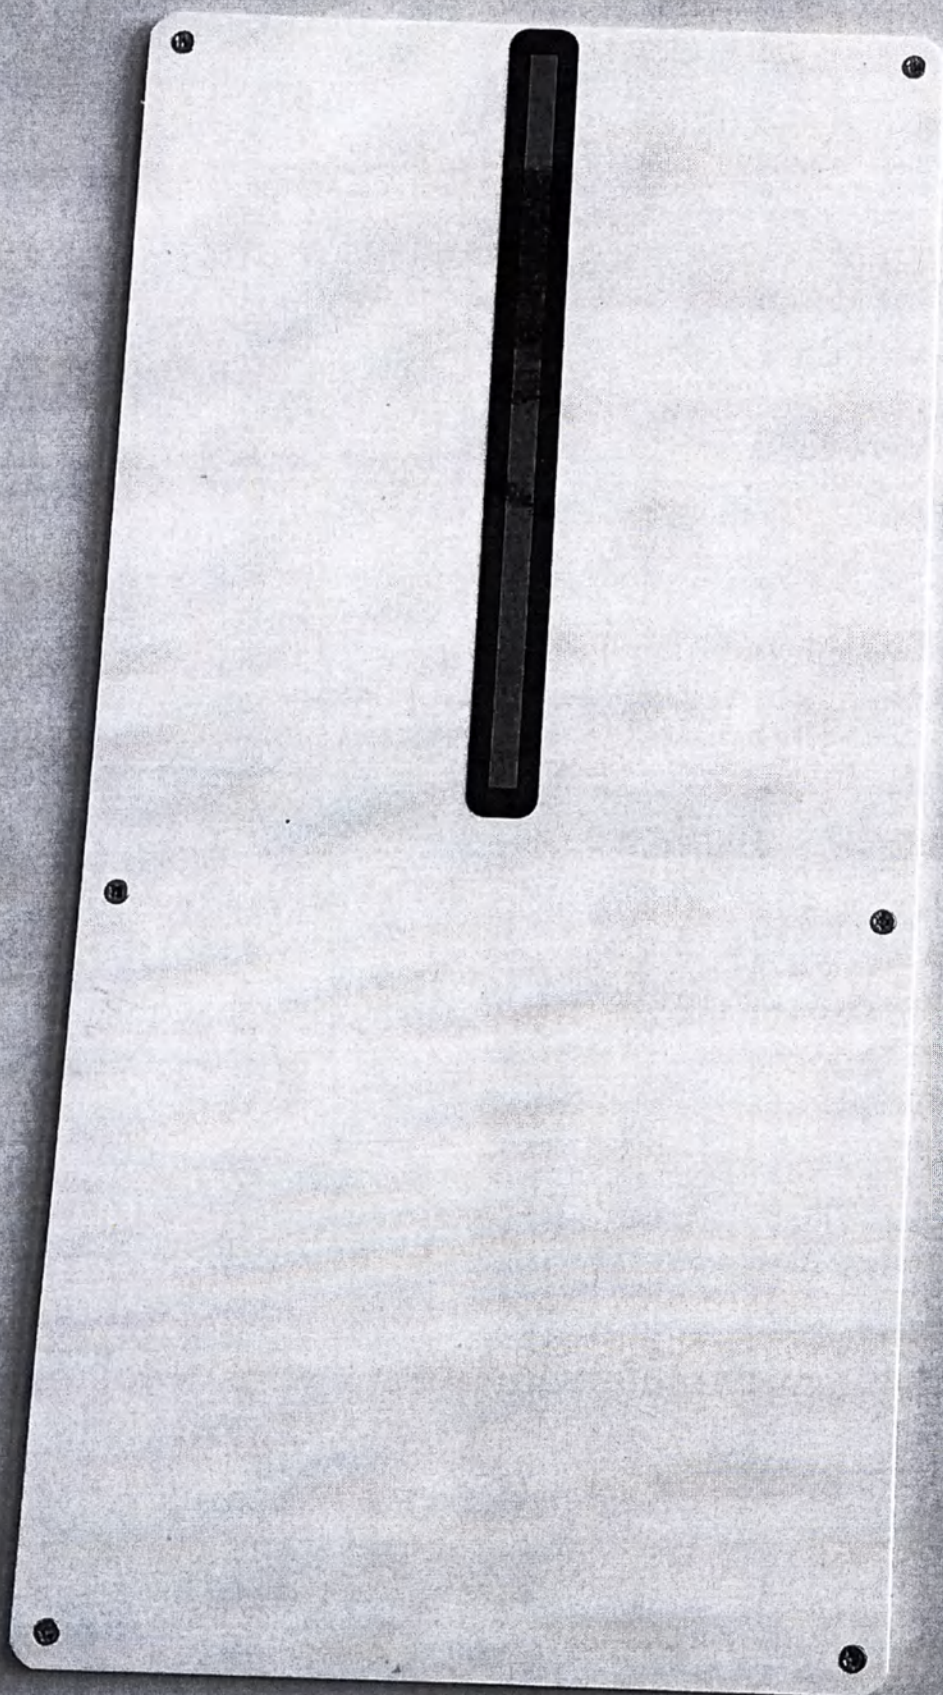




принадлежности: 13. Рельсы зубчатые – 2 шт.

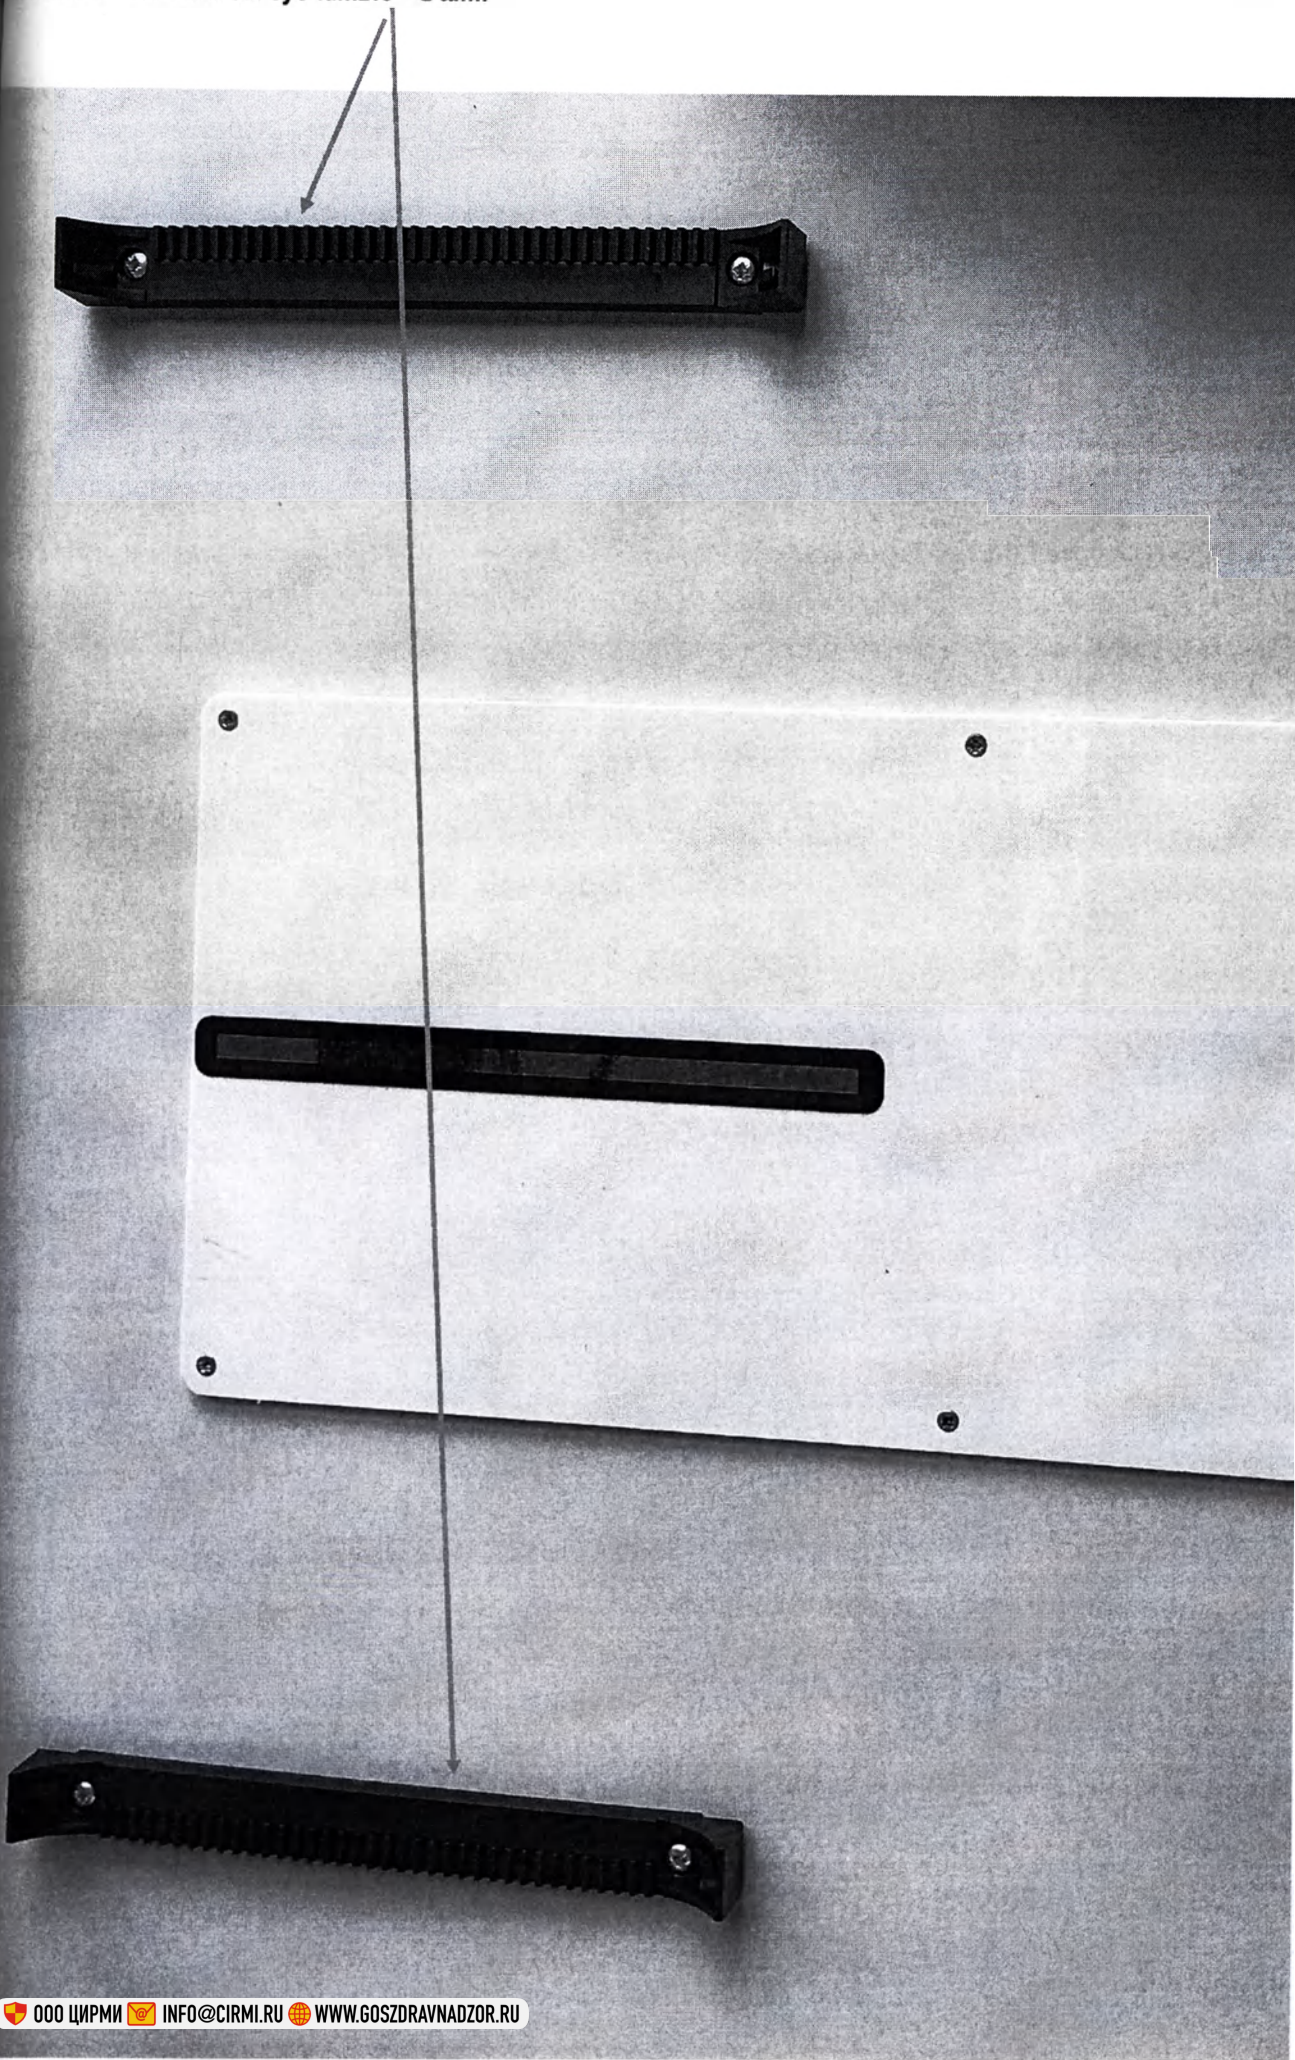



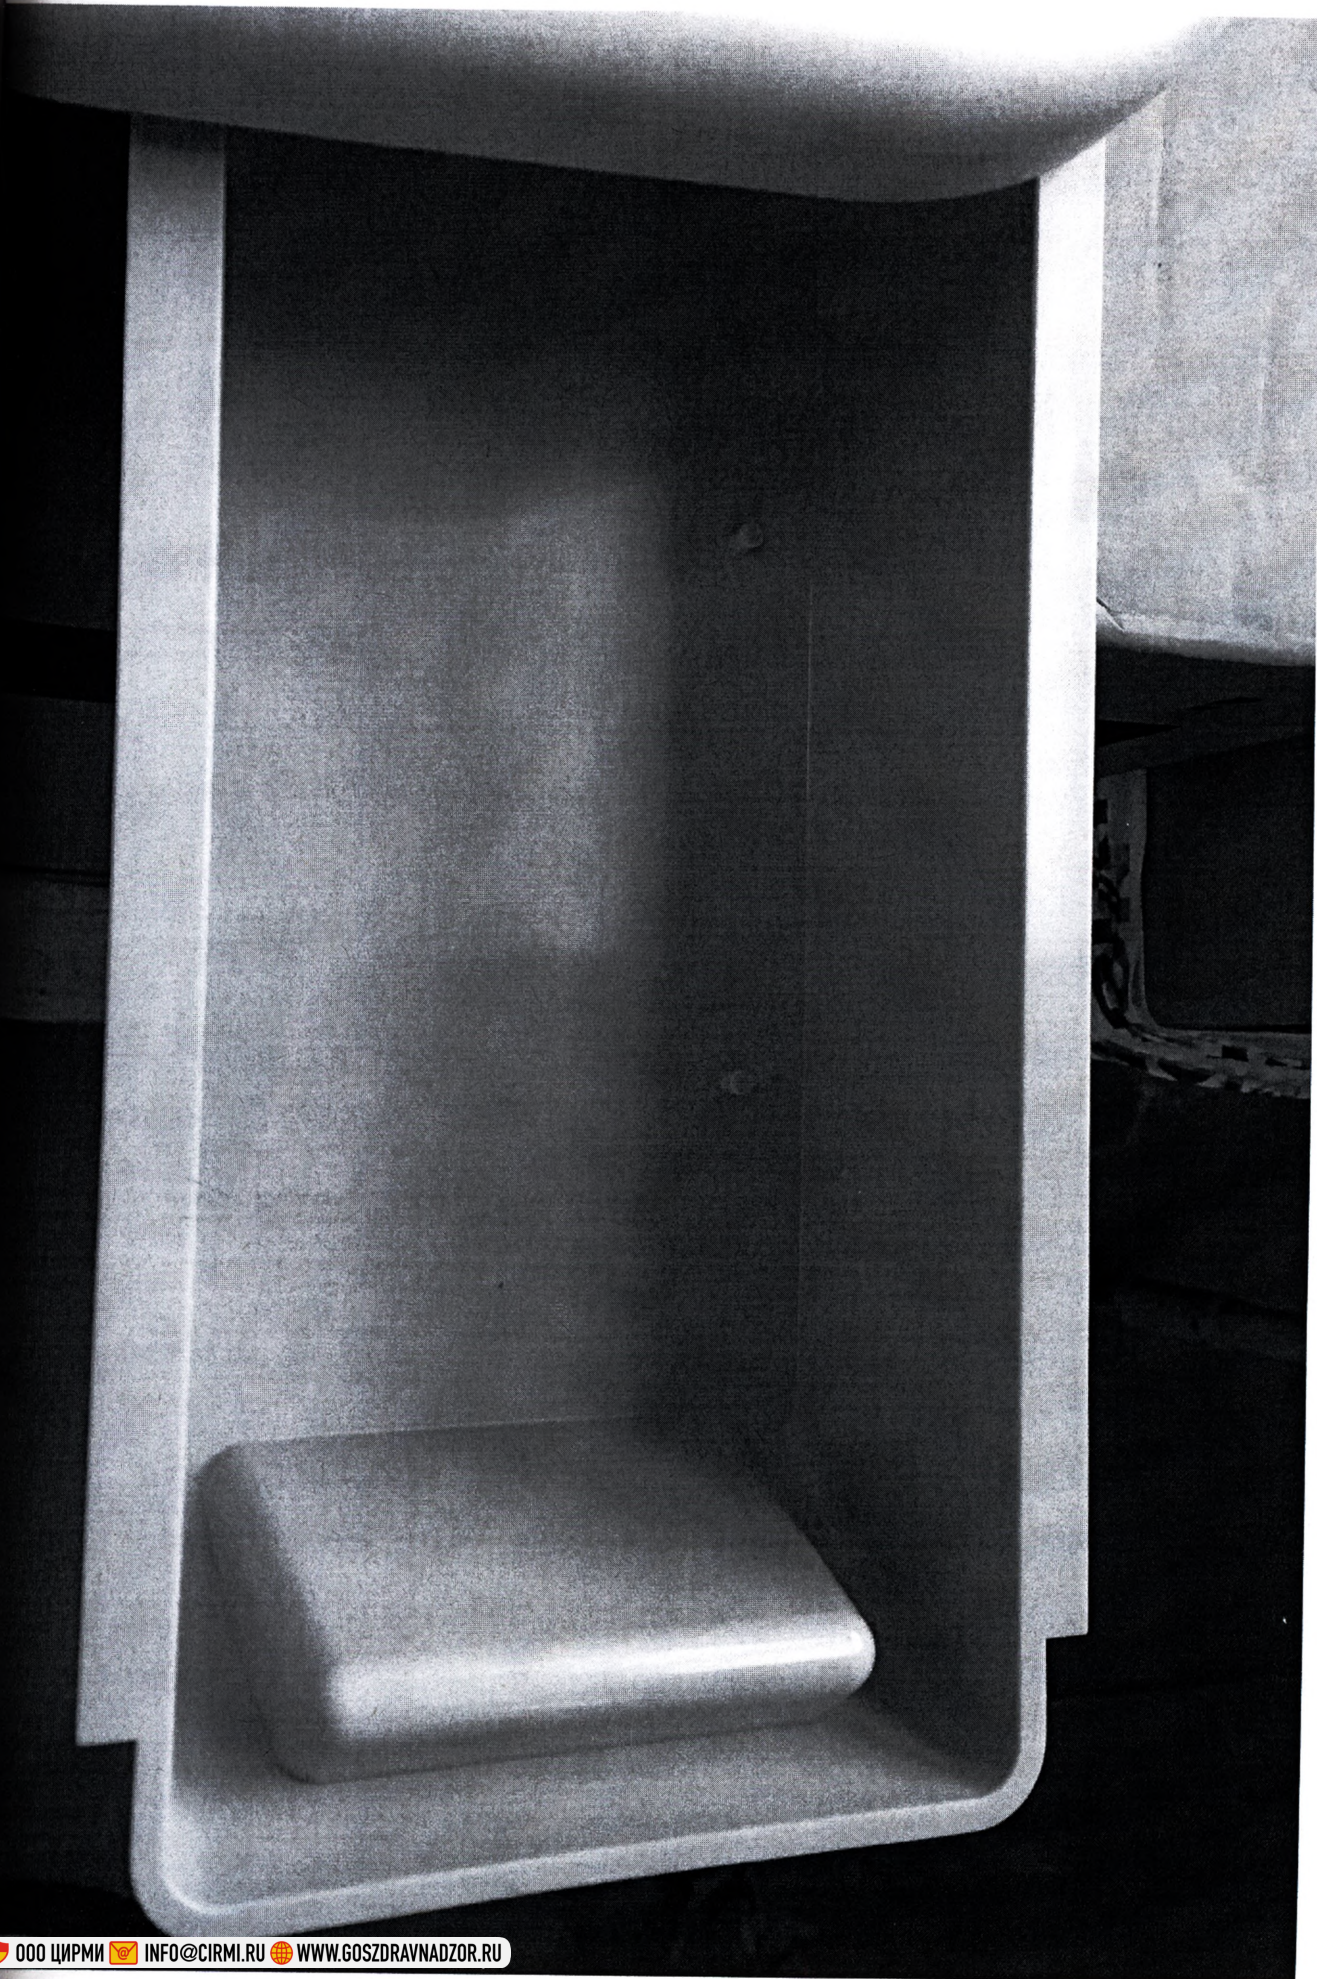



Принадлежности: 15. Блок питания – 1 шт.





принадлежности: 16. Кабель подключения основания щелевой лампы к столешнице – 1 шт.





принадлежности: 17. Кабель питания – 1 шт.





принадлежности: 18. Кабель упора для головы пациента – 1 шт.





принадлежности: 19. USB кабель – 1 шт.





принадлежности: 20. USB кабель высокоскоростной – 1 шт.





принадлежности: 21. Окуляры – 2 шт.









принадлежности: 23. Делитель луча – 1 шт.




**Keeler**



**CE** 3020-P-5031  
Serial No.3020/D1378


 Keeler Ltd, SL44AA, UK



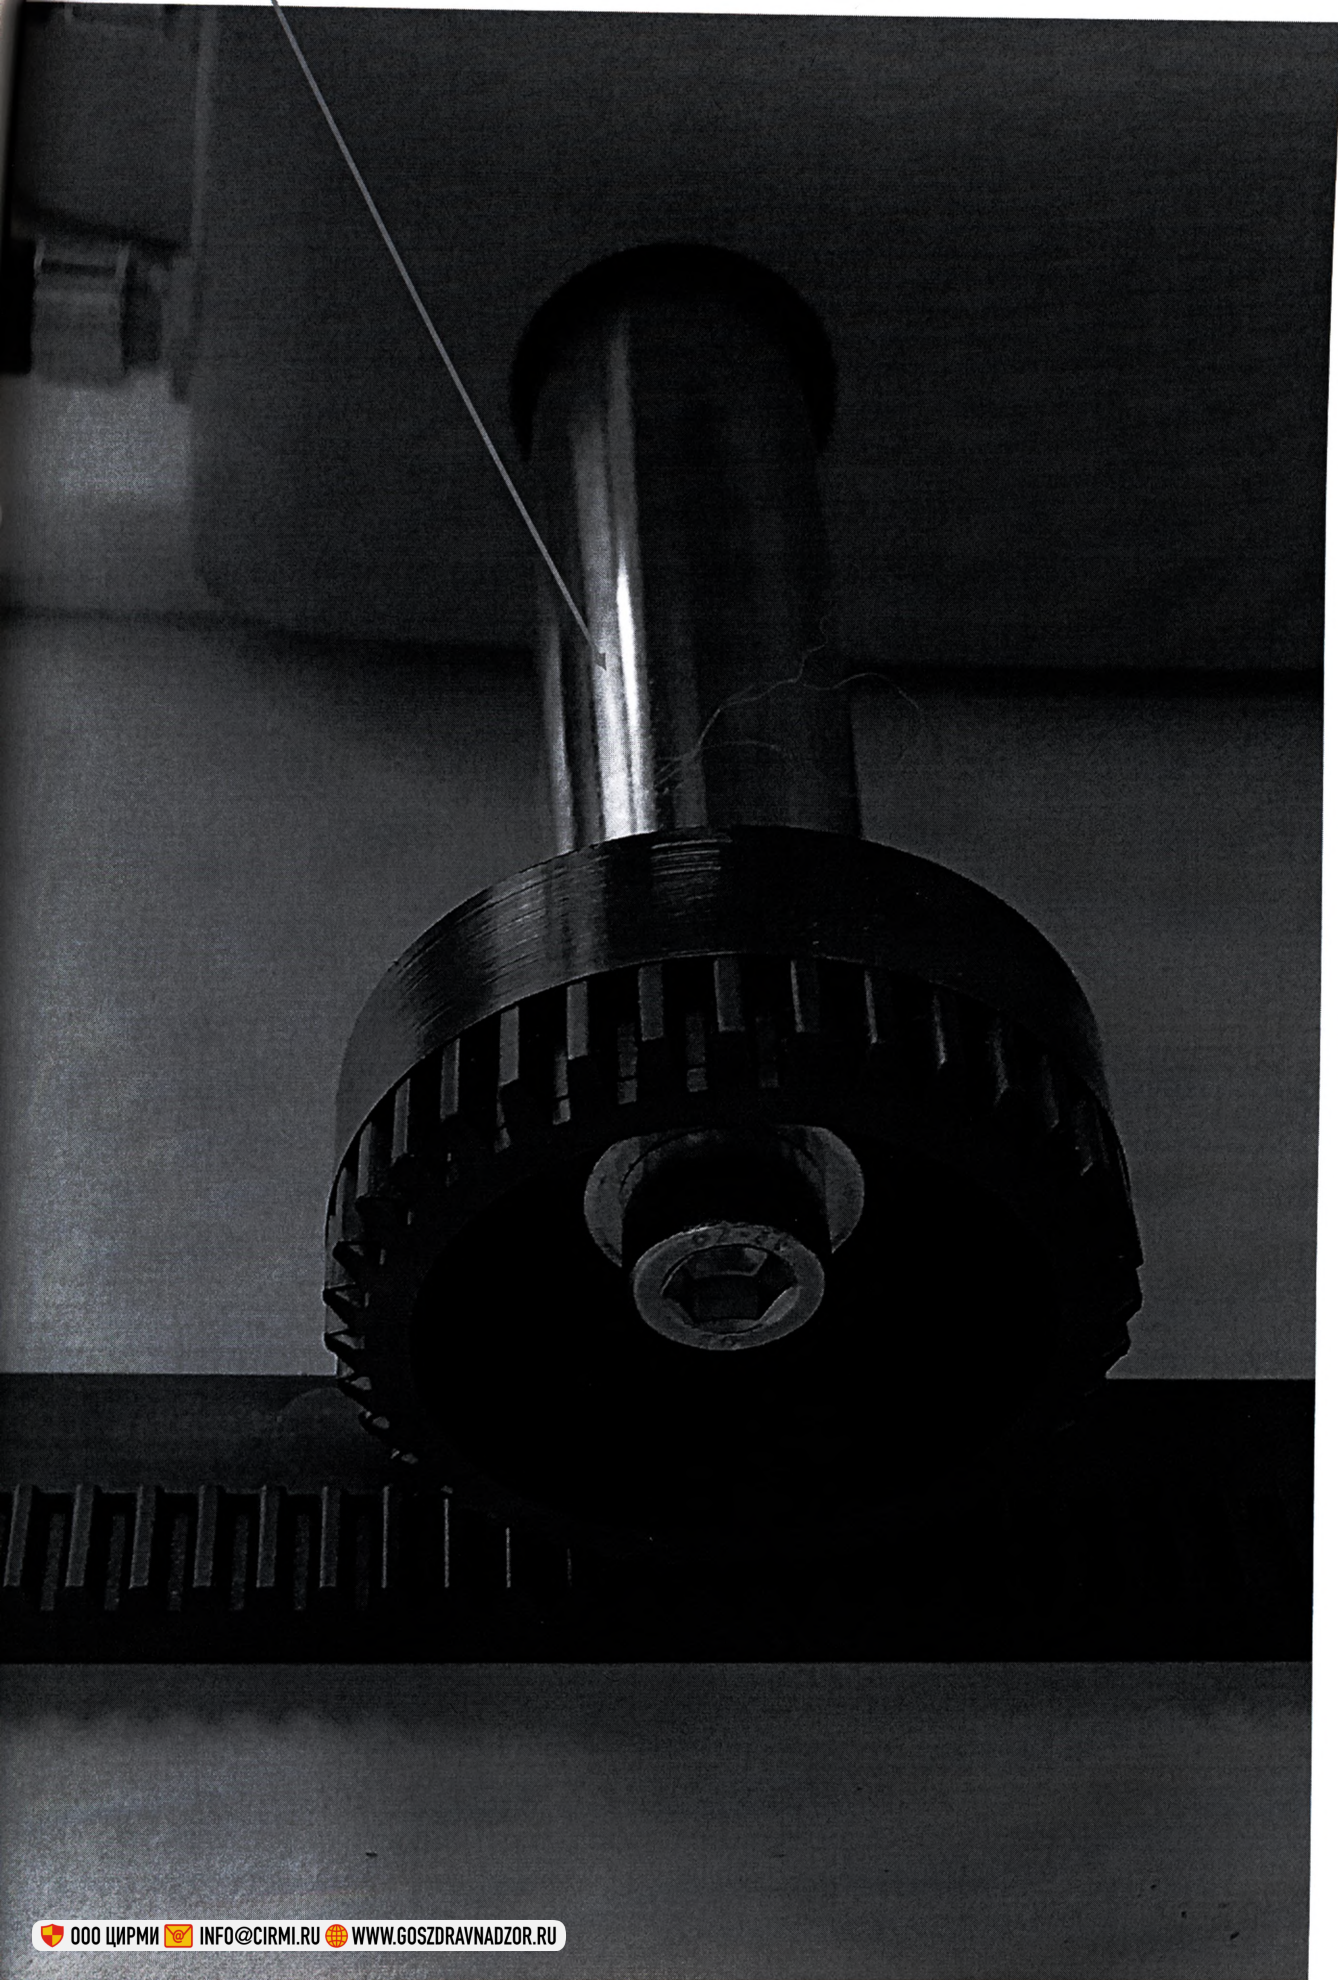



принадлежности: 25. Колеса зубчатые – 2 шт.

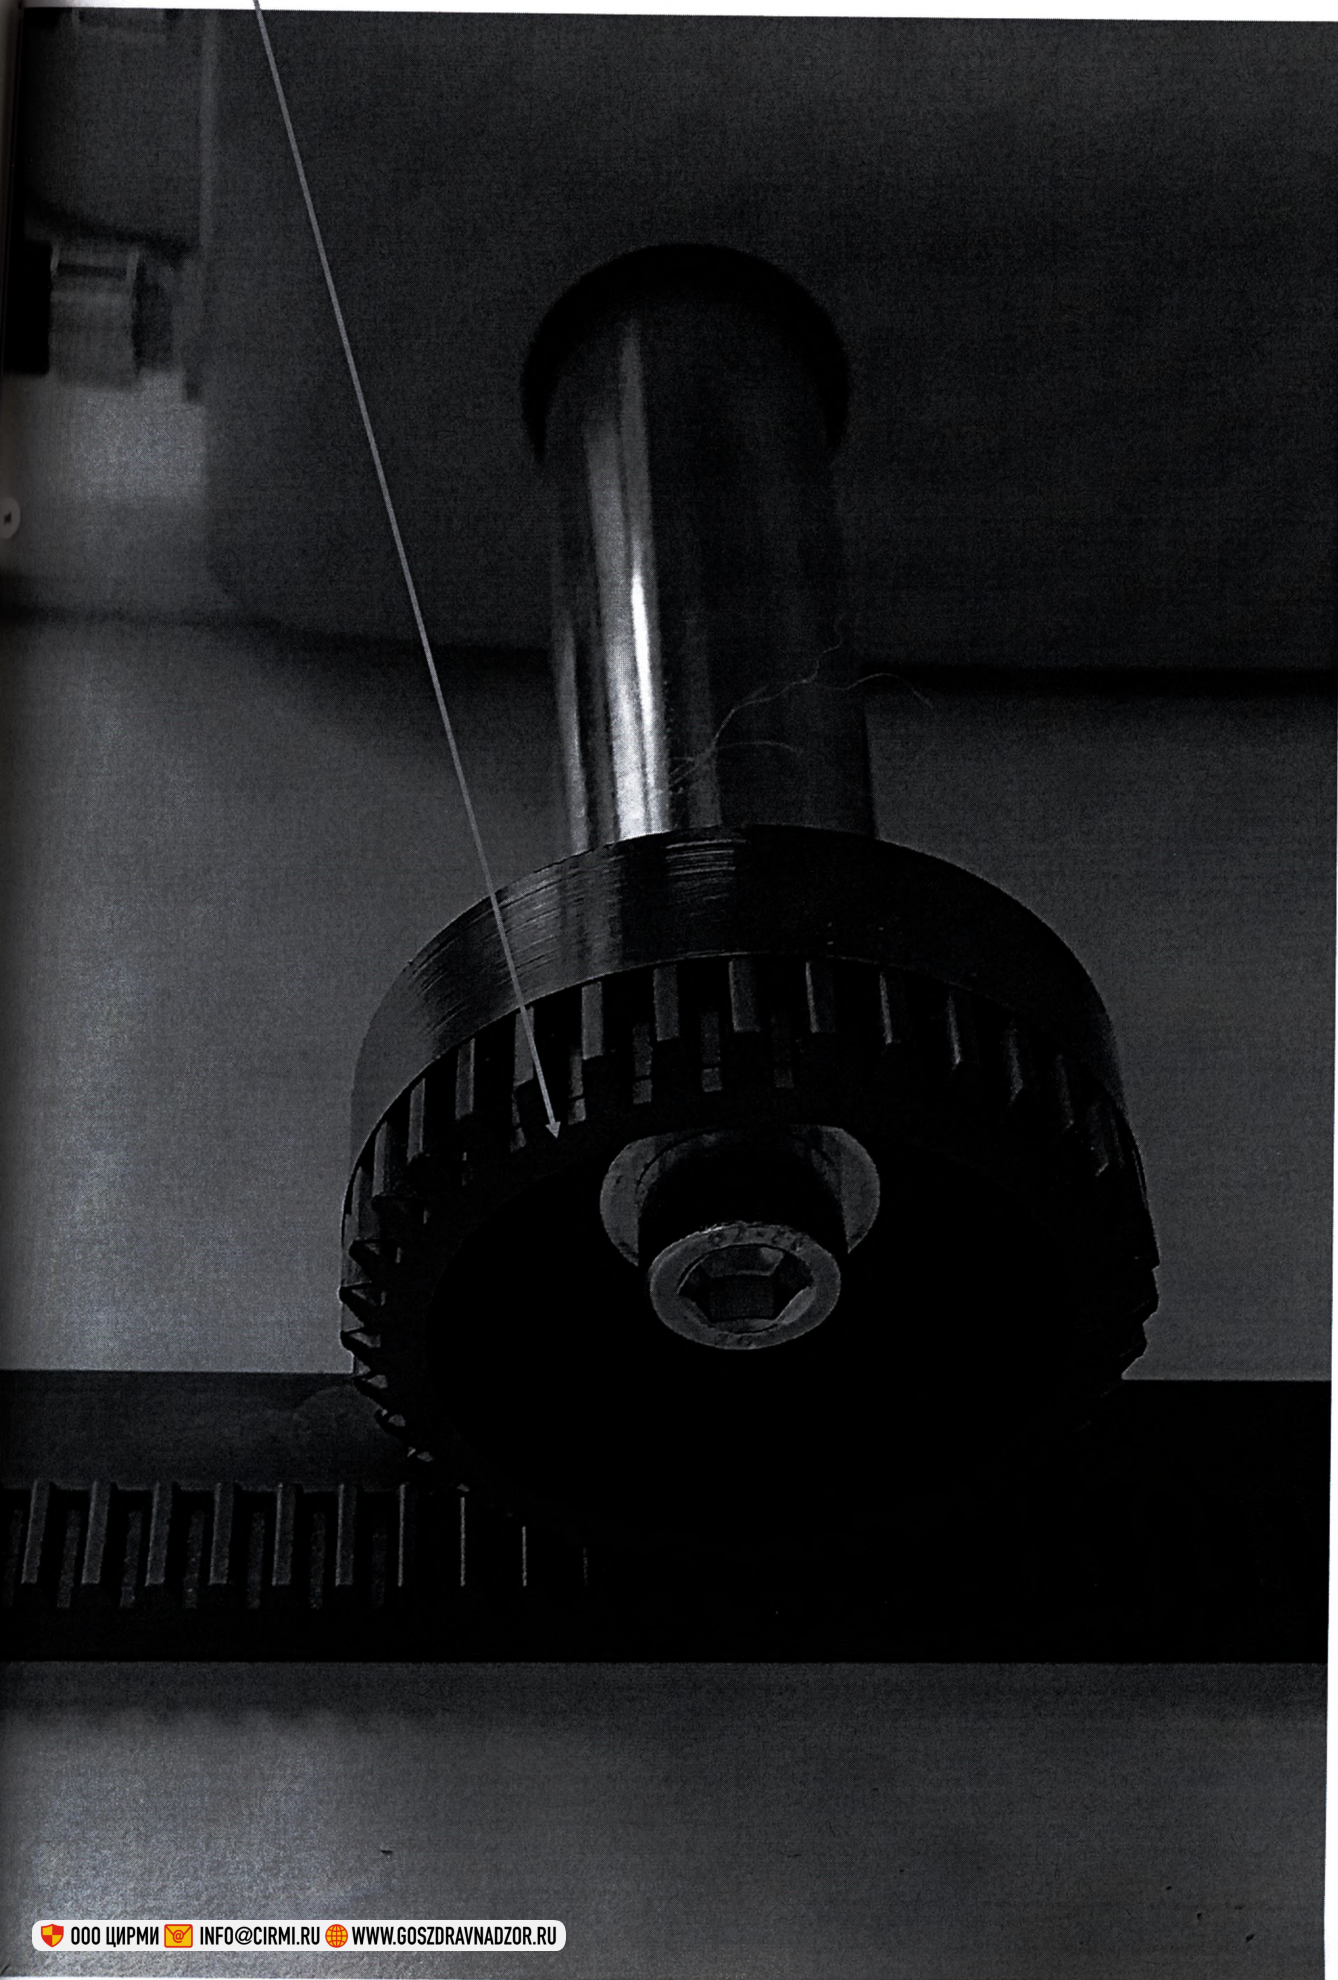



принадлежности: 26. Накладка джойстика – 1 шт.






принадлежности: 27. Крышки зубчатых рельс – 2 шт.





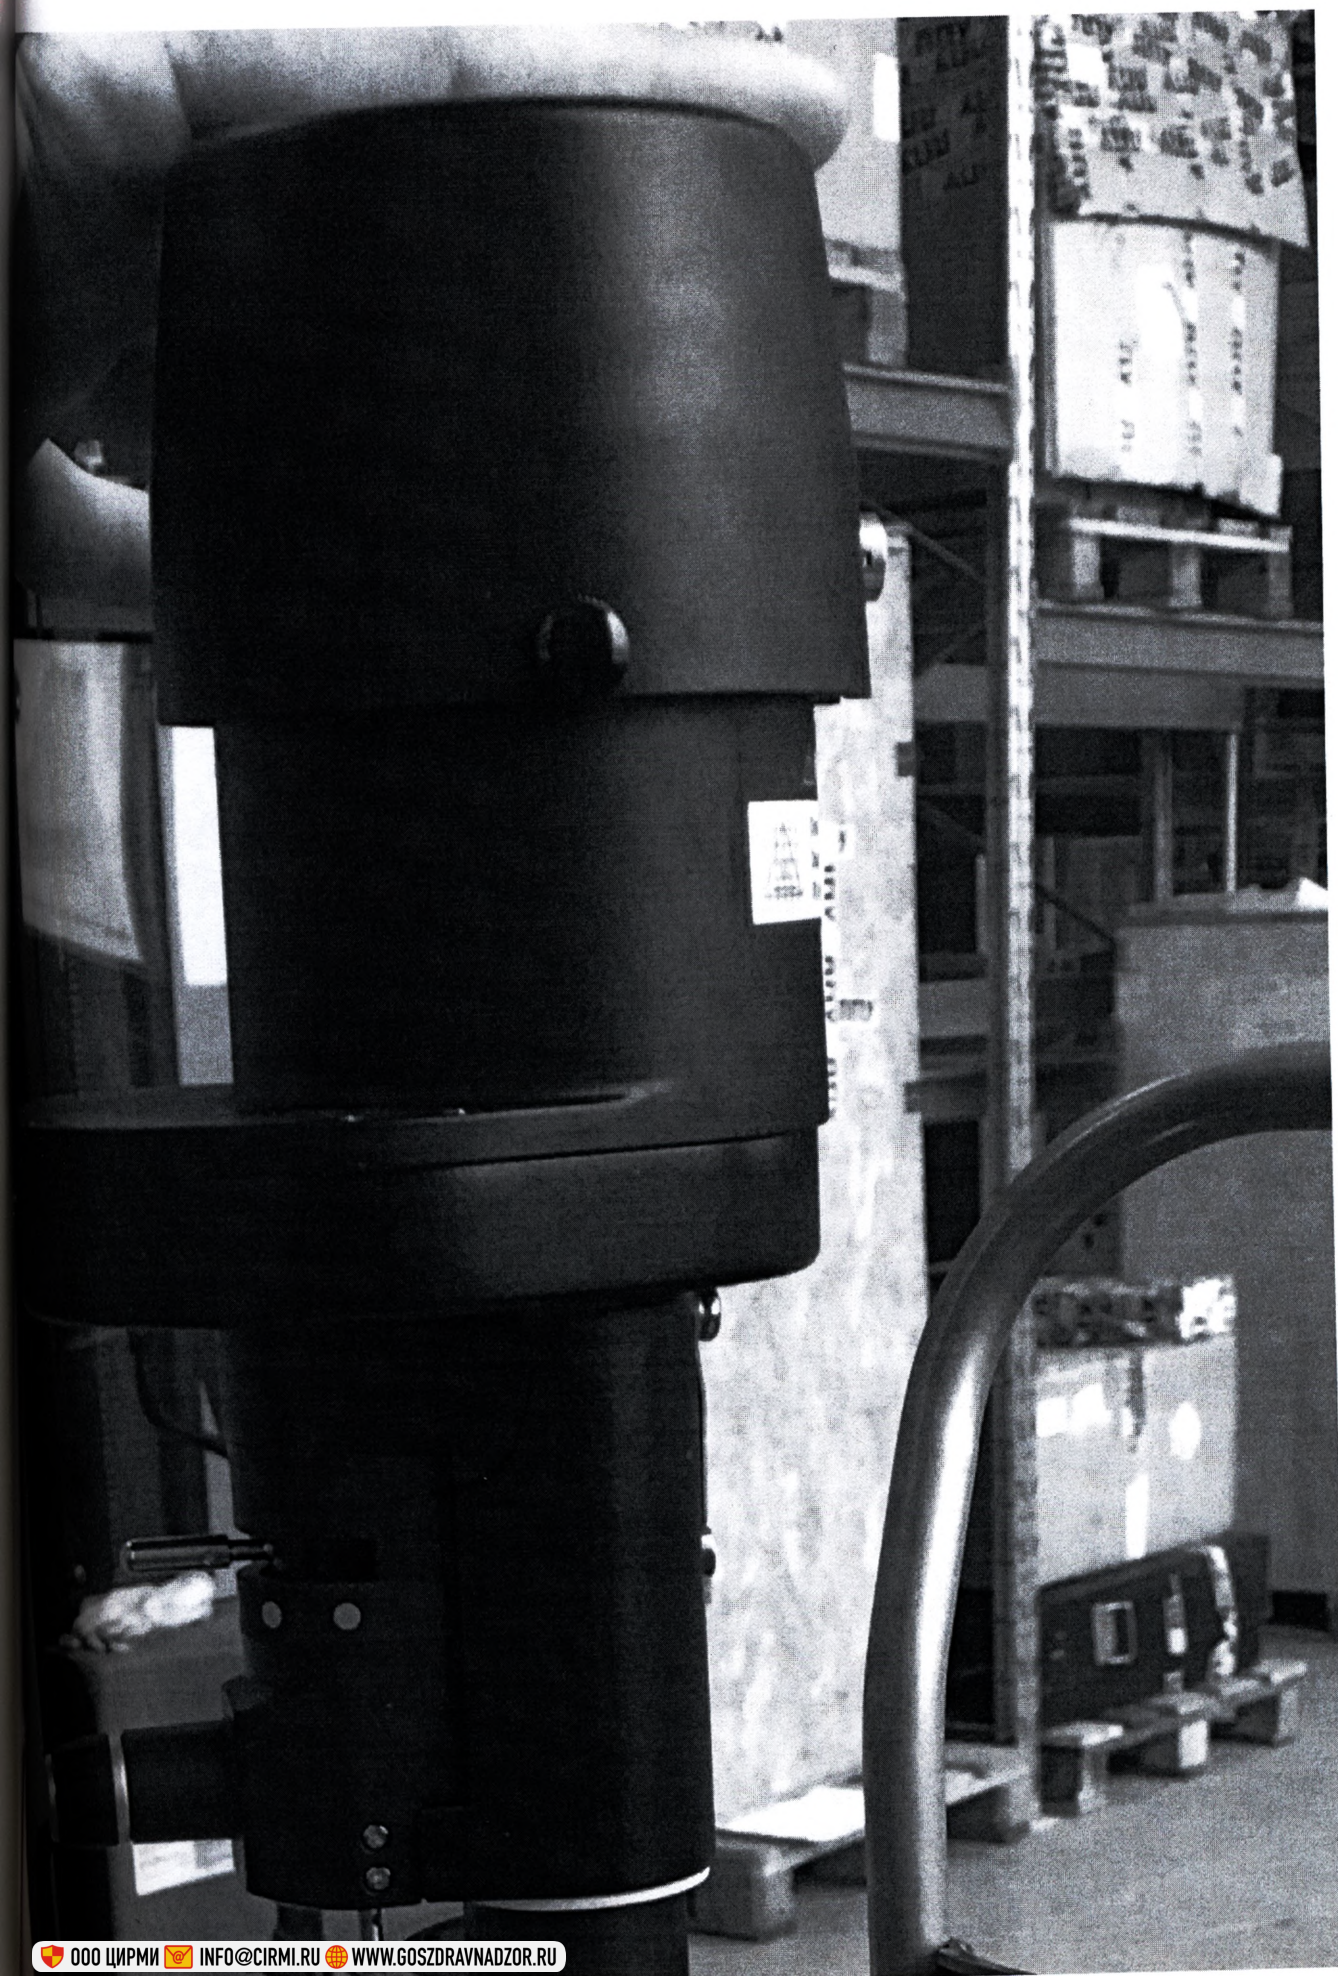













ежности: 31. Галогеновая лампа 6В 20Вт – не более 5 шт.

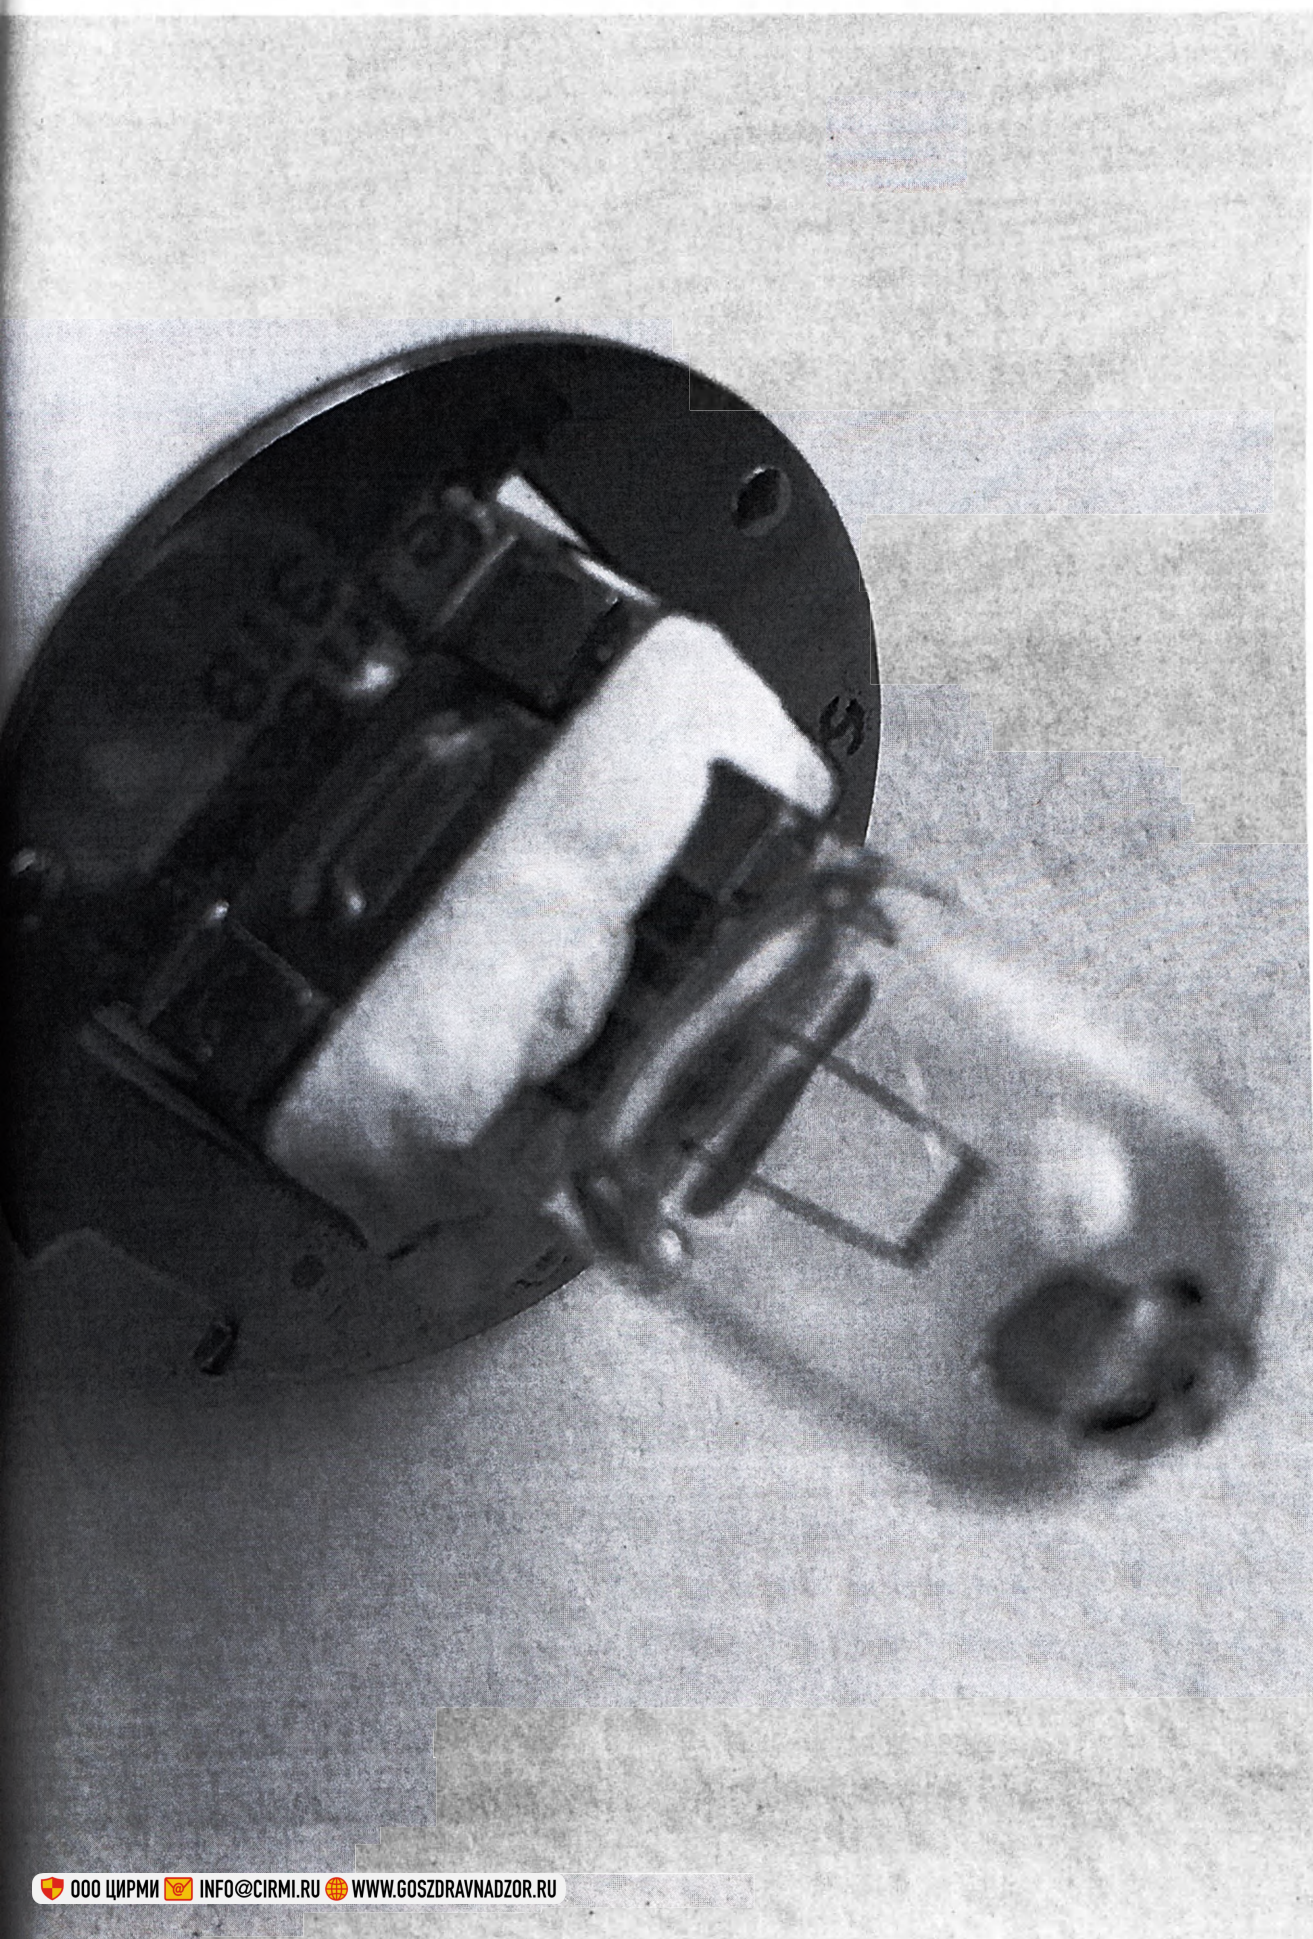



принадлежности: 32. Галогеновая лампа 12В 30Вт – не более 5 шт.

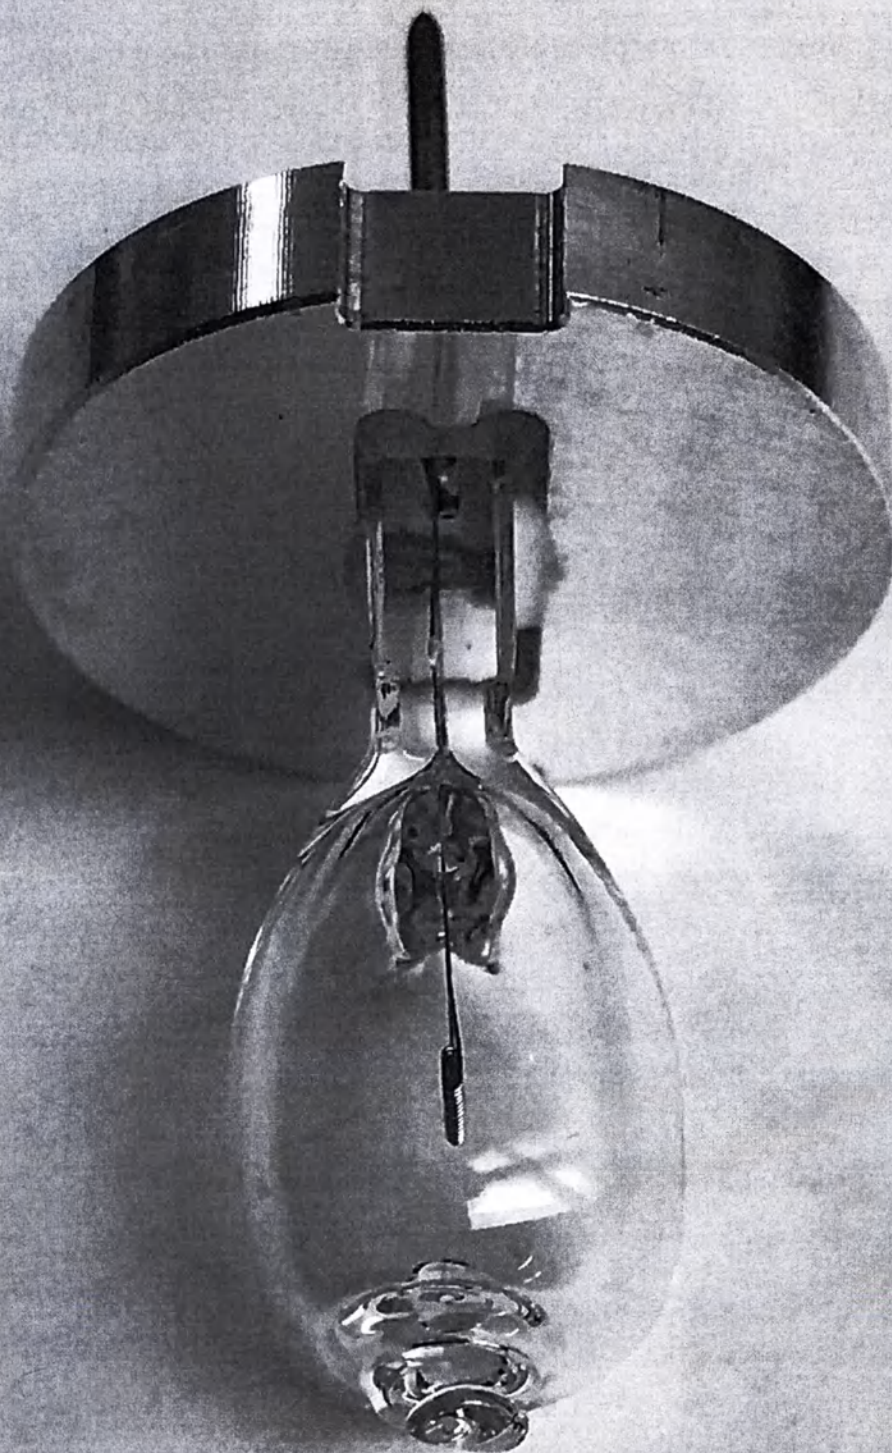



принадлежности: 33. Палочка юстированная – 1 шт.





жности: 34. Адаптер для подключения фотокамеры – 1 шт.










...екая офтальмологическая диагностическая вариант исполнения H-Series с принадлежностями: 17:  
...ности: 36. Видеокомплект специальный – 1 шт.





принадлежности: 37. Кабель фотокомплекта интерфейсный – 1 шт.

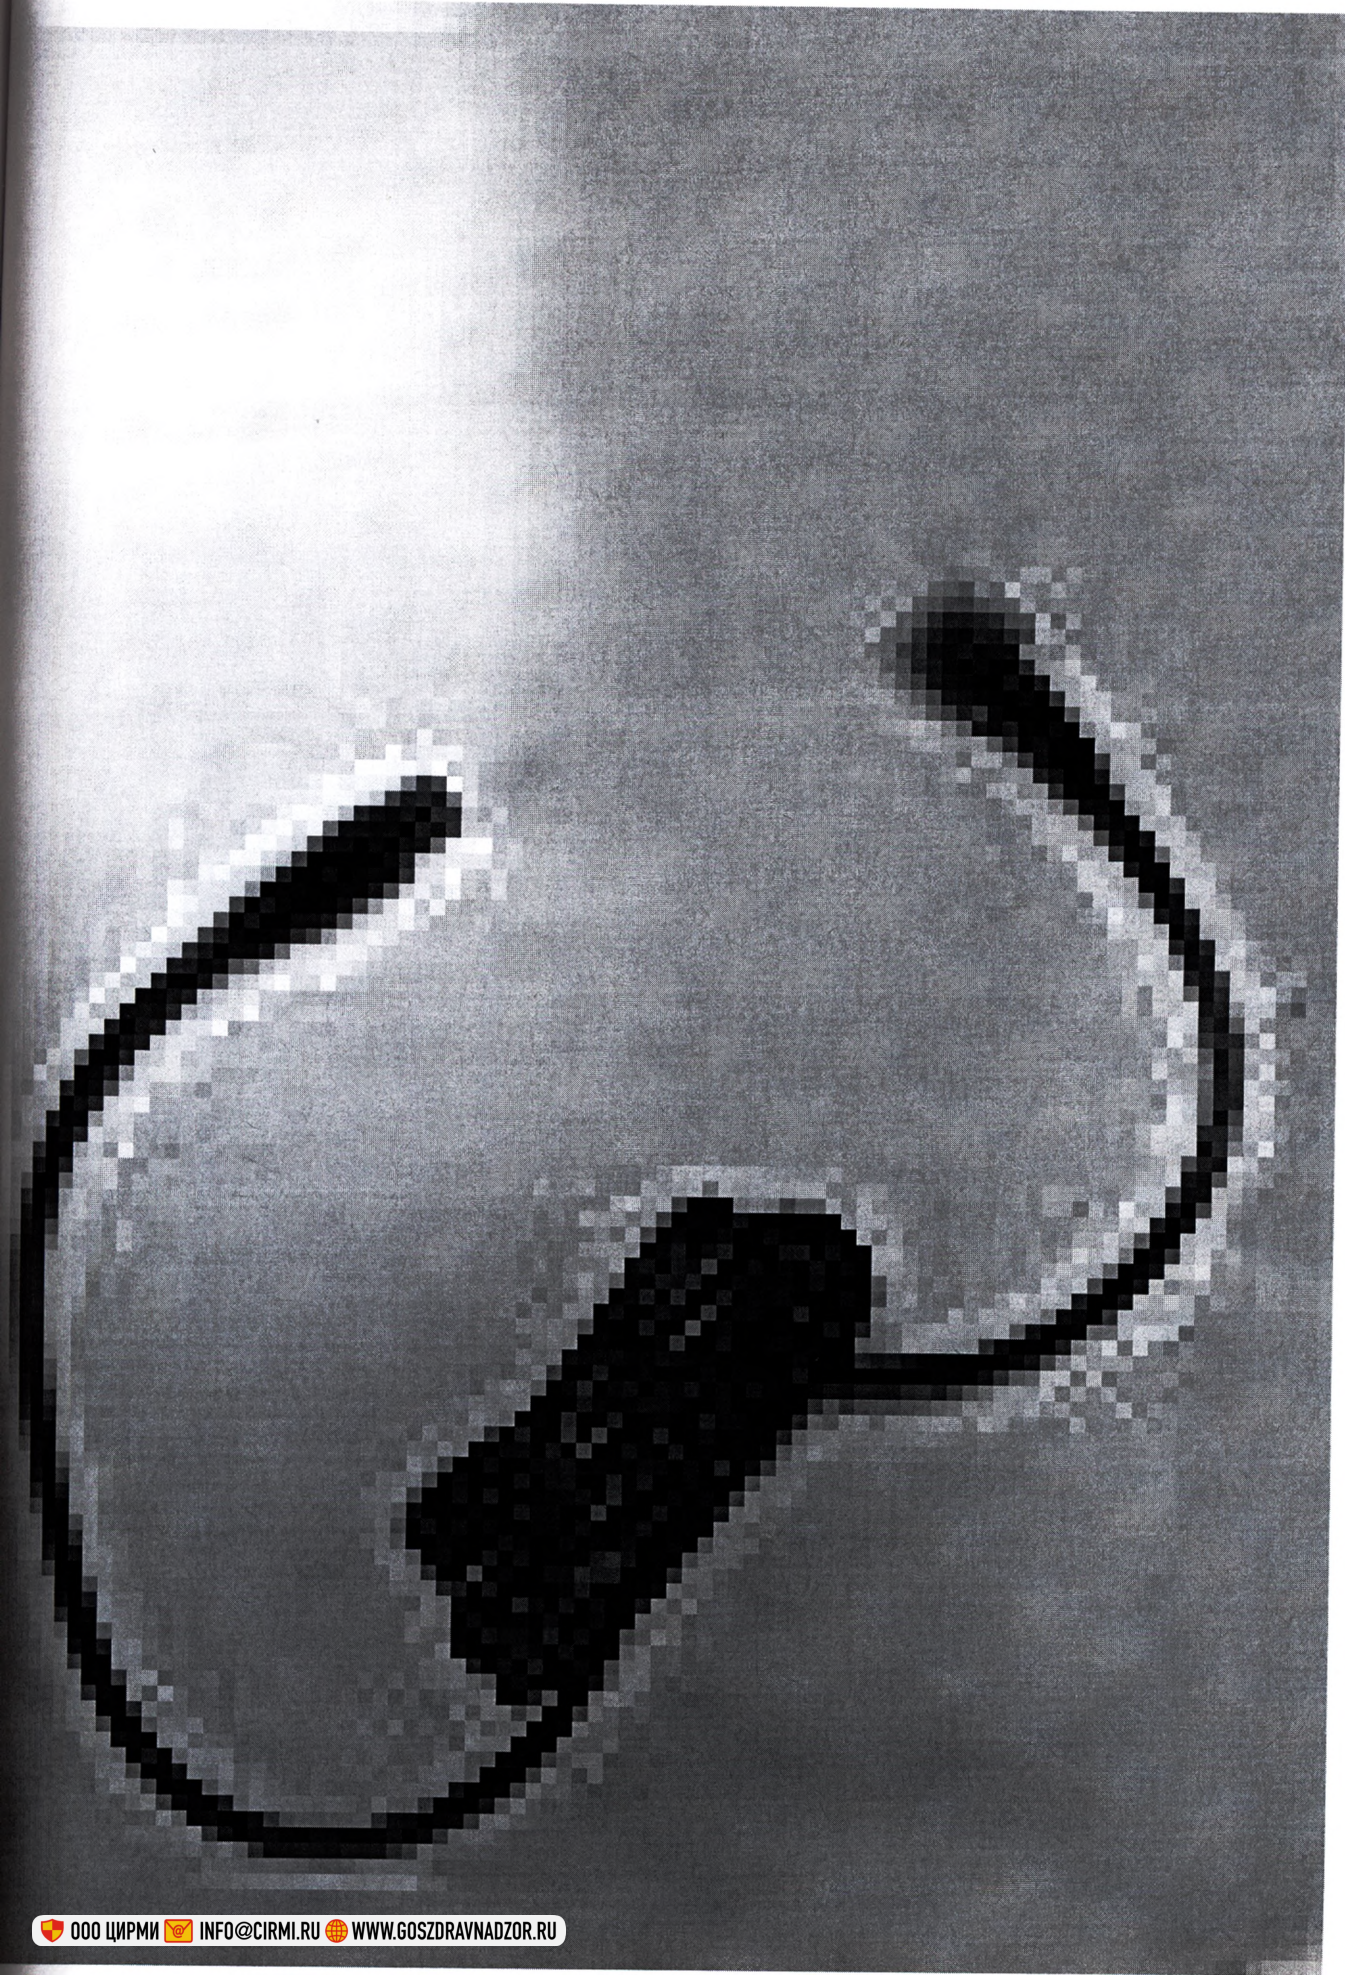








принадлежности: 39. Блок питания фотокомплекта – 1 шт.

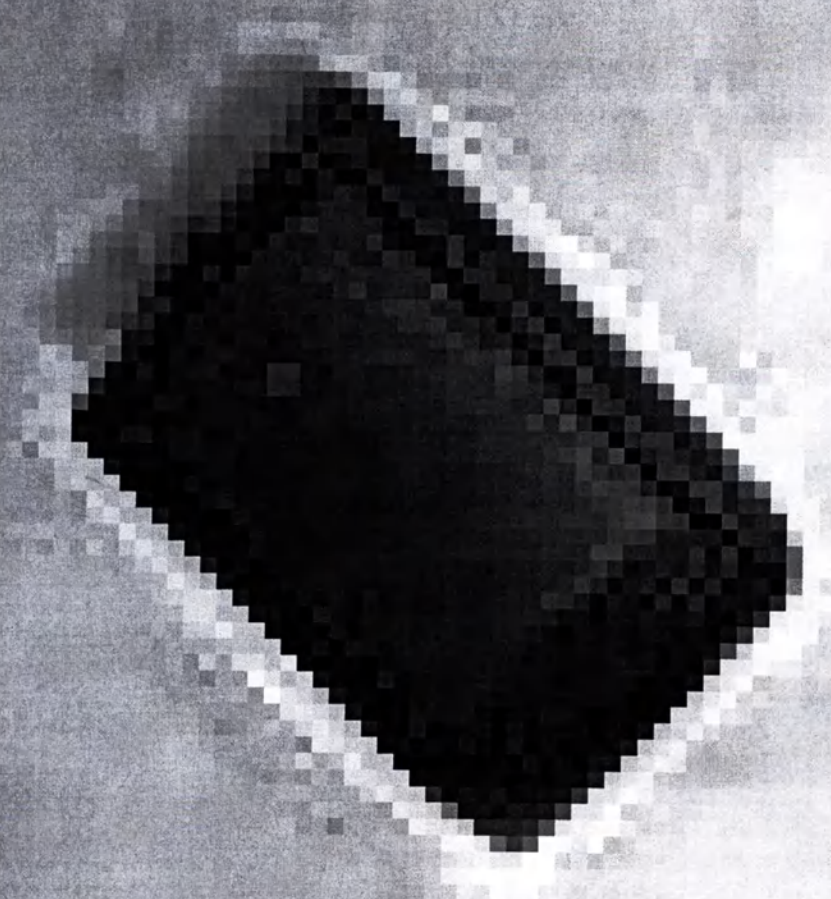




Блок питания видеосистемы – 1 шт.




41. Линза для осмотра сетчатки глаза – 1 шт.





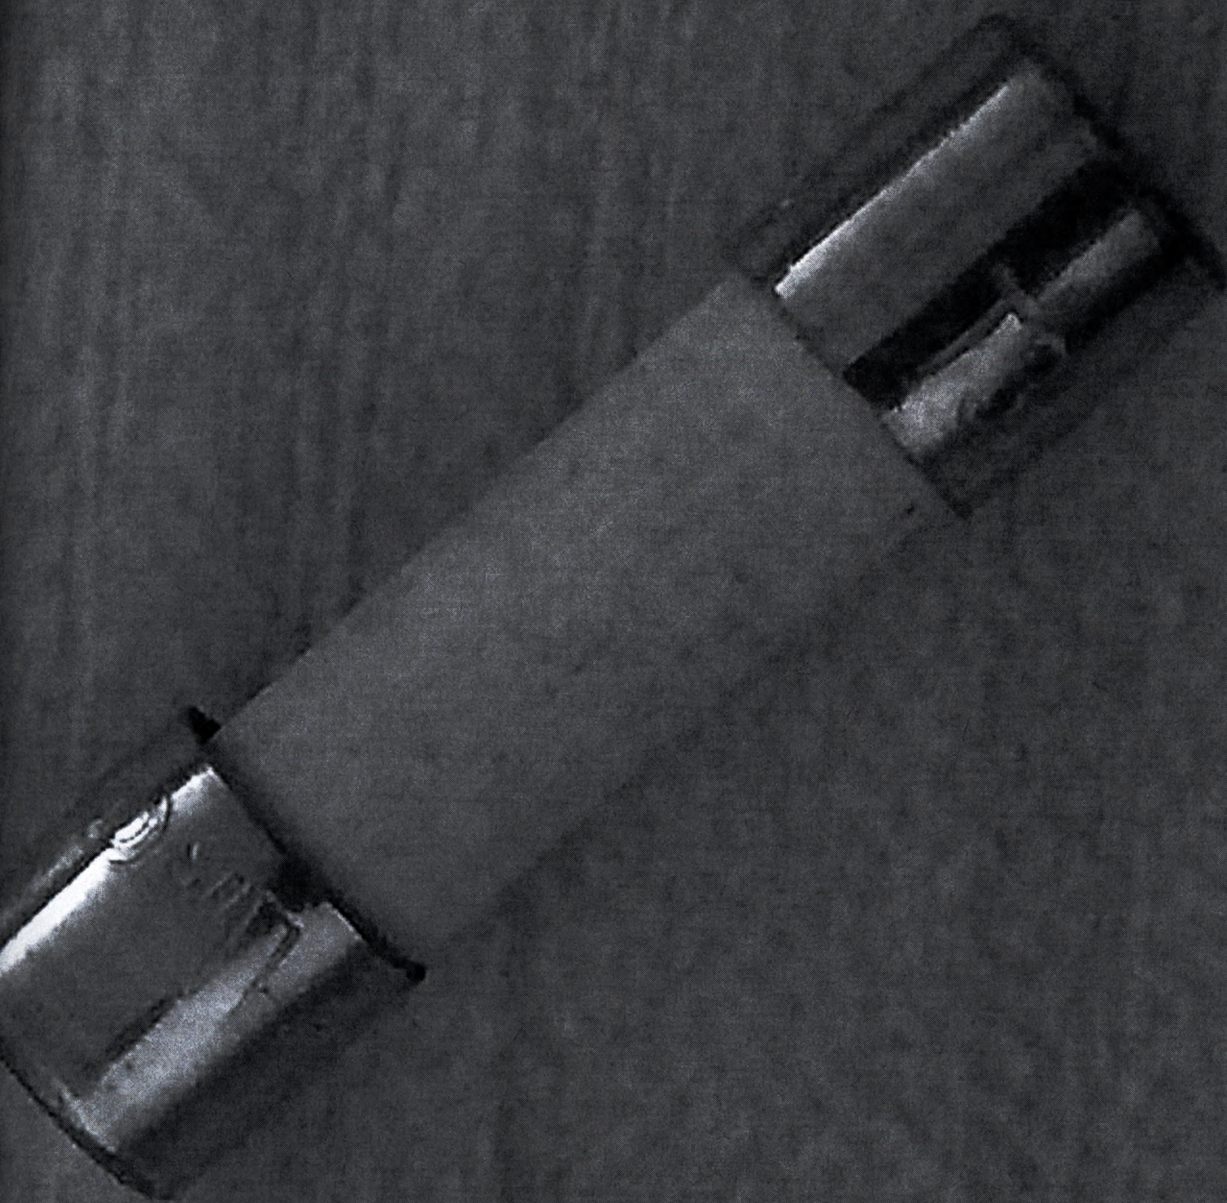



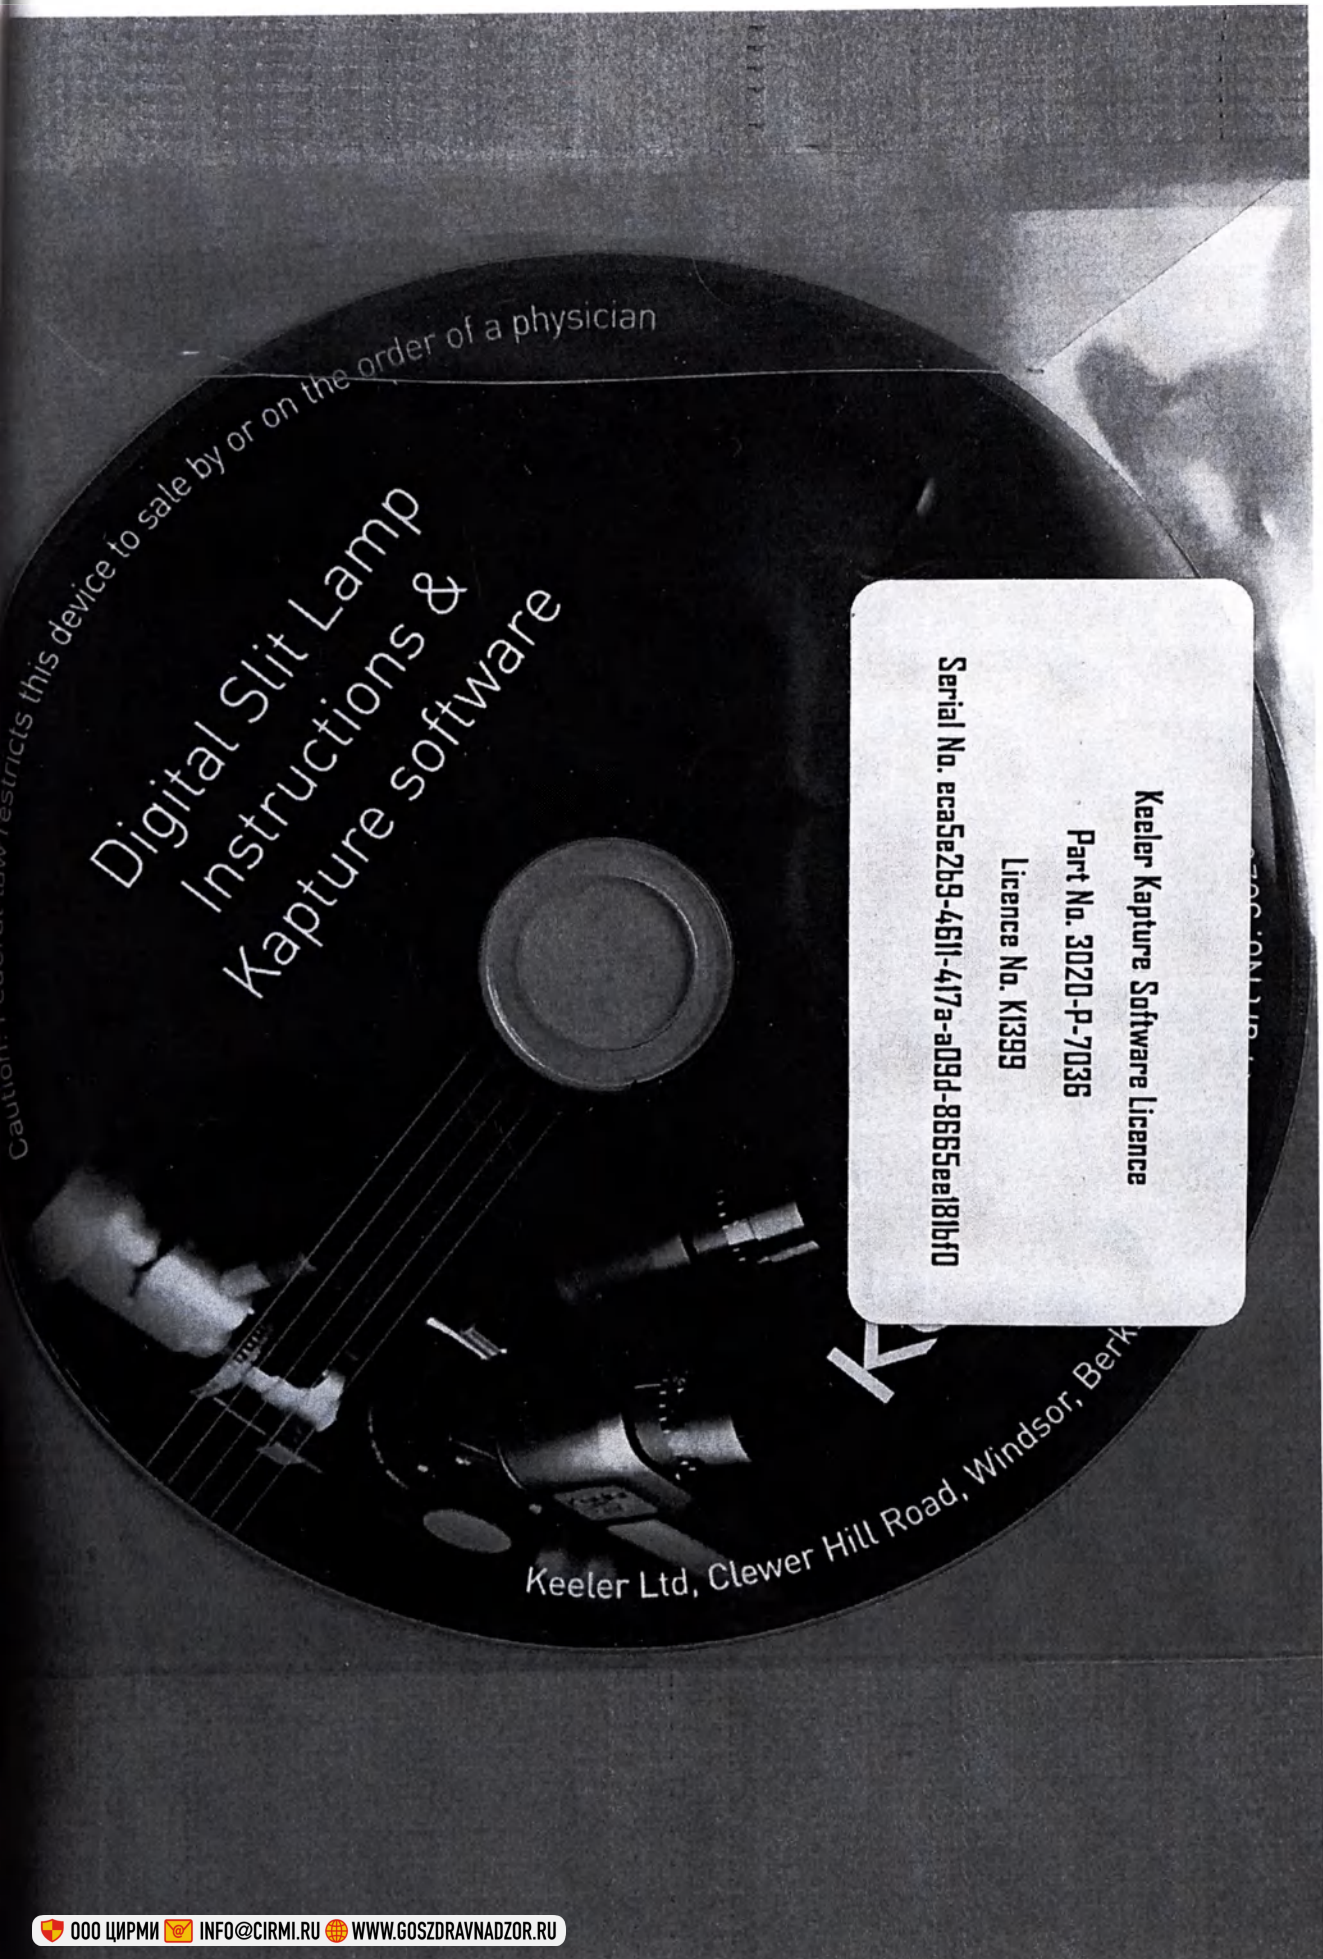

Caution: This device is for sale by or on the order of a physician

Digital Slit Lamp  
Instructions &  
Kapture software

Keeler Ltd, Clewer Hill Road, Windsor, Berkshire, UK

Keeler Kapture Software License  
Part No. 3020-P-7036  
License No. K1399  
Serial No. e5a5e2b9-4611-417a-a09d-8665eae181b10

27  
Tel: 01753 851591



принадлежности: 44. Комплект монтажных принадлежностей, в составе:

крепления пластины листовой – 10 шт.




принадлежности: 44. Комплект монтажных принадлежностей, в составе:  
крепления осветительной башни – 10 шт.






жности: 44. Комплект монтажных принадлежностей, в составе:  
крепления микроскопа – 10 шт.

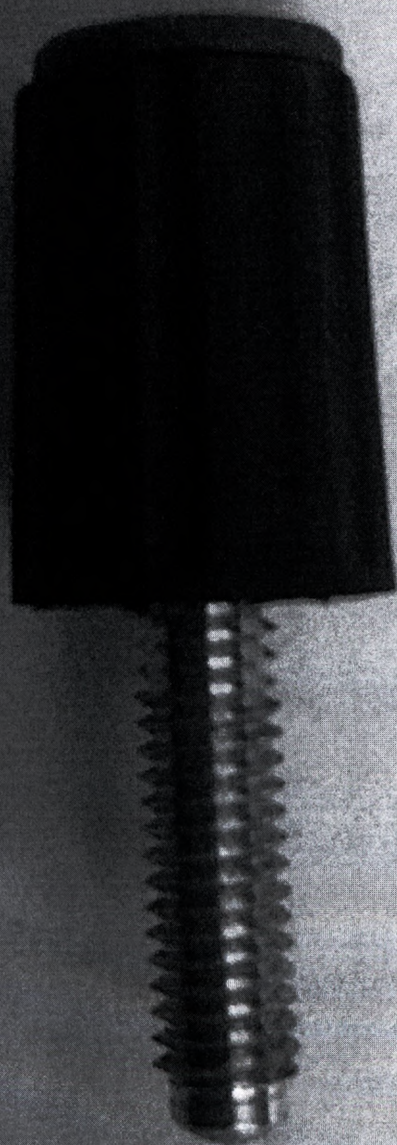




принадлежности: 44. Комплект монтажных принадлежностей, в составе:

M3x5 – 10 шт.

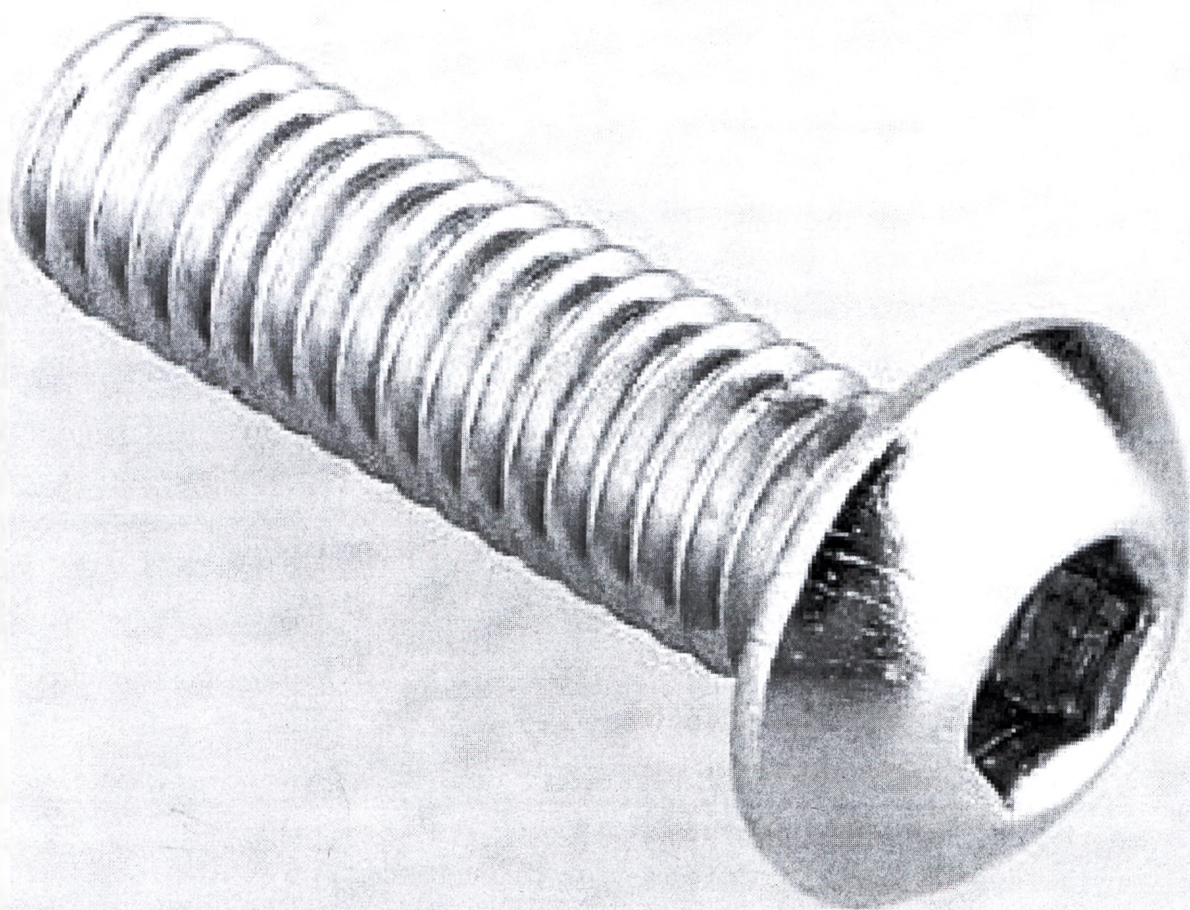



Принадлежности: 44. Комплект монтажных принадлежностей, в составе:  
М2.5 – 10 шт.

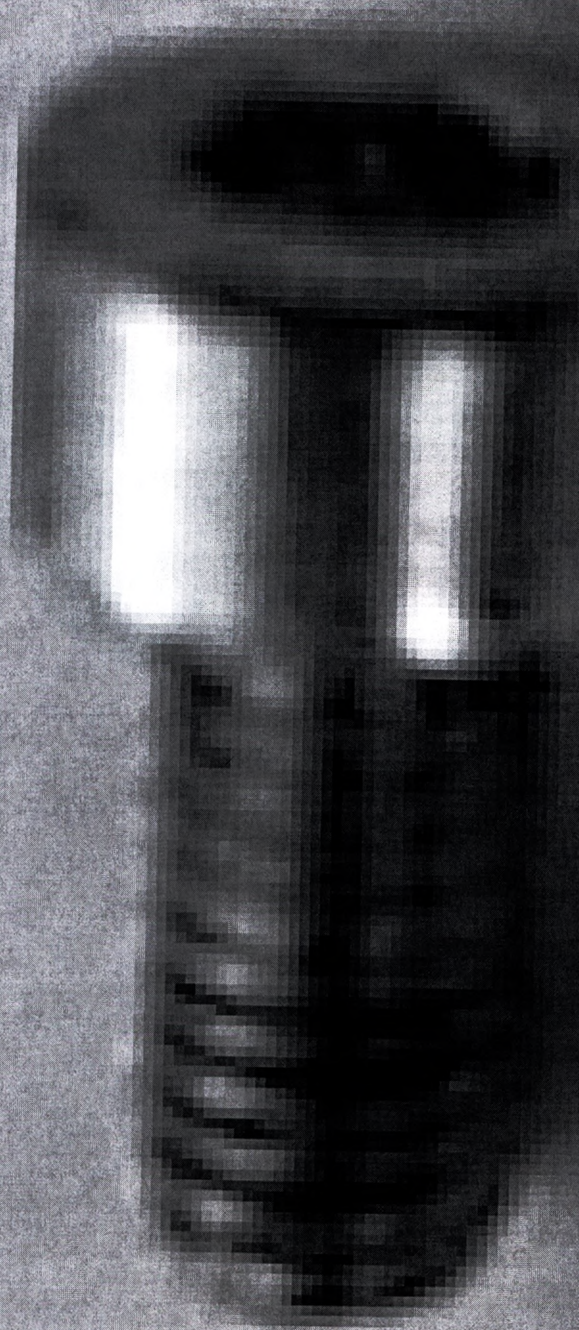



Принадлежности: 44. Комплект монтажных принадлежностей, в составе:

М6 – 10 шт.





принадлежности: 44. Комплект монтажных принадлежностей, в составе:  
М3х18 – 10 шт.











жности: 44. Комплект монтажных принадлежностей, в составе:

3/8 – 10 шт.

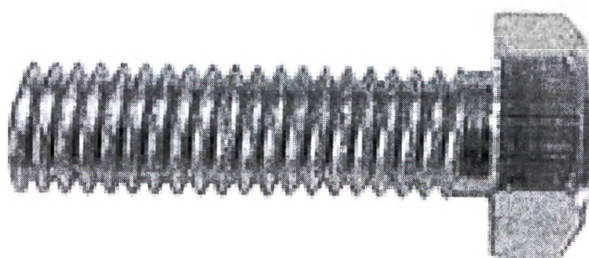




жности: 44. Комплект монтажных принадлежностей, в составе:  
специализированная – 5 шт.

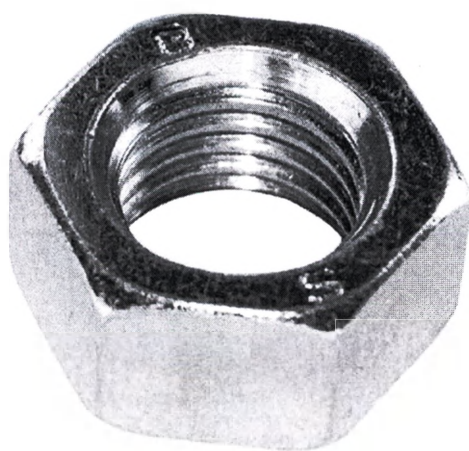



принадлежности: 44. Комплект монтажных принадлежностей, в составе:  
специализированный – 1 шт.

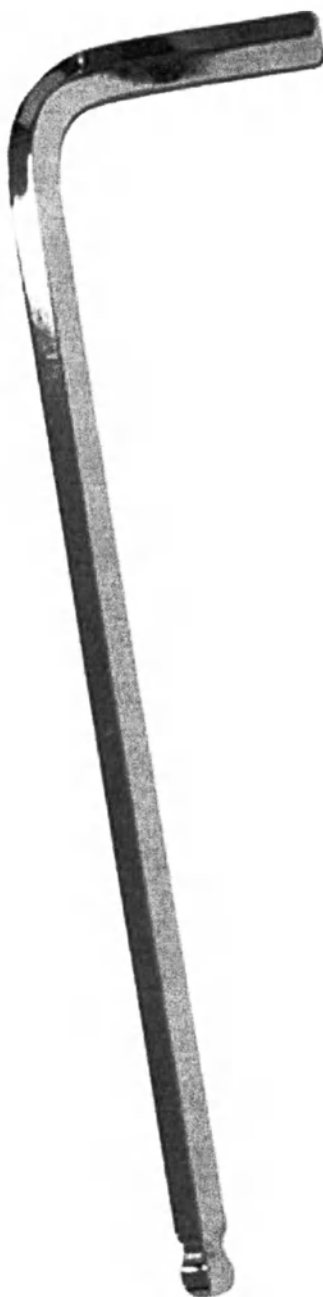



В документе пронумеровано

пронумеровано и скреплено печатью

