


УТВЕРЖДАЮ

Президент
ЗАО «Имплант МТ»


Скворцова С.В.


« 08 » 20 17 г





**Фотографические изображения общего вида, маркировки и
упаковки медицинского изделия**


**Набор инструментов для установки эндосистемы модульной тотальной
бедренной кости по ТУ 32.50.13-018-49346483-2017**


2017

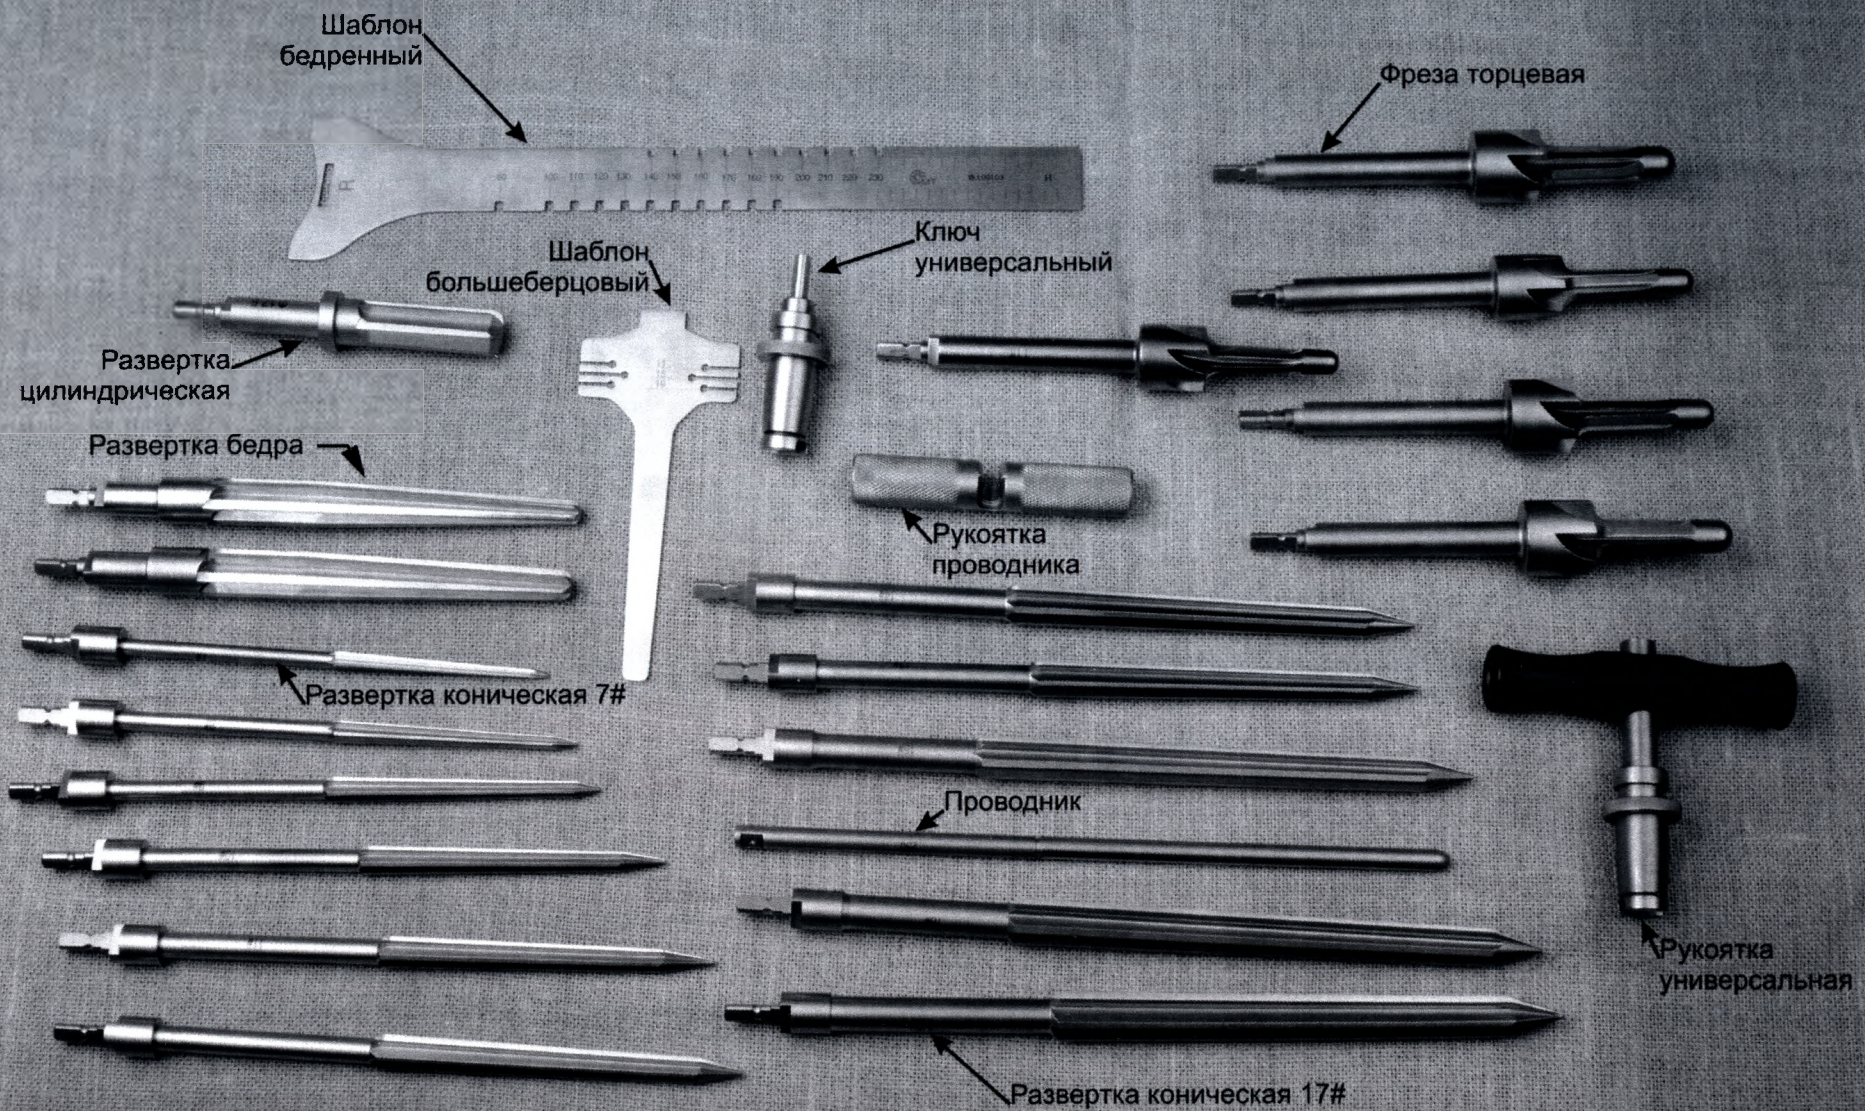

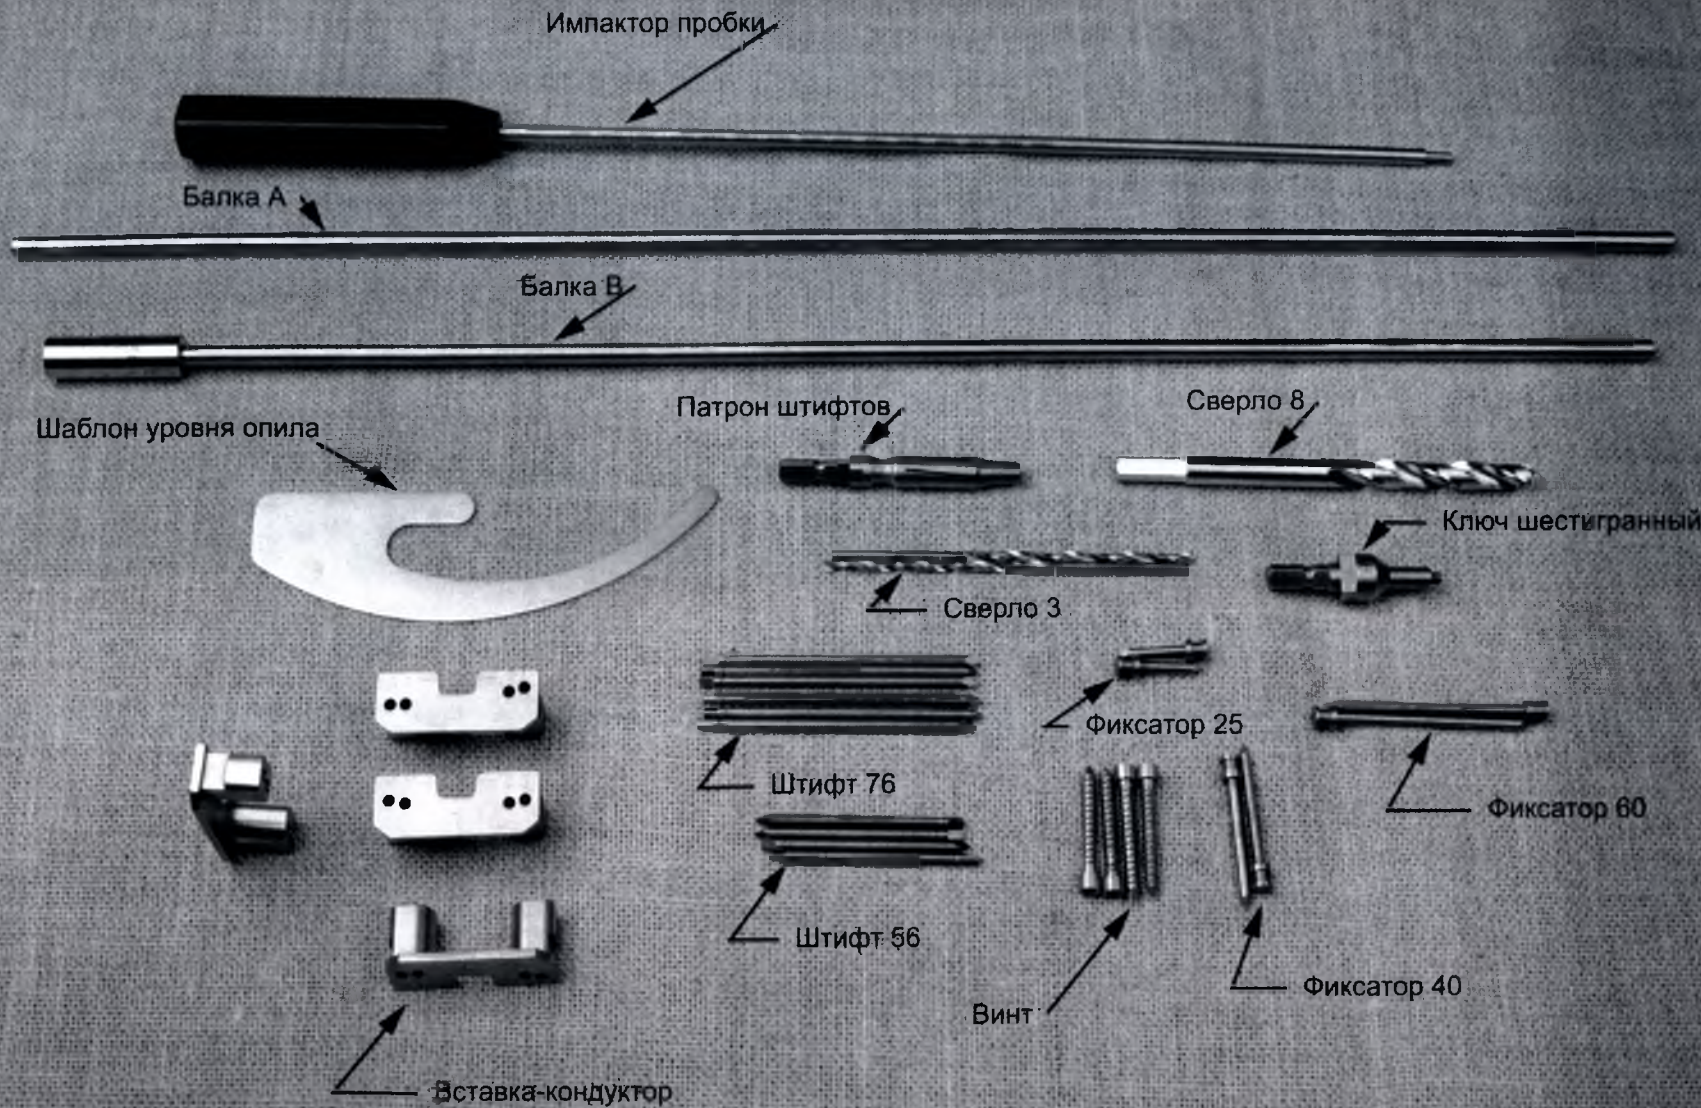

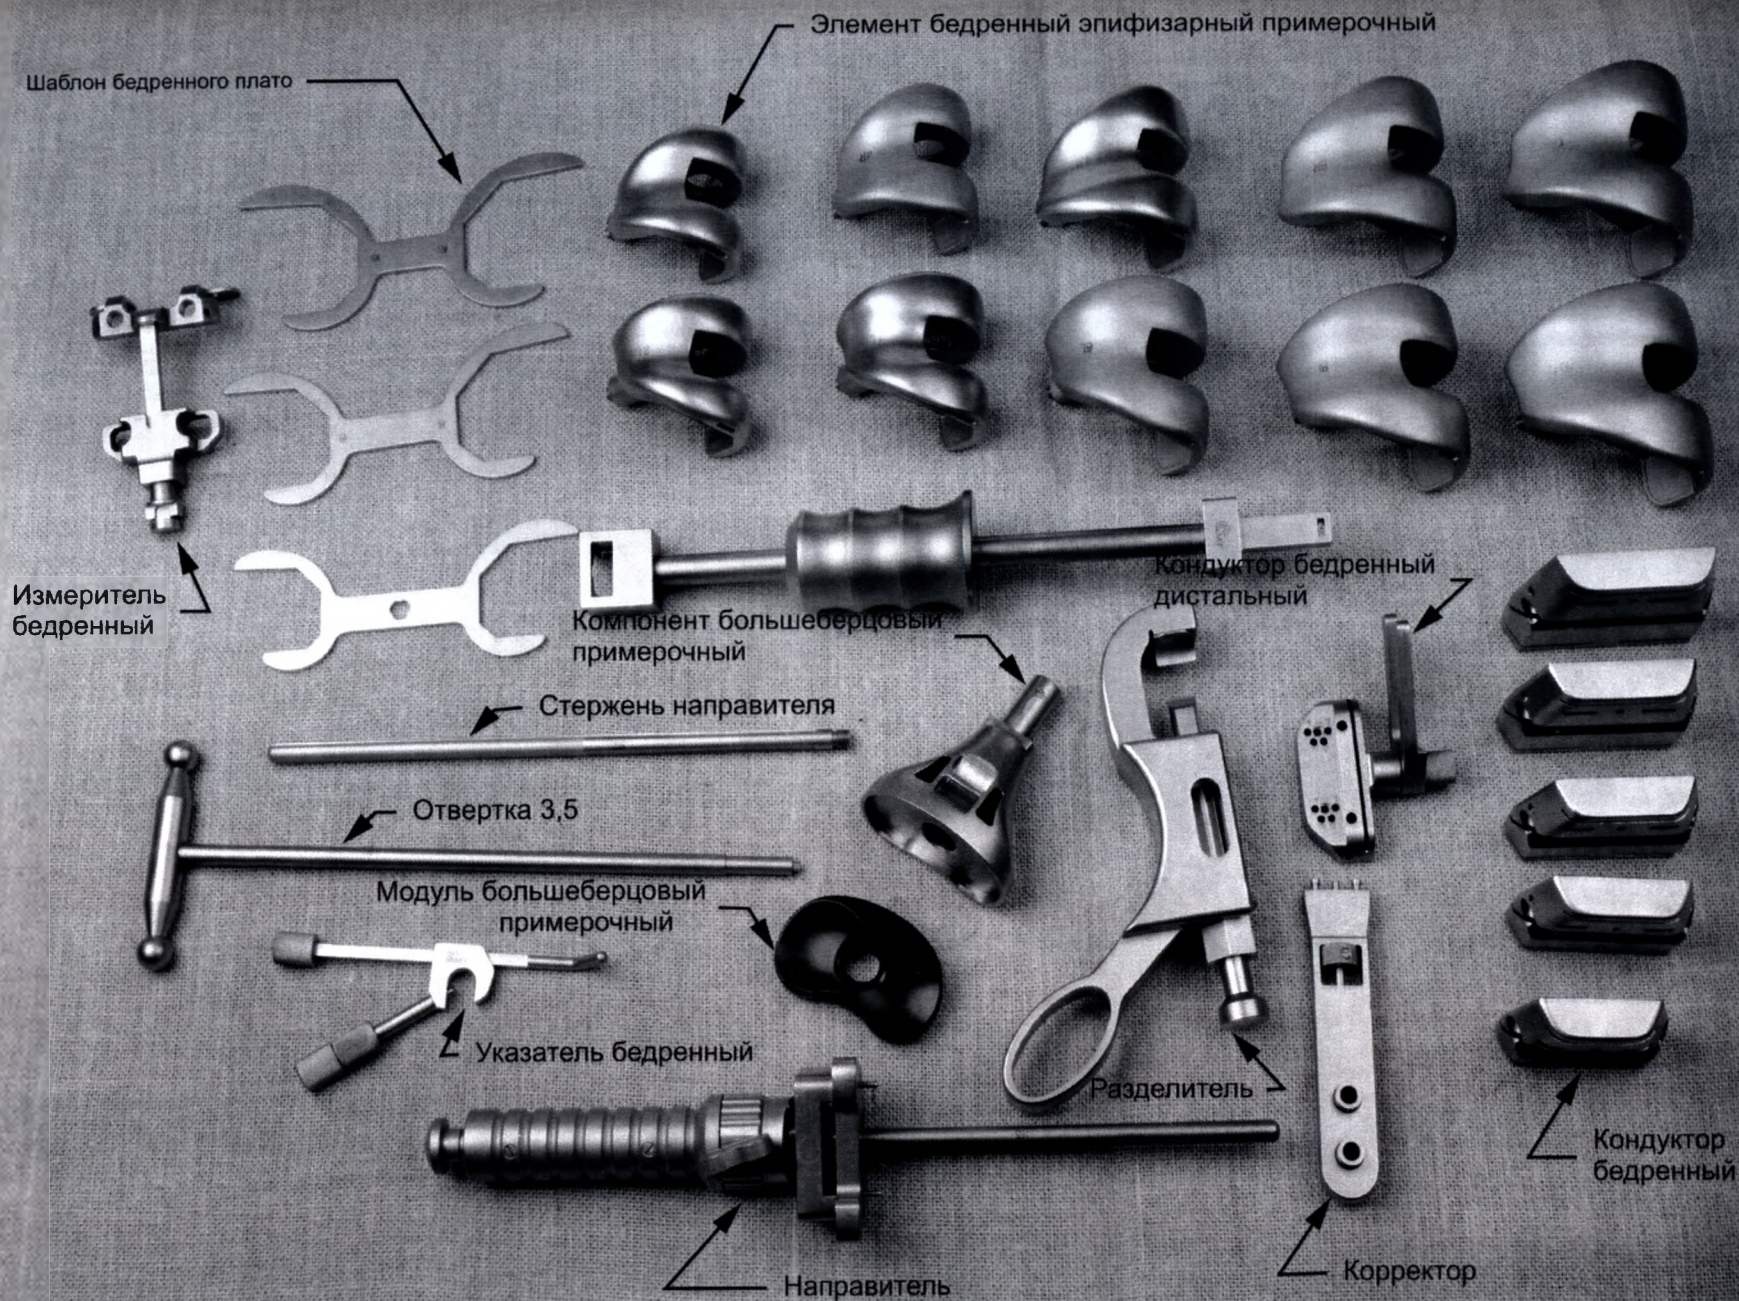

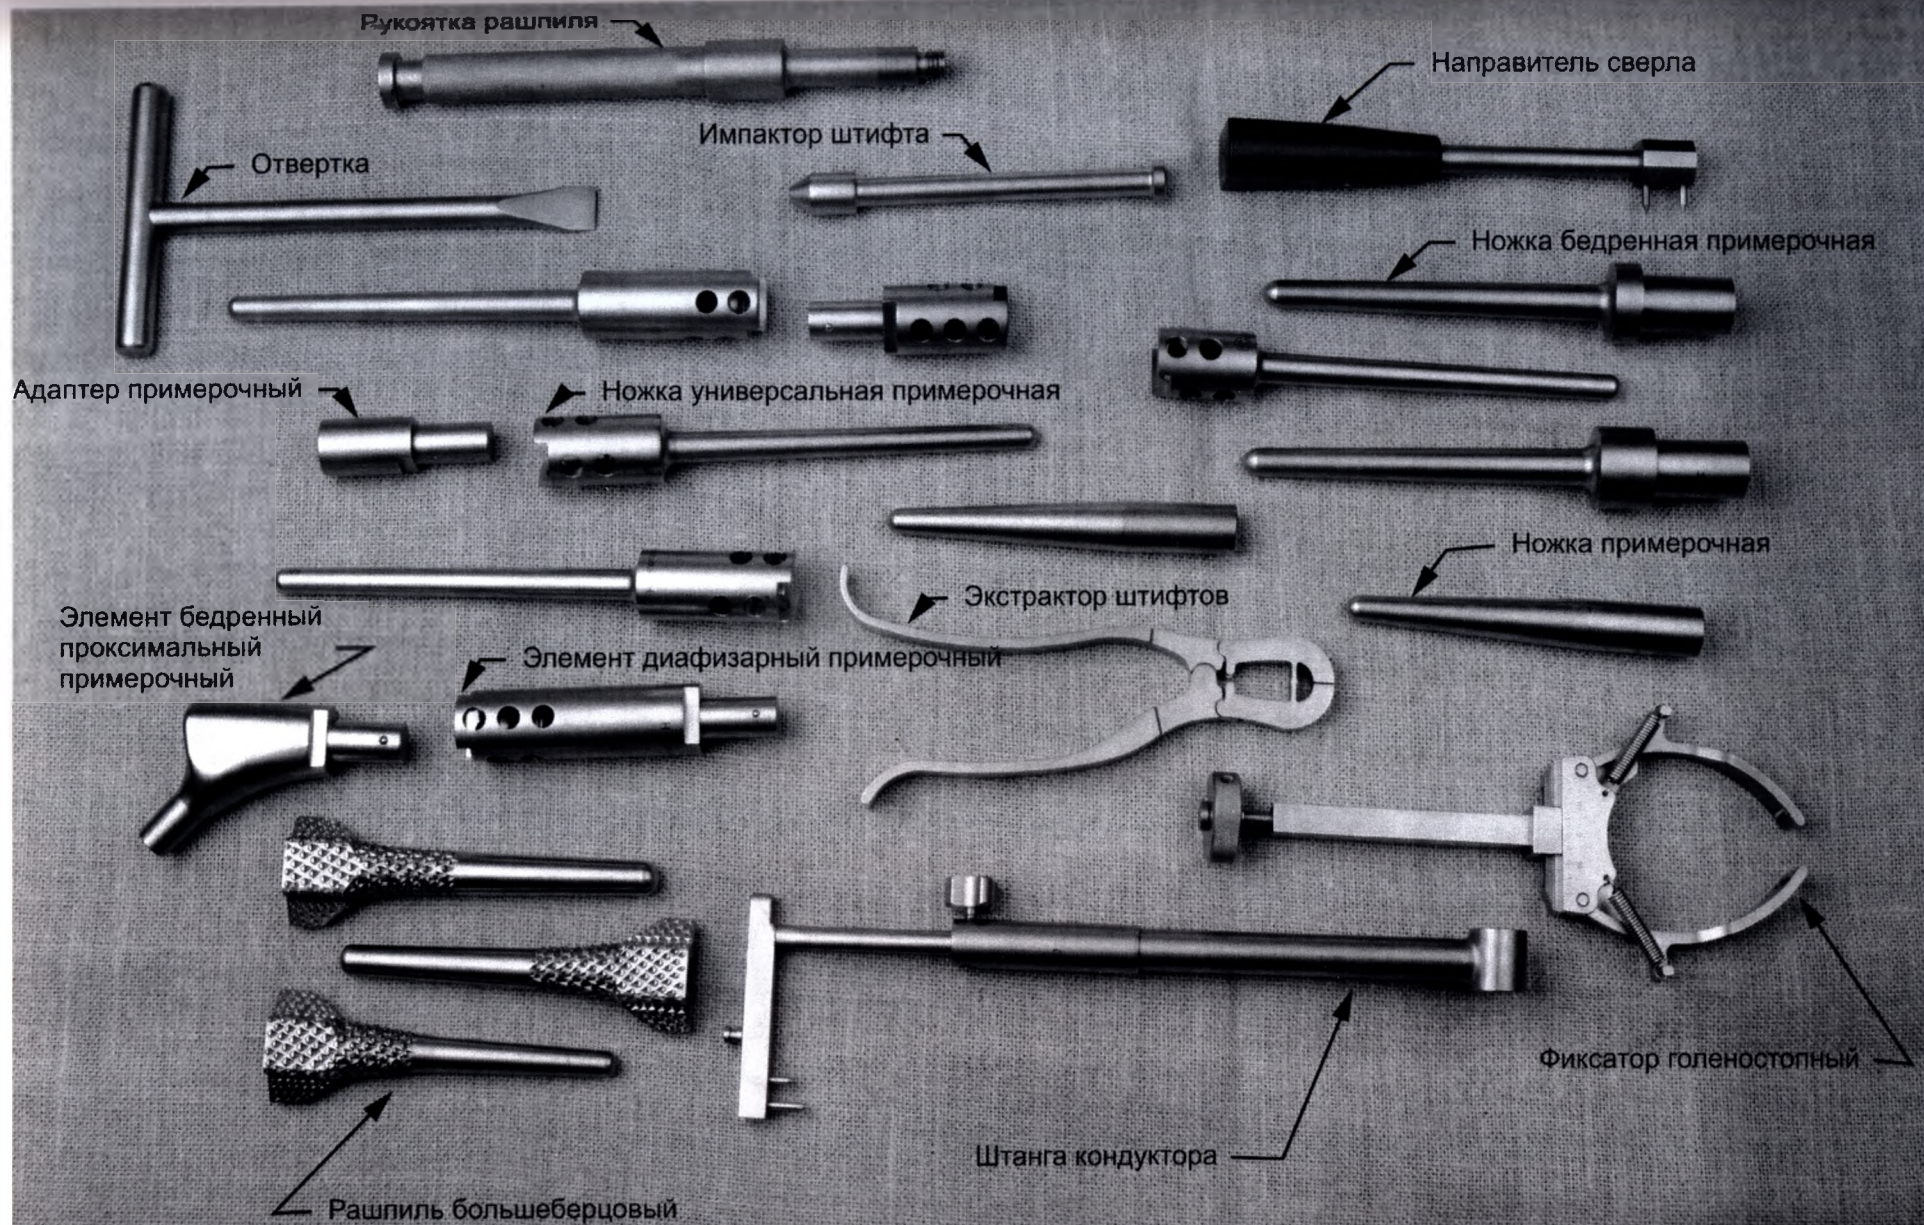

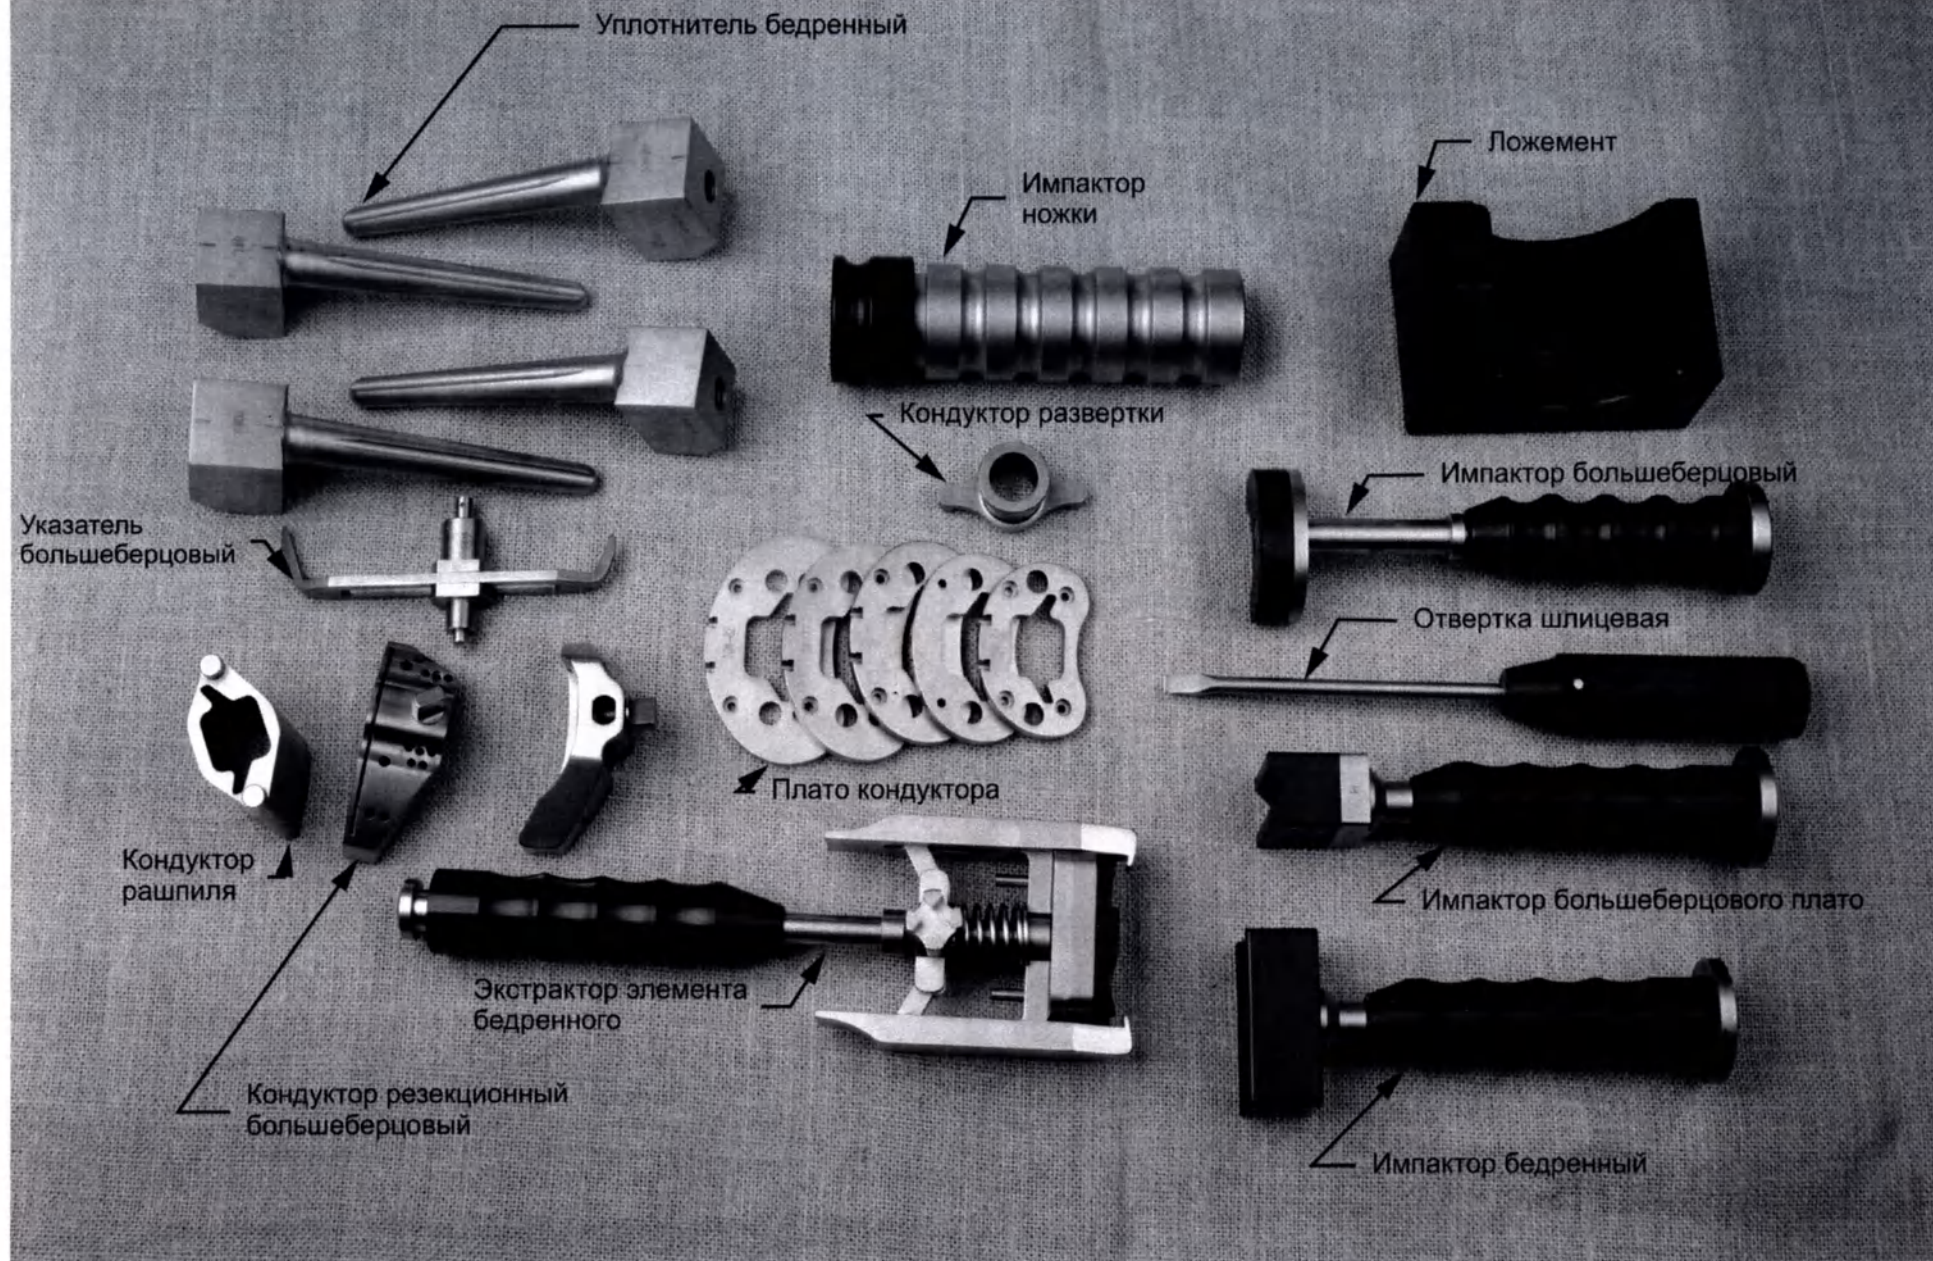

Группа компаний "АМТ"
Тел. +7(495)7-403-403
www.amtplants.ru



Кондуктор безректный дистальный

Количество: 1
Материал: Нержавеющая сталь (AISI 316L)
Материал: Нержавеющая сталь (AISI 316L)

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

Вставка кондуктор

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ


ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ

ИДТ



Набор инструментов для установки эндопротеза
модульной тотальной бедренной кости



VM15

Типоразмер -

Количество: 1

REF

18.02.000


Материал: Нержавеющая сталь (Н)
титановый сплав BT6
Капролон В

LOT

18.00.000.02



ЗАО "Имплант МТ"
121552, Россия
Москва ул. Гривенская 1
www.ImplantMT.ru



21.12.2016



Президент
ЗАО «Имплант МТ»

С.В. Скворцова

С.В. Скворцова

