


Директор


ООО «Медика Продакт»

Михалева Е.М.


2017 г.

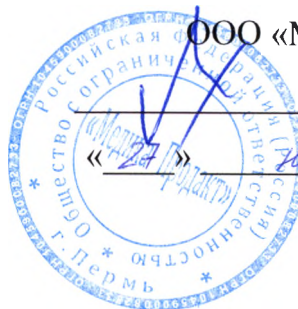


Фотографические изображения медицинского изделия
**«Анализатор измерения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) VES-MATIC
CUBE 80 (ВЕС-МАТИК КУБ 80), с принадлежностями»**
производства «ДИЕССЕ Диагностика Сенезе С.п.А.», Италия
(«DIESSE Diagnostica Senese S.p.A.», Via Solari, 19, 20144 Milano, Italy; Тел.: +39 02
48 59 121.
Факс: +39 02 48 00 85 30, E-mail: salesoffice@diesse.it).

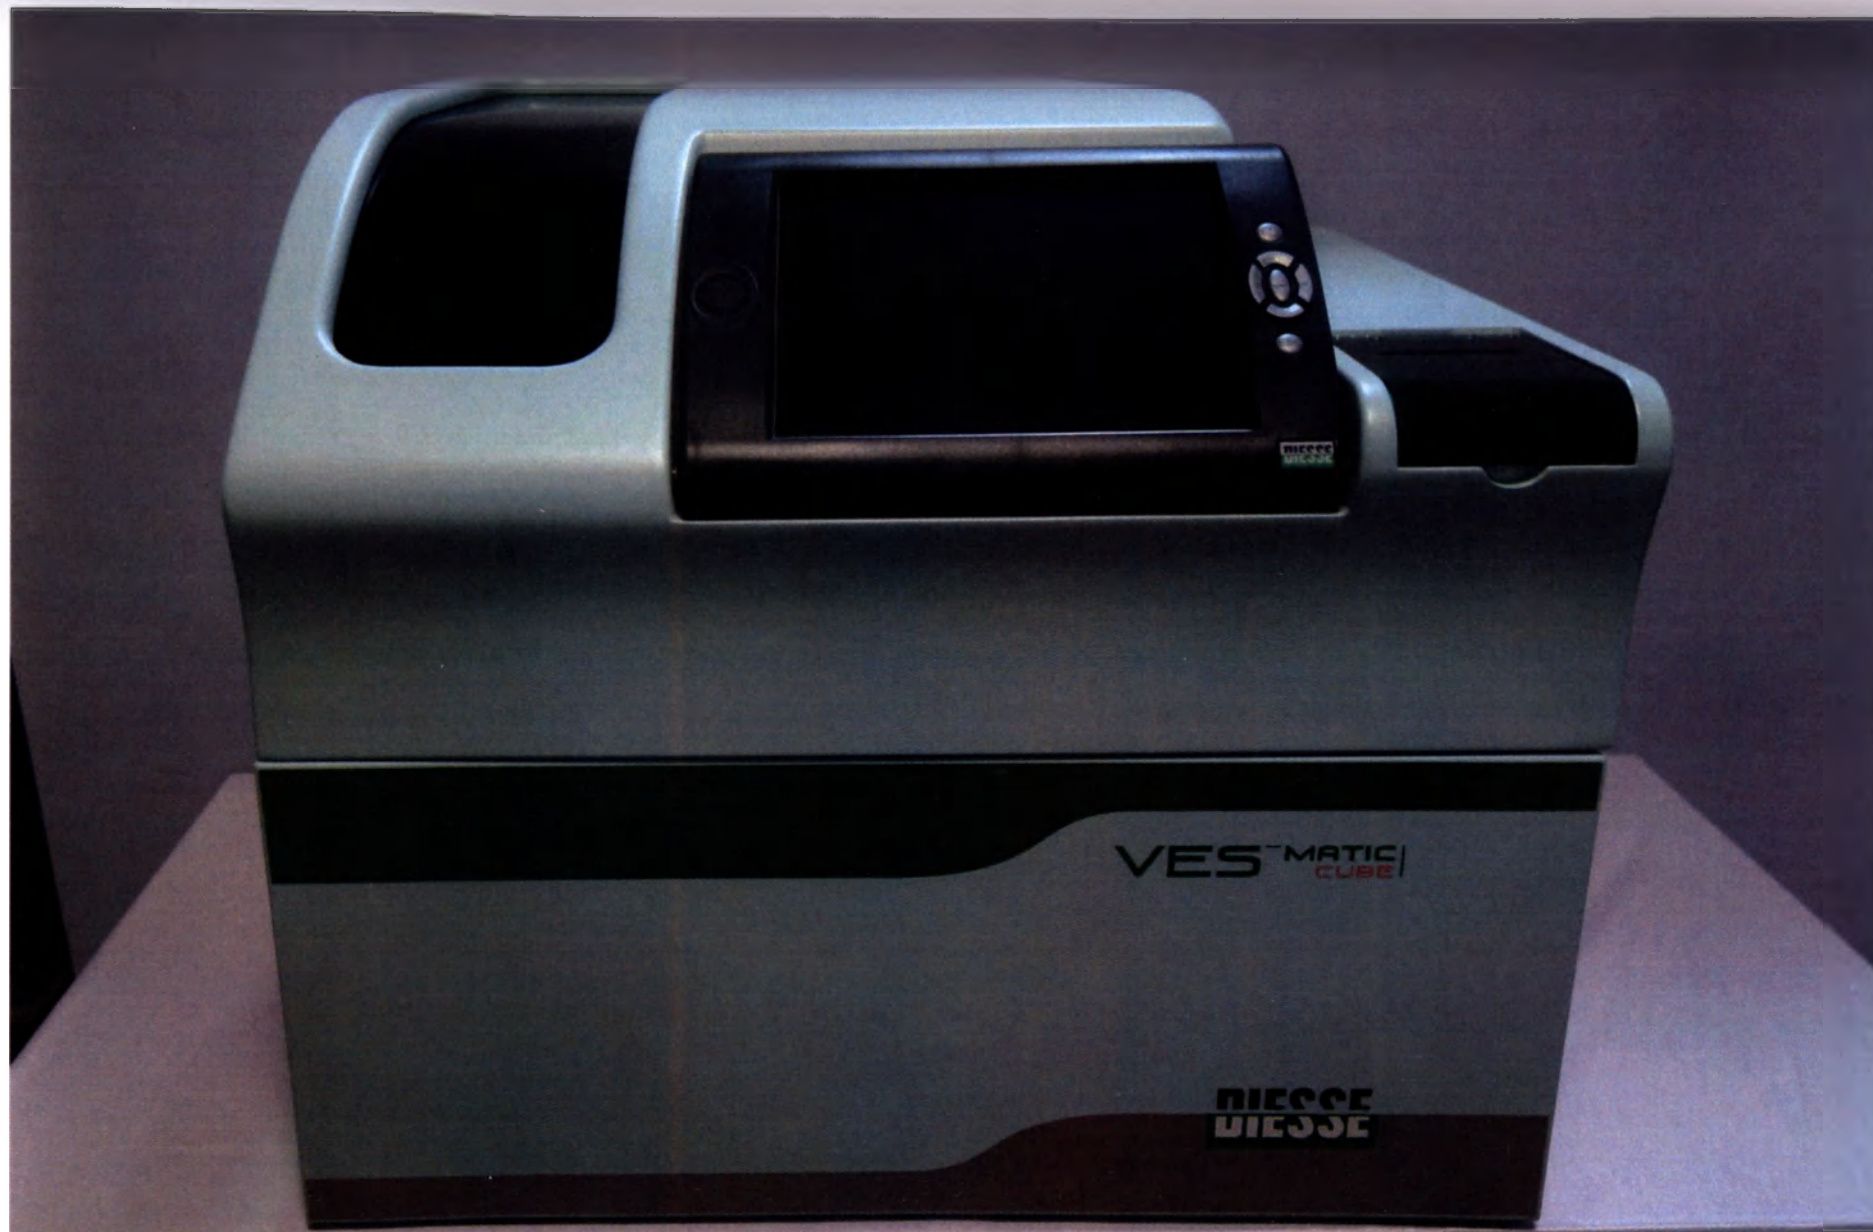


Анализатор измерения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) VES-MATIC CUBE 80 (БЕС-МАТИК КУБ 80)

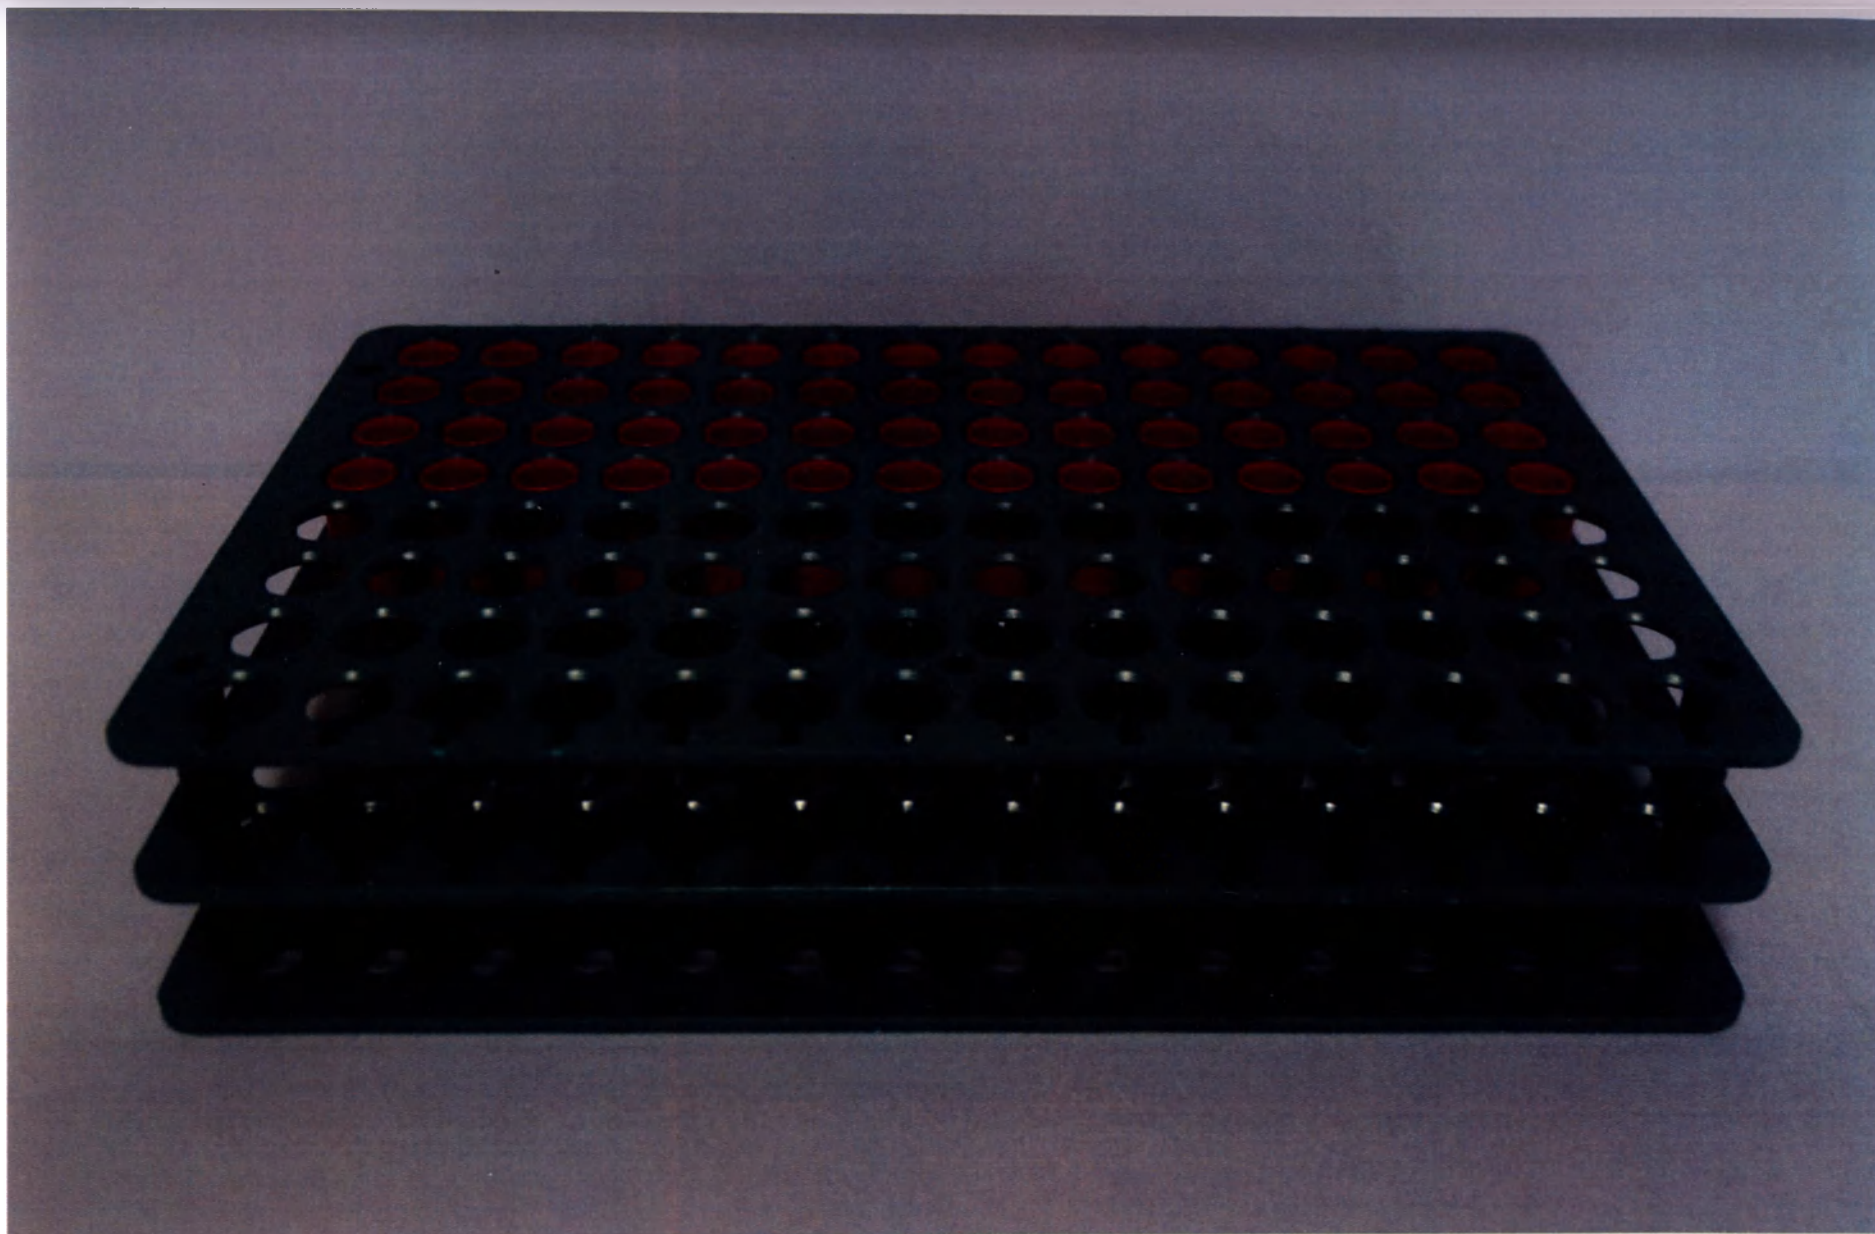

планшет для проб

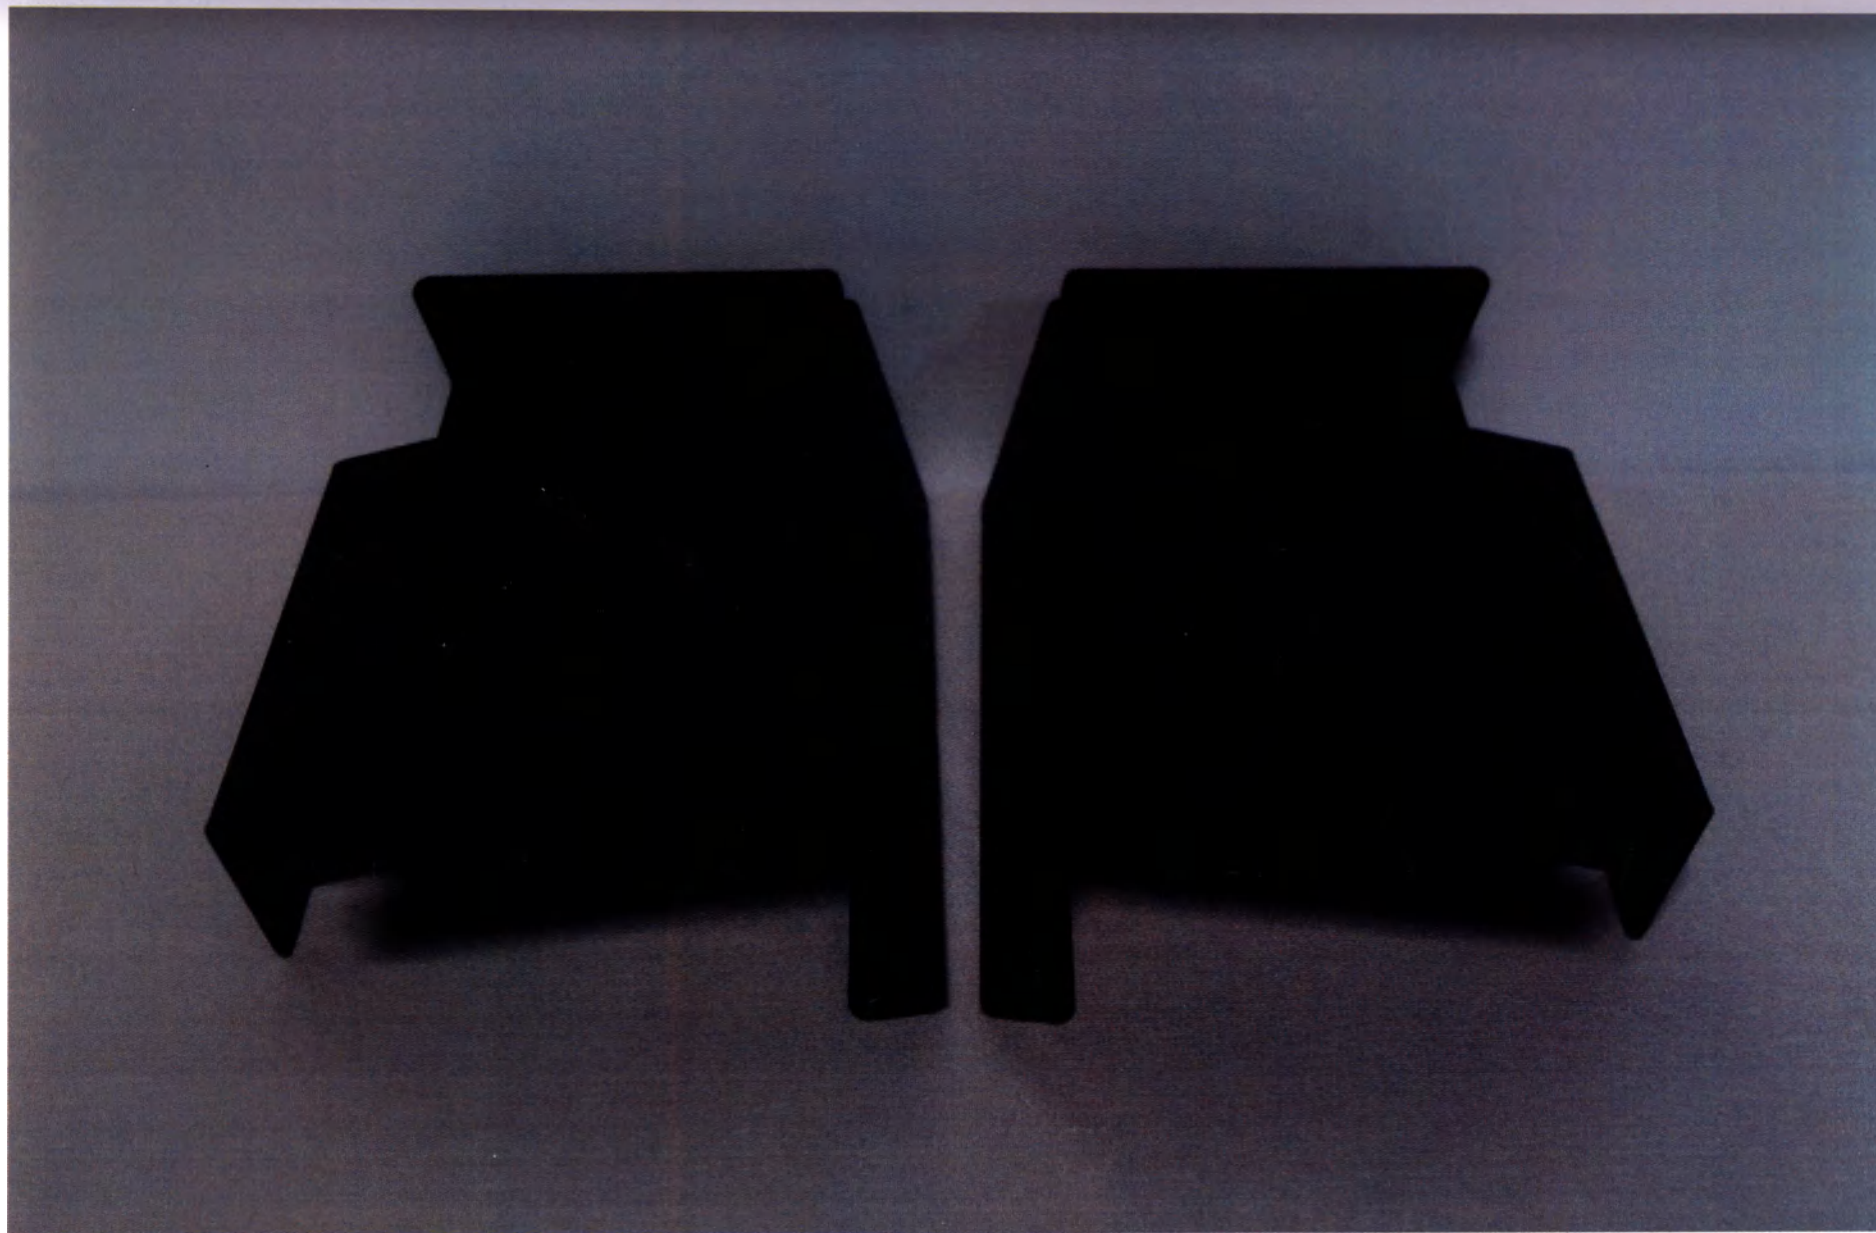


подставки для установки планшета

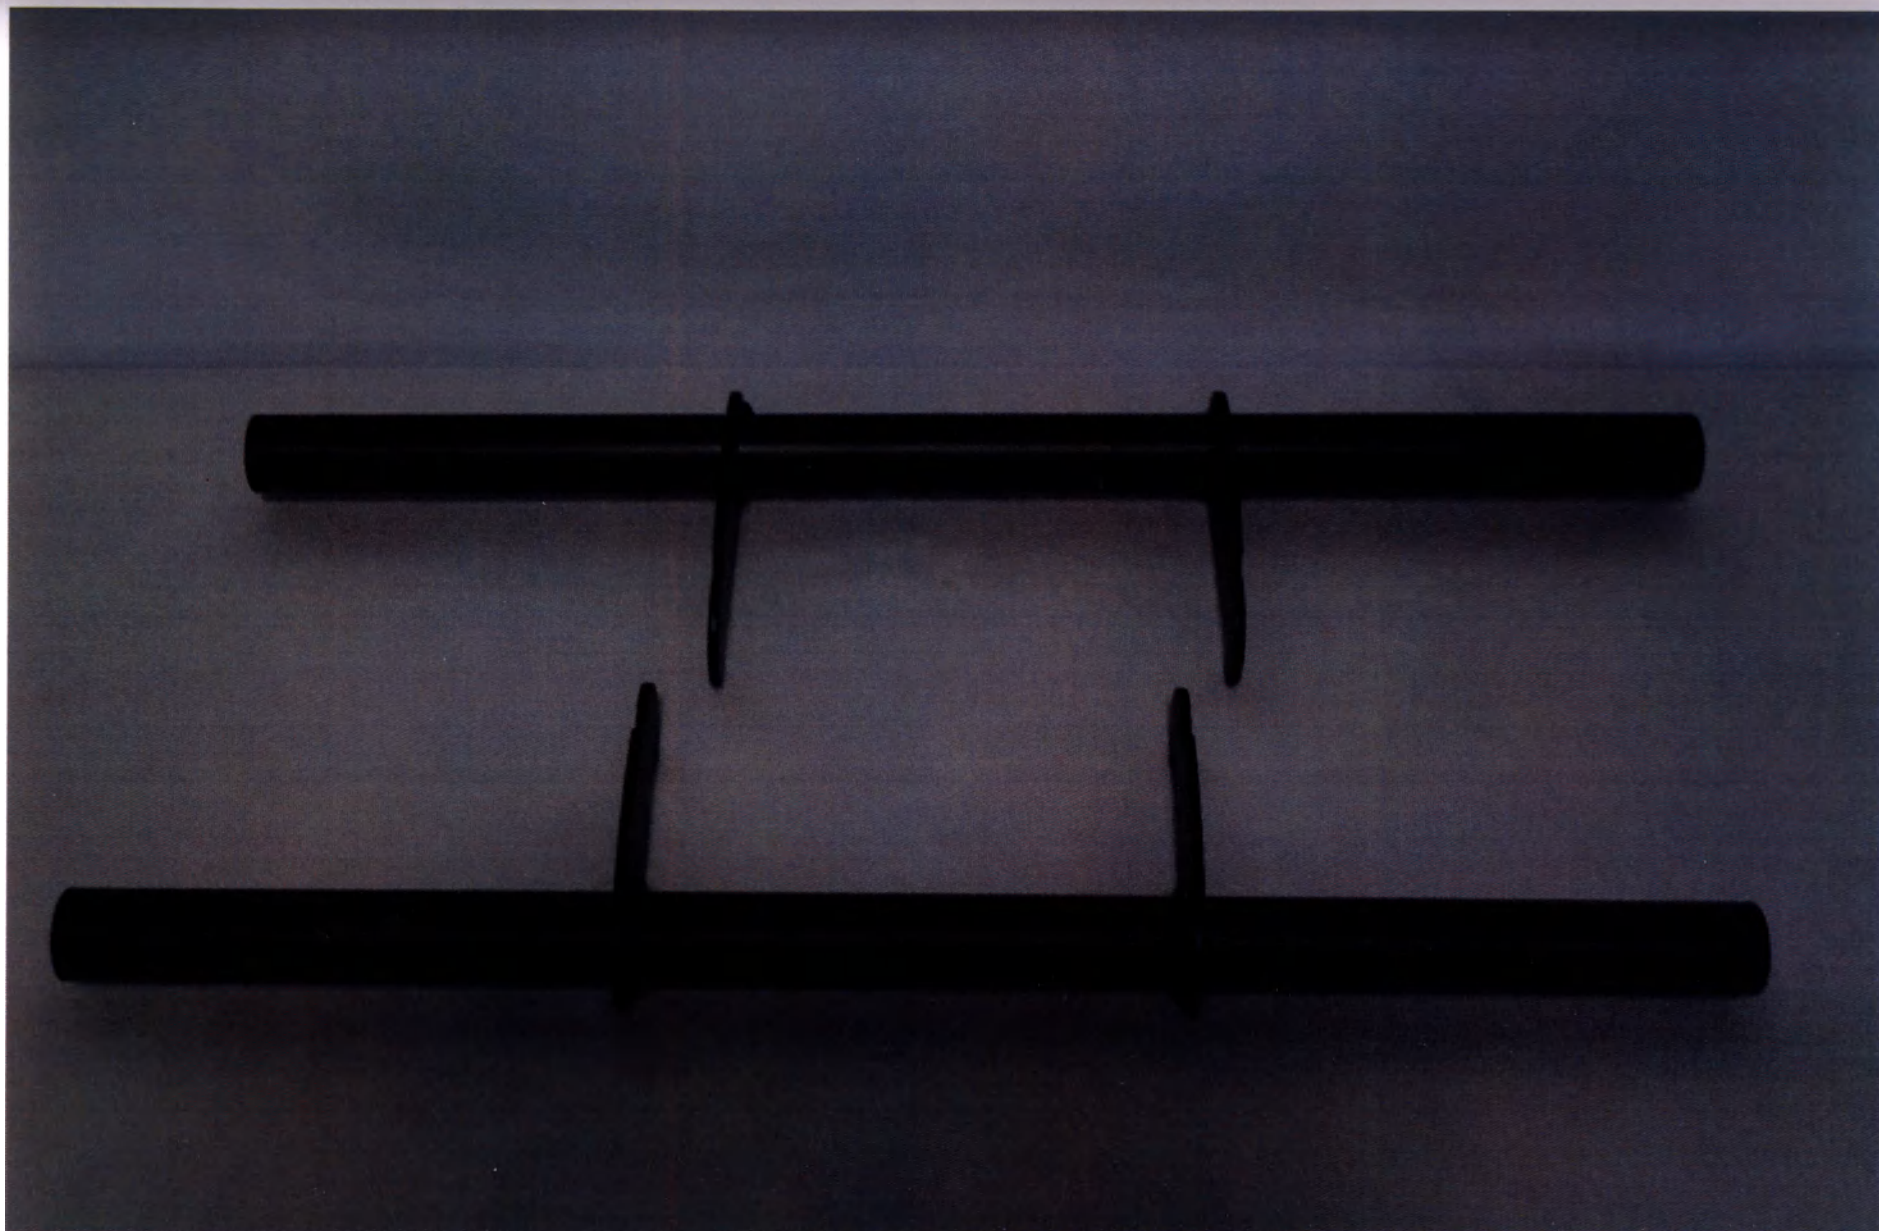


ручки для подъема прибора




ключ микропереключателя

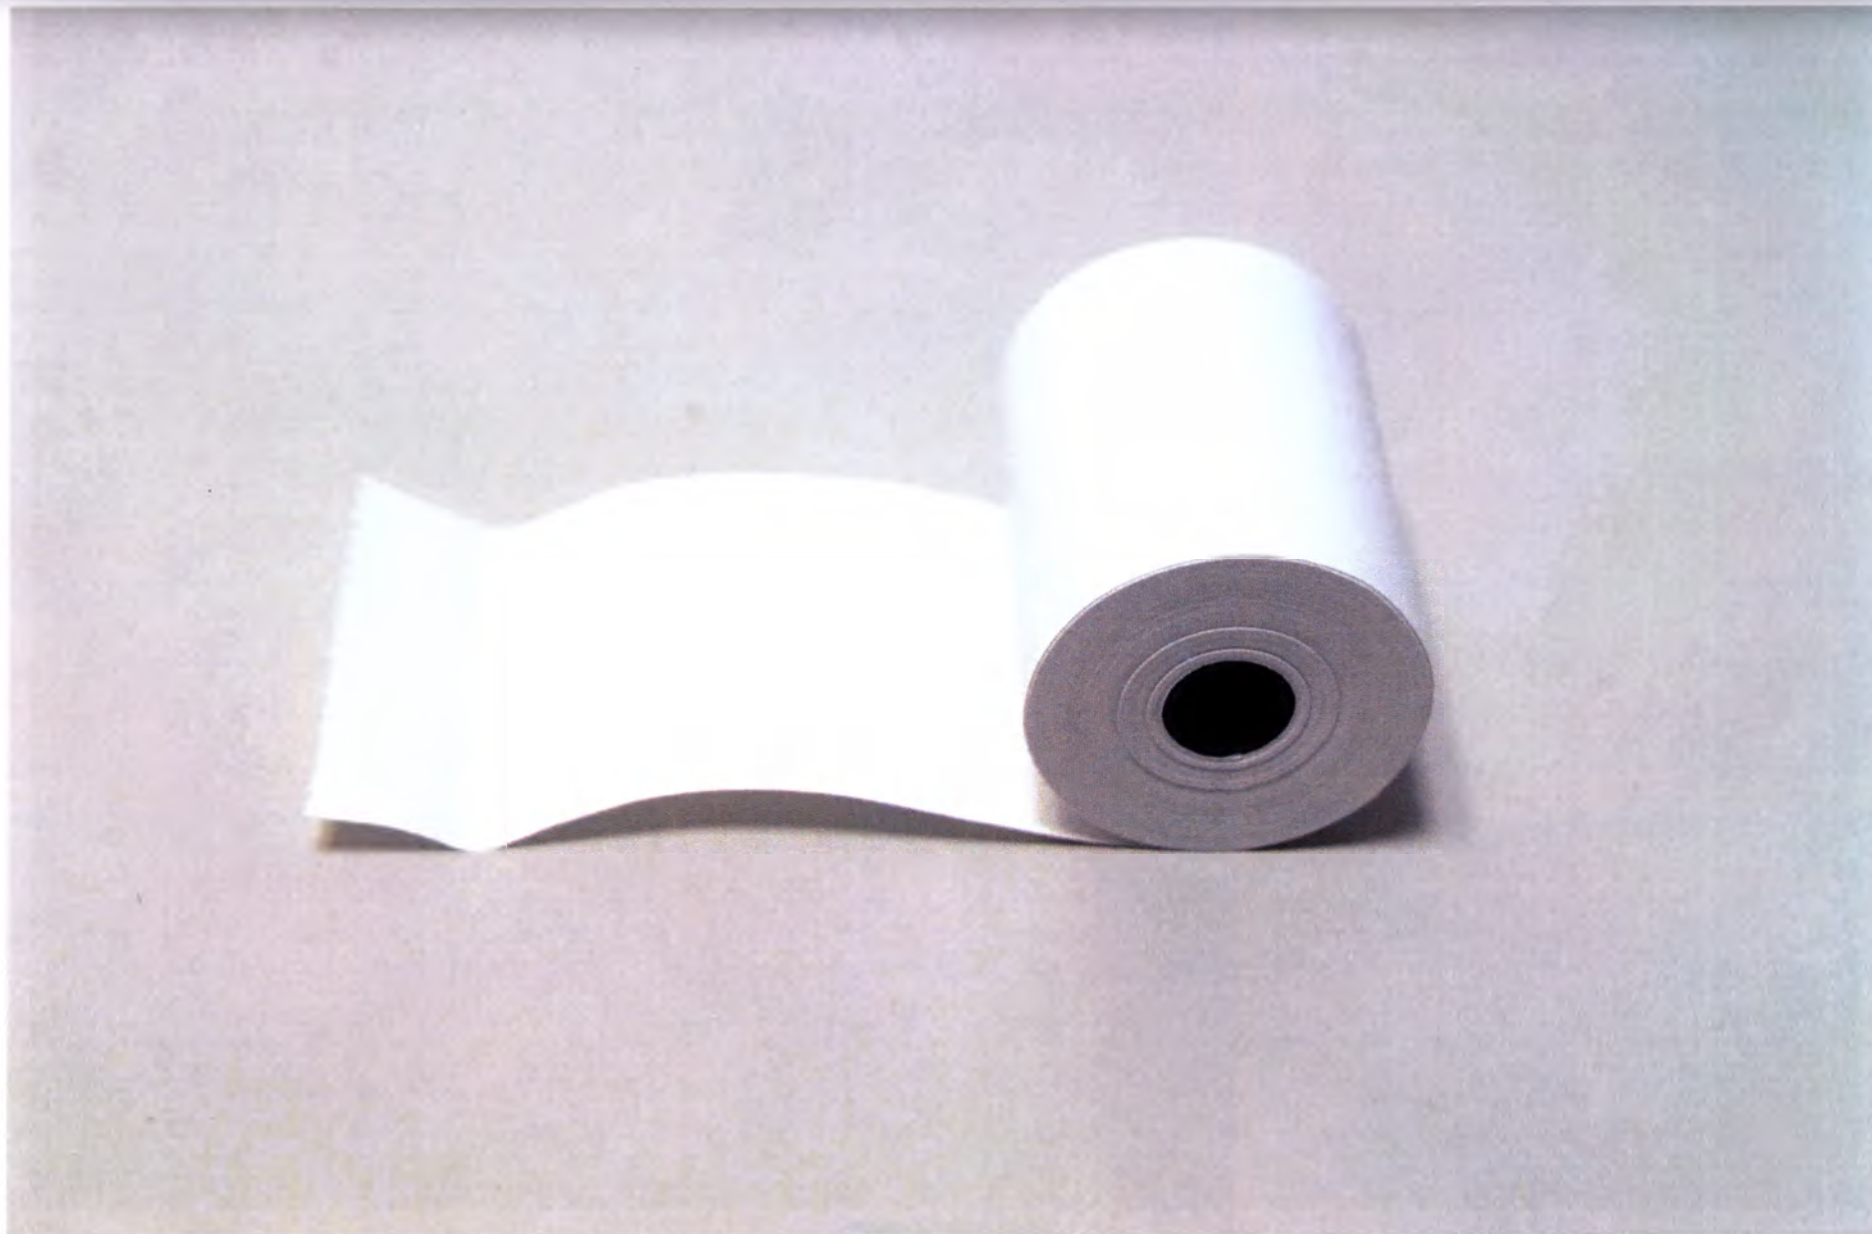

бумага для термопринтера

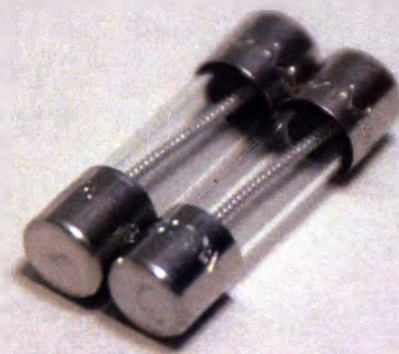

предохранители

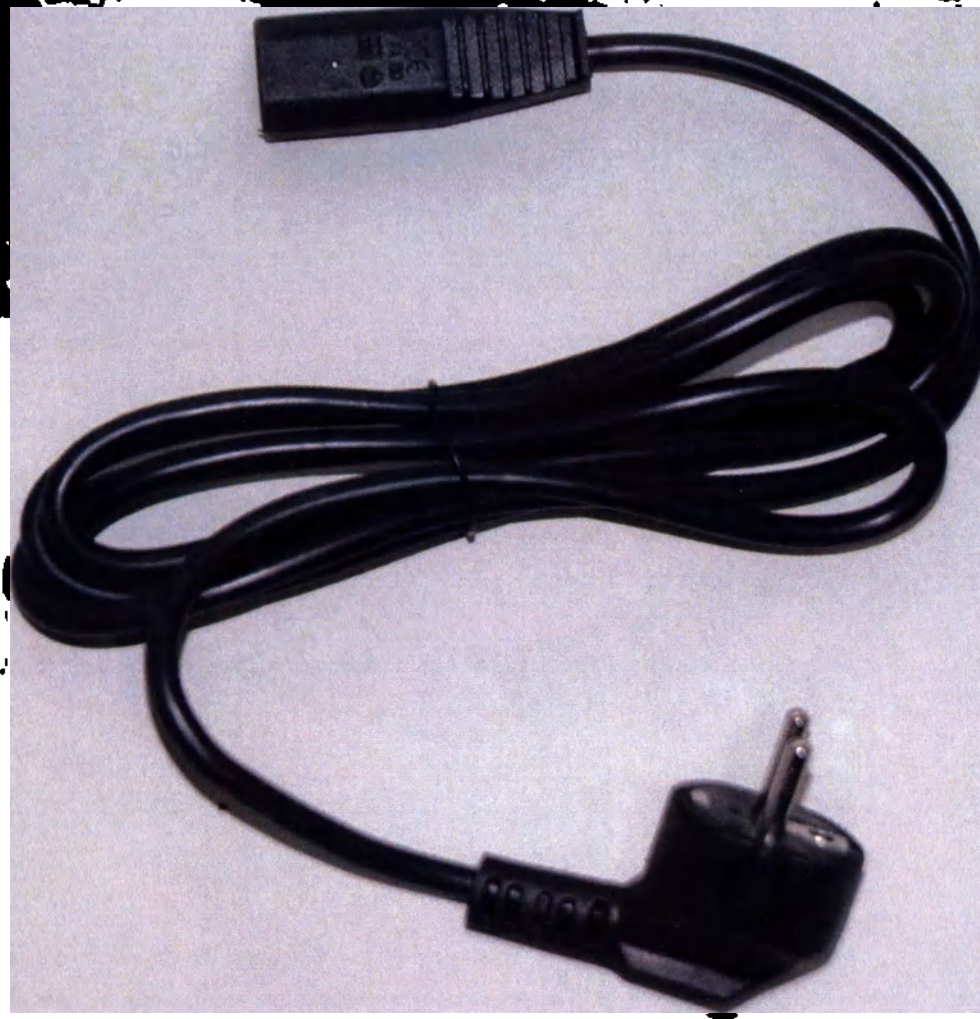

кабель питания



кабель SVT

«УТВЕРЖДАЮ»
Исполнительный директор
«DIESSE Diagnostica Senese S.p.A.»
Стефано Марчезе



DIESSE Diagnostica Senese S.p.A.
Via delle Rose, 10 - 53035 MONTECATINI (SI)
Sede Legale: Via A. Solari, 19 - 20144 MILANO
C.F. e P.IVA 05871140157

**Анализатор измерения скорости оседания
эритроцитов (СОЭ) VES-MATIC CUBE 80 (ВЕС-
МАТИК КУБ 80), с принадлежностями**

Руководство Пользователя



DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.p.A.

Via Solari, 19, 20144 Milano, Италия

Тел. +39 02 48 59 121

Факс +39 02 48 00 85 30, www.diesse.it

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:

Исполнительный директор

Стефано Марчезе



Транспондер на 1000 тестов



Транспондер на 5000 тестов



Транспондер на 10000 тестов

В данном документе прошнуровано,
пронумеровано и скреплено печатями
11 лист(а/-ов) бумаги

Михалева Е. М., Директор

