



ФОТО 1. Набор «Trialab KXP» (общий вид упаковки набора).



Набор «Trialab KXP»
Продукция: ООО «Триал»
ИЗОТОНИЧЕСКИЙ РАСТВОР (BioDil SYS) 20 л
Условия хранения: 5-20°C
Только для in vitro диагностики
Регистрационный номер: ВНИЗ.Вет.рег.
Серия: 010006/17
Дата изготовления: 20.01.2017 г.
Гарантийный срок: до 20.07.2018 г.

Набор «Trialab KXP» (Изотонический раствор BioDil SYS).



ФОТО 3. Набор «Trialab KXP» (Лизирующий реагент BioLyse-WH SYS).

В настоящем документе
проверено, прошито и
скреплено печатью

3

листов

Генеральный директор
ООО «Триалаб»

Прозоровский Н.С.



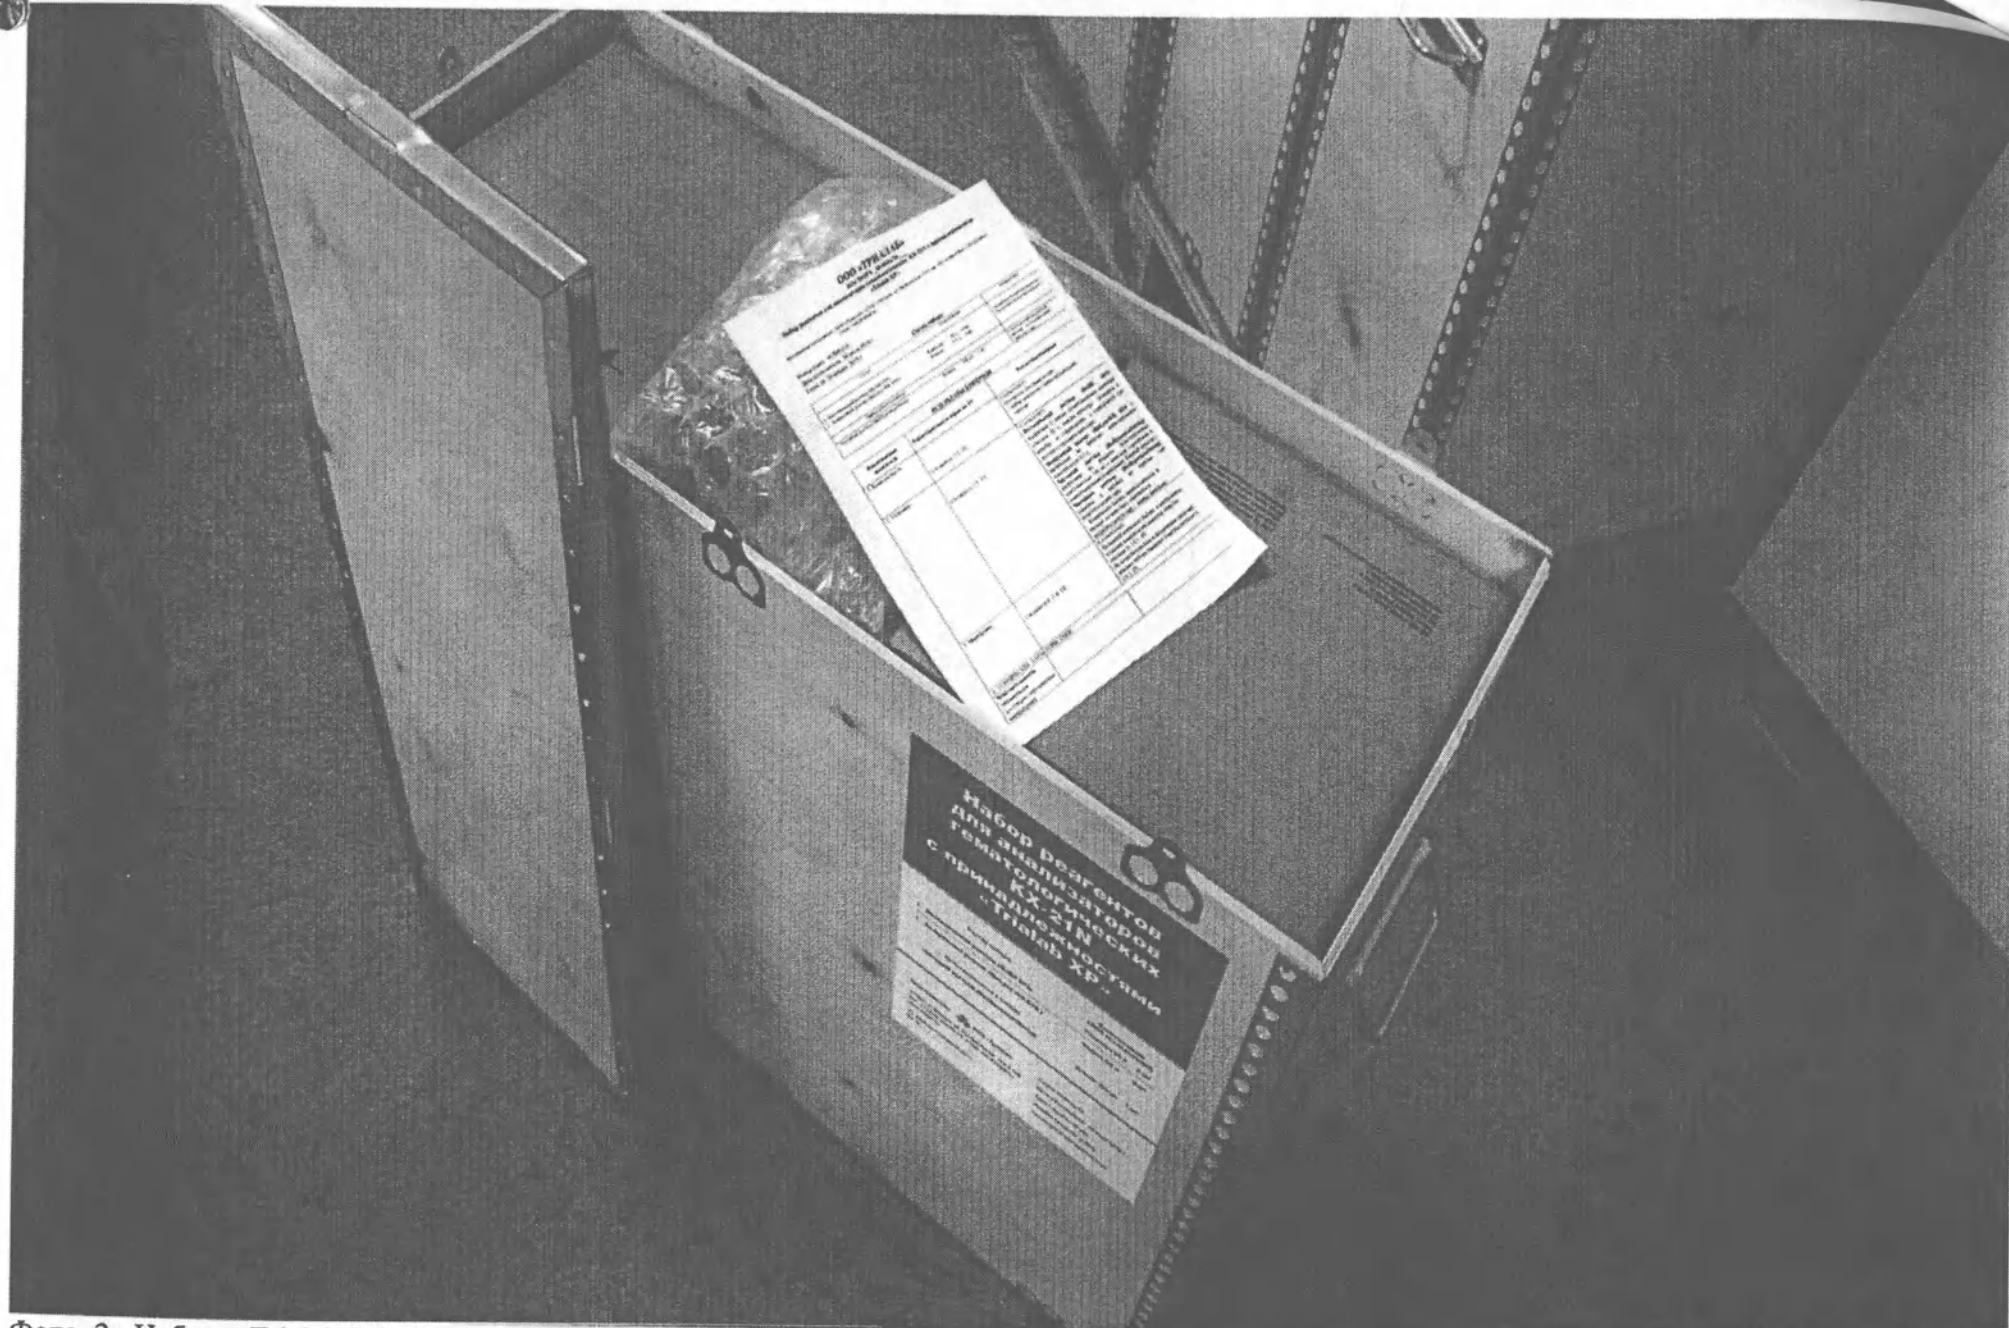


Фото 2. Набор «Trialab XR» (внутренний вид упаковки набора).


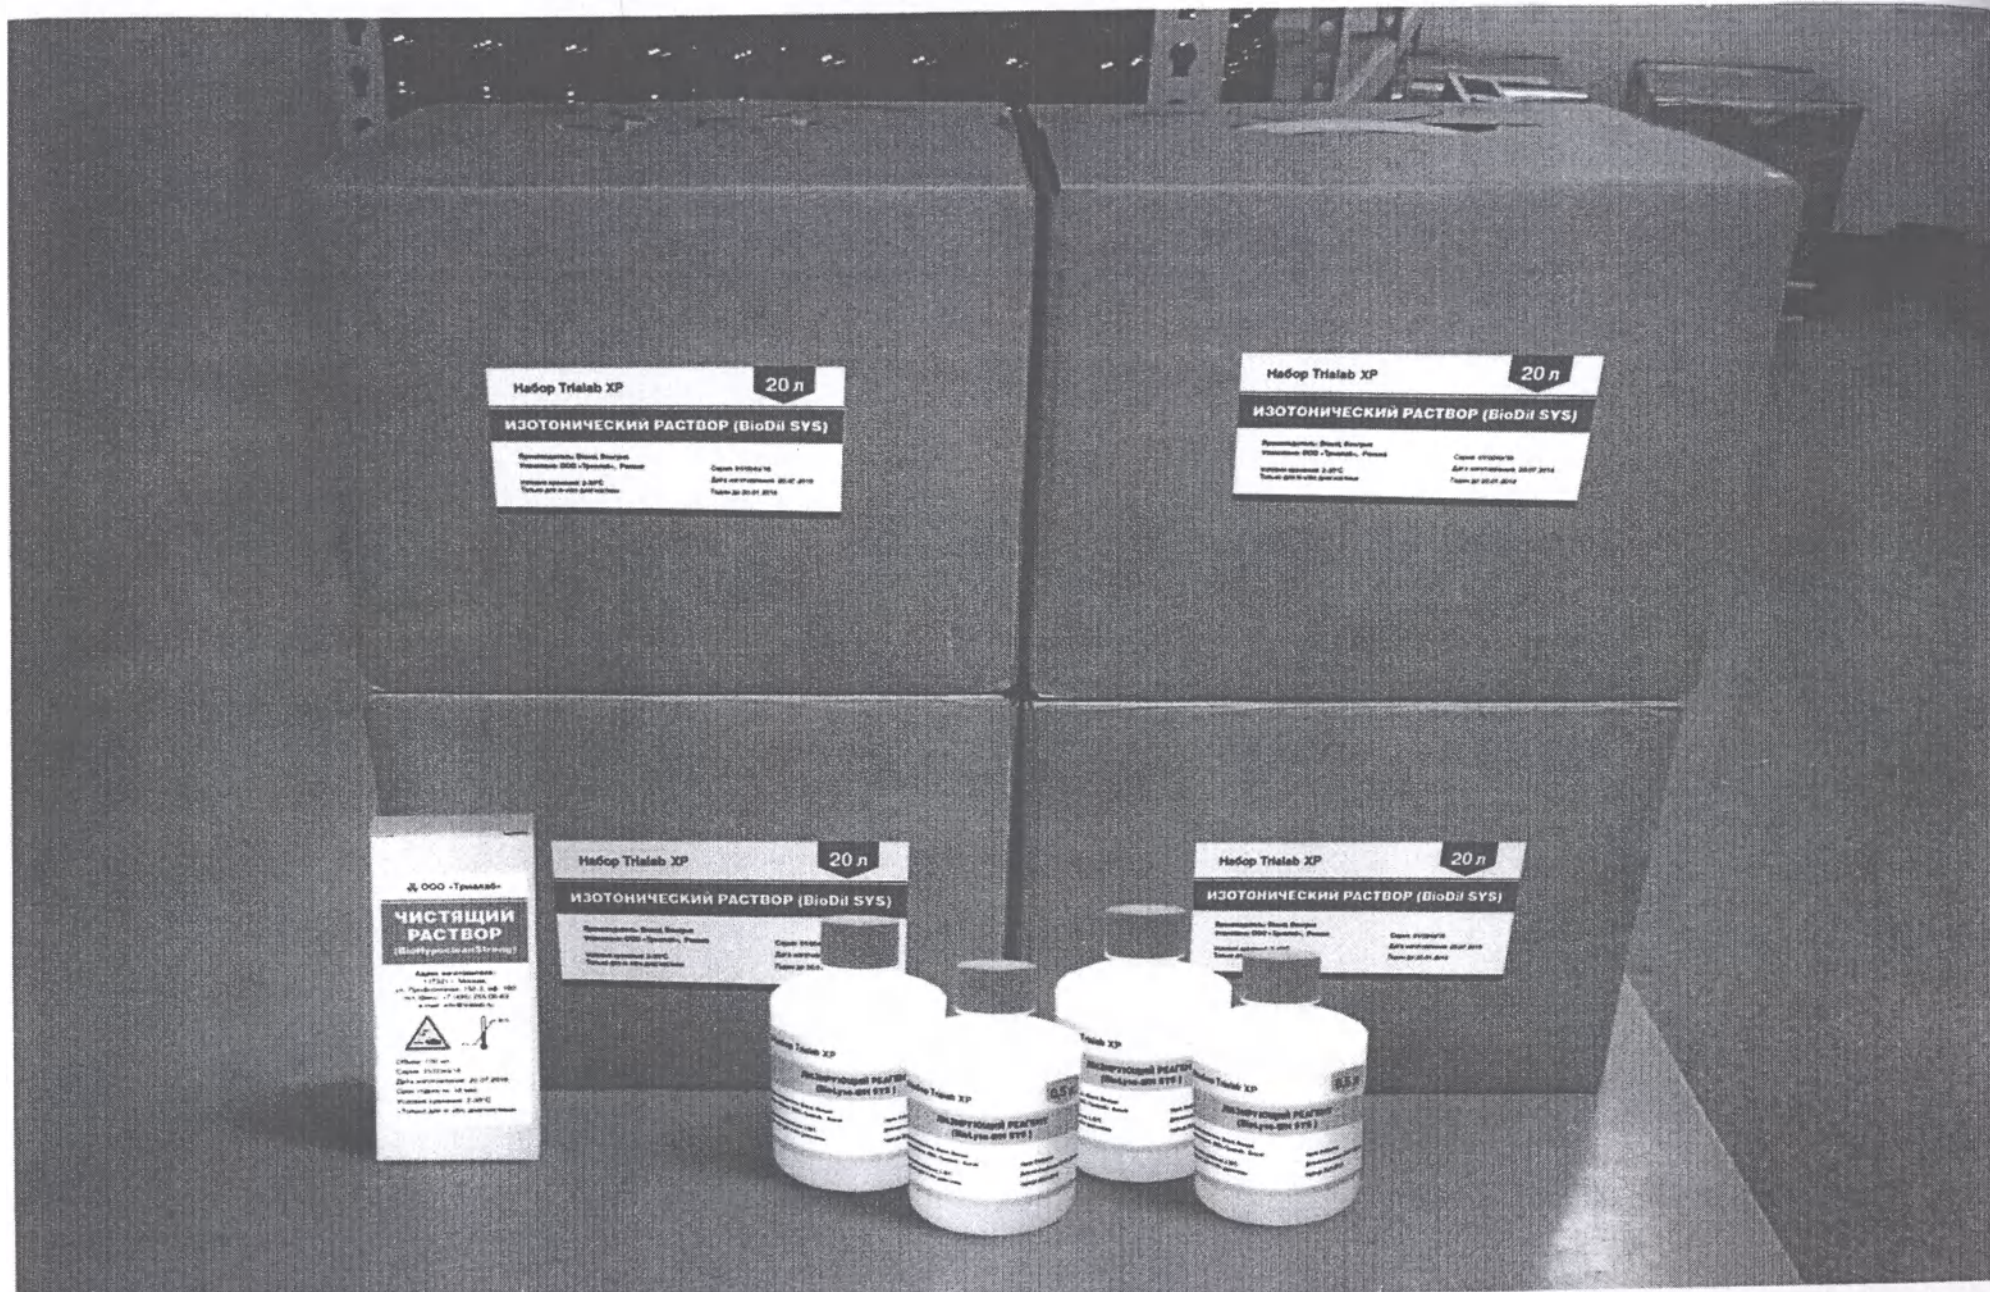


Фото 3. Состав набора «Trialab XP».

...ий раствор (BioDil SYS).

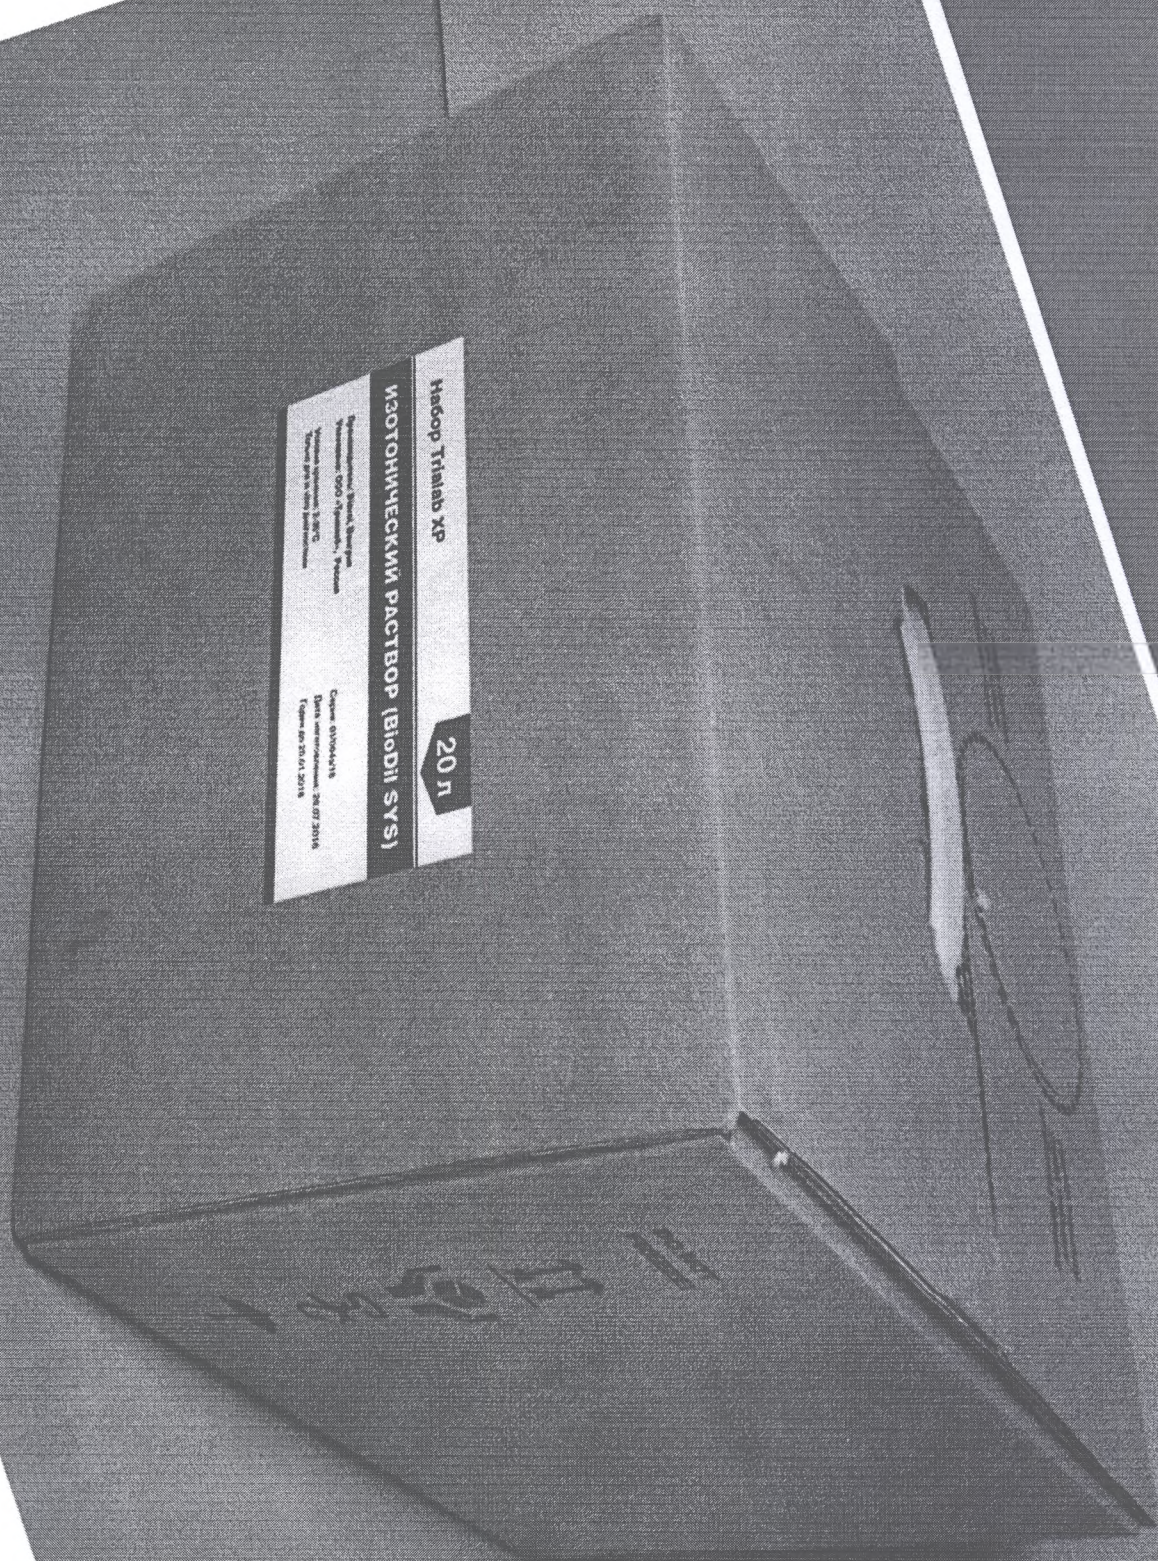

Набор TriLab XP 20 л

ИЗОТОНИЧЕСКИЙ РАСТВОР (BioDil SYS)

Продукция/реактив/вещество, биологический препарат
Исследования: ООО "Цирми", "Биофарм"
Исследования: ООО "Цирми", "Биофарм"
Исследования: ООО "Цирми", "Биофарм"

Срок годности: 24 мес.
Дата изготовления: 28.07.2018
Срок годности: 28.07.2018

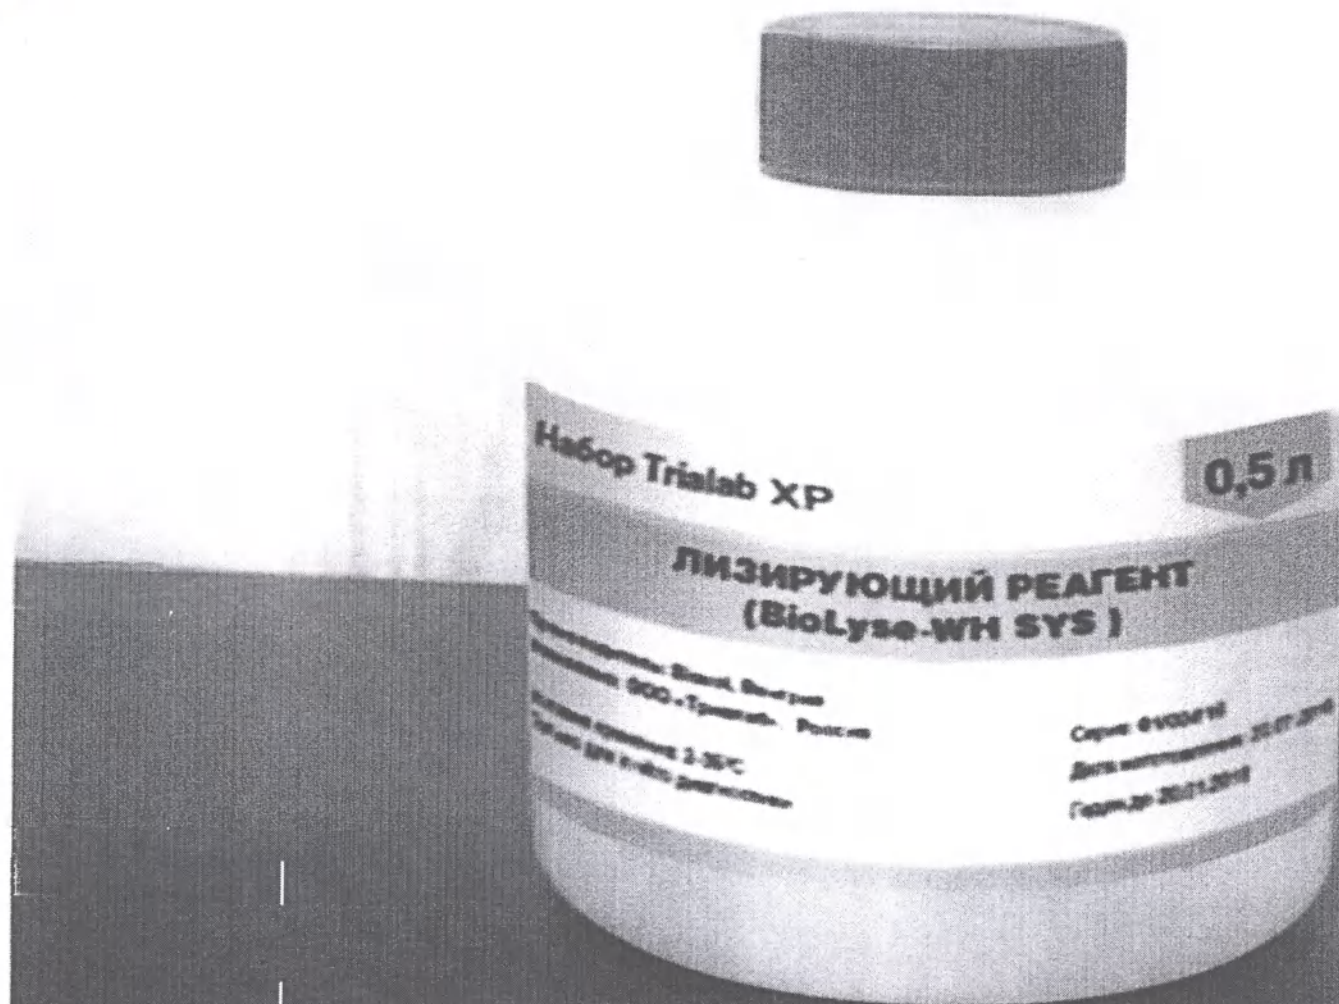


Фото 5. Набор «Trialab XP» (Лизирующий реагент (BioLyse-WH SYS)

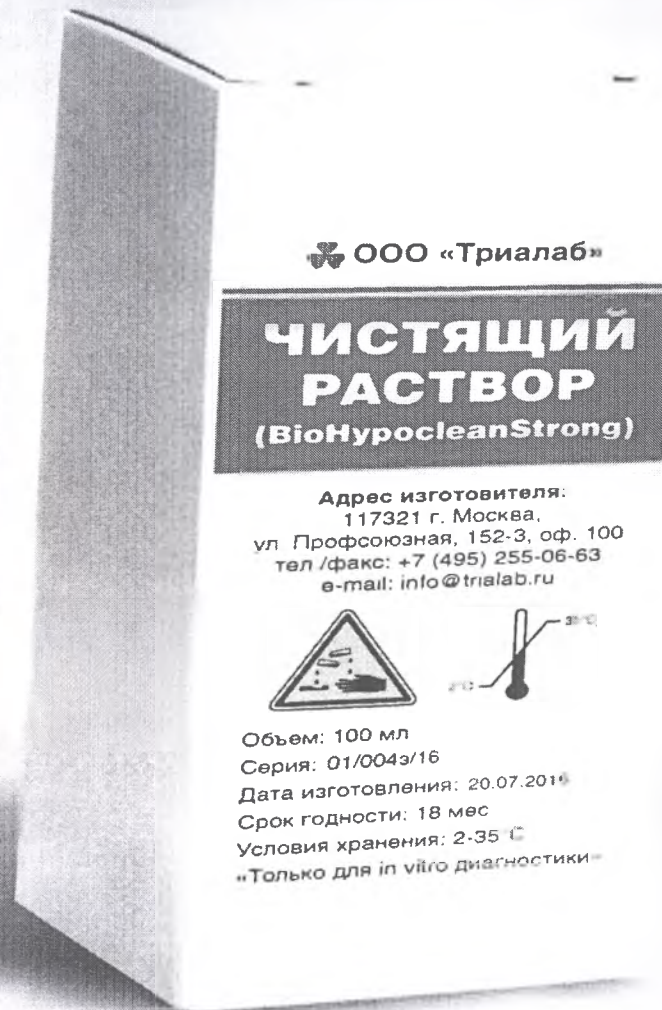


Фото 6. Набор «Trialab XP».
Принадлежности к набору - Чистящий раствор (BioHypocleanStrong).

КОПИЯ ВЕРНА



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО
«Триалаб»

Н.С. Прозоровский

«26» июля 2017 г.

МАРКИРОВКА

Набора реагентов для анализаторов гематологических КХ-21N «Trialab KXP» по ТУ
9398 - 004 -13296835- 2017

Компоненты набора.

Набор «Trialab KXP»

Производитель:  ООО «Триалаб»

20 л

ИЗОТОНИЧЕСКИЙ РАСТВОР (BioDil SYS)

Условия хранения: 2-35°C

Только для in vitro диагностики

Реагент произведен: Biochol, Венгрия

Серия: 01/004э/17

Дата изготовления: 20.01.2017 г

Годен до 20.07.2018 г

Набор «Trialab KXP»

Производитель:  ООО «Триалаб»

0,5 л

ЛИЗИРУЮЩИЙ РЕАГЕНТ (BioLyse-WH SYS)

Условия хранения: 2-35°C

Только для in vitro диагностики

Реагент произведен: Biochol, Венгрия

Серия: 01/004э/17

Дата изготовления: 20.01.2017 г

Годен до 20.07.2018 г

Набор реагентов для анализаторов гематологических КХ-21 N «Trialab KXP»

Состав набора

Комплектация (500 исследований)

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Изотонический раствор (BioDil SYS) | Канистра 20 л. 1 шт |
| 2. Лизирующий реагент (BioLyse-WH SYS) | Флакон 0,5 л. 1 шт |

Производитель:  ООО «Триалаб»

Серия: 01/004э/17

117321, г. Москва, ул. Профсоюзная, 152-3-100

Дата изготовления: 20 января 2017 г

Тел. +7 (495) 255-06-63, e-mail: info@trialab.ru

Срок годности: 18 мес.

www.trialab.ru

Условия хранения: 2-35°C.

ТУ 9398-004-13296835-2017

Только для in vitro диагностики.

РУ №

В настоящем документе
проверено, прошито и
скреплено печатью

2

листов



Генеральный директор
ООО «Триалаб»

Прозоровский Н.С.