

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Медтроник»



Плясунова Е.В.

«13» ноября 2017 г.


Фотографические изображения

Монитор Spectrum Medical для определения параметров крови, различных вариантов исполнения с принадлежностями

Spectrum Medical



systemA

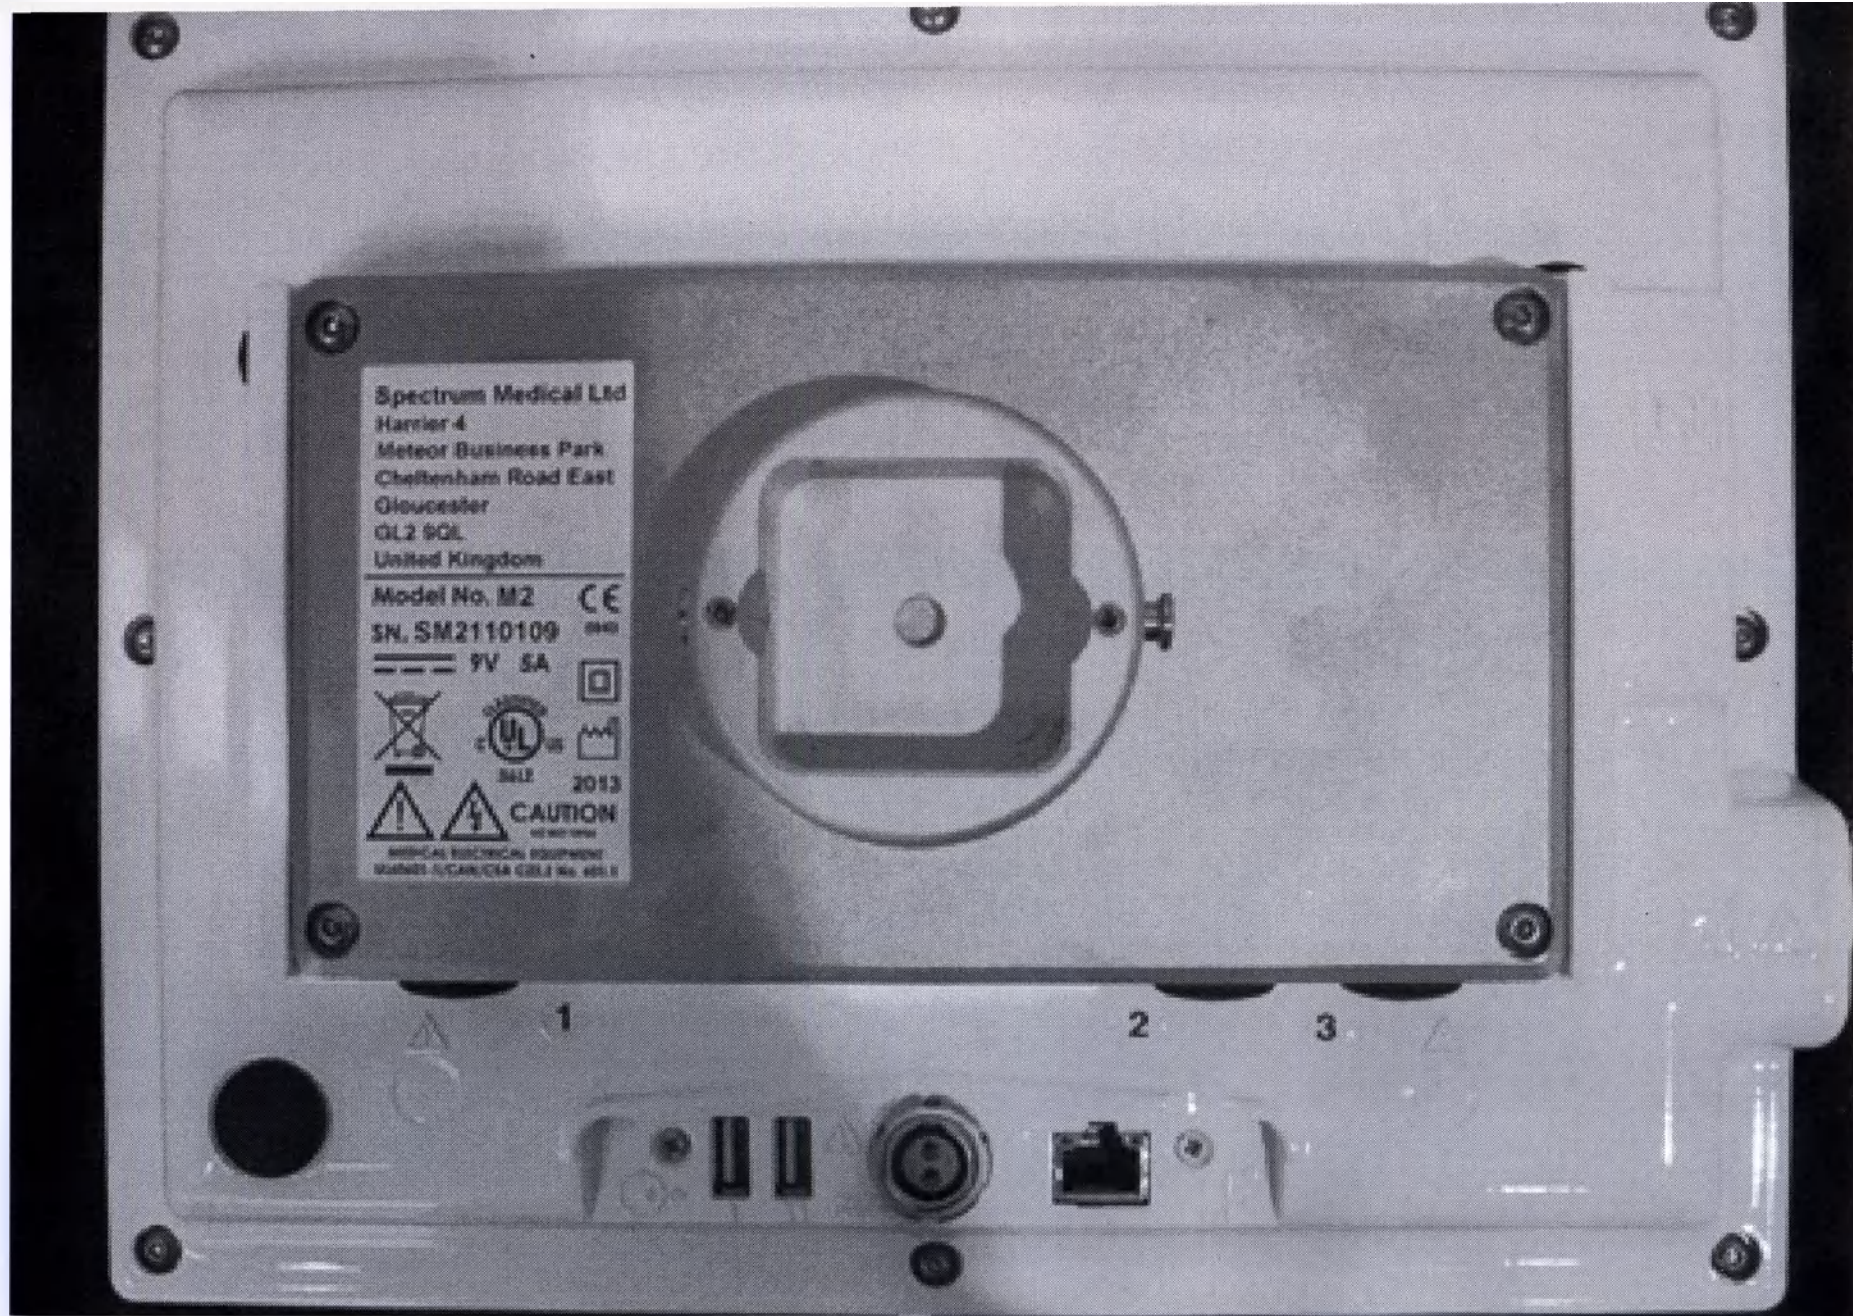

Монитор для определения параметров крови М2 вид сзади

THE WAY TO A BETTER WORLD



Монитор для определения параметров крови модель М3, М4 вид сзади

Блок питания



S/ N 141035
WEEK: 1312



PROTEK POWER
www.protek.com.tw

MODEL: PMP90-11-K17

INPUT: 100-240V~
47-63 Hz, 1.06-0.45A

OUTPUT: 70W MAX.

P1: 9V —, 7.78A

P2: RETURN



IEC 60601-1



EN60950-1




E 178020

This product is also identified with the
Listing Mark for ITE Power Supply
under File E157410.


MADE IN TAIWAN



Отвертка

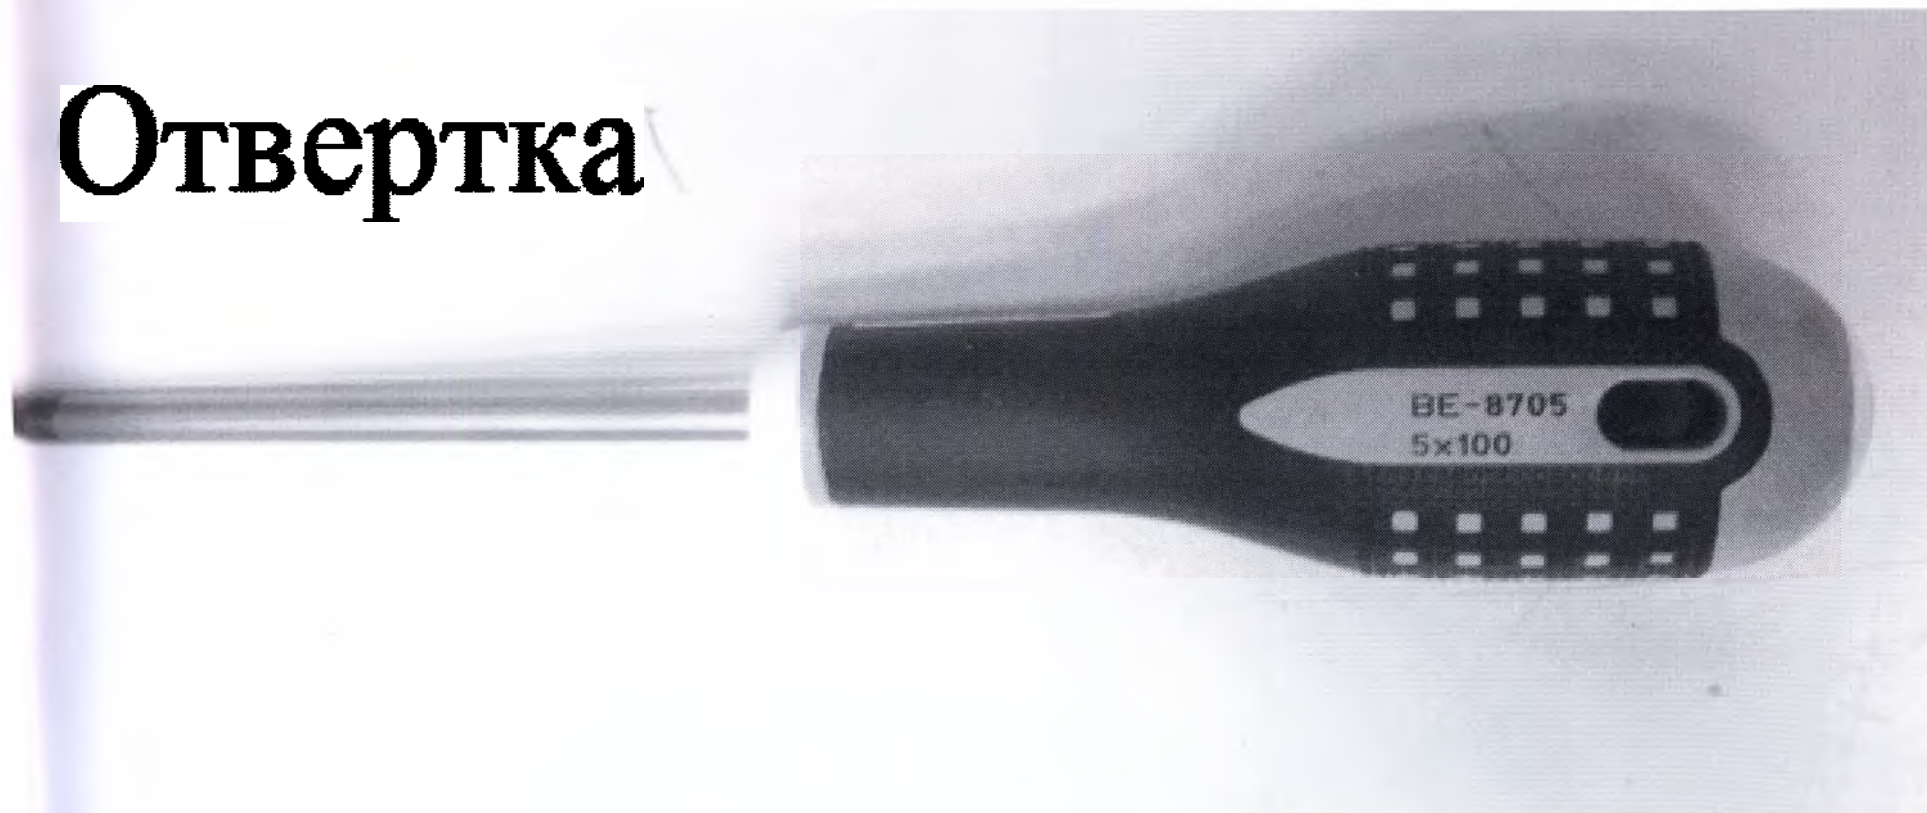


Карта SD

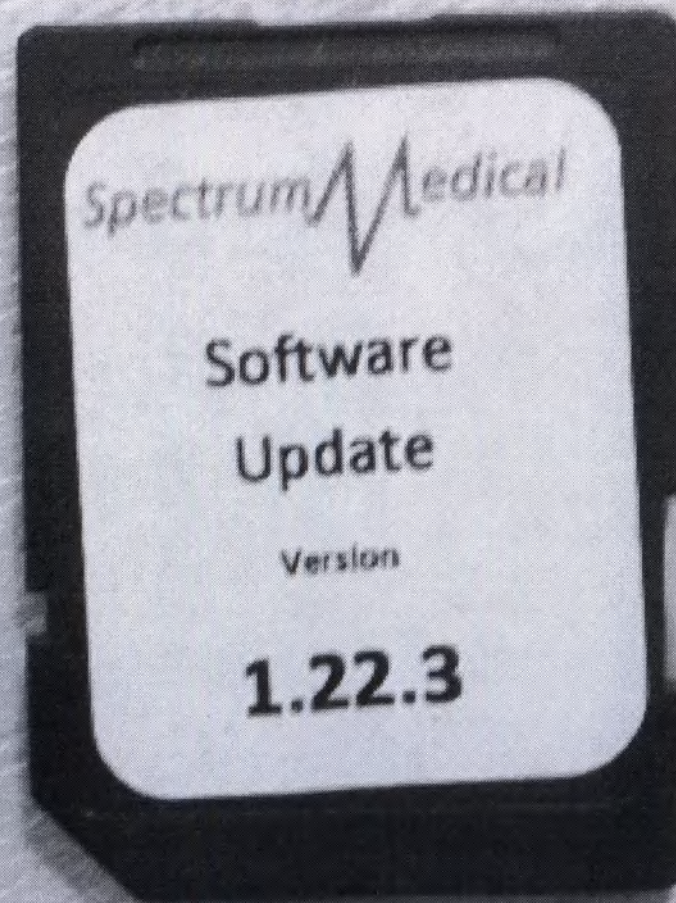





Кабель питания

Рычаг несущий

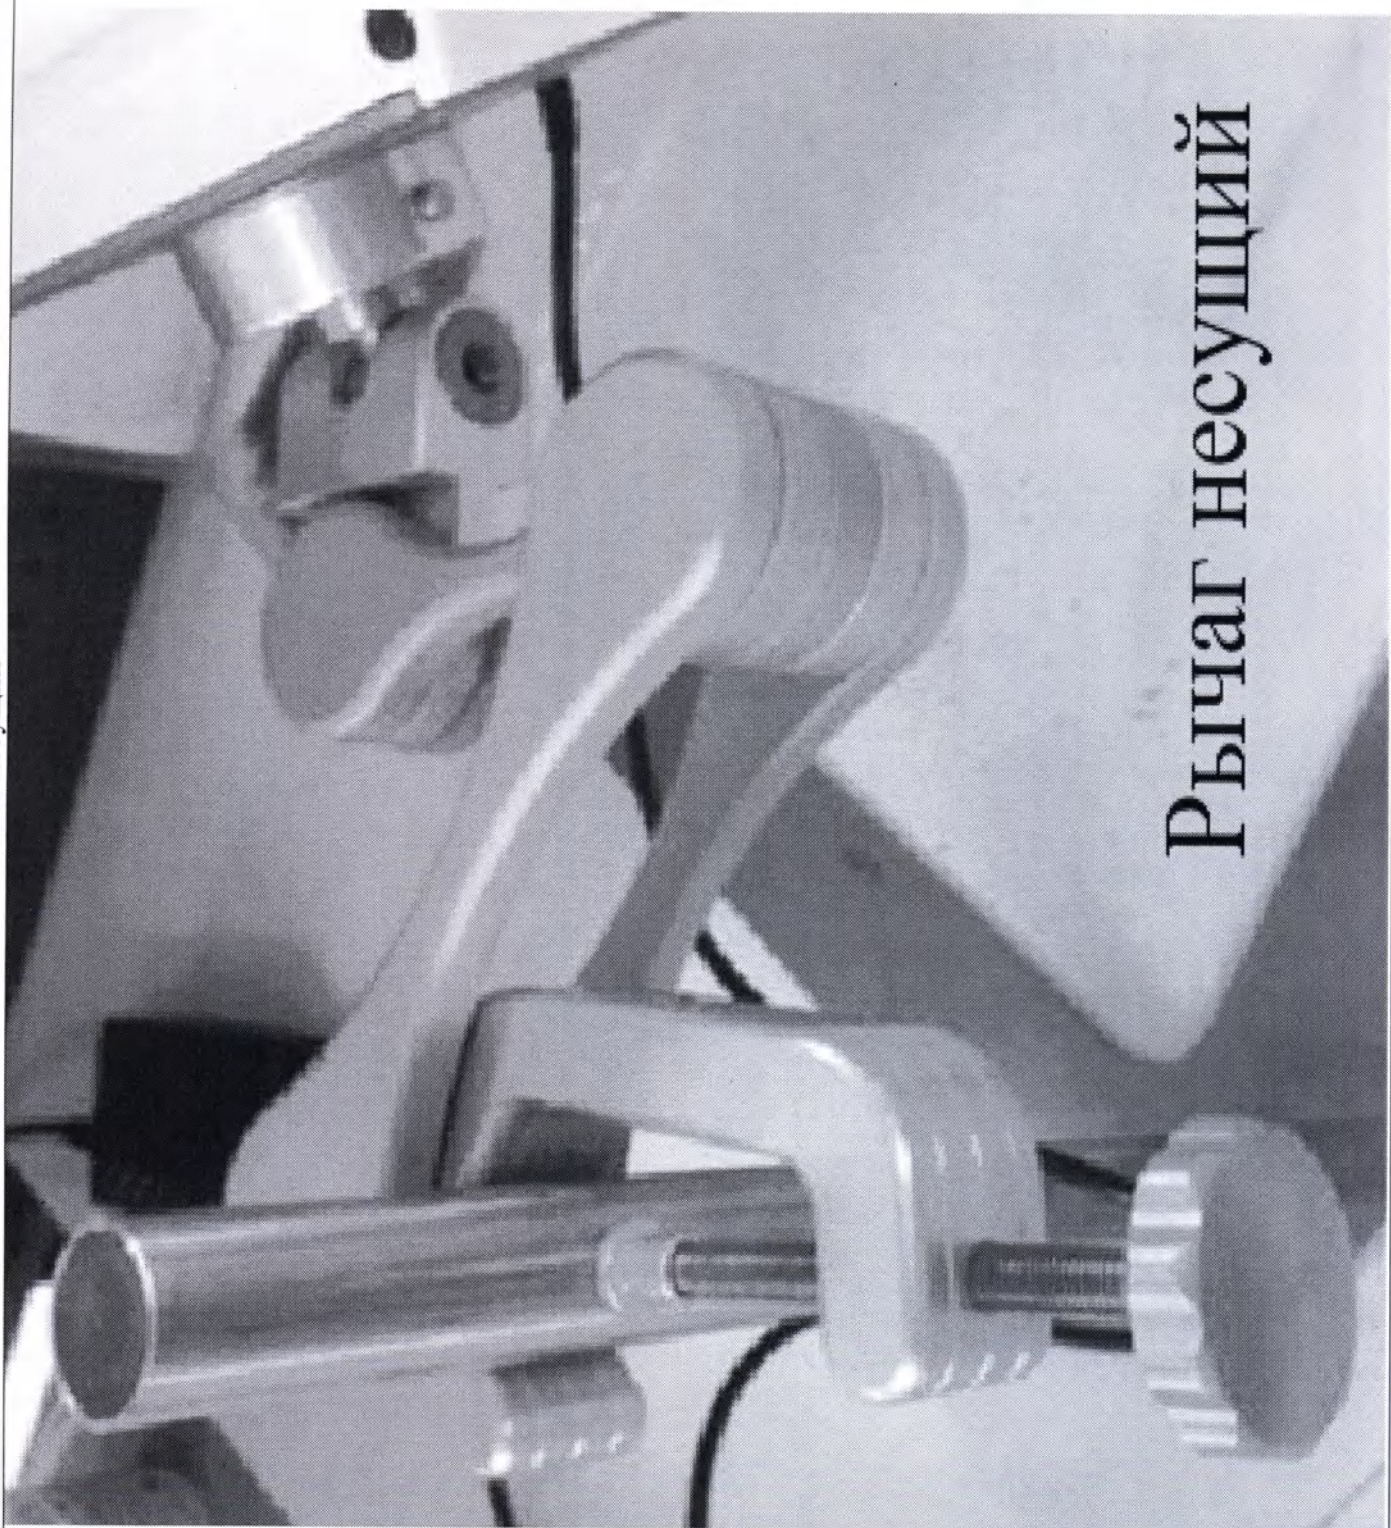


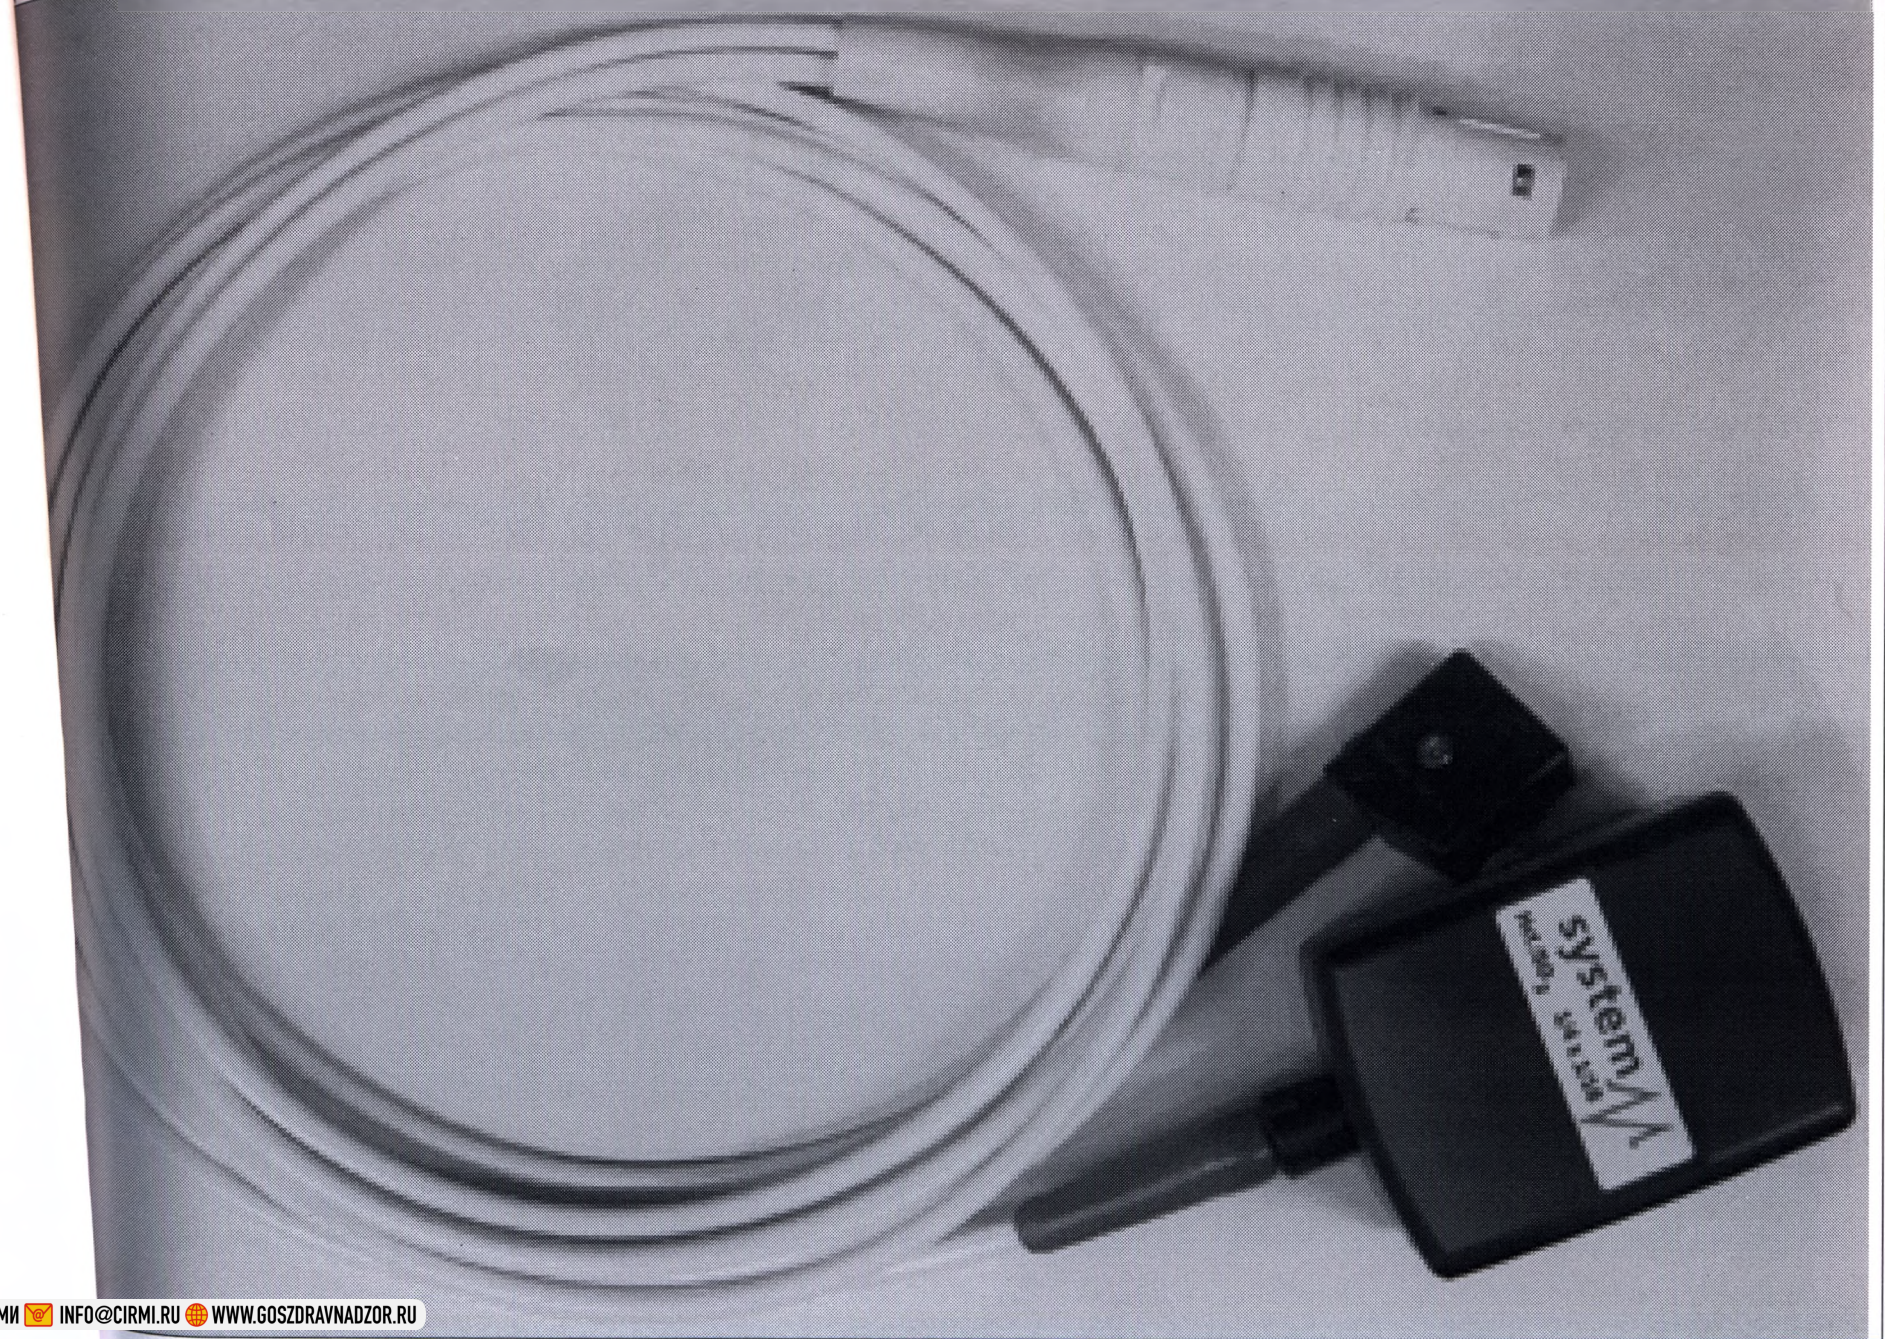



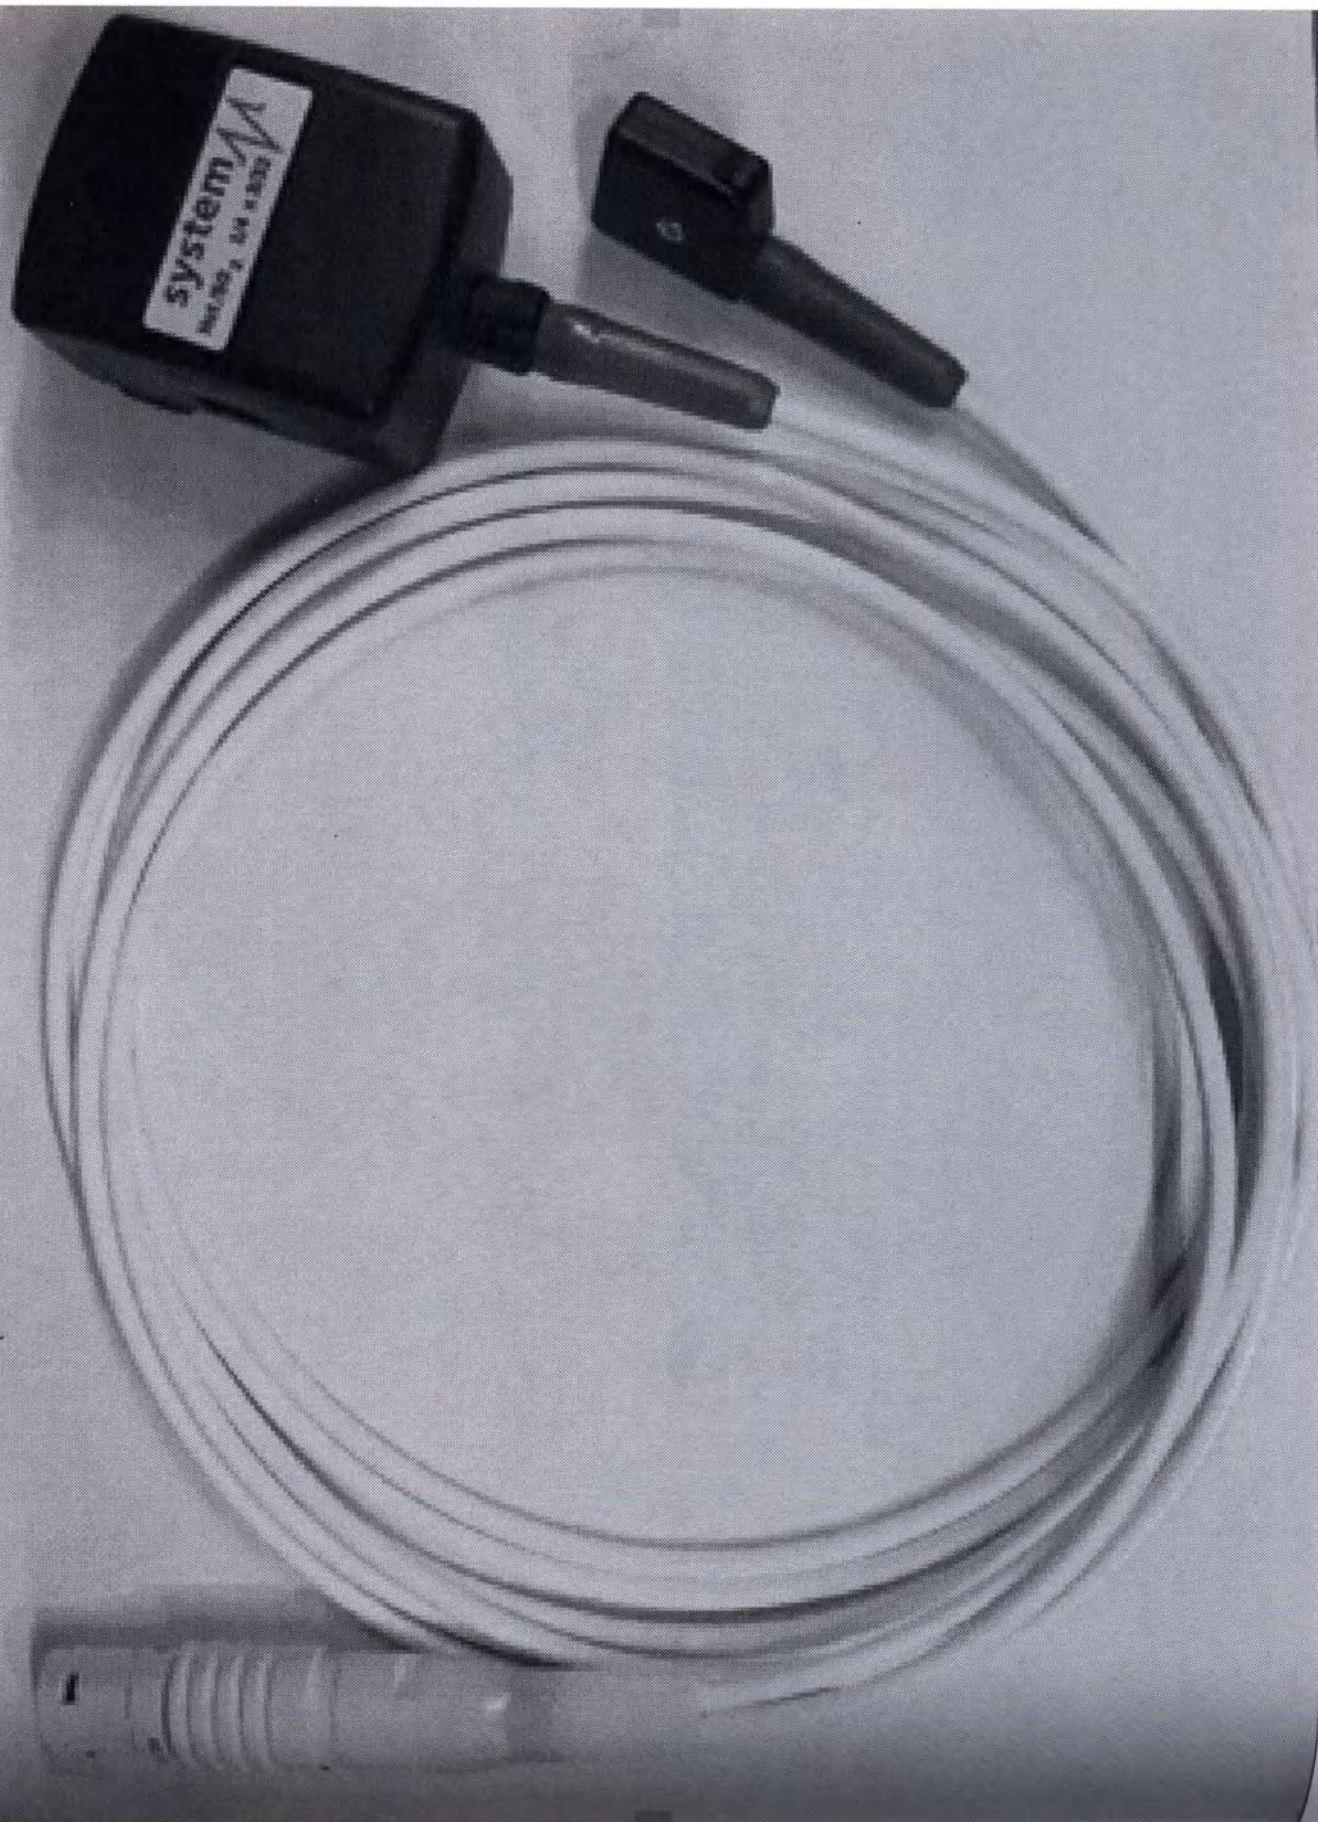




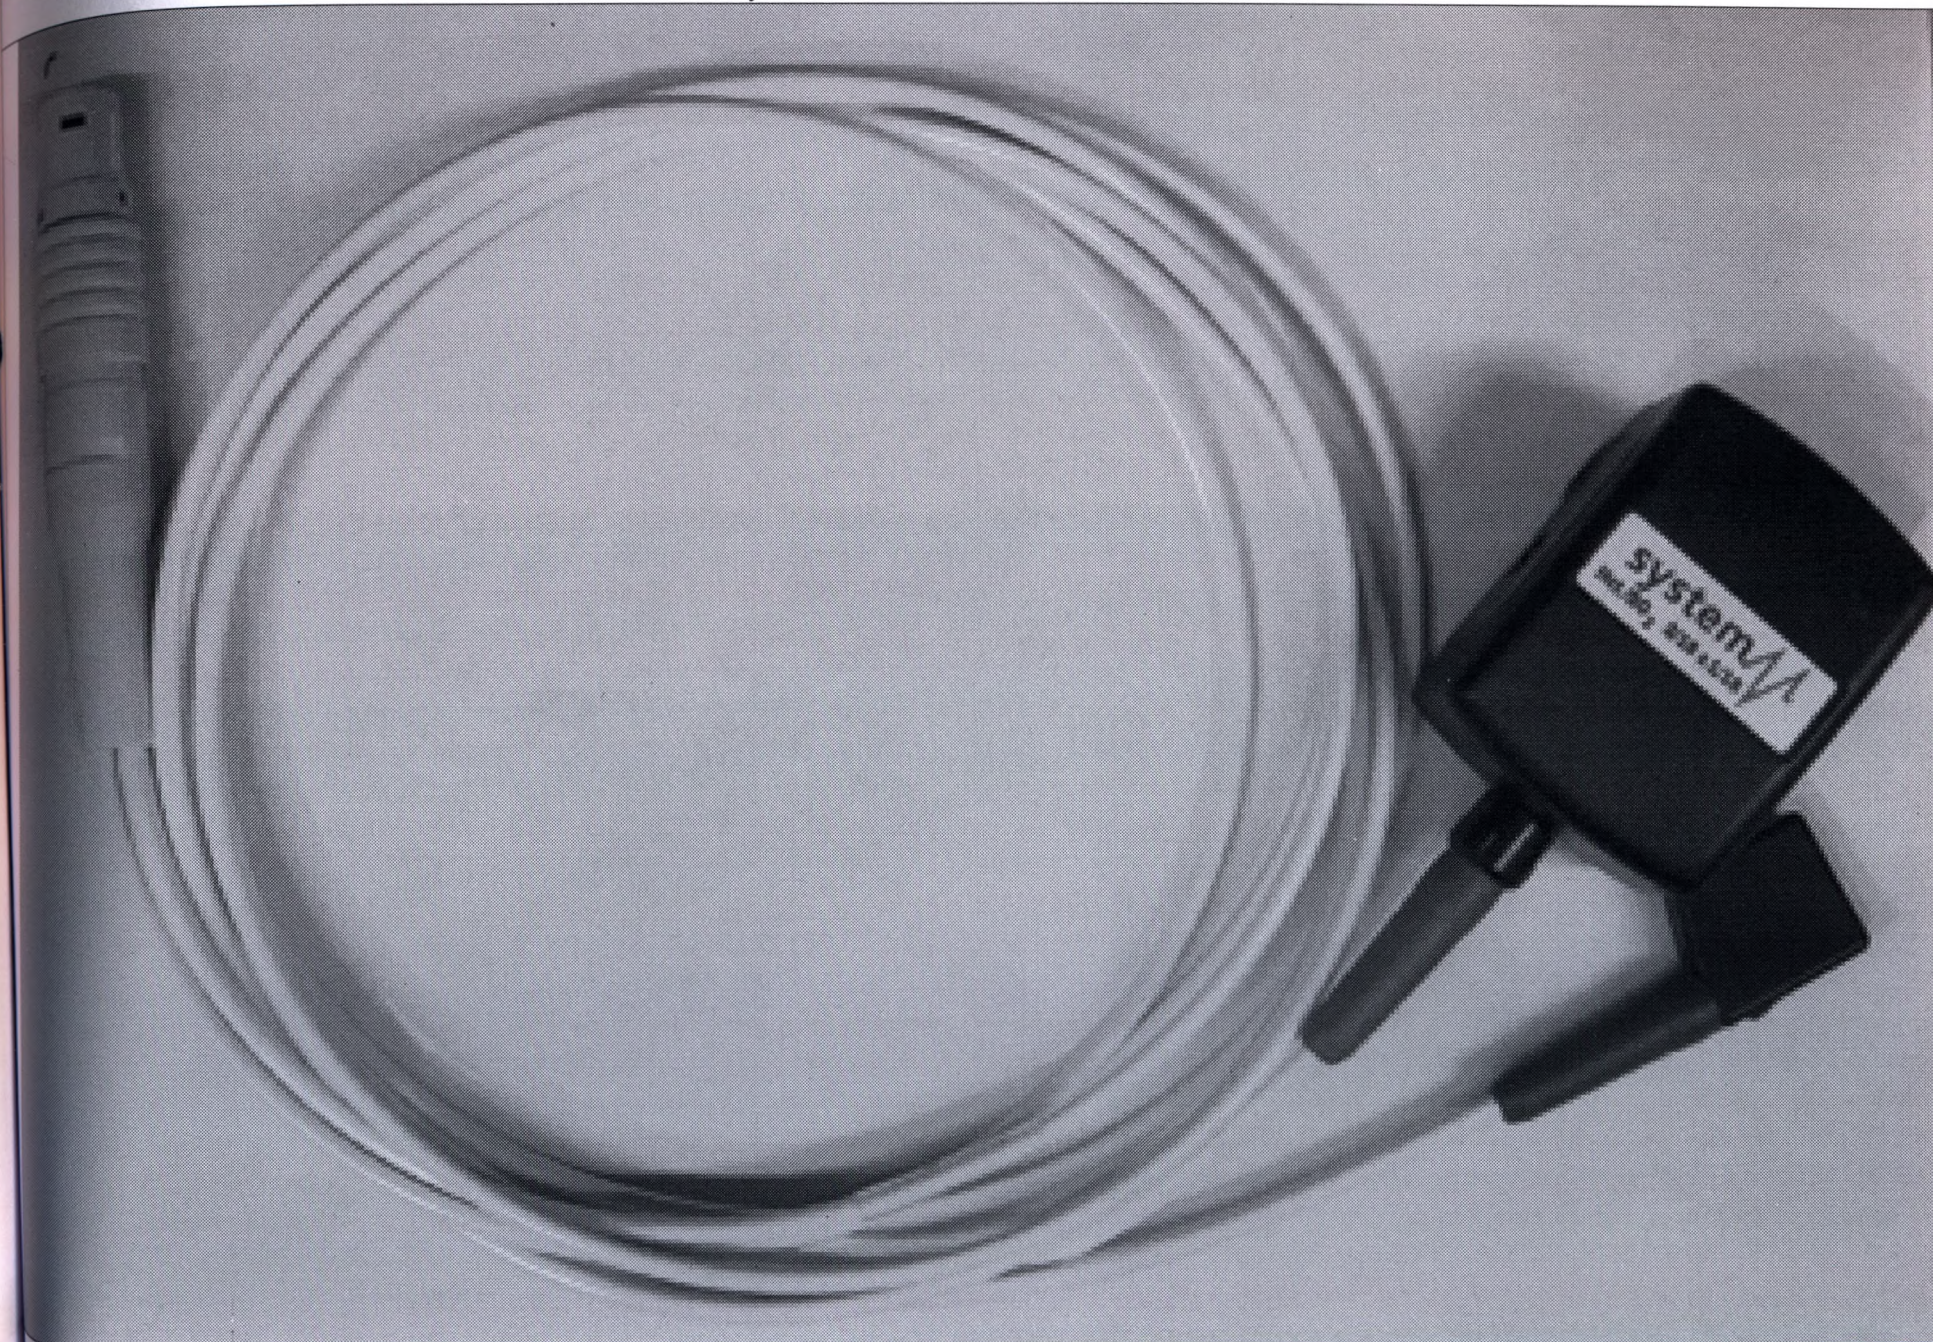




Датчик для измерения сатурации артериальной и венозной крови, гематокрита, и уровня гемоглобина
System 3/8 x 3/32 НСТ/SvO₂ SaO₂

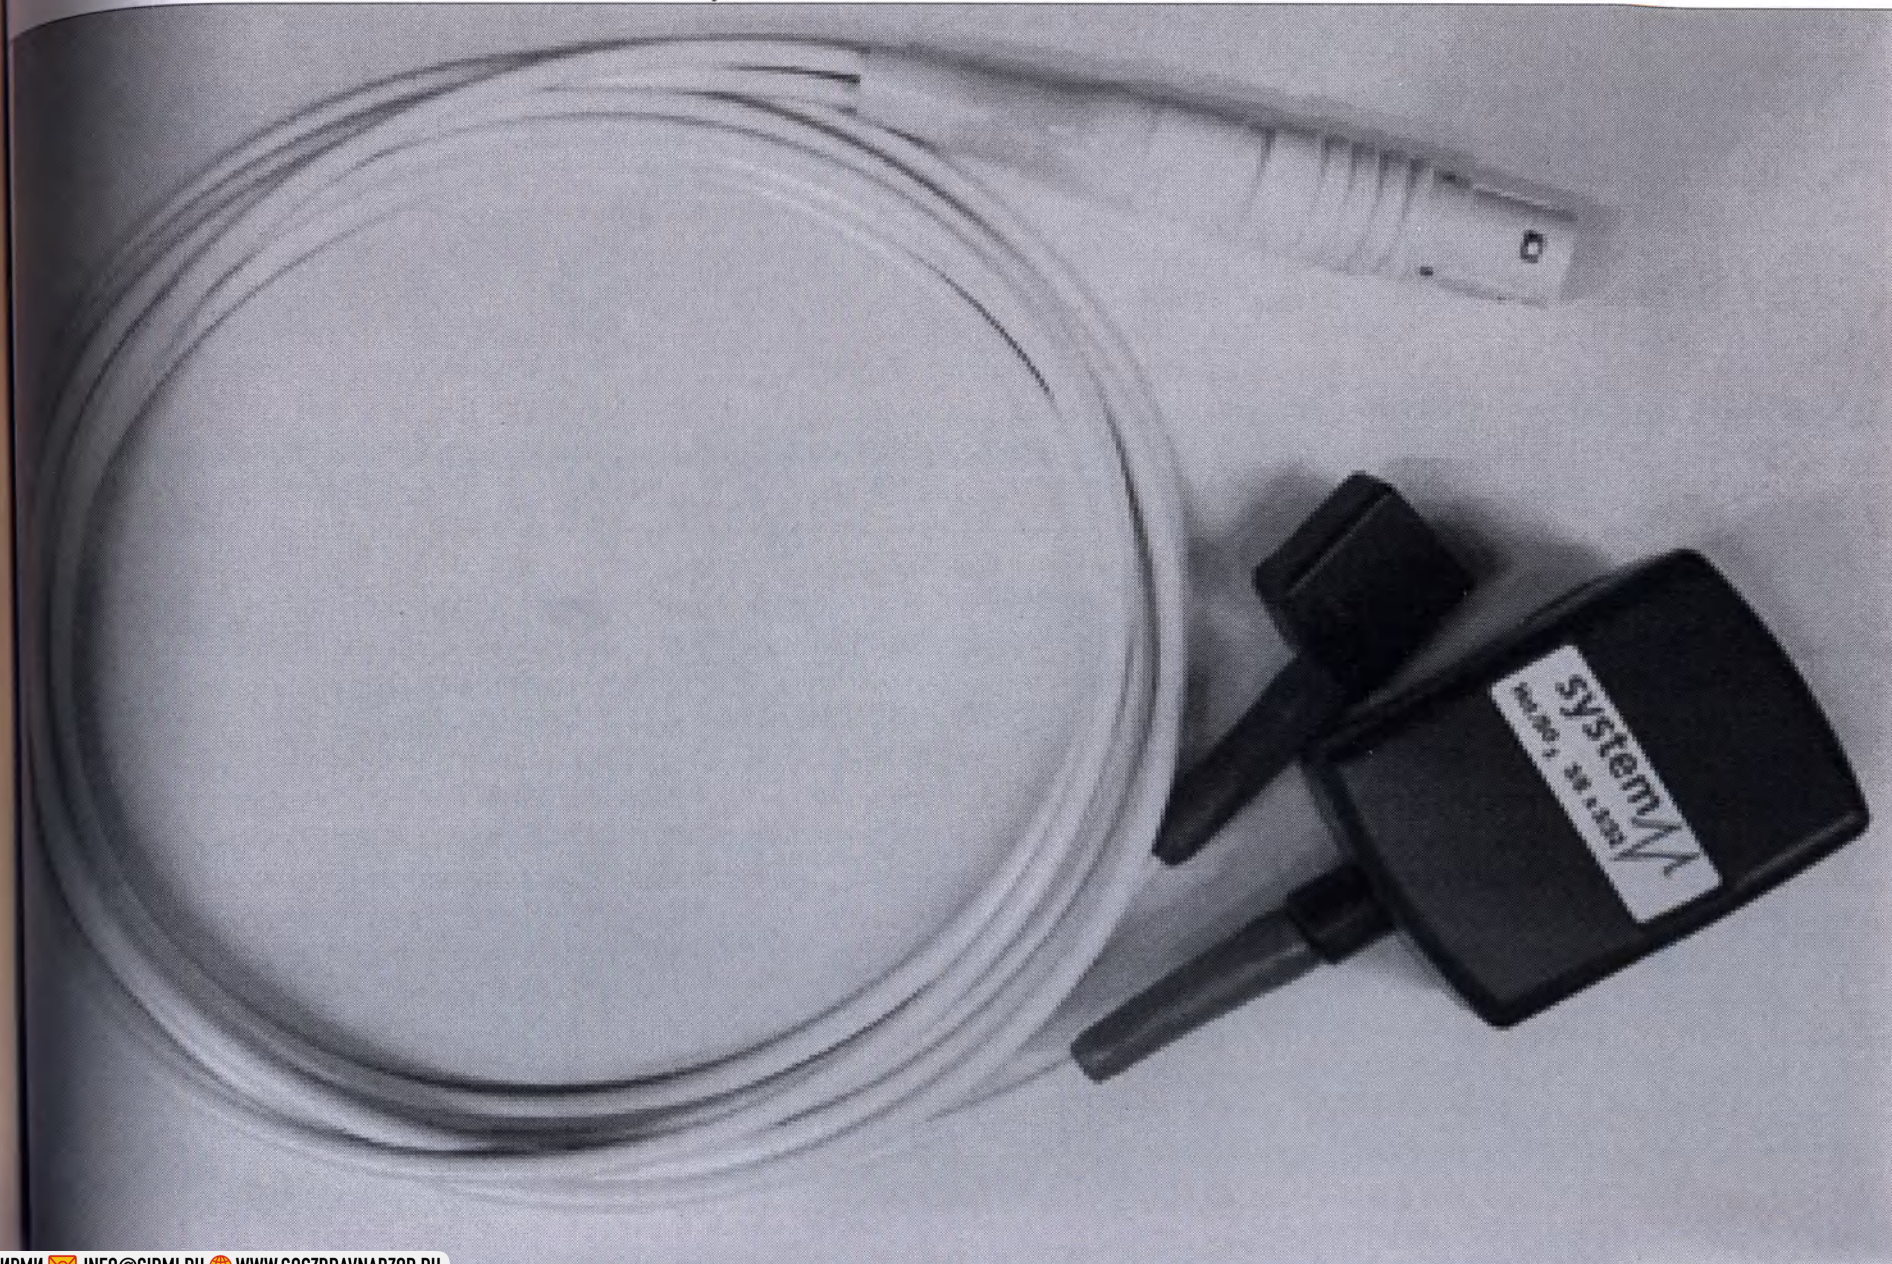










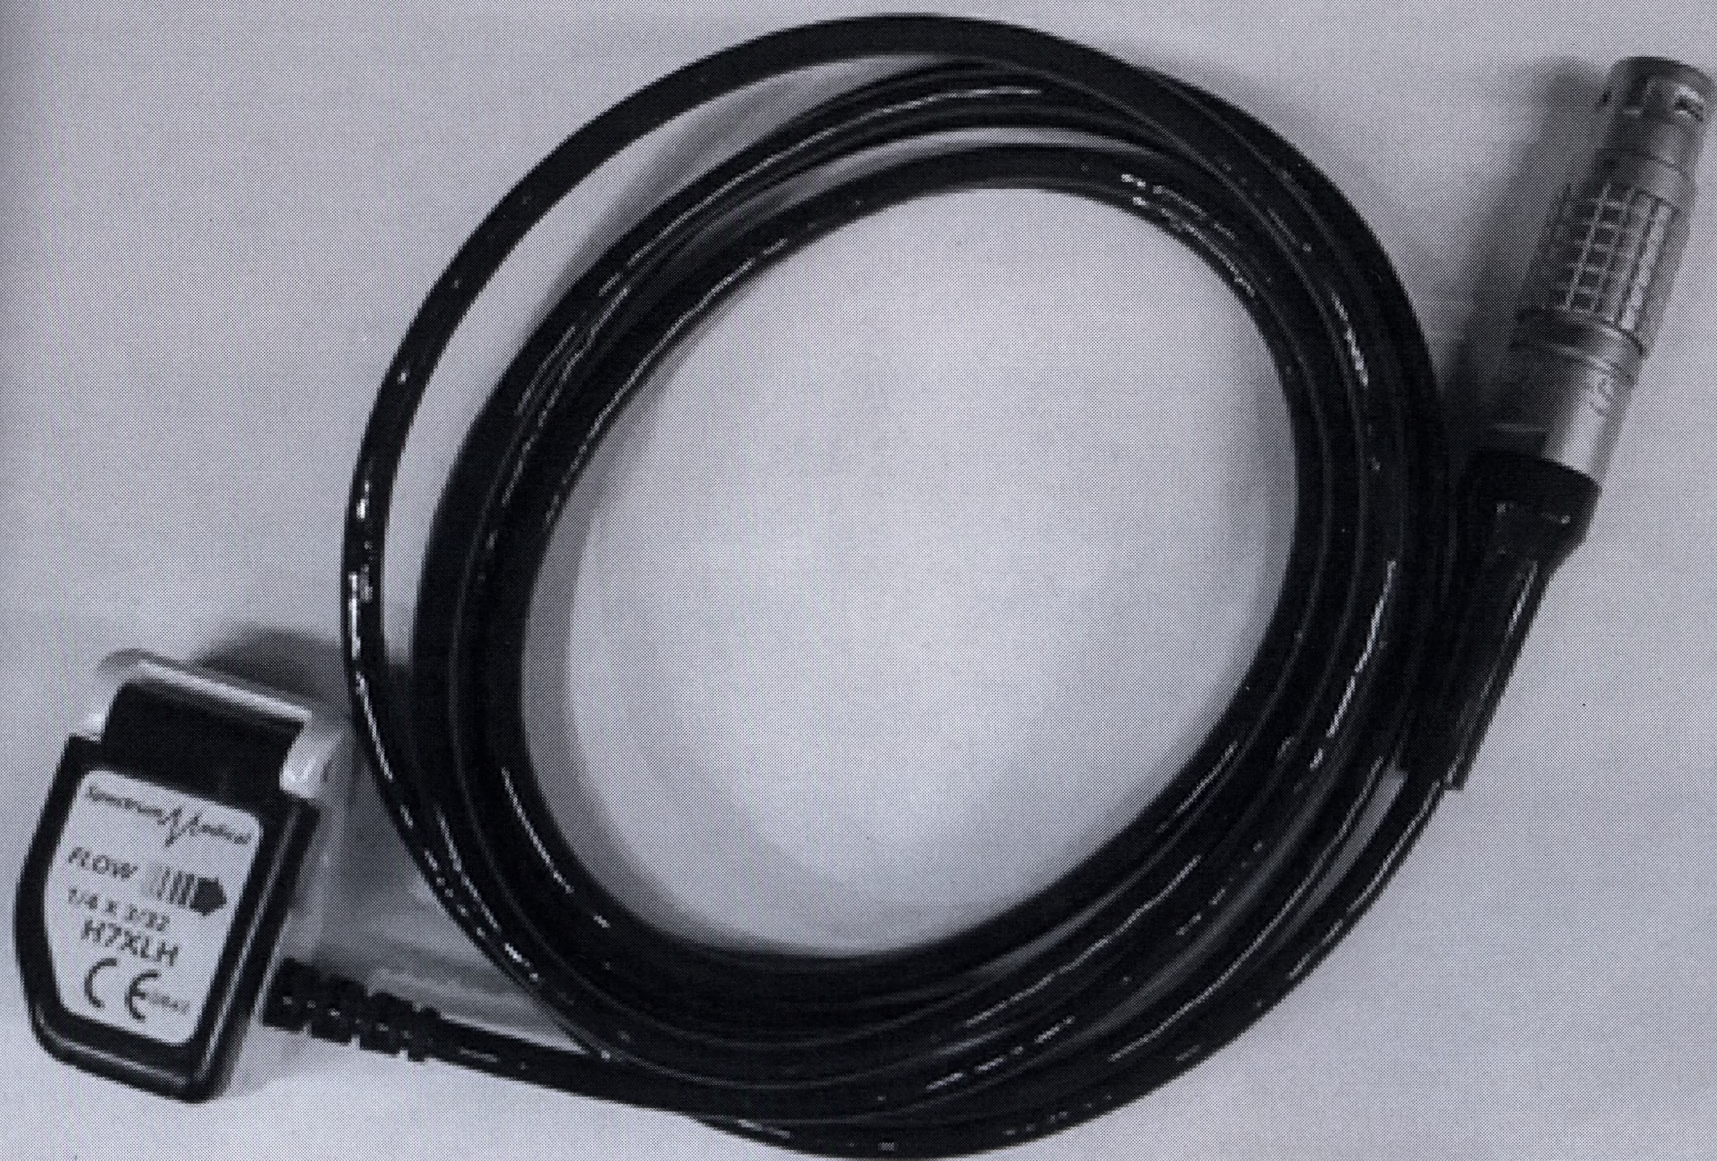

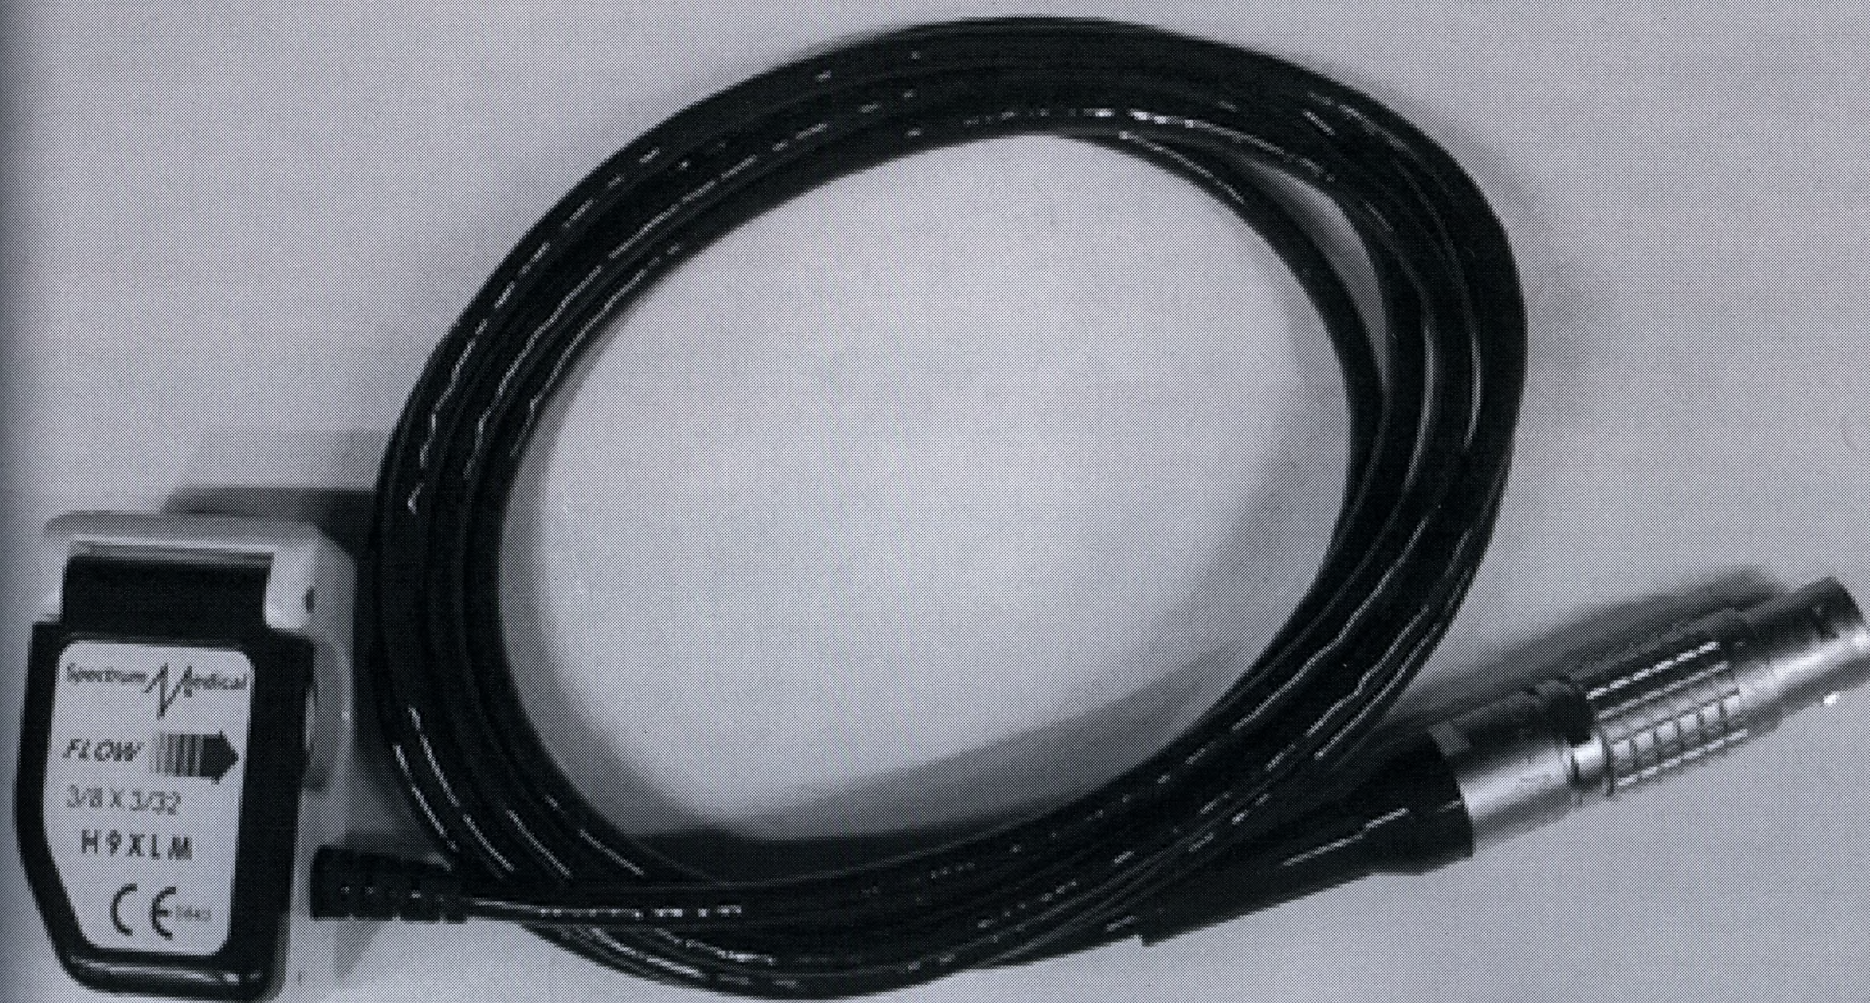

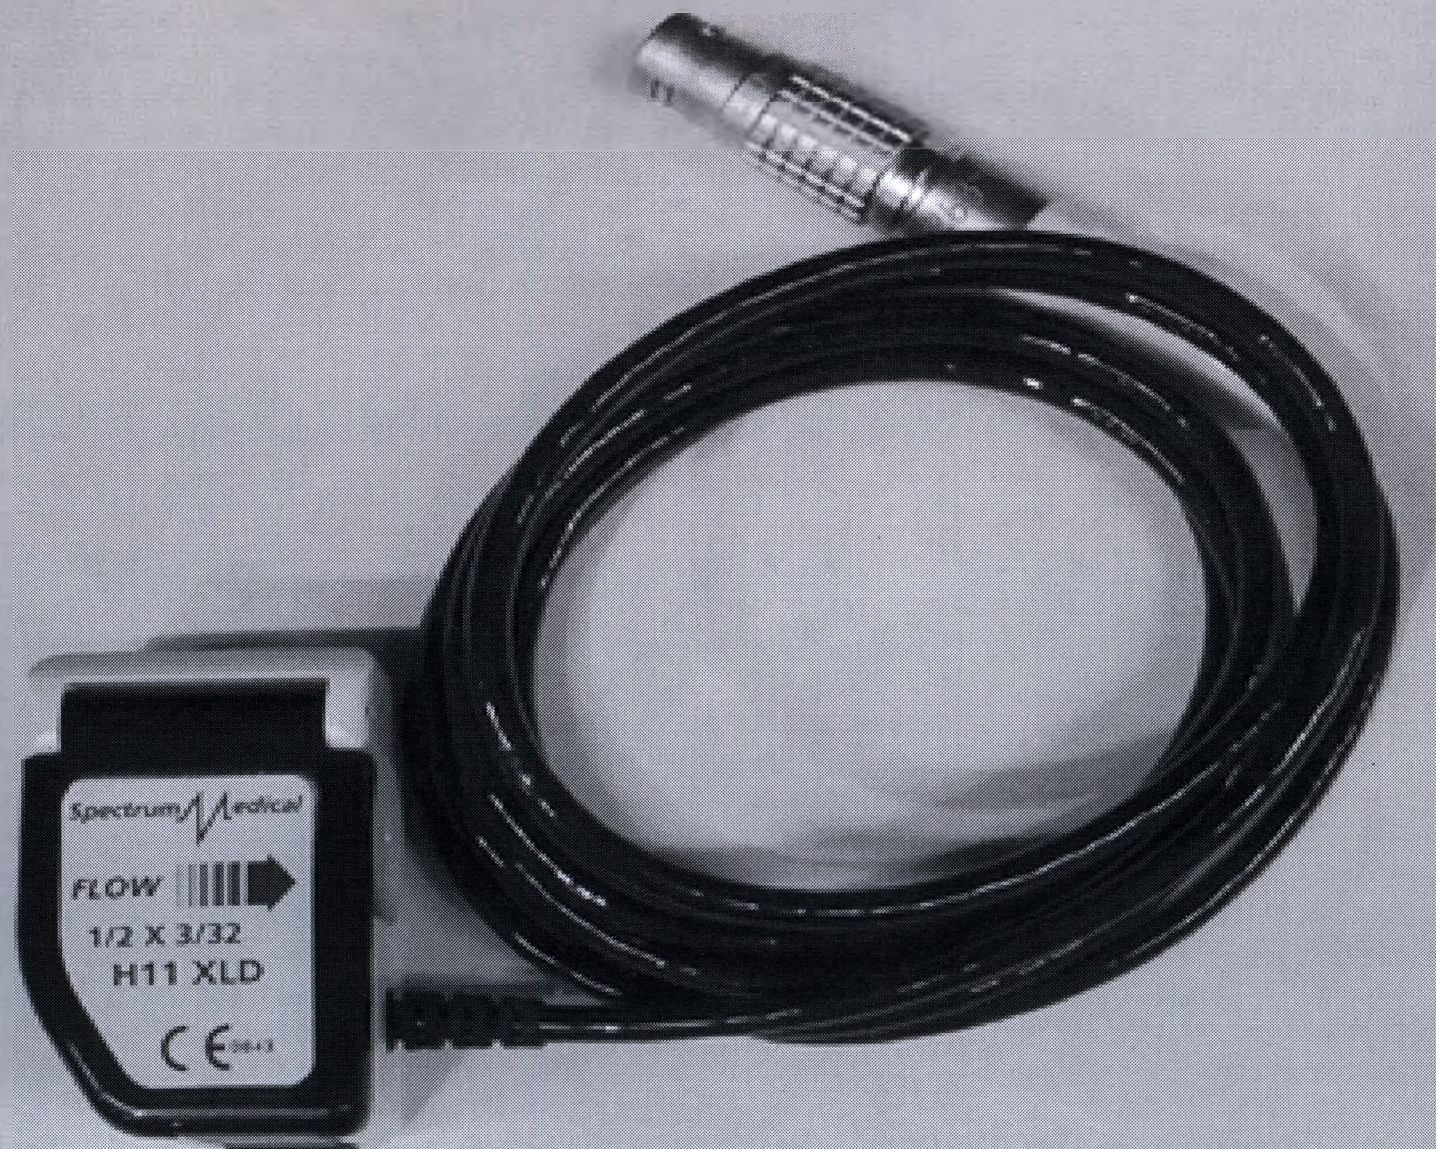




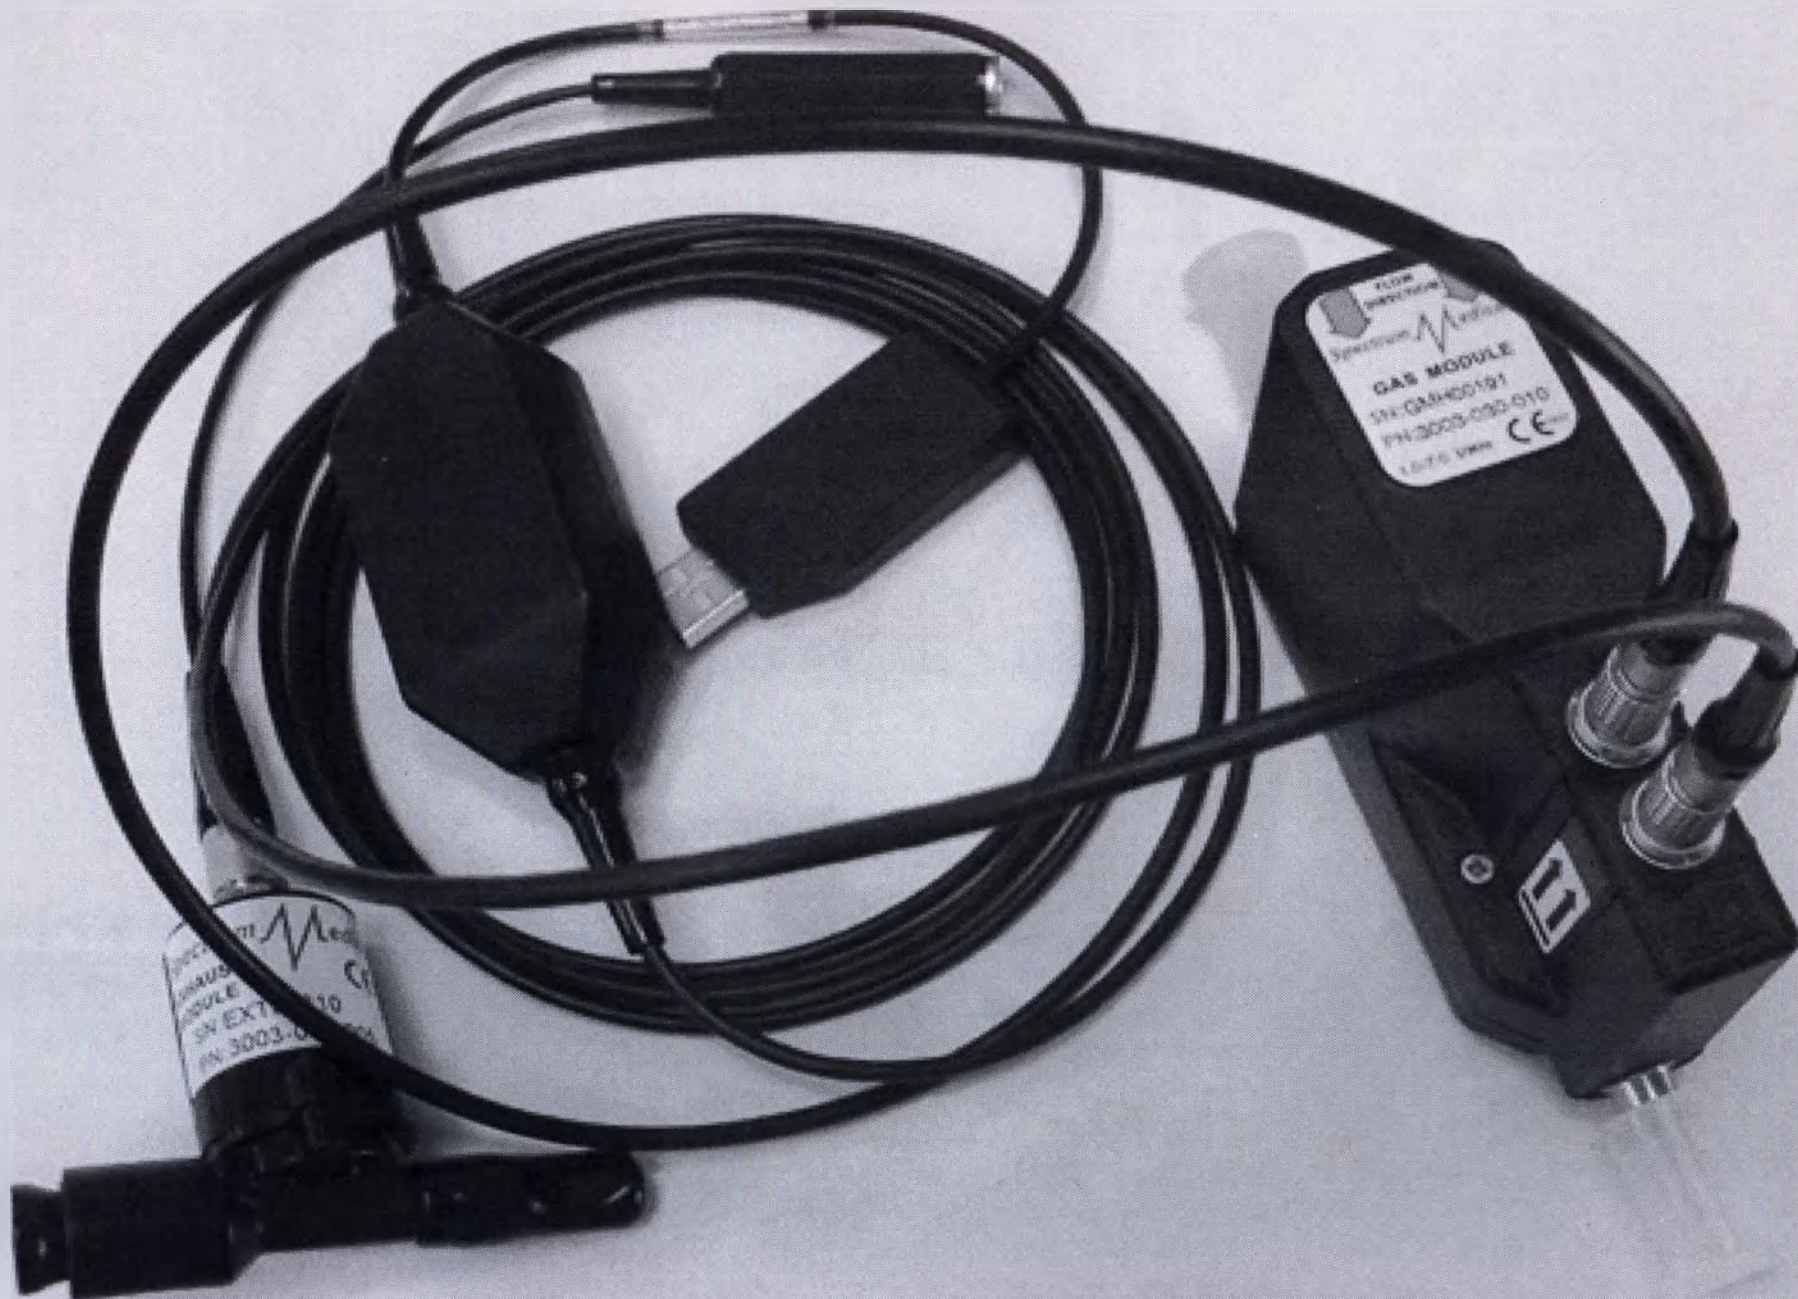




информационный ресурс



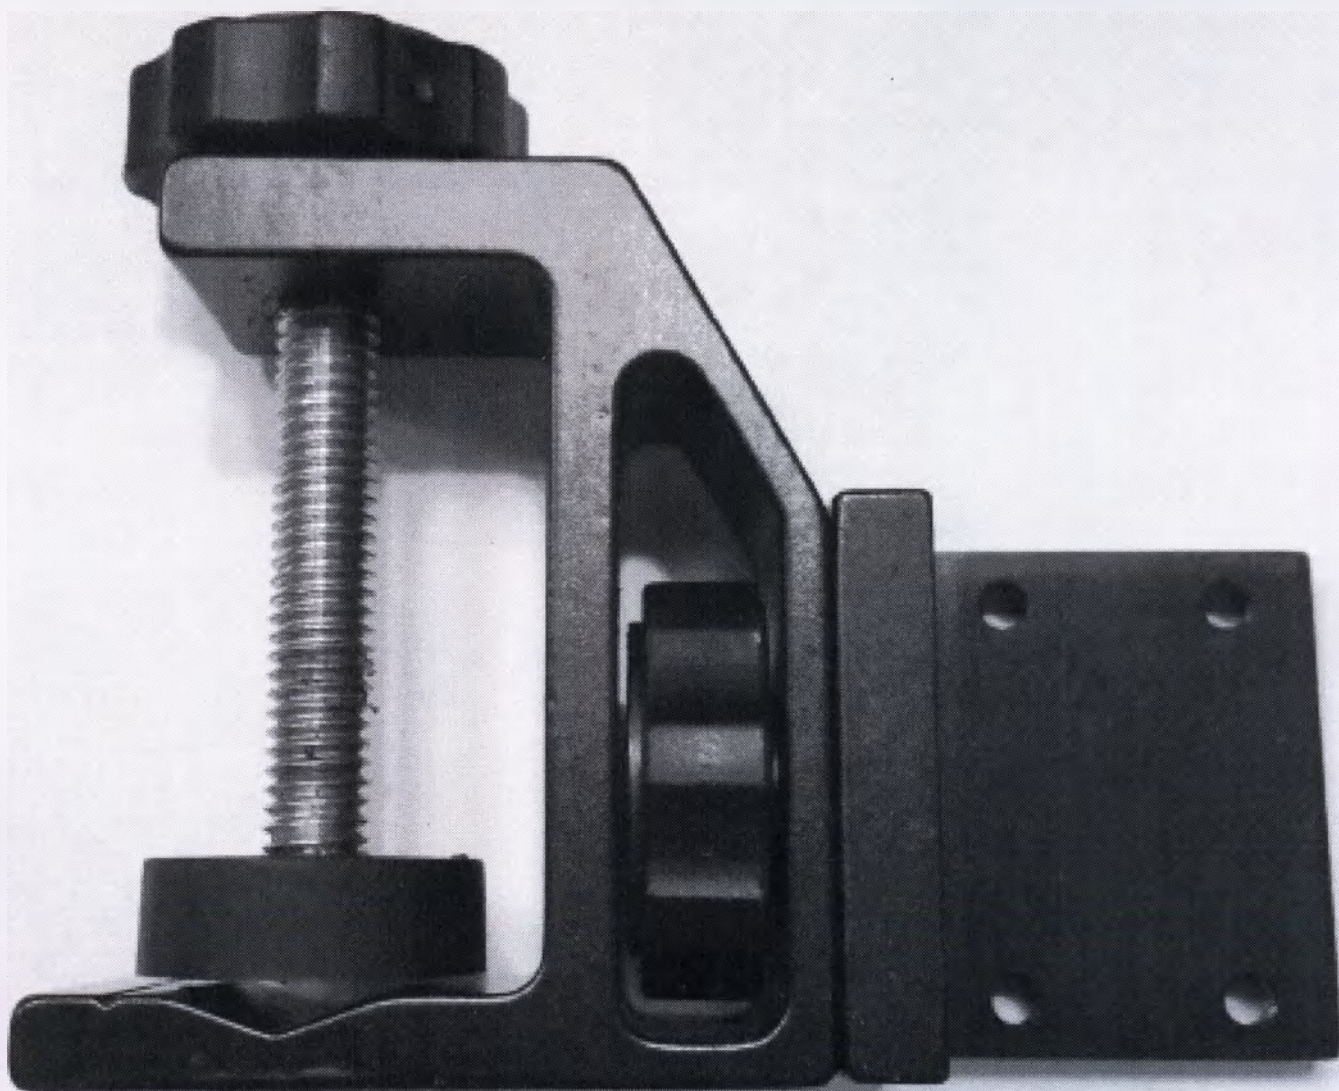

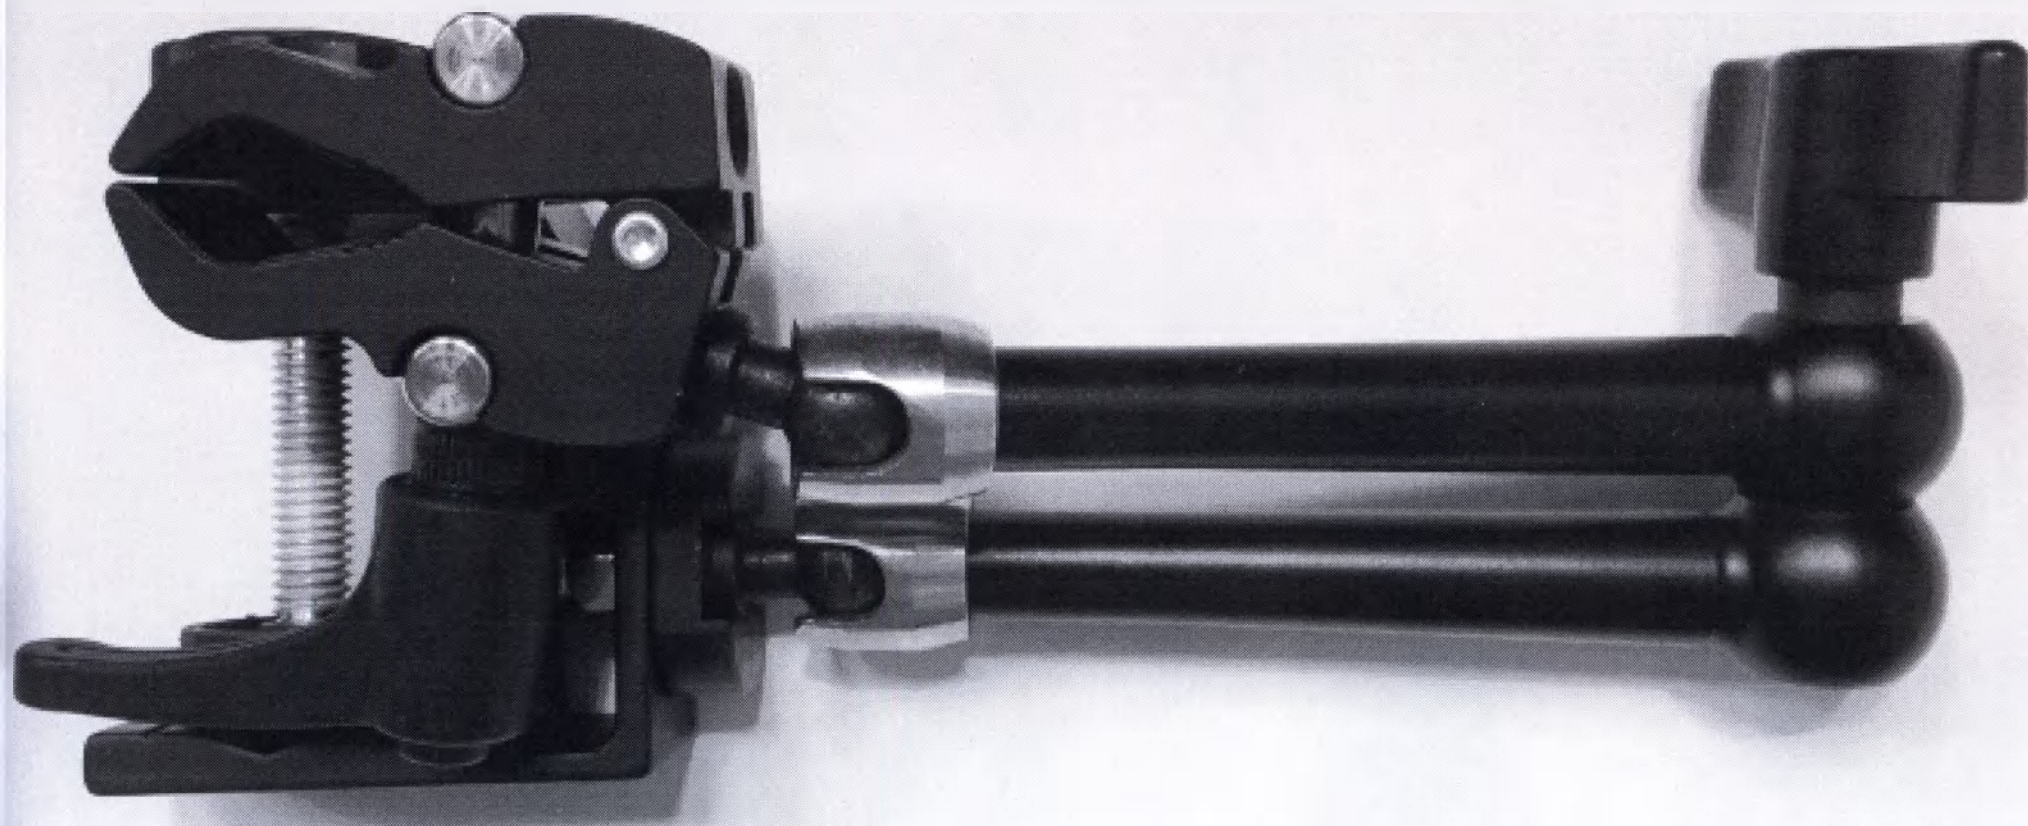



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью ООО «Медтроник»
31 листа(ов)

