

Фотографическое изображения медицинского изделия «Устройство для экспресс-диагностики хеликобактериоза по уреазной активности биоптата (in vitro) тест-система ХЕЛПИЛ® (четыре формы выпуска: Бланк, Стандарт, Планшет, Лента)». Общий вид



Фотографическое изображение медицинского изделия «Устройство для экспресс-диагностики хеликобактериоза по уреазной активности биоптата (in vitro) тест-система ХЕЛПИЛ® (Бланк)»

номер партии: 42650316, дата изготовления: 03.2016, срок годности: 03.2018

Вид с лицевой стороны



Вид с оборотной стороны



Фотографическое изображение медицинского изделия «Устройство для экспресс-диагностики хеликобактериоза по уреазной активности биоптата (in vitro) тест-система ХЕЛПИЛ® (Стандарт)»,

номер партии: 42650316, дата изготовления: 03.2016, срок годности: 03.2018

Вид с лицевой стороны



Вид с обратной стороны



Фотографическое изображение медицинского изделия «Устройство для экспресс-диагностики хеликобактериоза по уреазной активности биоптата (in vitro) тест-система ХЕЛПИЛ® (Планшет)»

номер партии: 42650316, дата изготовления: 03.2016, срок годности: 03.2018

Вид с лицевой стороны



Вид с обратной стороны




Фотографическое изображение медицинского изделия «Устройство для экспресс-диагностики хеликобактериоза по уреазной активности биоптата (in vitro) тест-система ХЕЛПИЛ® (Лента)»

номер партии: 42650316, дата изготовления: 03.2016, срок годности: 09.2017

Вид с лицевой стороны




Вид с оборотной стороны

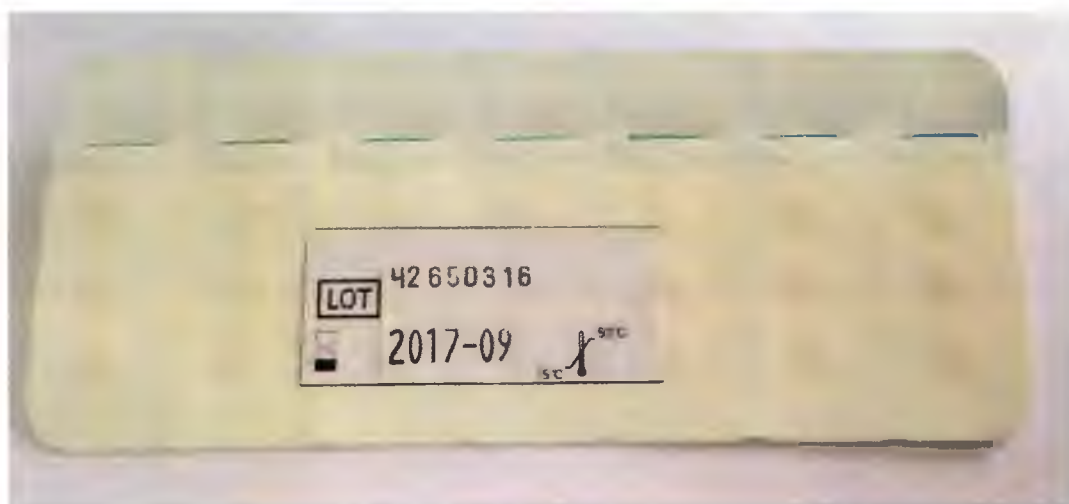

Фотографическое изображения медицинского изделия «Устройство для экспресс-диагностики хеликобактериоза по уреазной активности биоптата (in vitro) тест-система ХЕЛПИЛ® (четыре формы выпуска: Бланк, Стандарт, Планшет, Лента)»

Маркировка картонных коробок

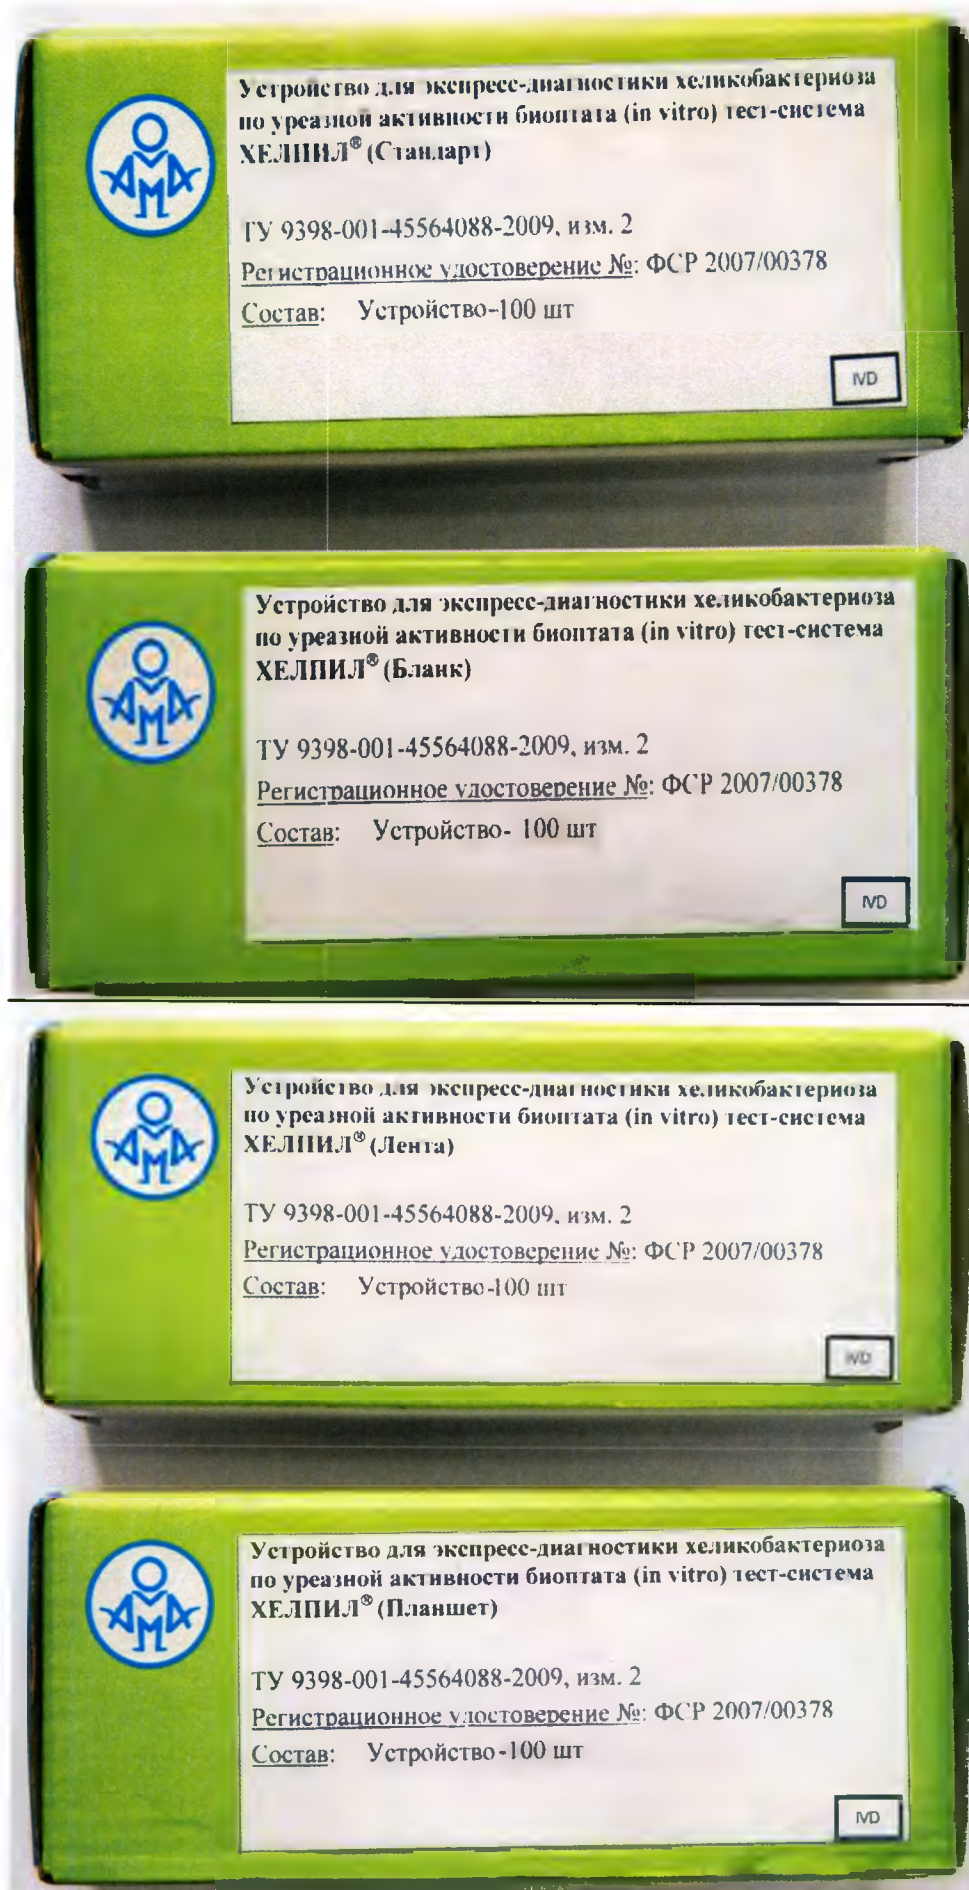

Условия хранения: Хранение устройств должно осуществляться в упаковке изготовителя при температуре от плюс 15 °С до плюс 50 °С в защищенном от света месте. Место хранения должно быть защищено от возможных механических воздействий (трение, давление, удары). Изделия необходимо беречь от паров аммиака, попадания прямого солнечного света и влаги. После открытия пленки неиспользованные индикаторные диски устройства необходимо использовать в течение 8 часов

