

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «МедРегистратор»



Е. Е. Жвакина


2017г.


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Система экстракорпоральной ударно-волновой литотрипсии
(литотриптер) Esonolith моделей E3000, EM1000 с
принадлежностями

I. Базовый состав модели Econolith E3000:

1. Модуль ударно – волновой Shock-Wave Unit SW-6 с генератором ударных волн HVG SG-3.

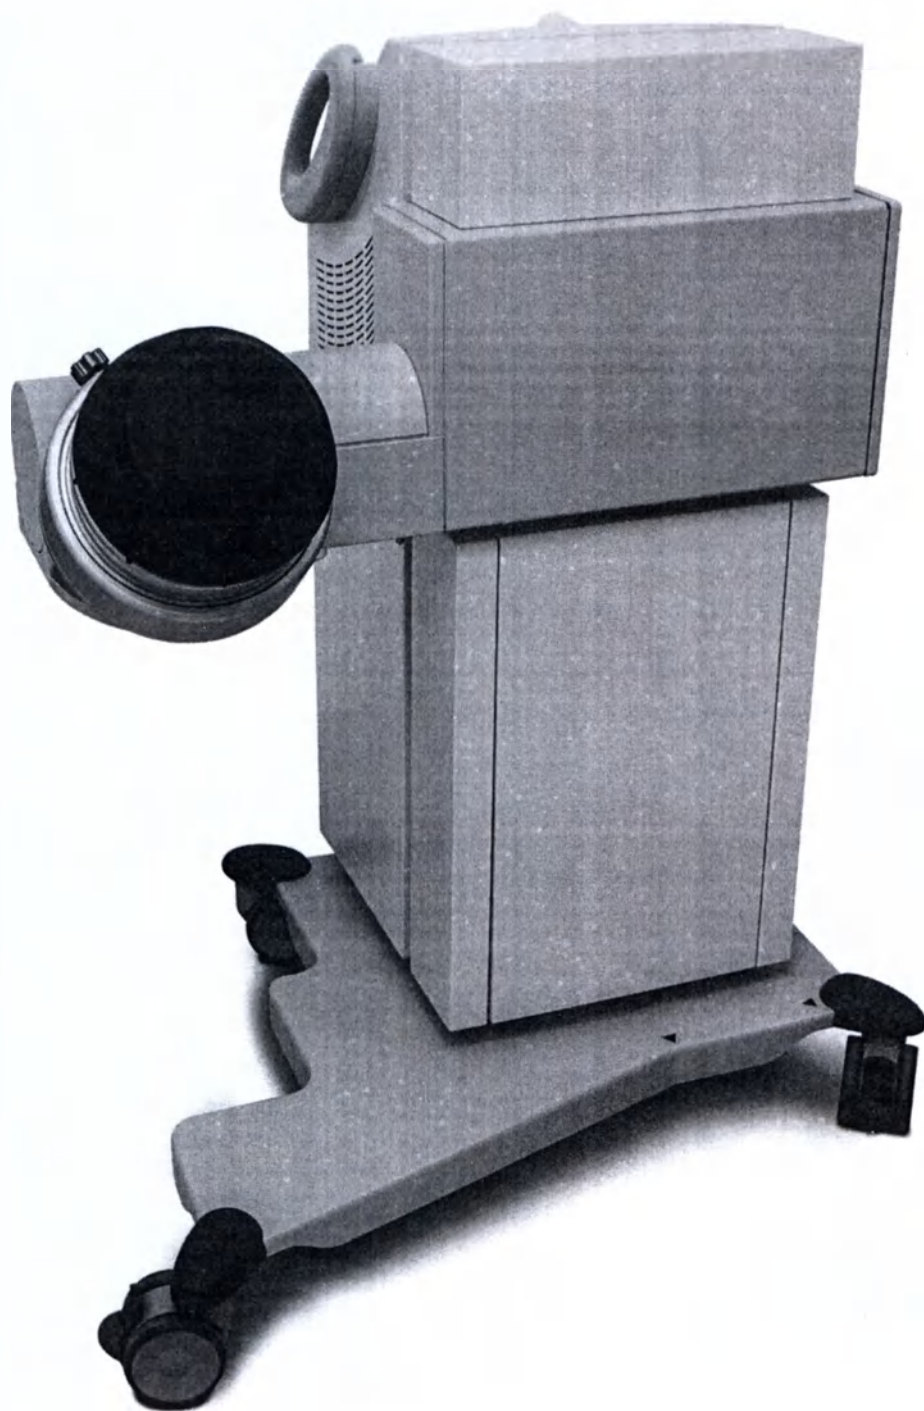


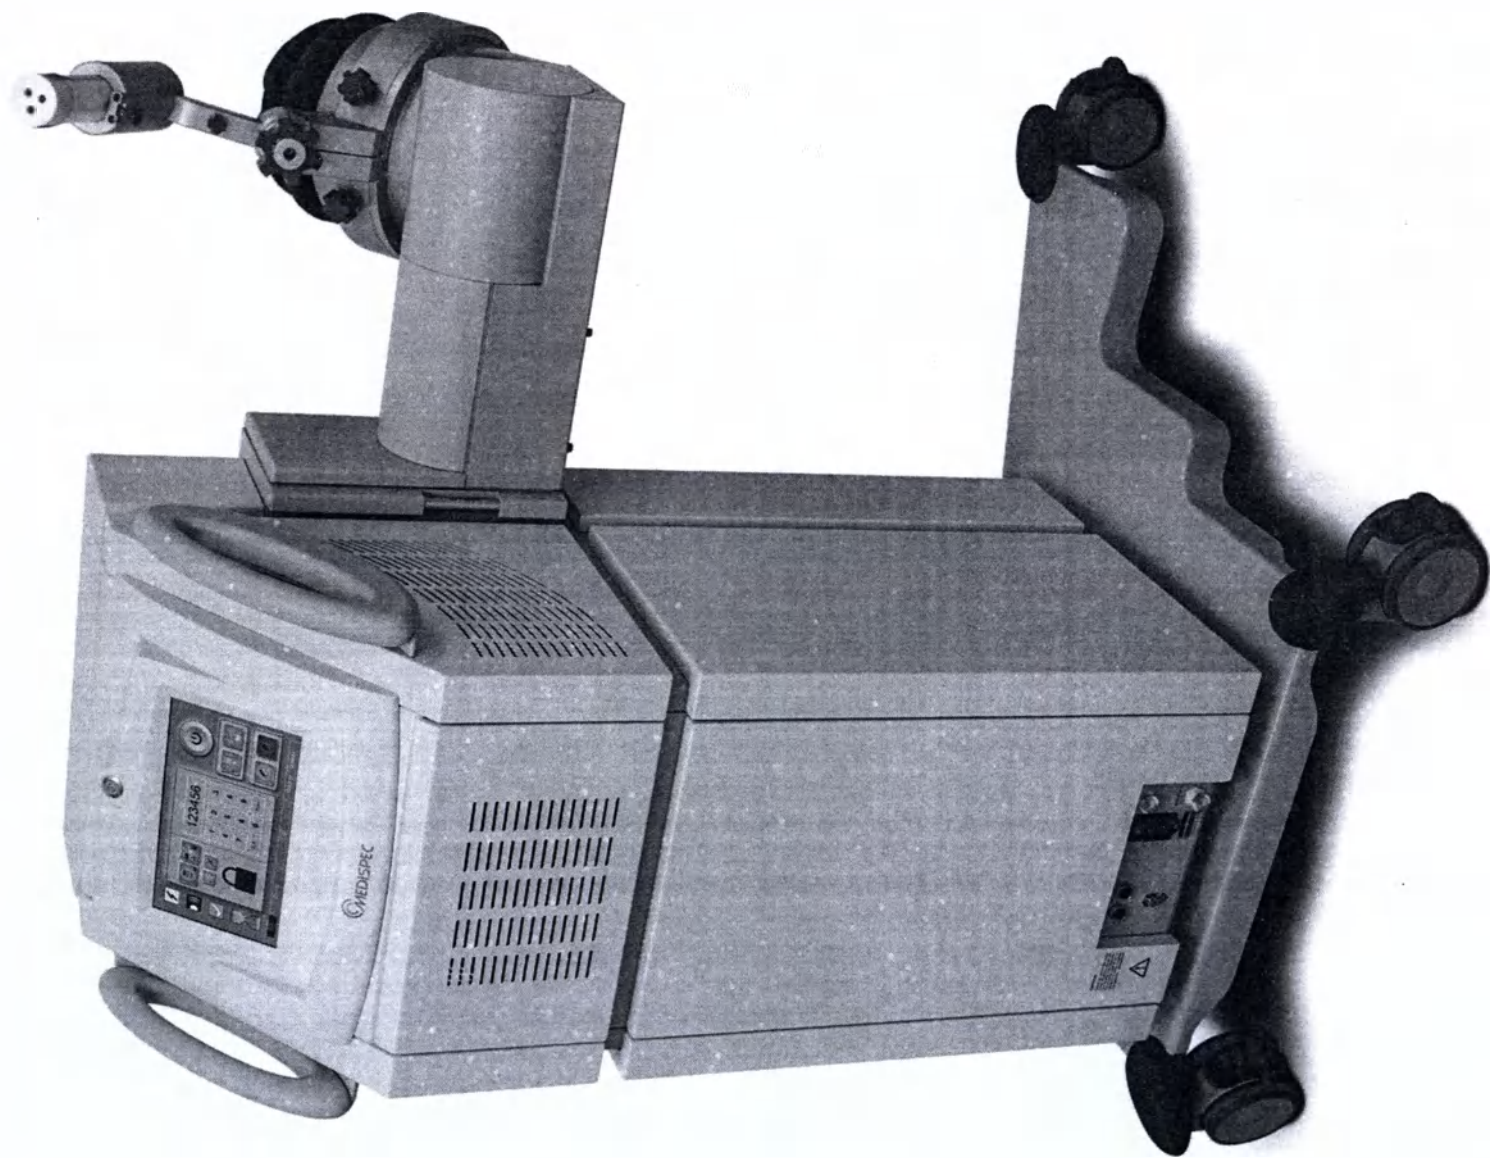


2. Стол пациента многофункциональный Treatment Table Wide 4-axes TT-4




3. С-дуга рентгеновская Visionspec XR-5 рентгеновской локализации (наведения).

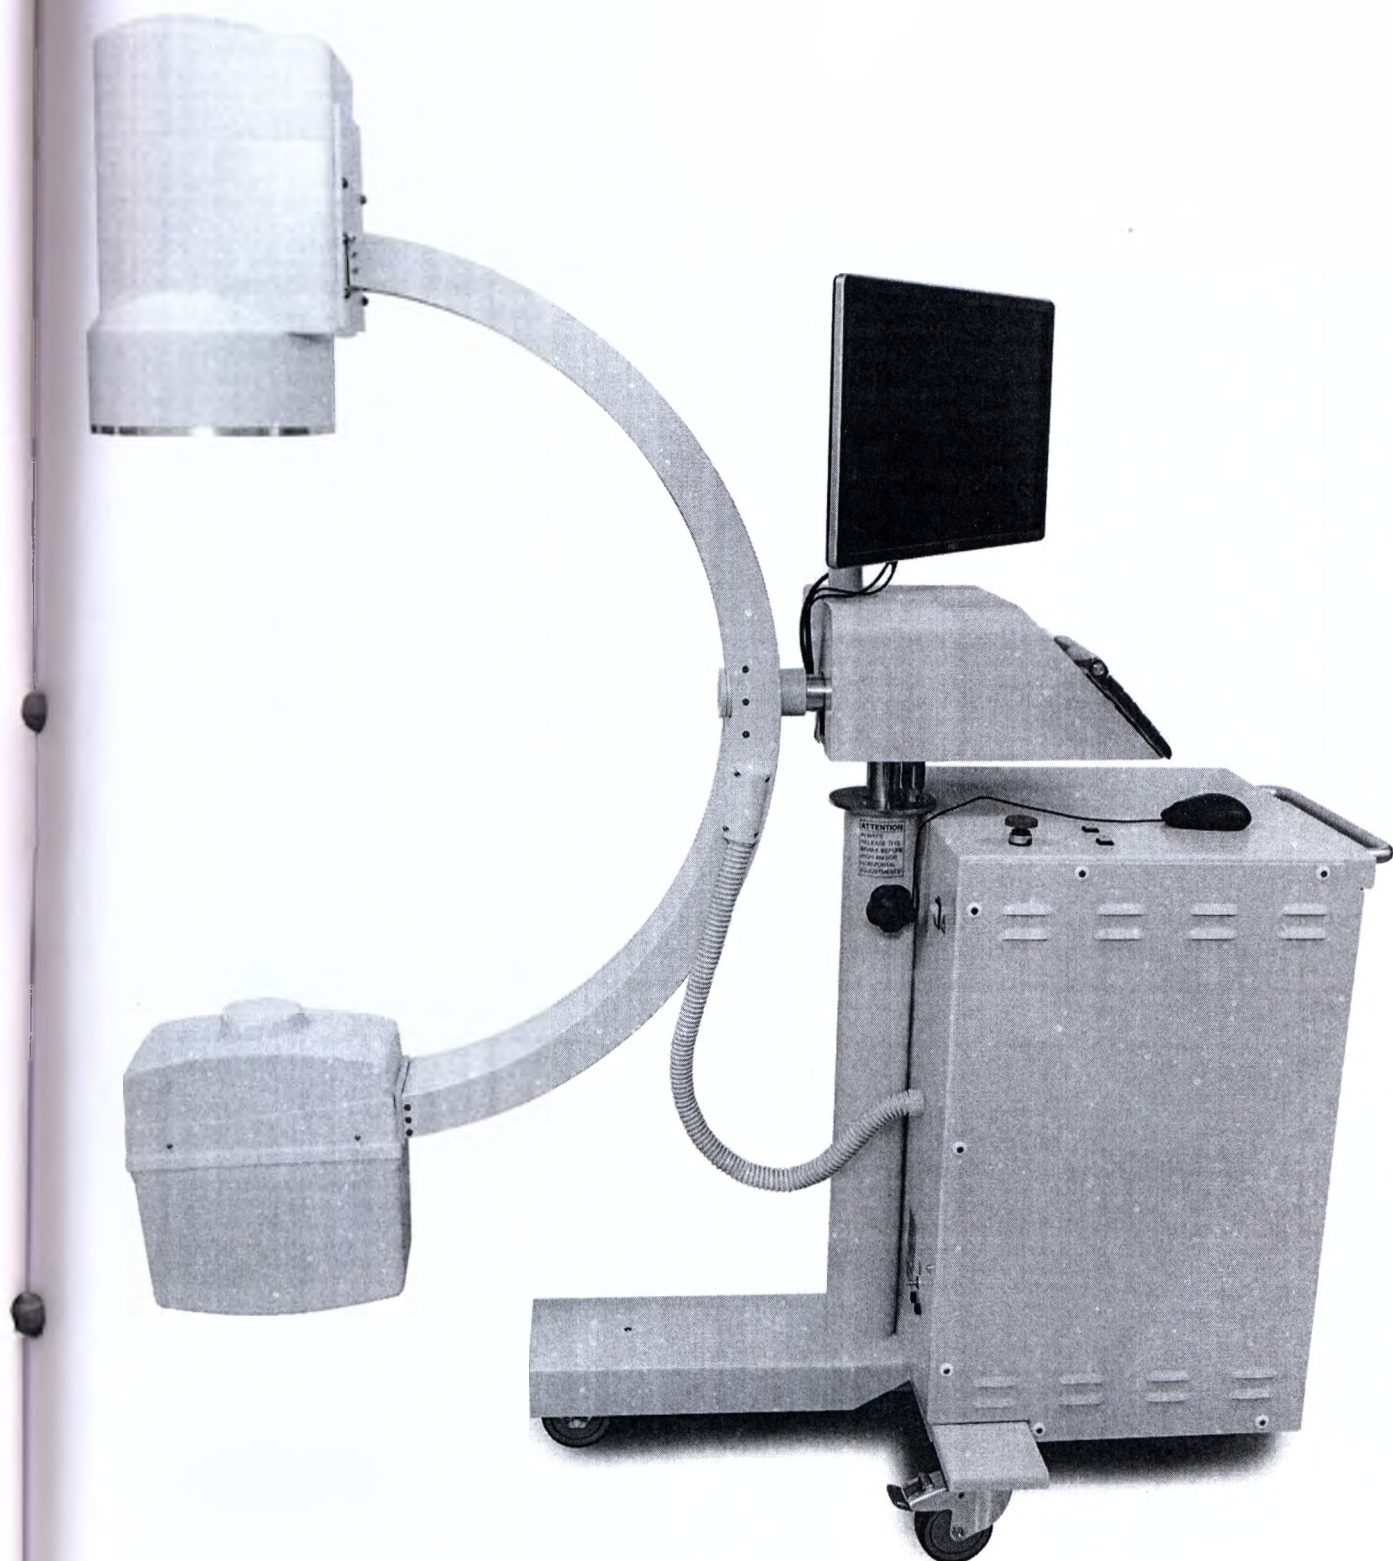

4. Тестер универсальный для контроля фрагментации

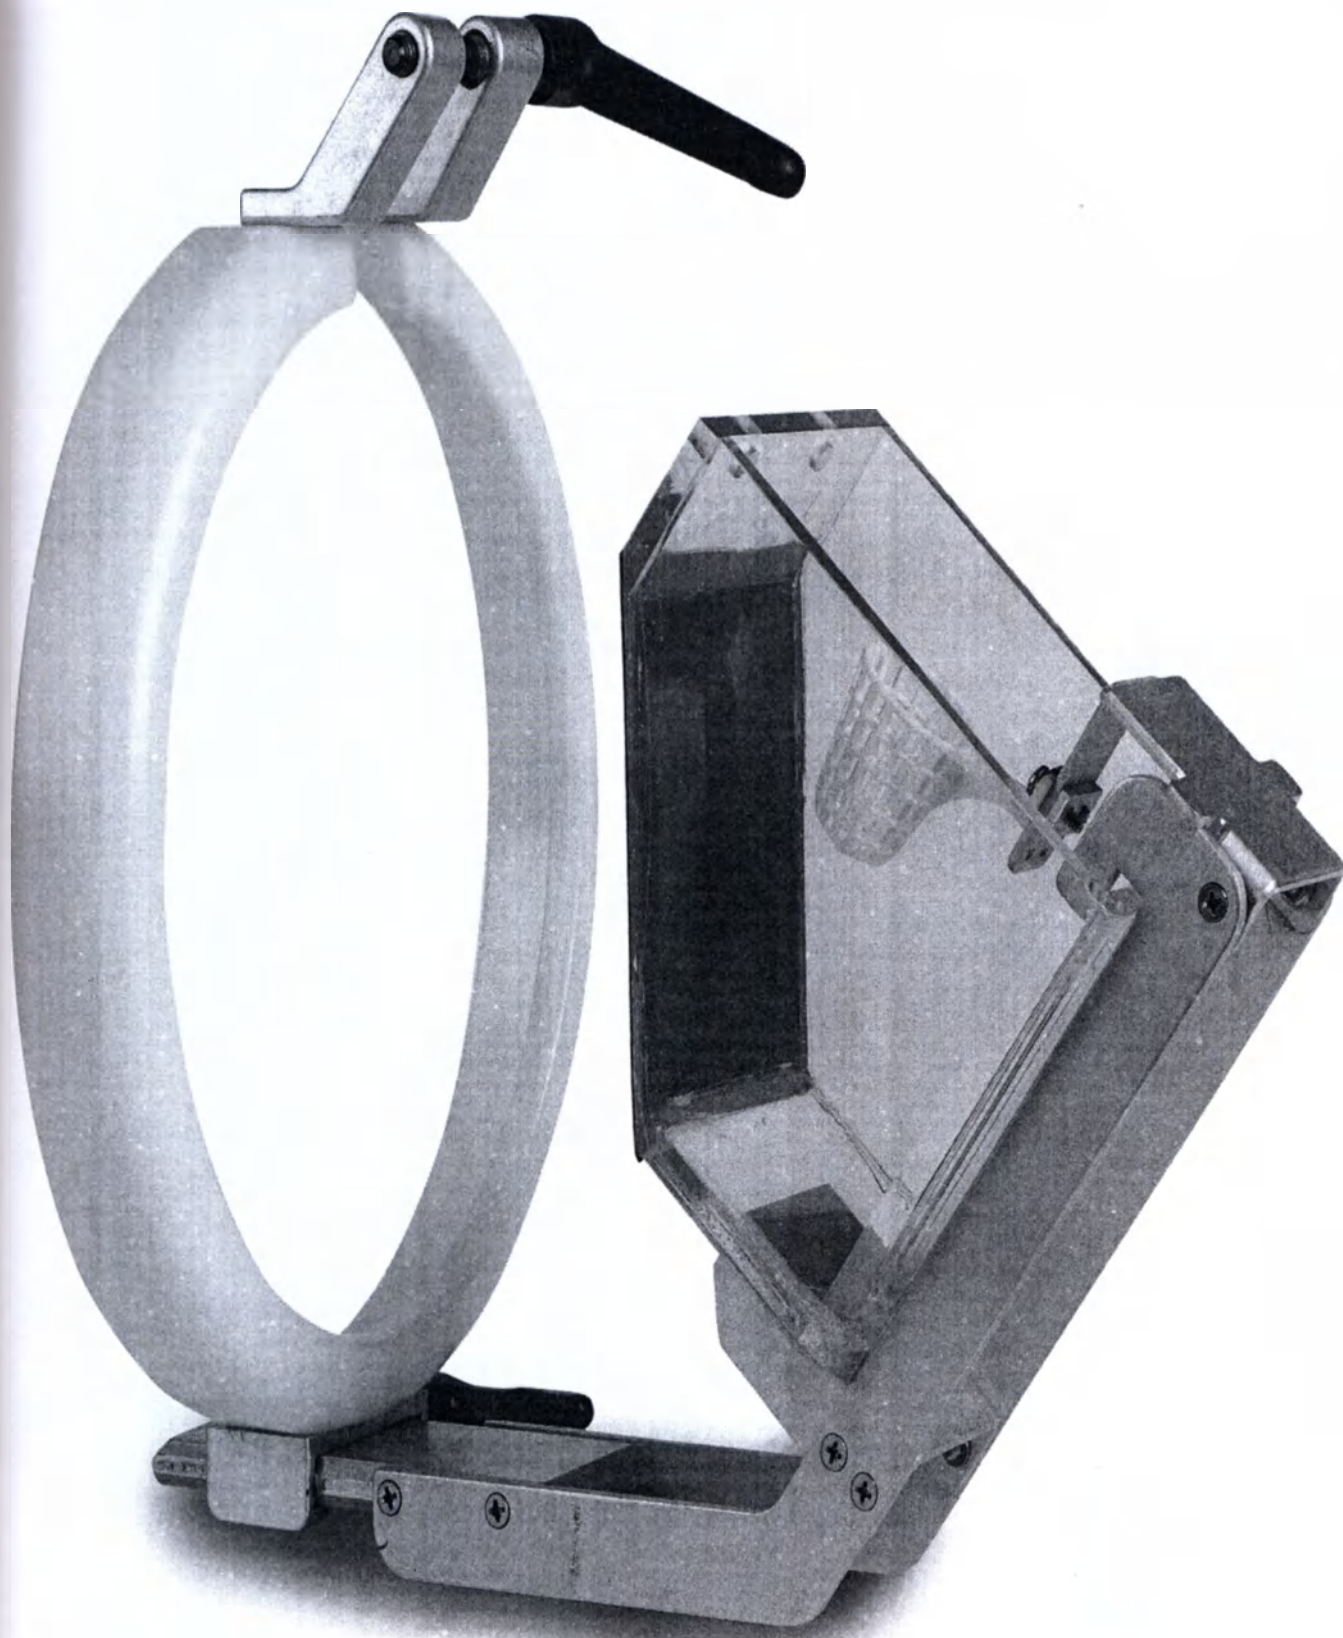


5. Шарики для тестов диаметра 9'' для тестового дробления перед началом лечения-не более 20 шт.

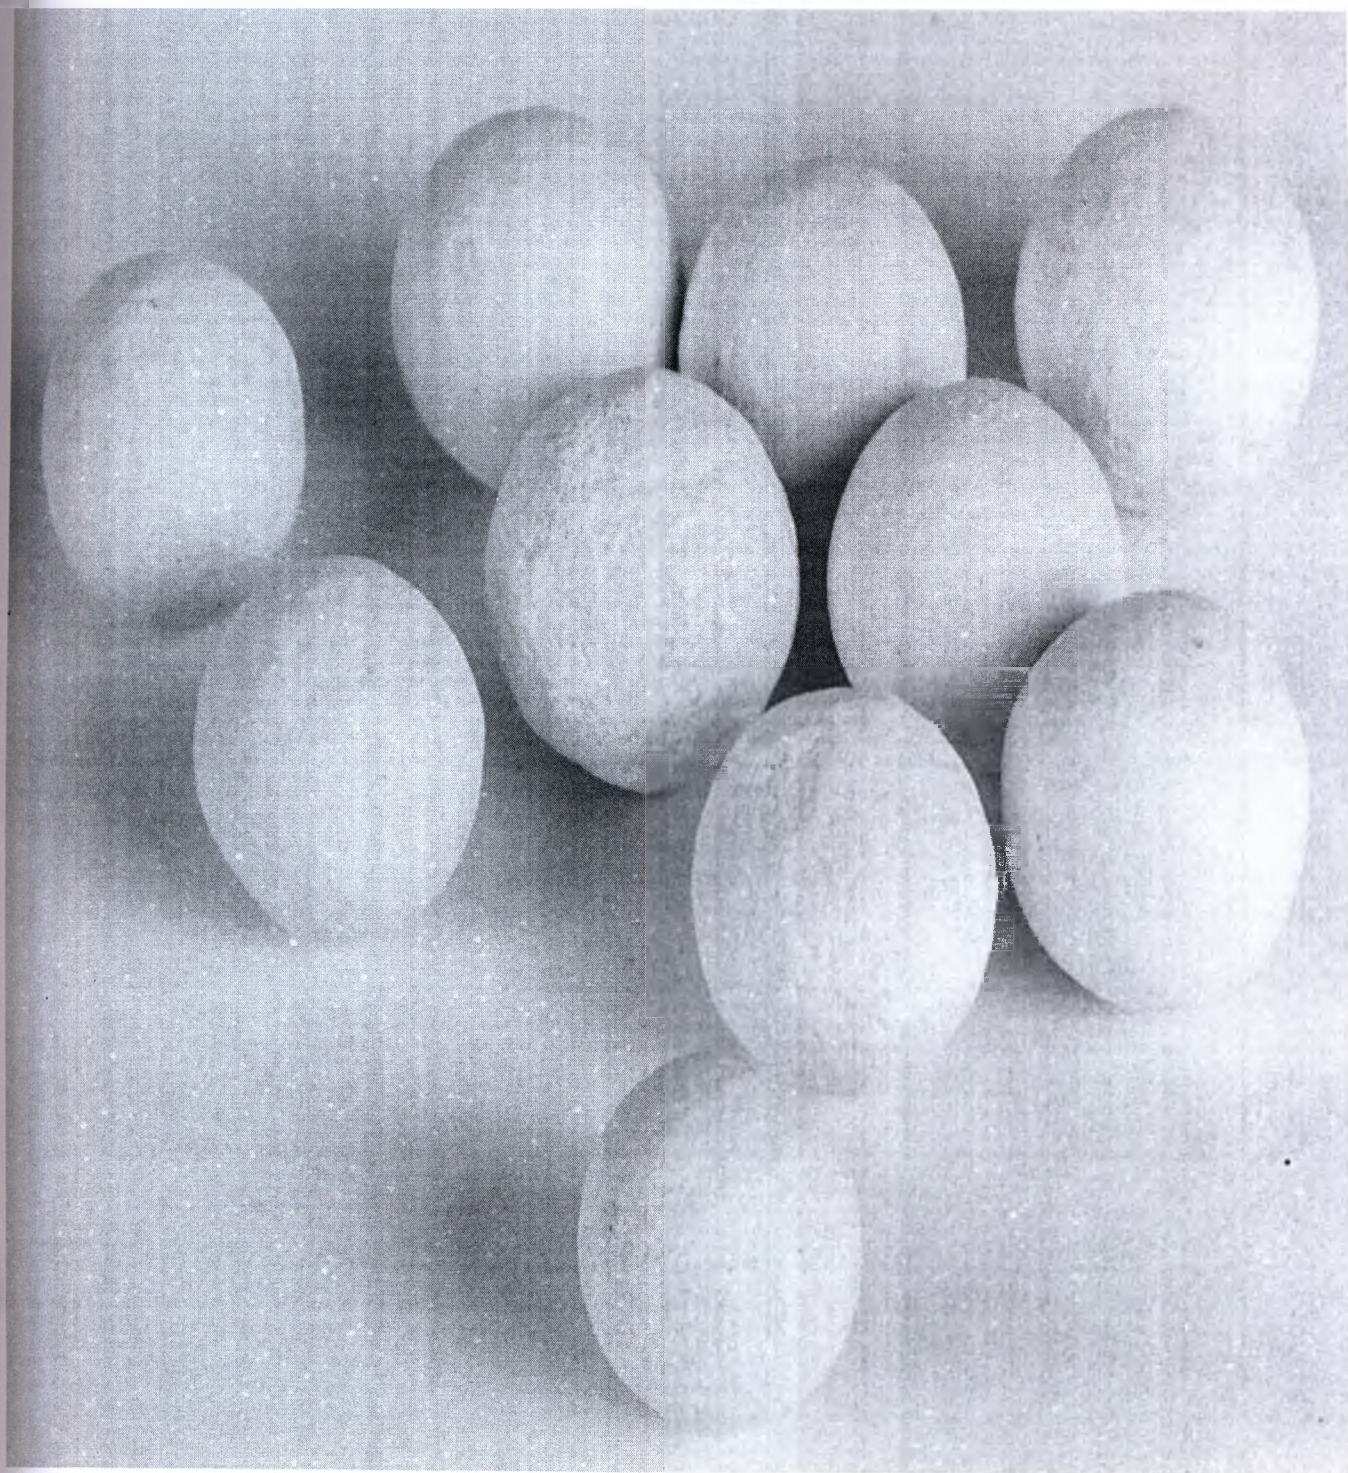

6. Документация: Руководство по эксплуатации на Систему экстракорпоральной ударно-волновой литотрипсии (литотриптер) Esonolith модели E3000 с принадлежностями;




7. Руководство по эксплуатации на С-дугу рентгеновскую Visionspec XR-5 рентгеновской локализации (наведения);

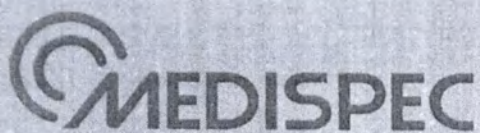

С-дуга рентгеновская
Visionspec XR-5
рентгеновской локализации
(наведения)

РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ



РЕДАКЦИЯ А


GROUND BREAKING TECHNOLOGY
Within Your Reach

8. Руководство по эксплуатации на Стол пациента многофункциональный Treatment Table Wide 4-axes TT-4



Стол пациента
многофункциональный
Treatment Table Wide 4-axes
TT-4

РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

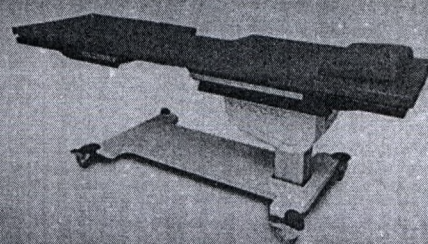


Редакция А

GROUND BREAKING TECHNOLOGY WITHIN YOUR REACH

II. Принадлежности:


1. Генератор ударных волн HVG SG 3 (дополнительно, при необходимости)

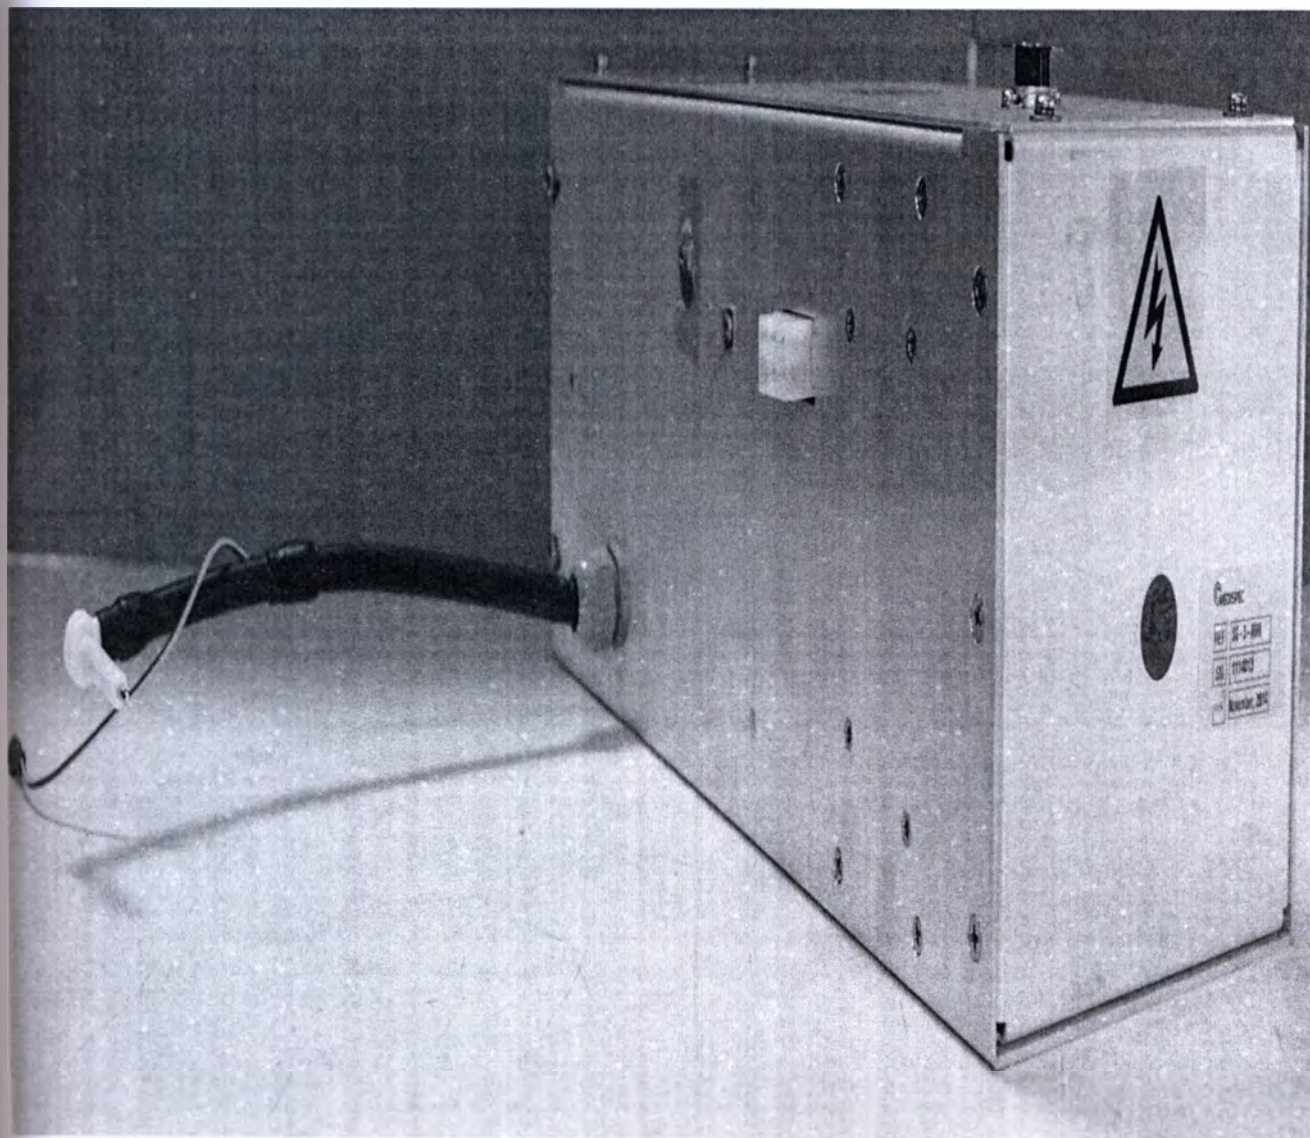

2. Манипулятор типа «мышь», не более 2-х шт.




3. Клавиатура, не более 2 шт

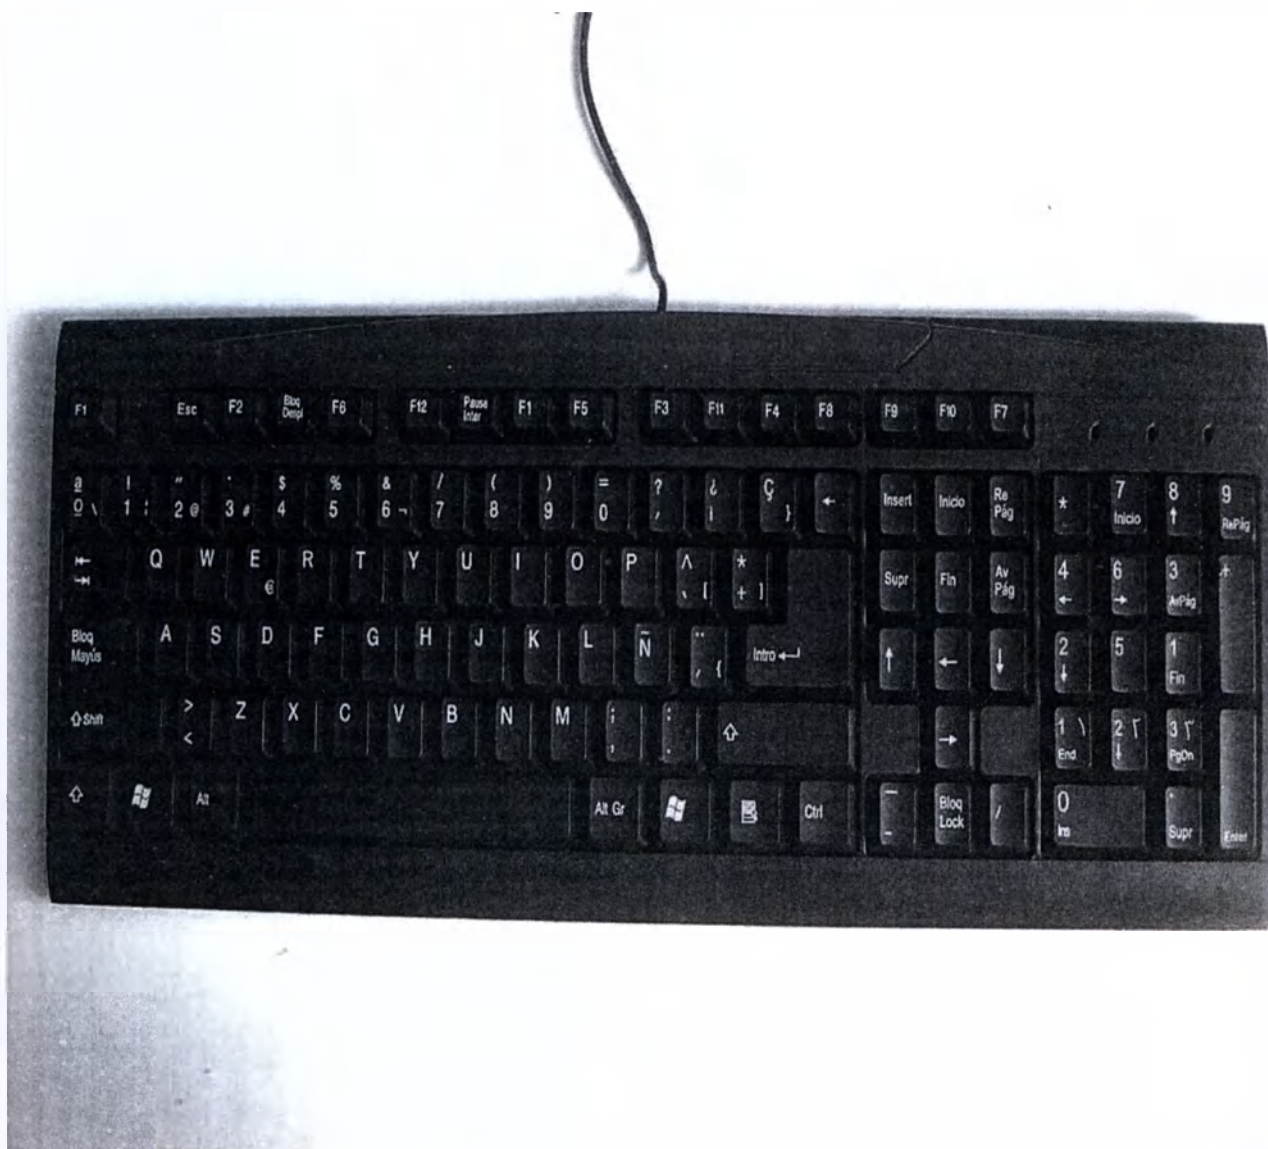


4. Монитор системы визуализации, не более 4-х шт



5. Кабель ЭКГ универсальный (опционально, по требованию заказчика)

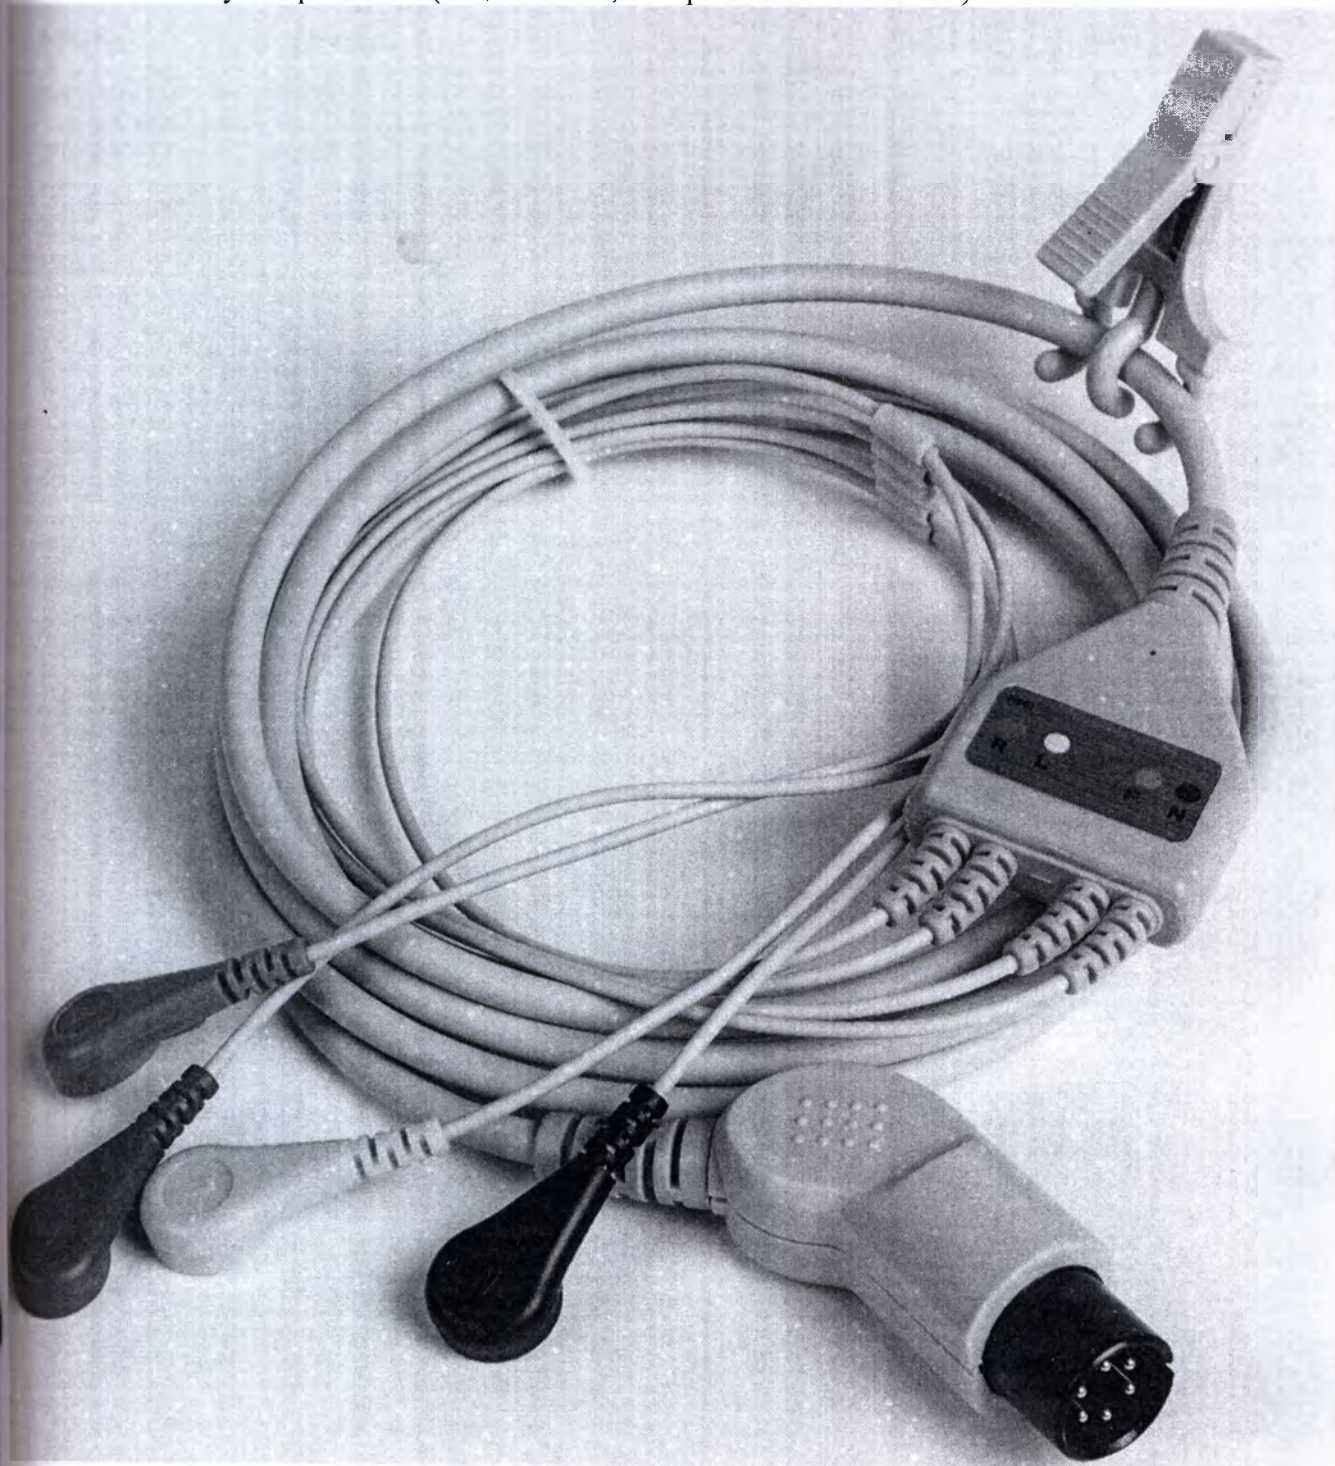


6. Кабели соединительные прочие, не более 10 штук.

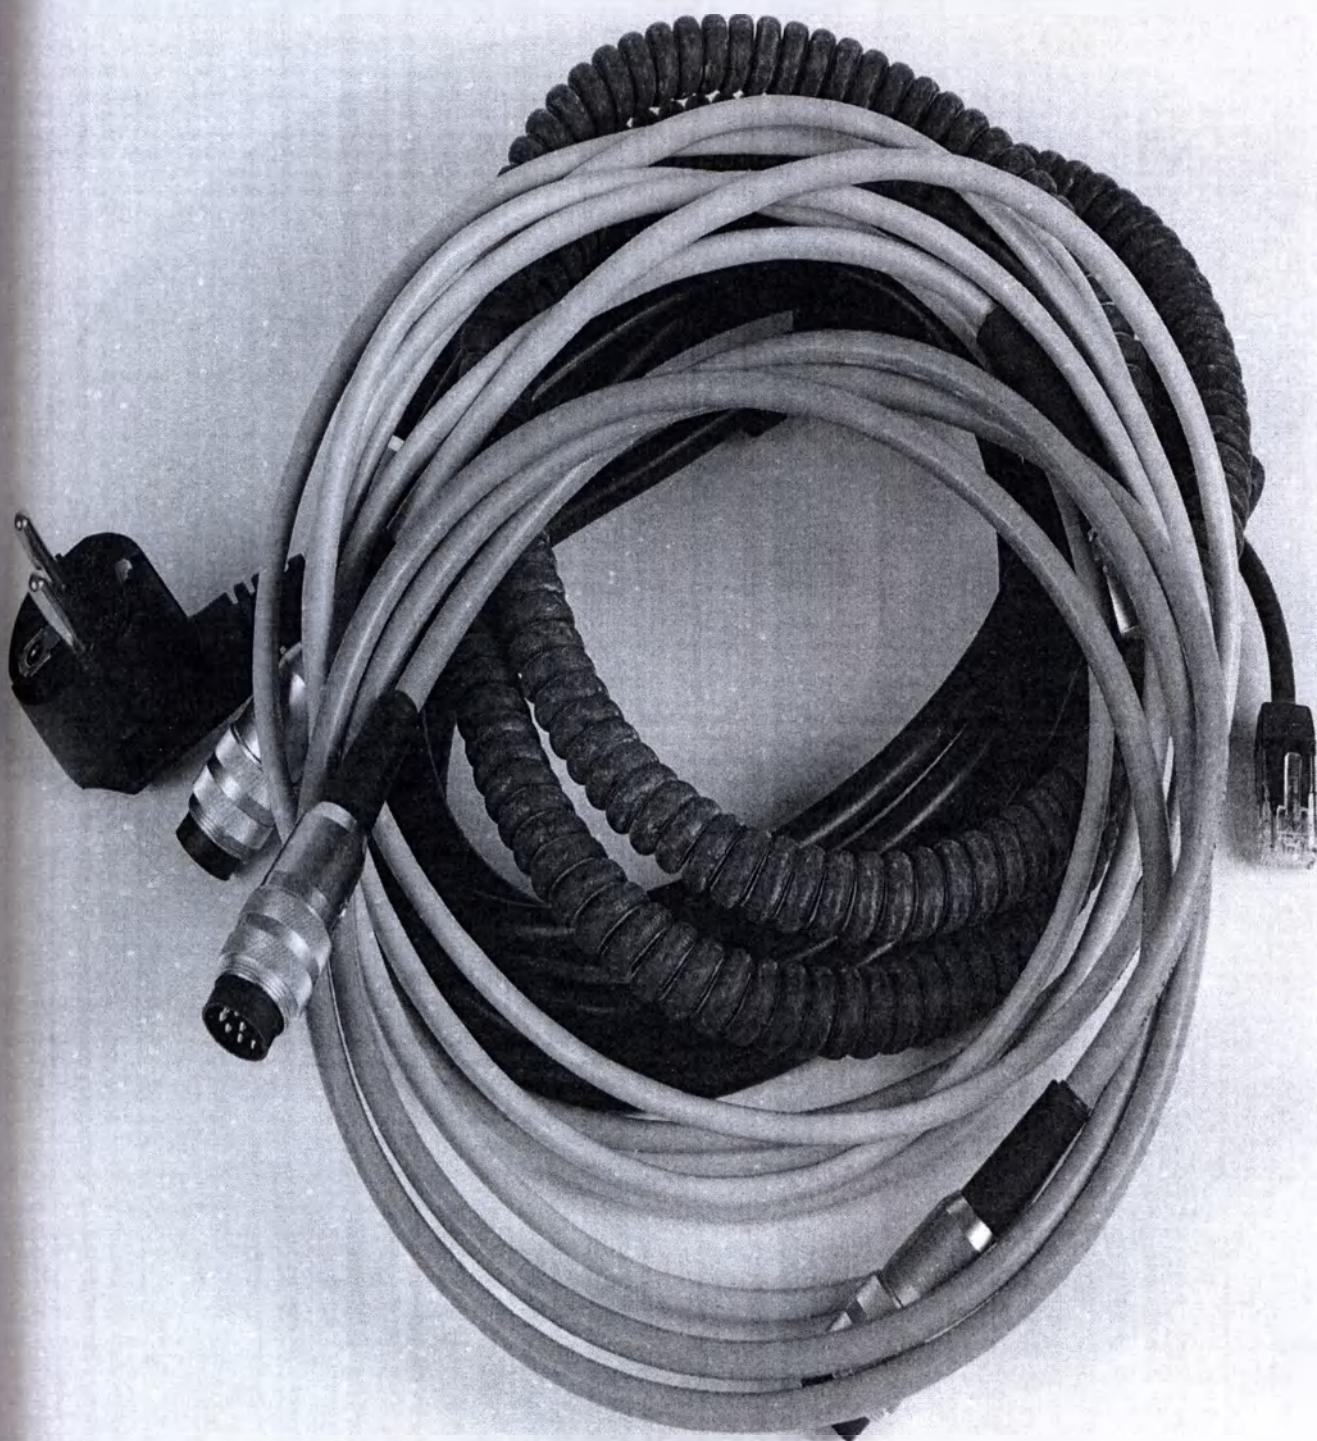


7. Мембрана смыкающая Coupling Membrane SW-6-D002, не более 10 шт




8. Педаль рентгена, не более 2 шт

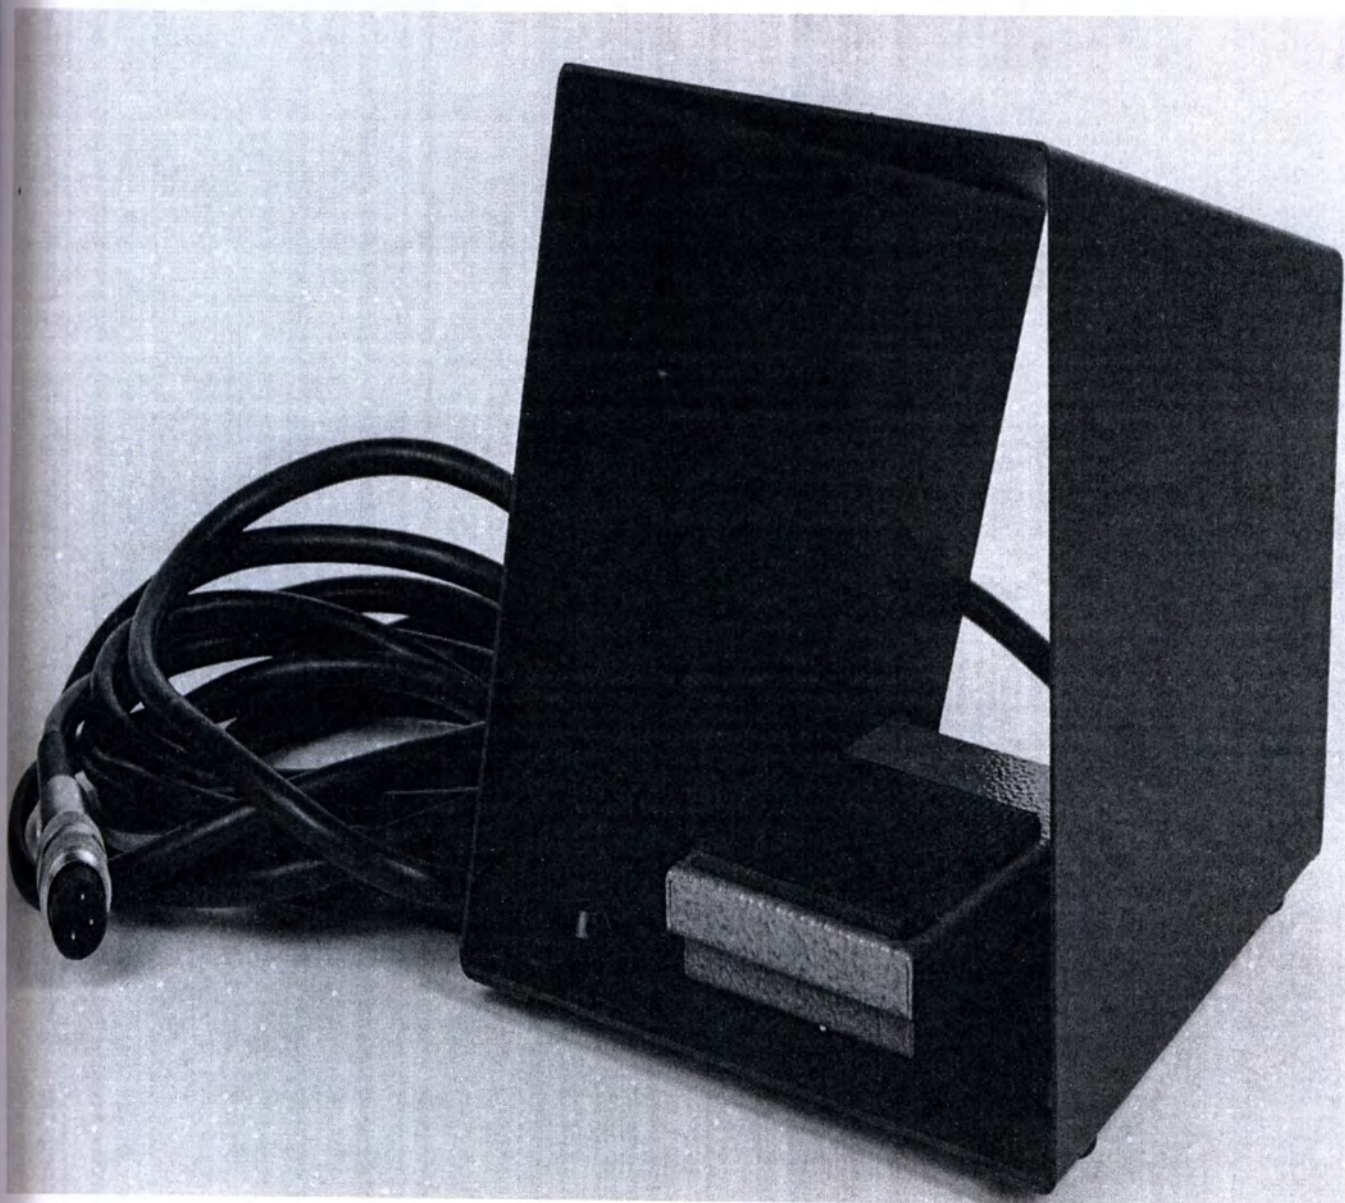

9. Пойнтер для калибровки системы визуализации.

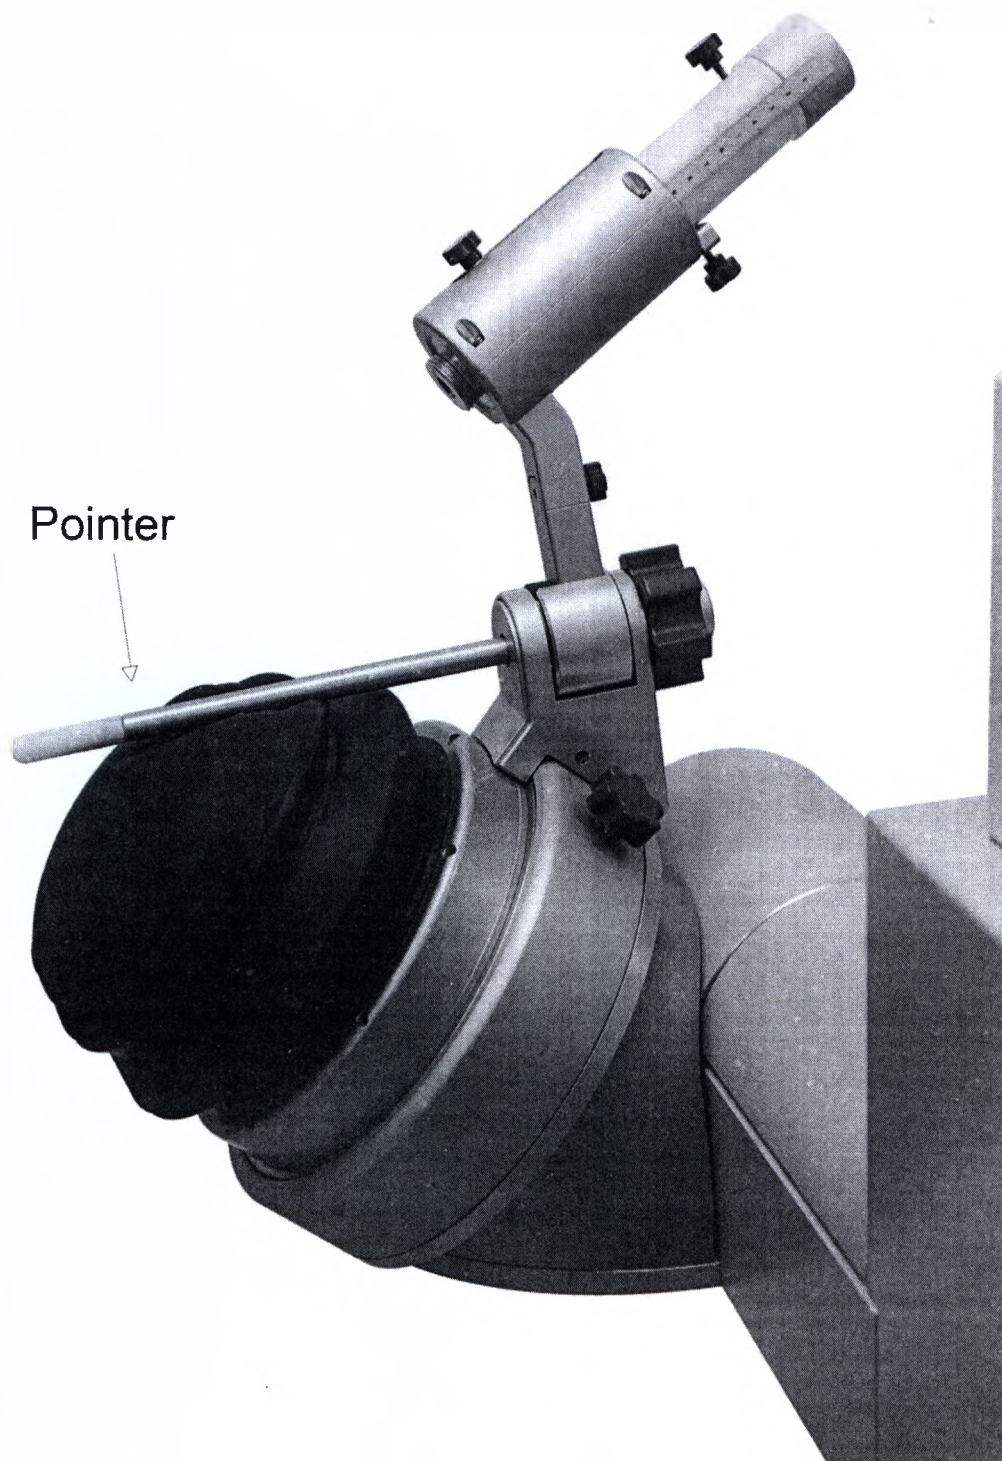


10. Универсальный держатель для датчика ультразвукового аппарата

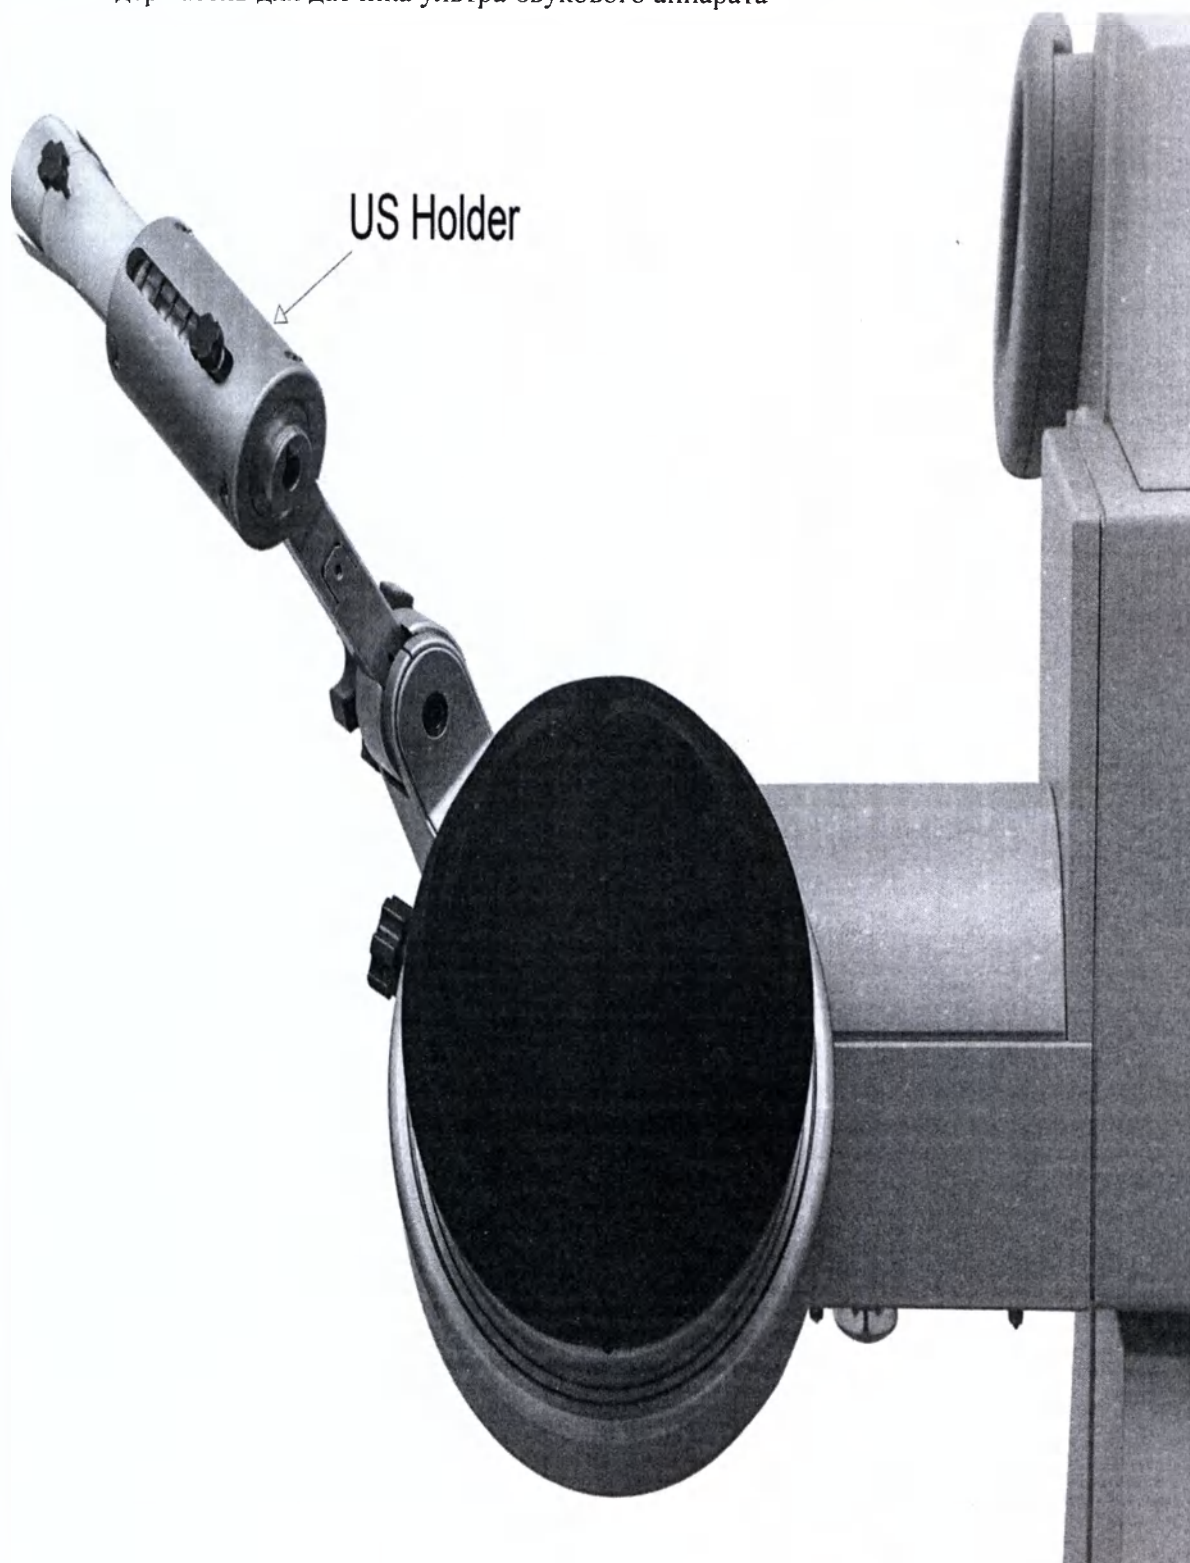


11. Покрытие стола пациента



12. Опора съемная для ног пациента с креплением для стола, не более 4 шт.

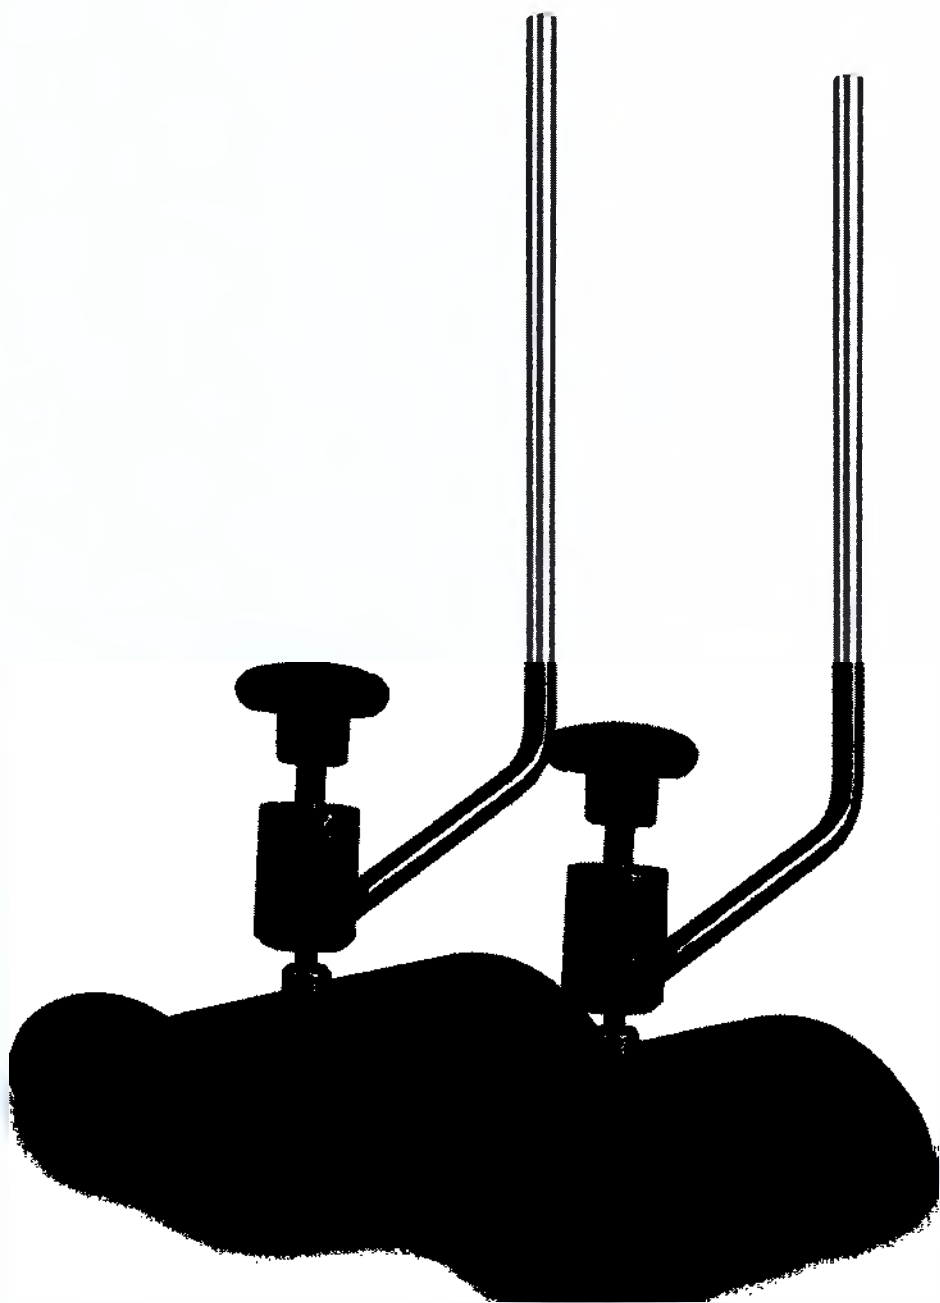

13. Электропривод движения стола по осям X и Y.

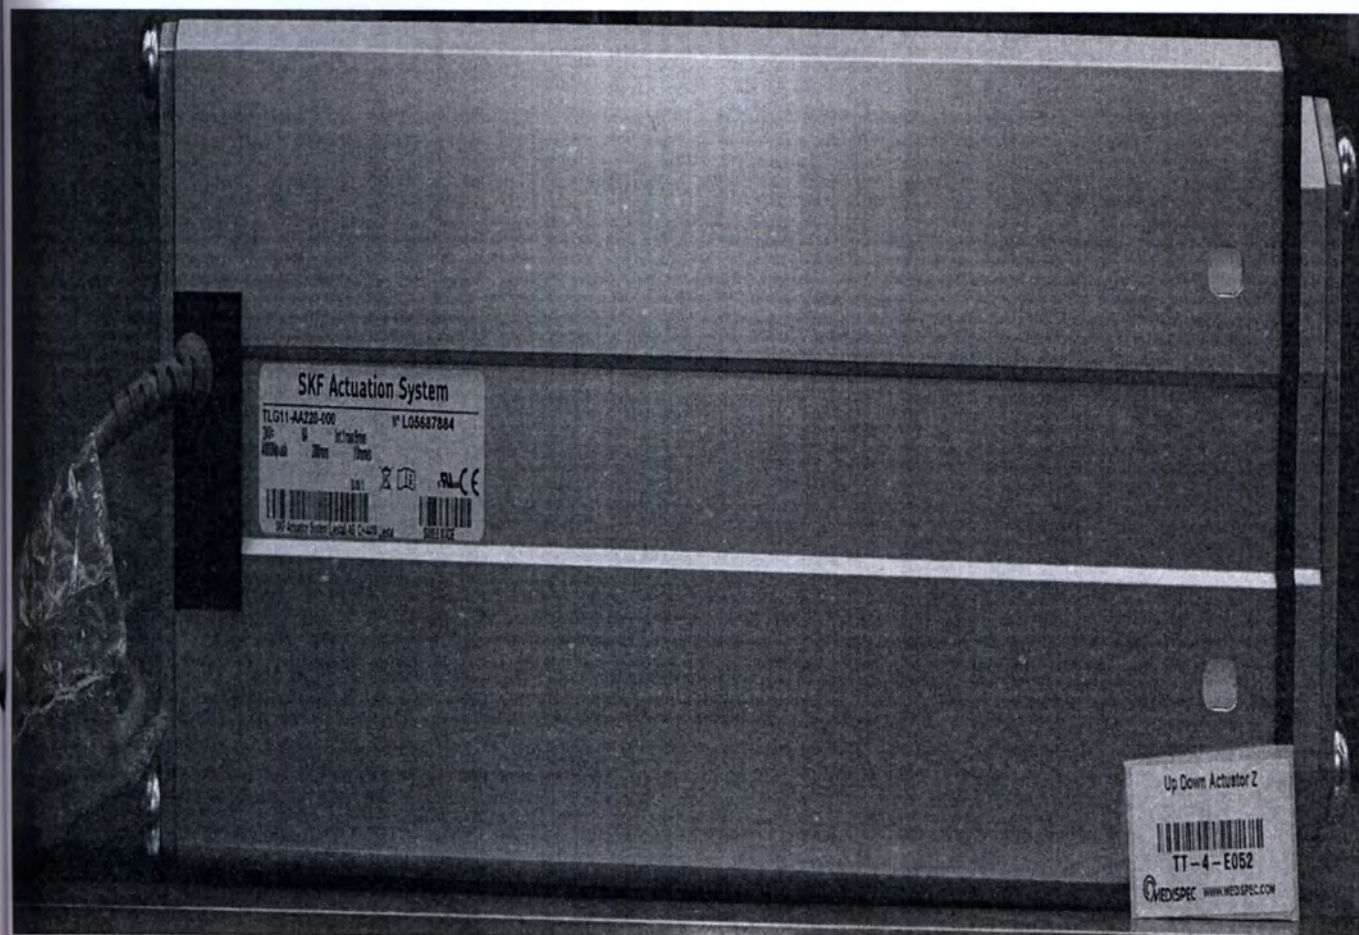

14. Пульт управления столом пациента




15. Моноблок рентгеновской С-дуги



III. Базовый состав модели Econolith EM1000:

1. Модуль ударно – волновой Shock-Wave Unit SW-8 с генератором ударных волн HVG SG-2.




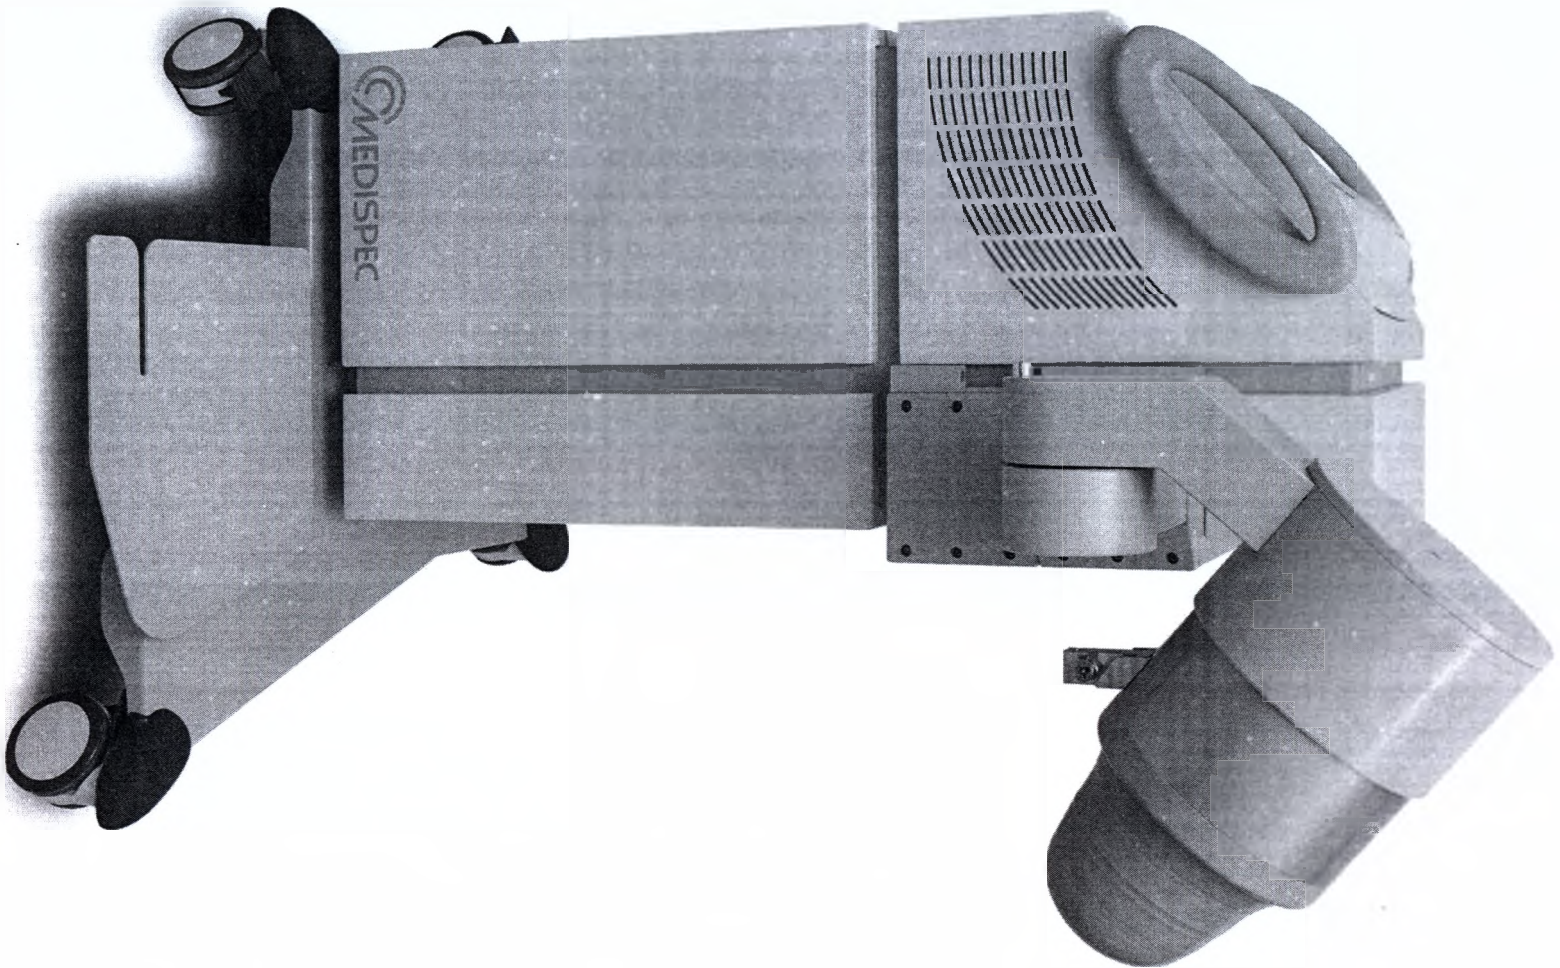


2. Стол пациента многофункциональный Treatment Table Wide 4-axes TT-4




3. С-дуга рентгеновская Visionspec XR-5 рентгеновской локализации (наведения).

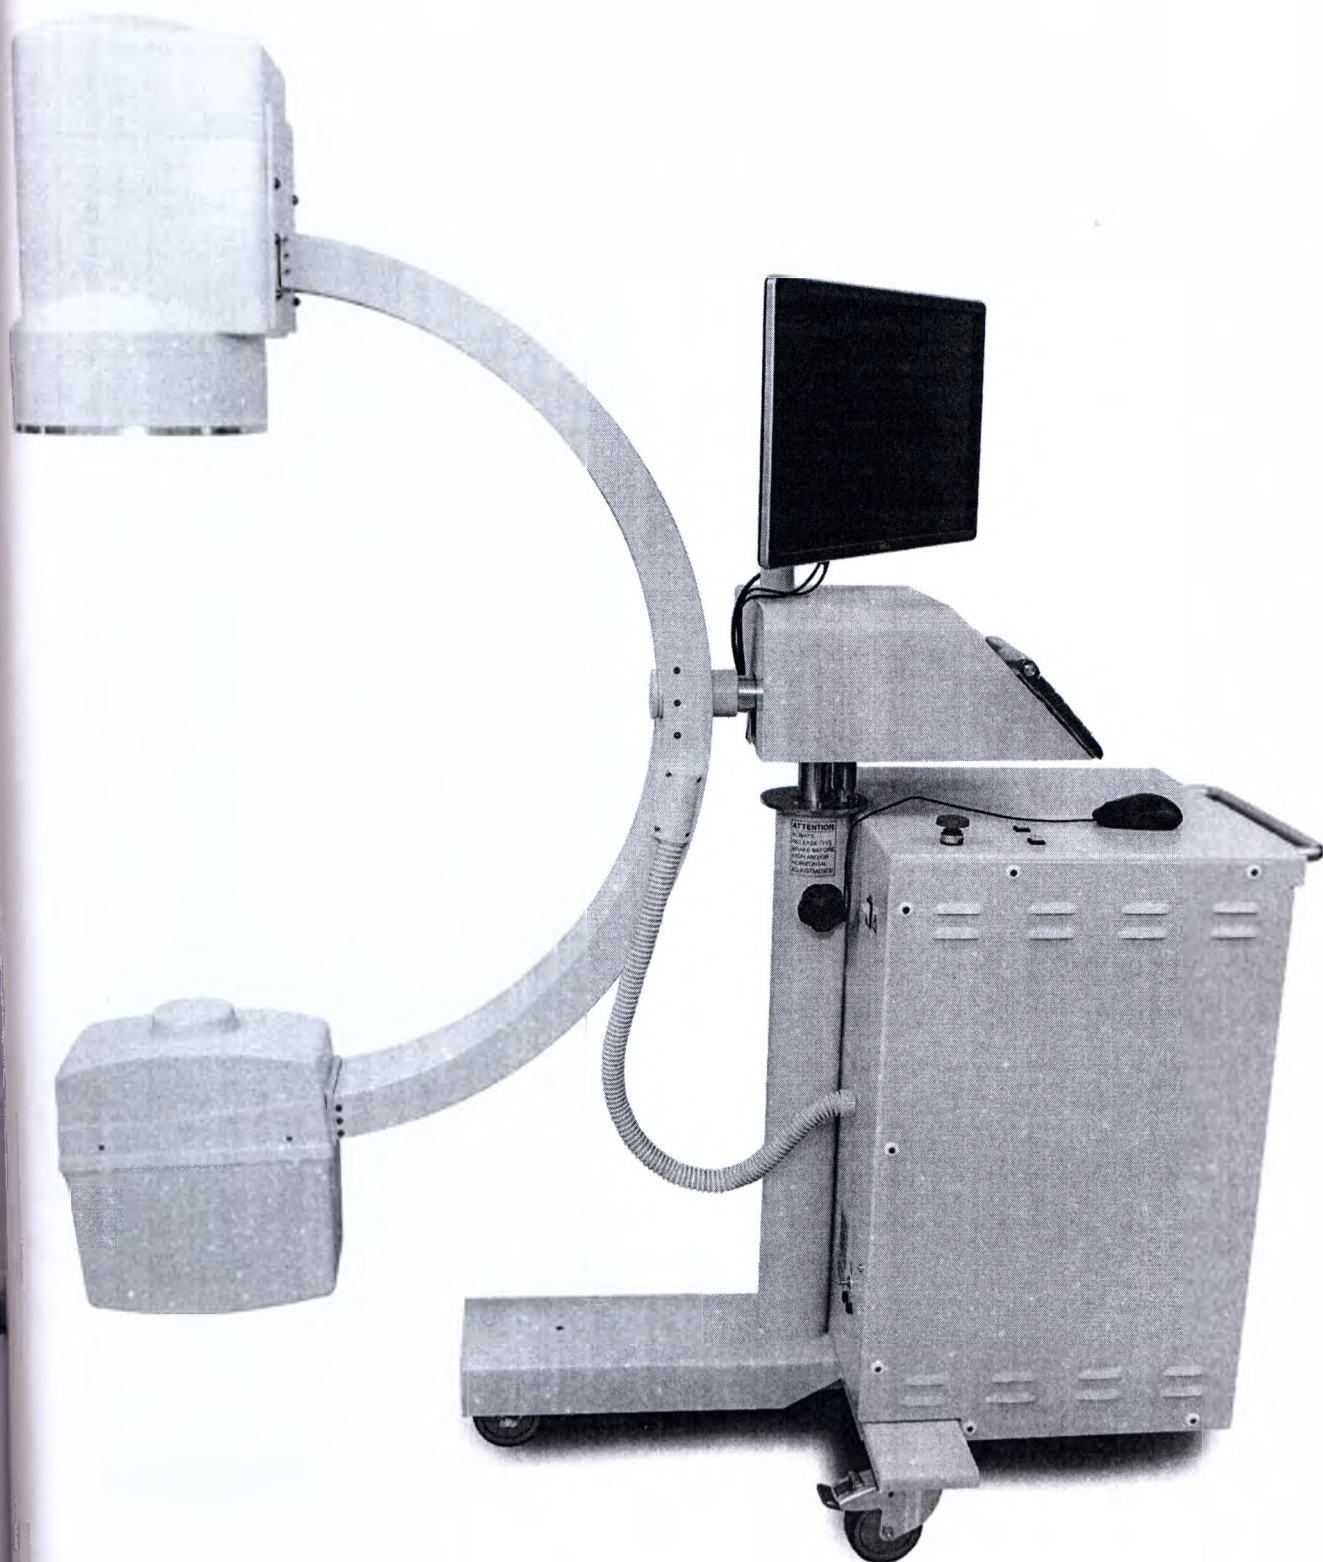


4. Тестер универсальный для контроля фрагментации

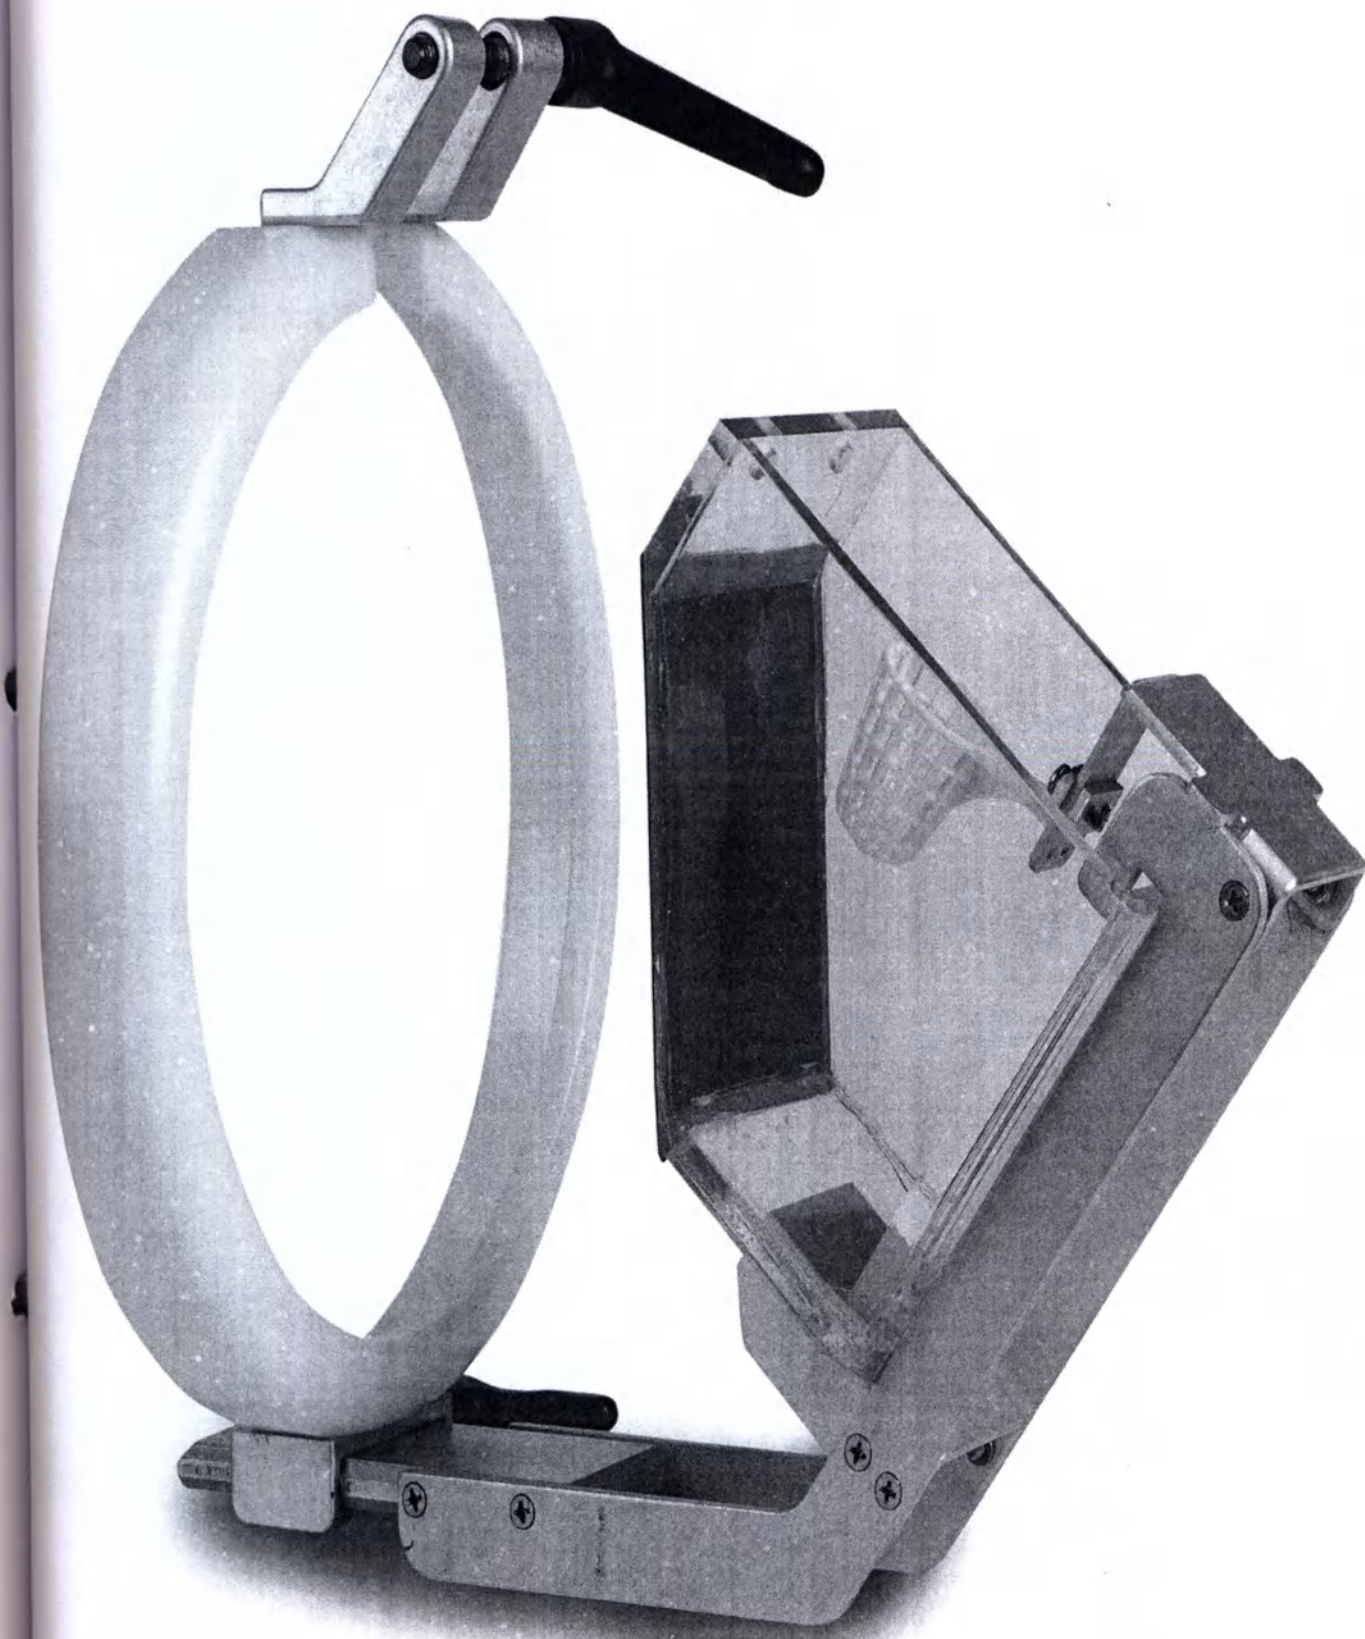



5. Шарики для тестов диаметра 9'' для тестового дробления перед началом лечения-не более 20 шт.

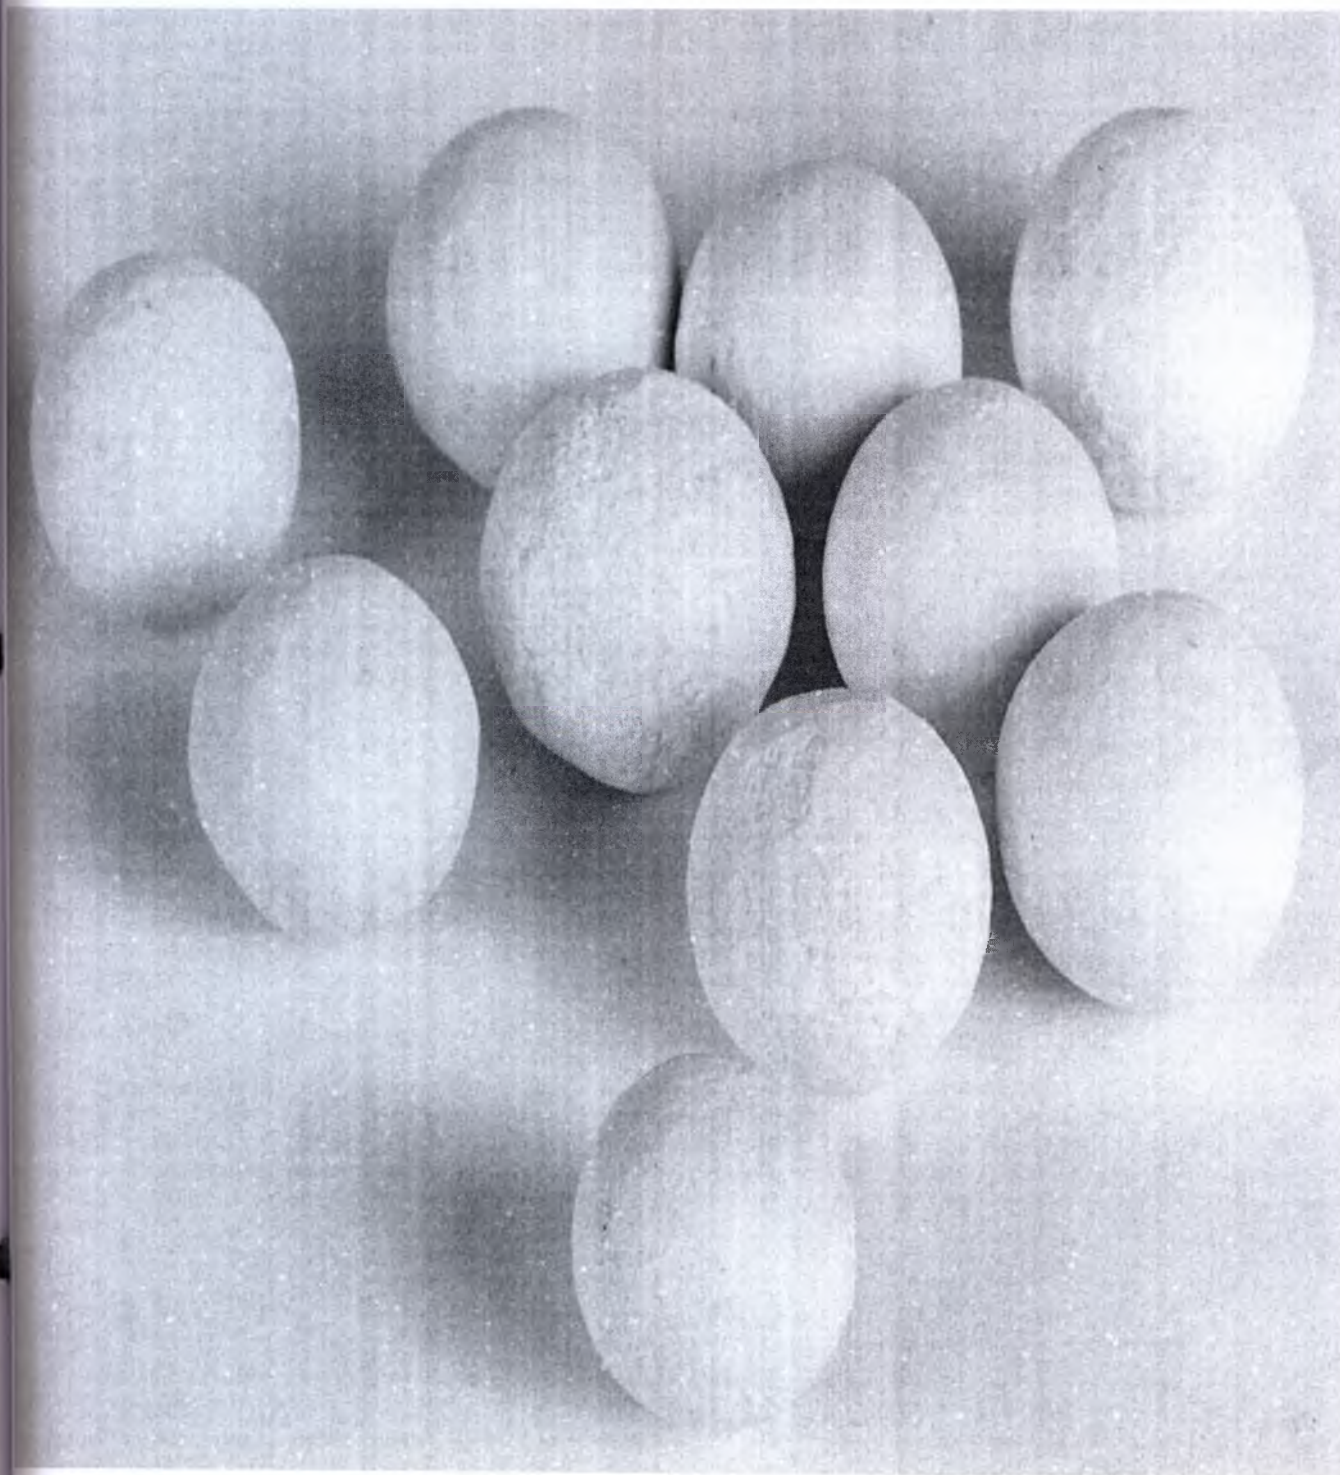

6. Документация: Руководство по эксплуатации на Систему экстракорпоральной ударно-волновой литотрипсии (литотриптер) Esonolith модели EM1000 с принадлежностями;

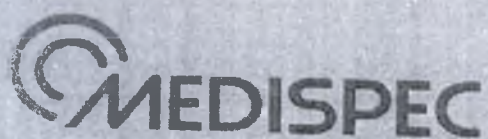

*Система экстракорпоральной ударно-
волновой литотрипсии
(литотриптер) Esonolith модели
EM1000 с принадлежностями
Руководство по эксплуатации*



GROUND BREAKING TECHNOLOGY
Within Your Reach

7. Руководство по эксплуатации на С-дугу рентгеновскую Visionspec XR-5 рентгеновской локализации (наведения);



С-дуга рентгеновская
Visionspec XR-5
рентгеновской локализации
(наведения)

РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ



РЕДАКЦИЯ




GROUND BREAKING TECHNOLOGY
Within Your Reach

8. Руководство по эксплуатации на Стол пациента многофункциональный Treatment Table Wide 4-axes TT-4



Стол пациента
многофункциональный
Treatment Table Wide 4-axes
TT-4

РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

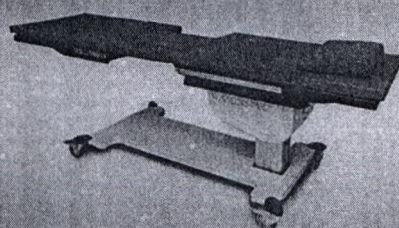


Редакция А


GROUND BREAKING TECHNOLOGY WITHIN YOUR REACH

IV. Принадлежности:

1. Генератор ударных волн HVG SG-2 (дополнительно, при необходимости)

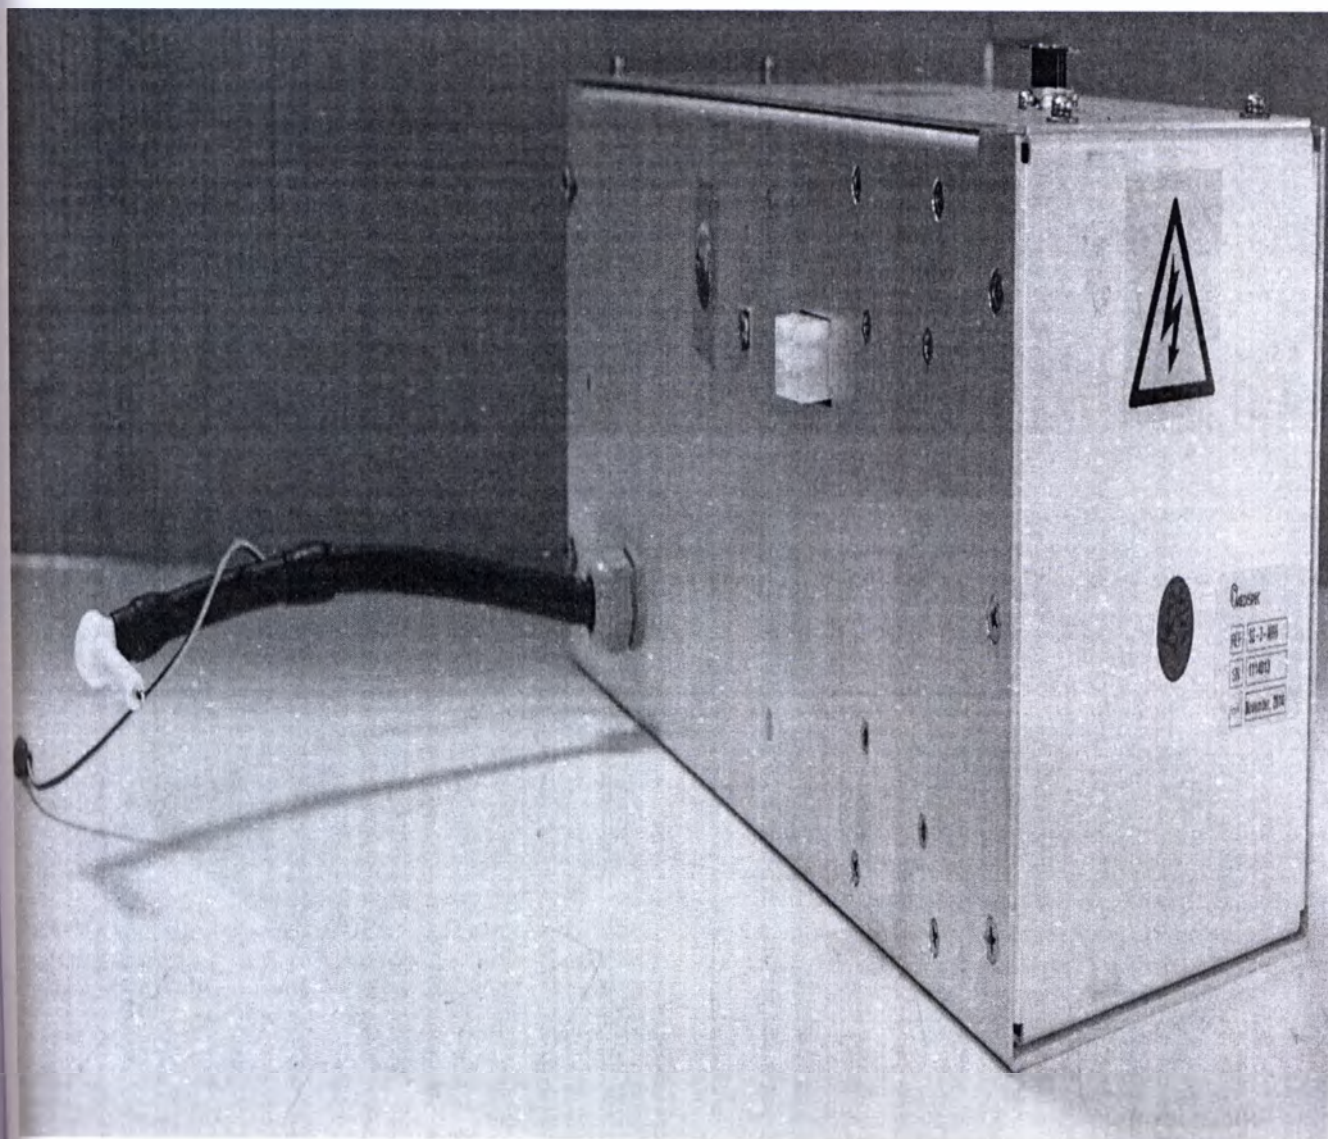

2. Электро-магнитная головка ЕНЗ

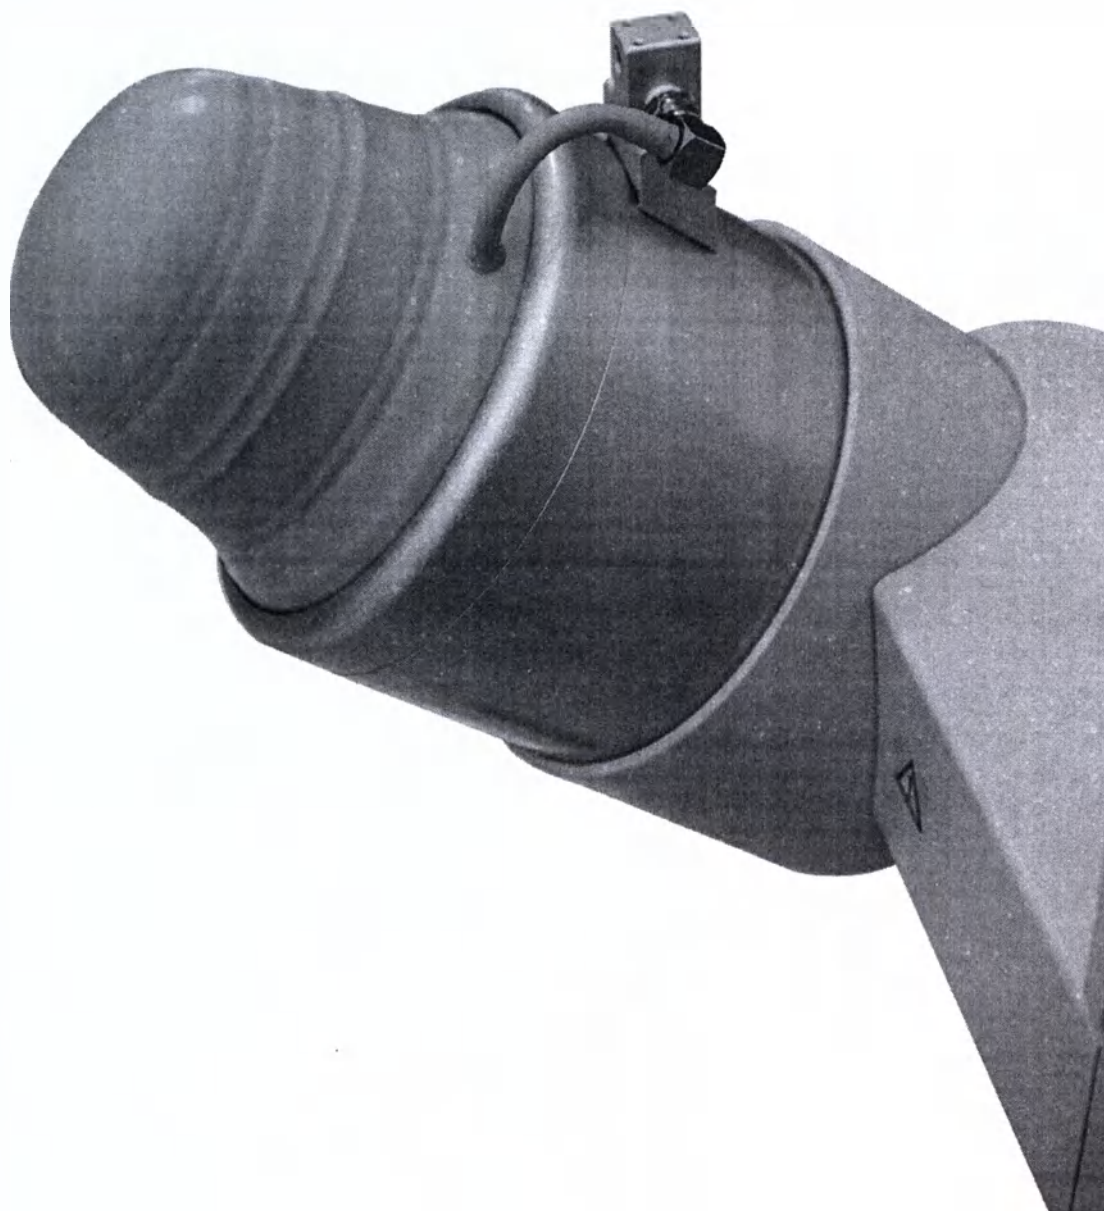

3. Манипулятор типа «мышь», не более 2-х шт.



4. Клавиатура, не более 2 шт




5. Монитор системы визуализации, не более 4-х шт



6. Кабель ЭКГ универсальный (опционально, по требованию заказчика)




7. Кабели соединительные прочие, не более 10 штук.

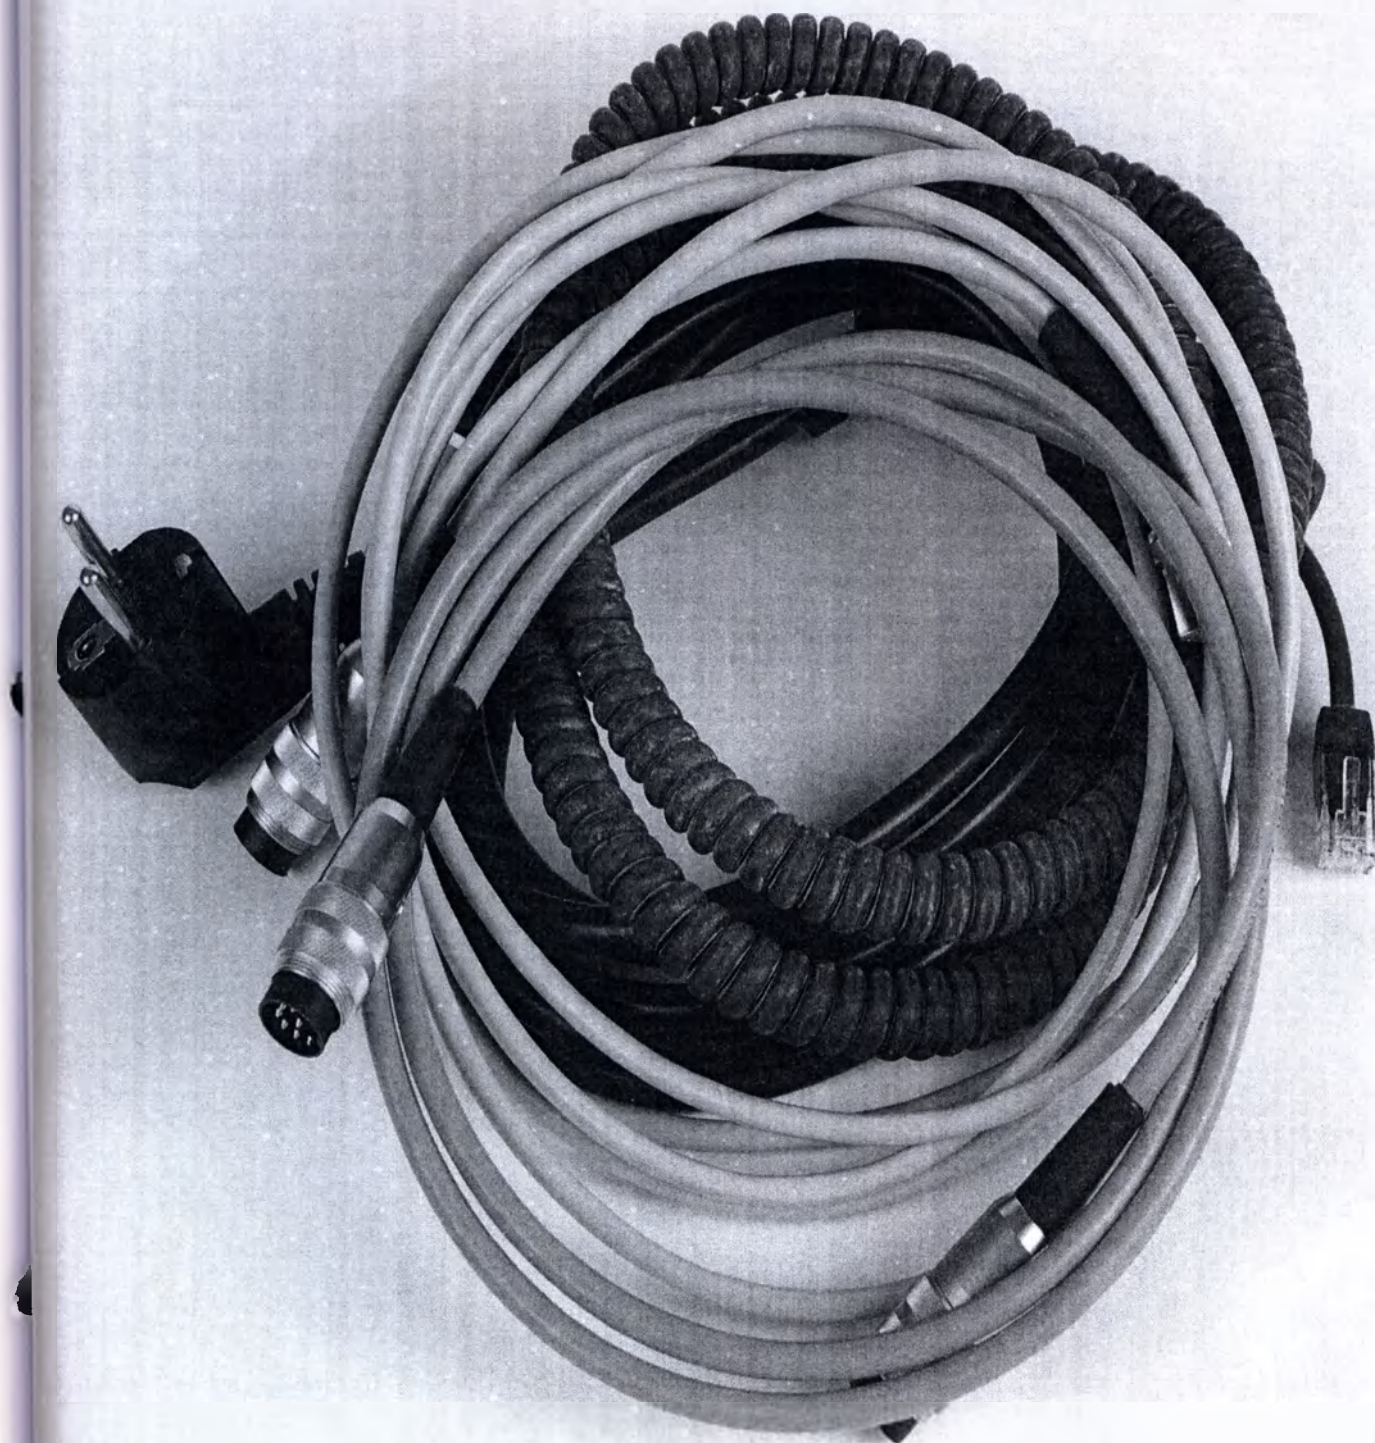


8. Мембрана смыкающая Coupling Membrane SW-6-D002, не более 10 шт




9. Педаль рентгена, не более 2 шт

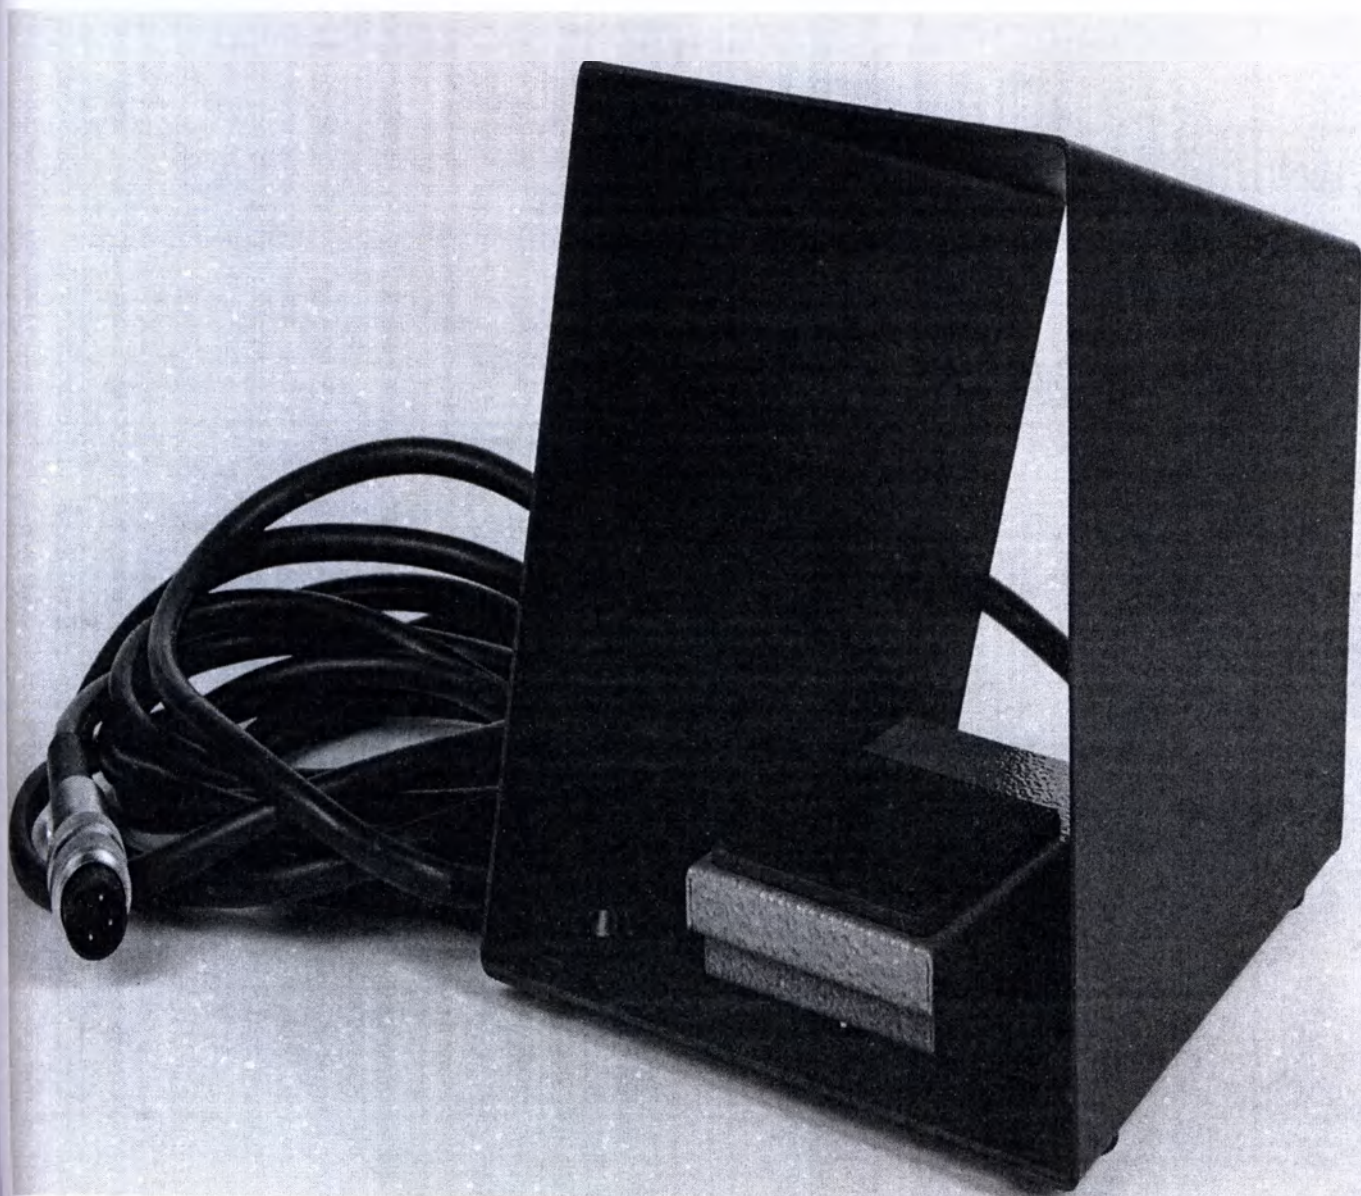


10. Пойнтер для калибровки системы визуализации.

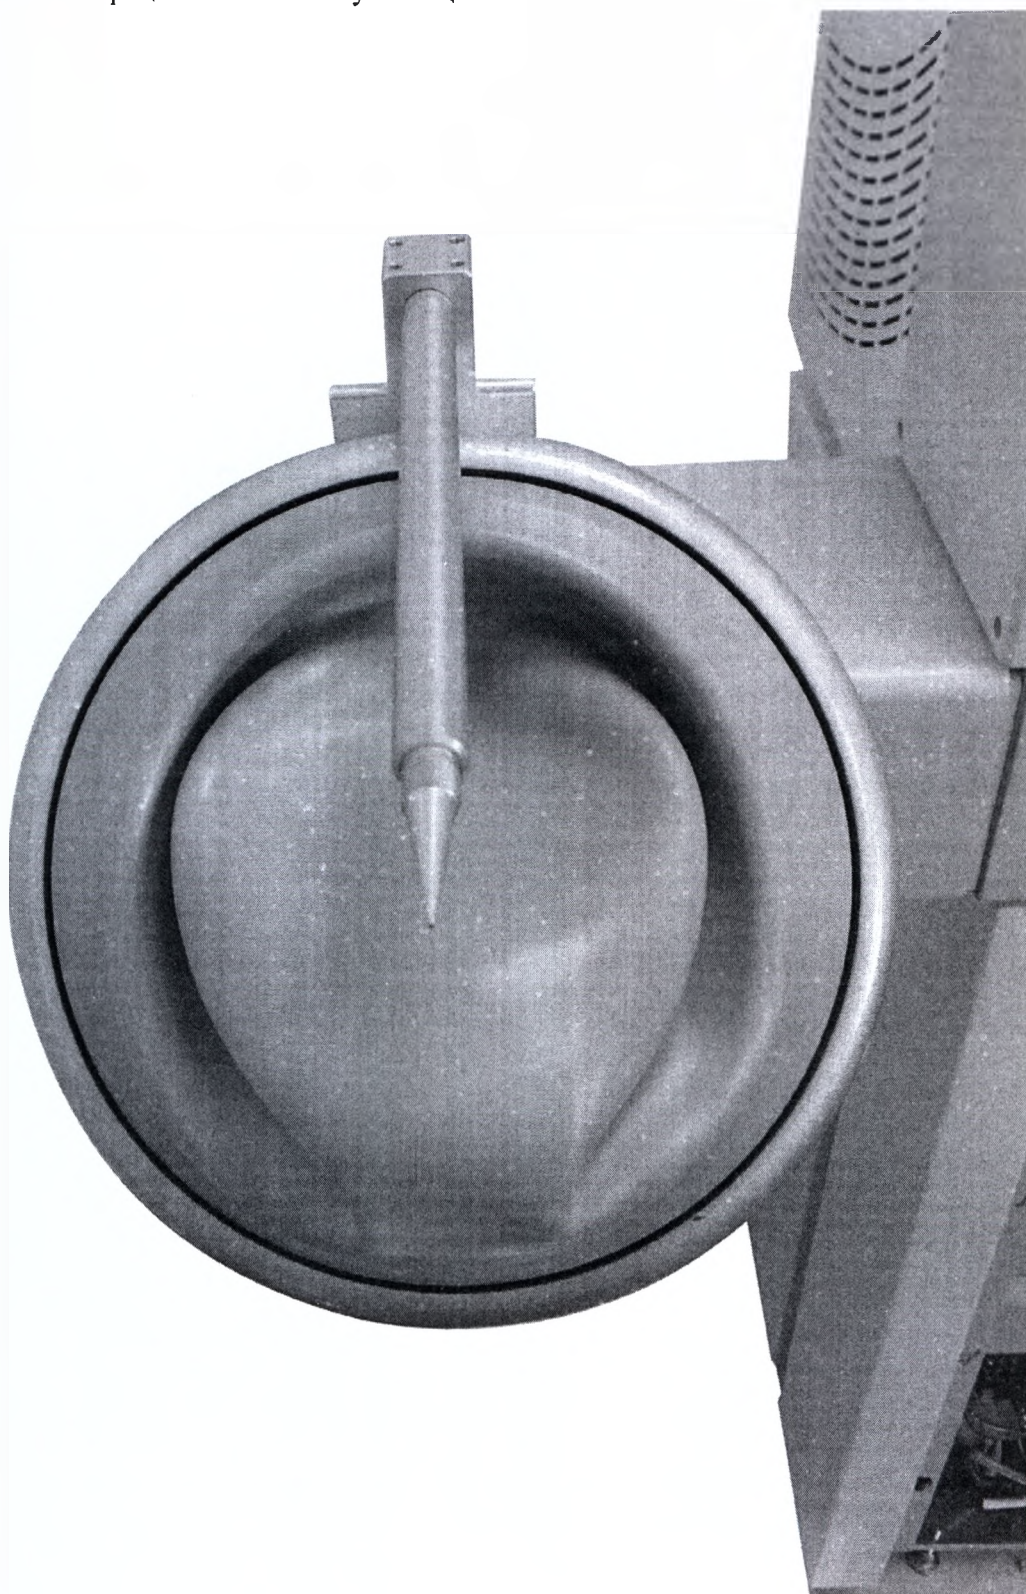

11. Универсальный держатель для датчика ультразвукового аппарата

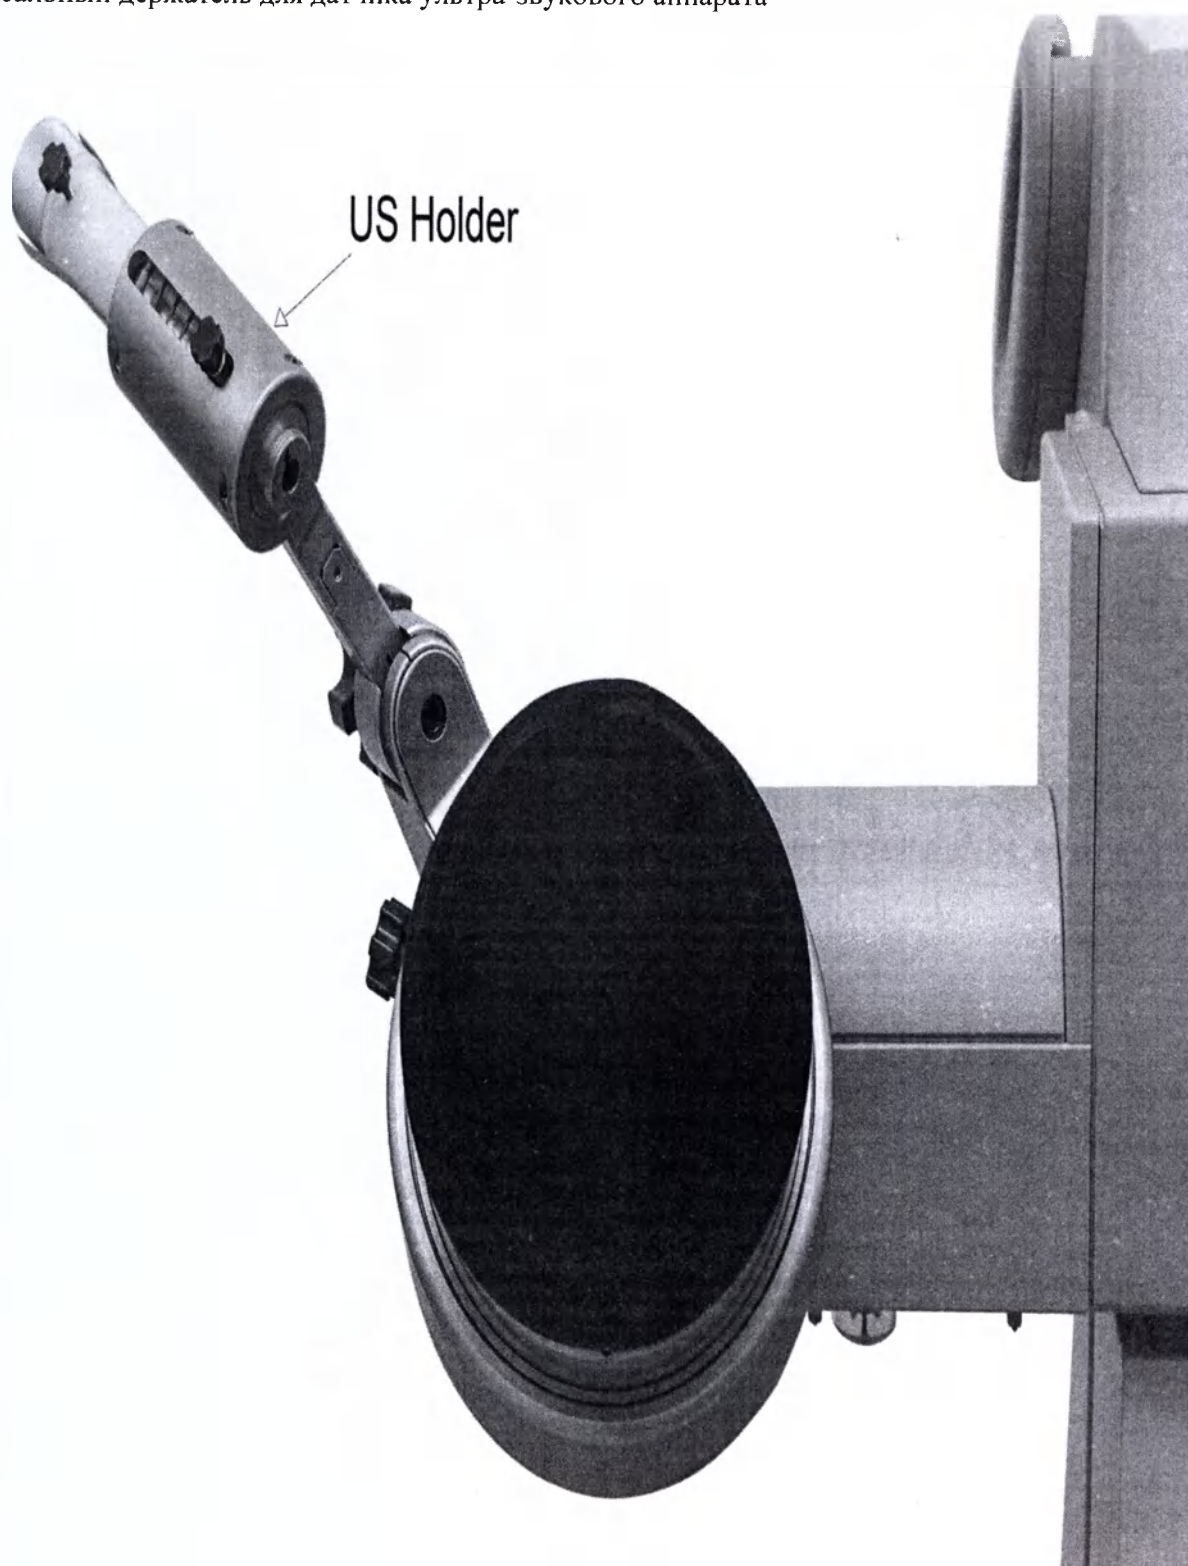


12. Покрытие стола пациента

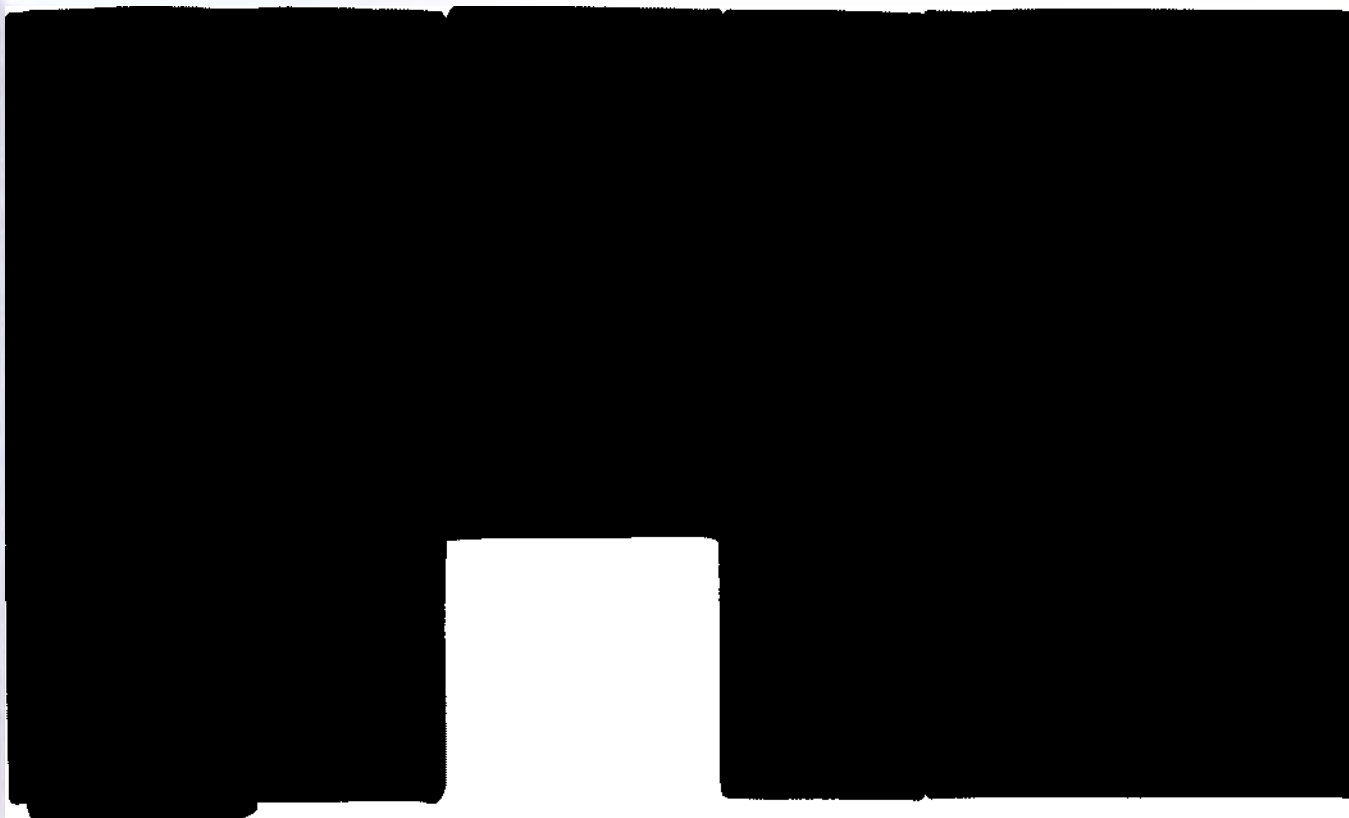

13. Опора съемная для ног пациента с креплением для стола, не более 4 шт.



14. Электропривод движения стола по осям X и Y.

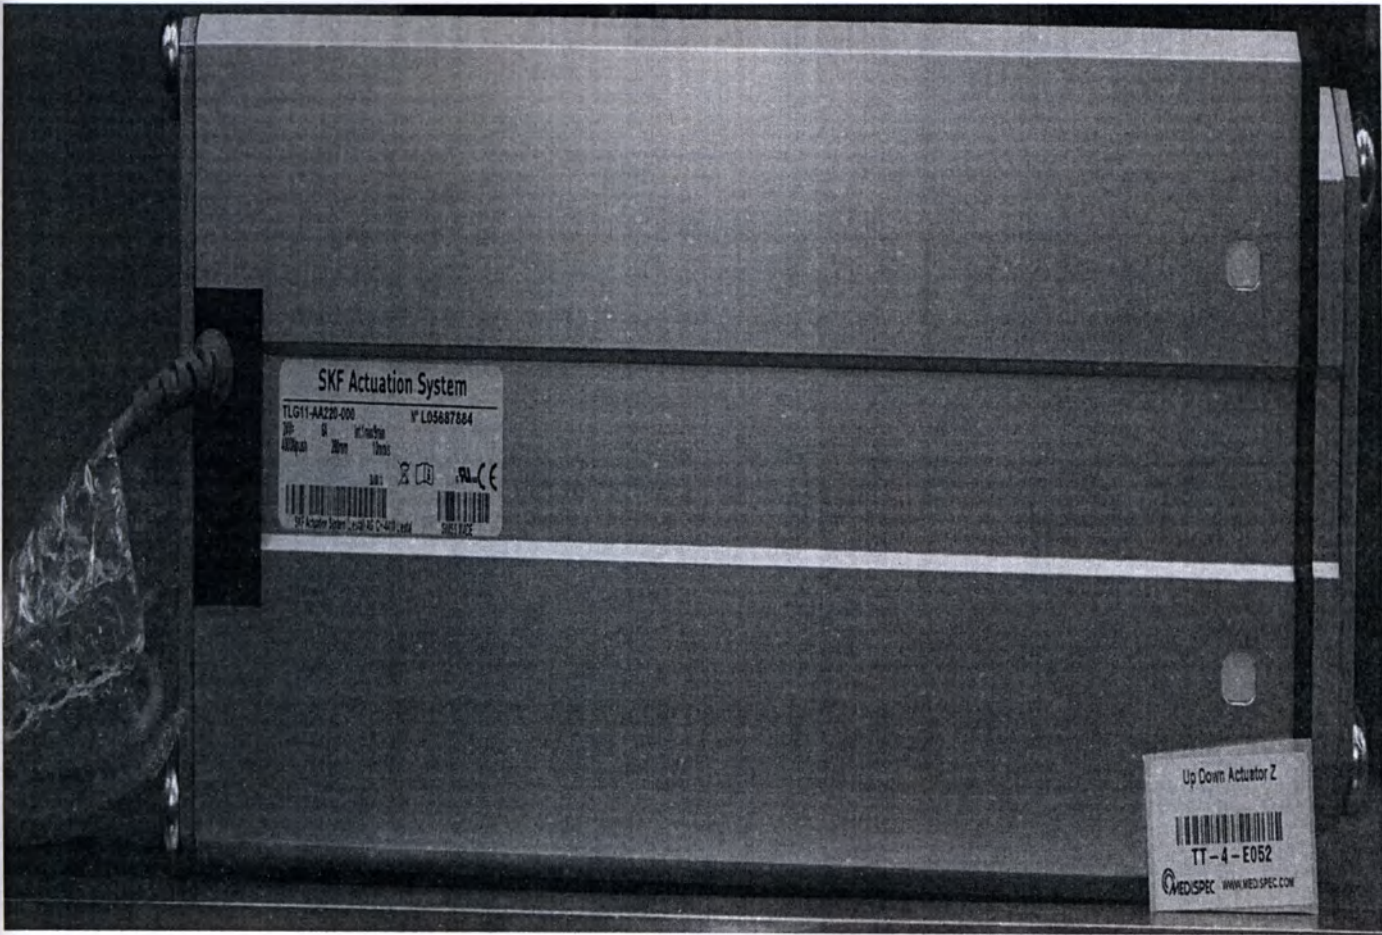

15. Пульт управления столом пациента



16. Моноблок рентгеновской С-дуги



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью

