

ПОДТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «биоМерье Рус»
(от имени «биоМерье С.А.»
по доверенности от 27.10.2015)

Н.В. Бердникова

«14» 05 2017 г.




Фотографическое изображение медицинского изделия для диагностики in vitro

«Набор реагентов для количественного определения антител к поверхностному антигену вируса гепатита В (anti-HBs) в сыворотке или плазме крови человека VIDAS Anti-HBs Total II (AHBS) на анализаторах иммунологических семейства VIDAS»

производства «биоМерье С.А.» (bioMérieux S.A.), Франция

Общий вид набора реагентов для количественного определения антител к поверхностному антигену вируса гепатита В (anti-HBs) в сыворотке или плазме крови человека VIDAS Anti-HBs Total II (AHBS) на анализаторах иммунологических семейства VIDAS

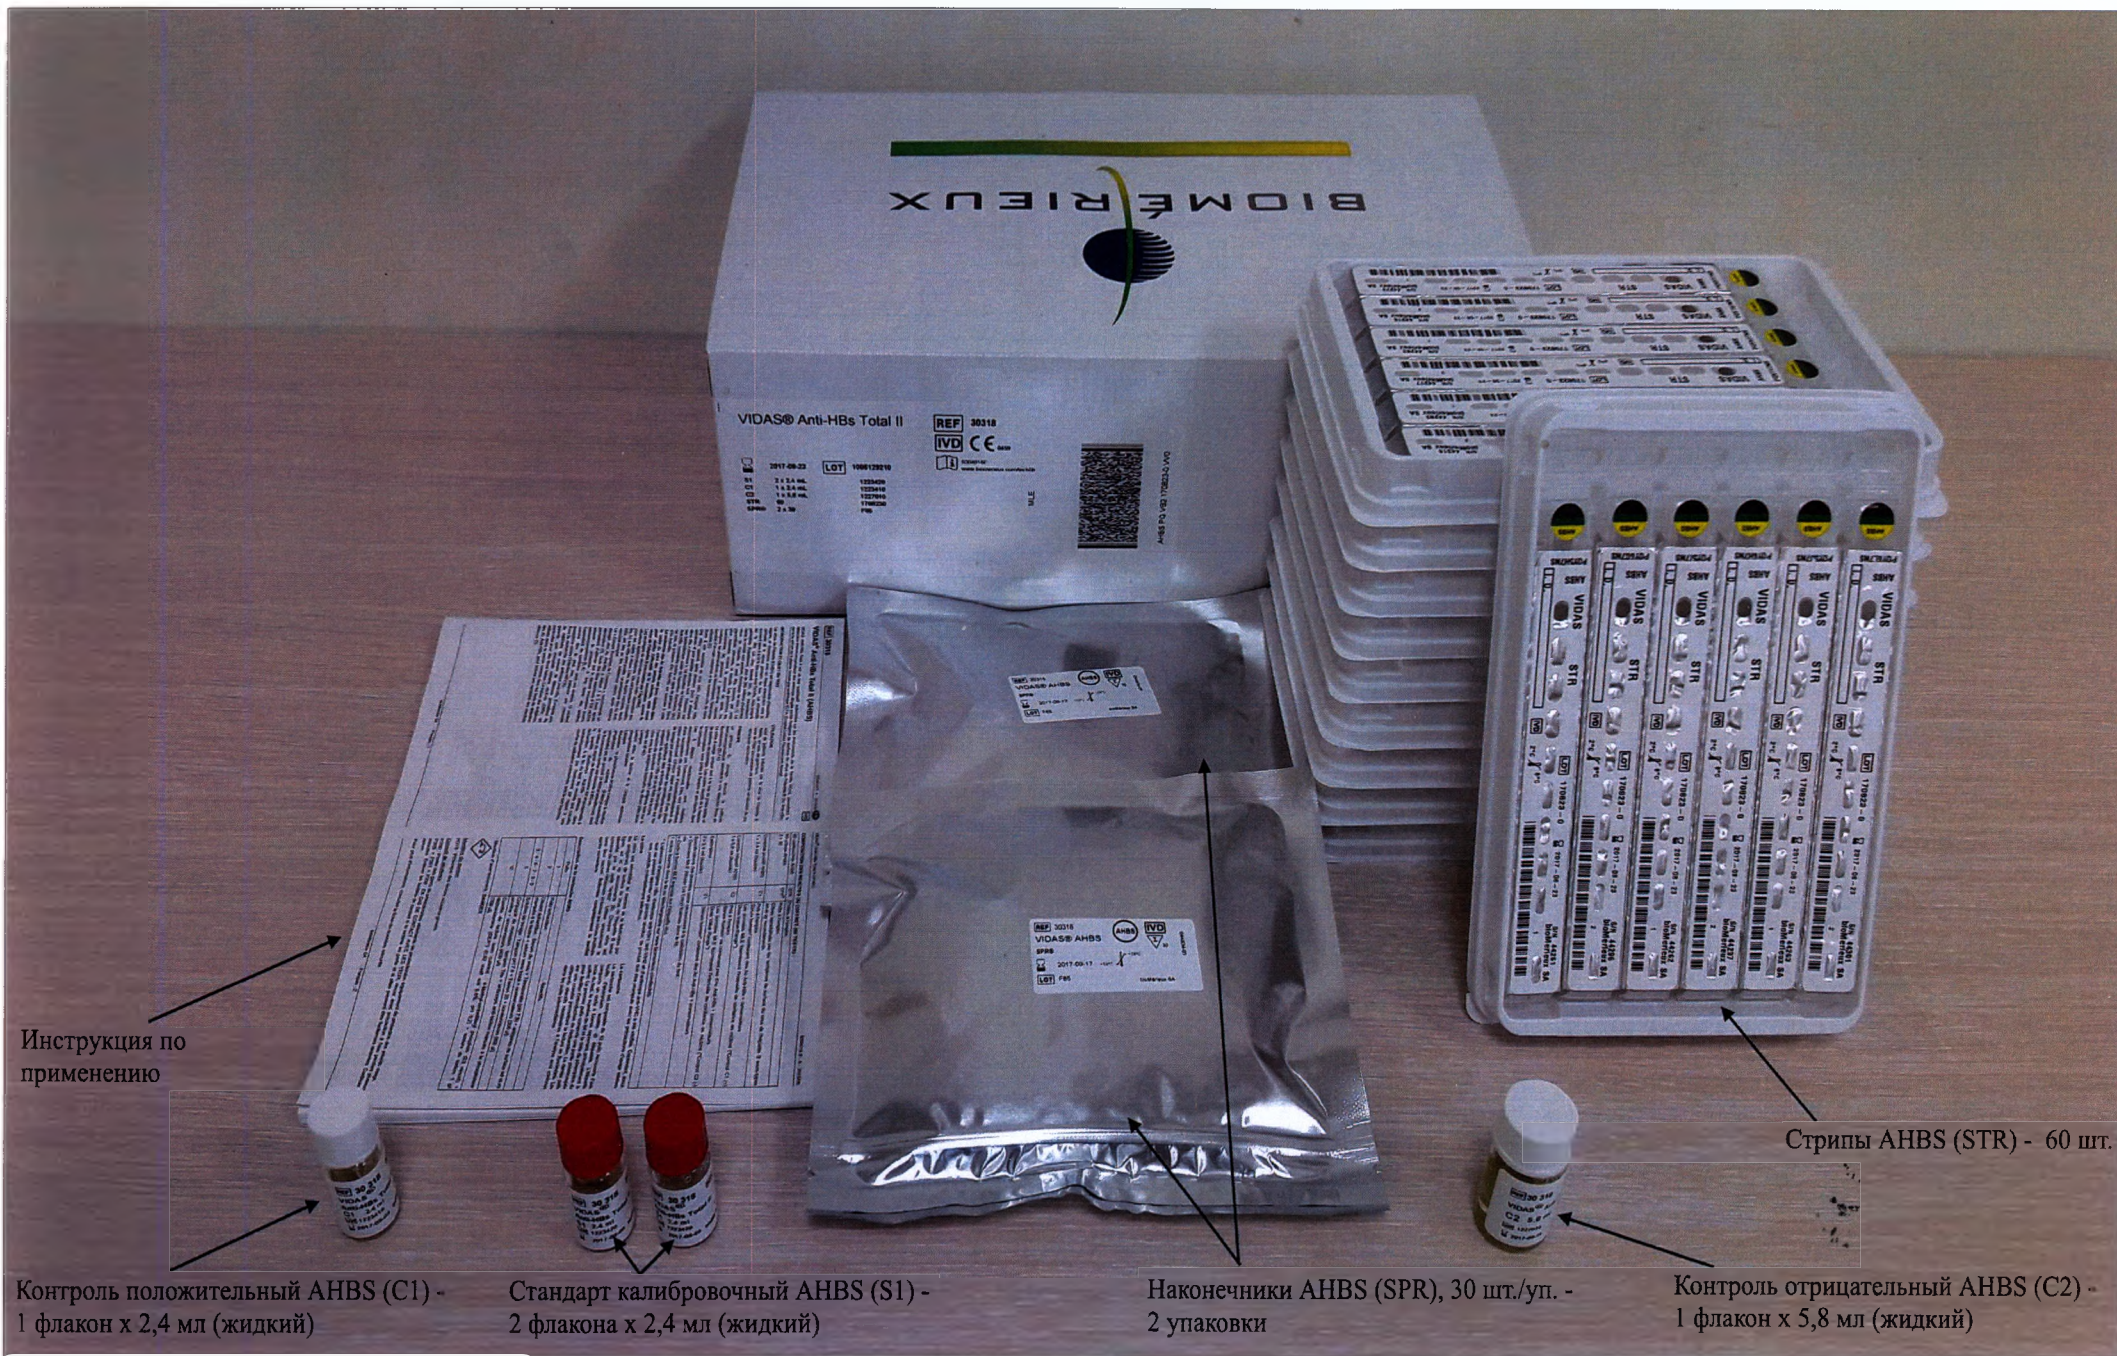

Инструкция по применению

Контроль положительный AHBS (C1) - 1 флакон x 2,4 мл (жидкий)

Стандарт калибровочный AHBS (S1) - 2 флакона x 2,4 мл (жидкий)

Наконечники AHBS (SPR), 30 шт./уп. - 2 упаковки

Стрипы AHBS (STR) - 60 шт.

Контроль отрицательный AHBS (C2) - 1 флакон x 5,8 мл (жидкий)


1. Стрипы АНБS (STR) - 60 шт.




2. Наконечники АНБS (SPR), 30 шт./уп. – 2 упаковки.



3. Контроль положительный АНBS (C1) – 1 флакон х 2,4 мл (жидкий).

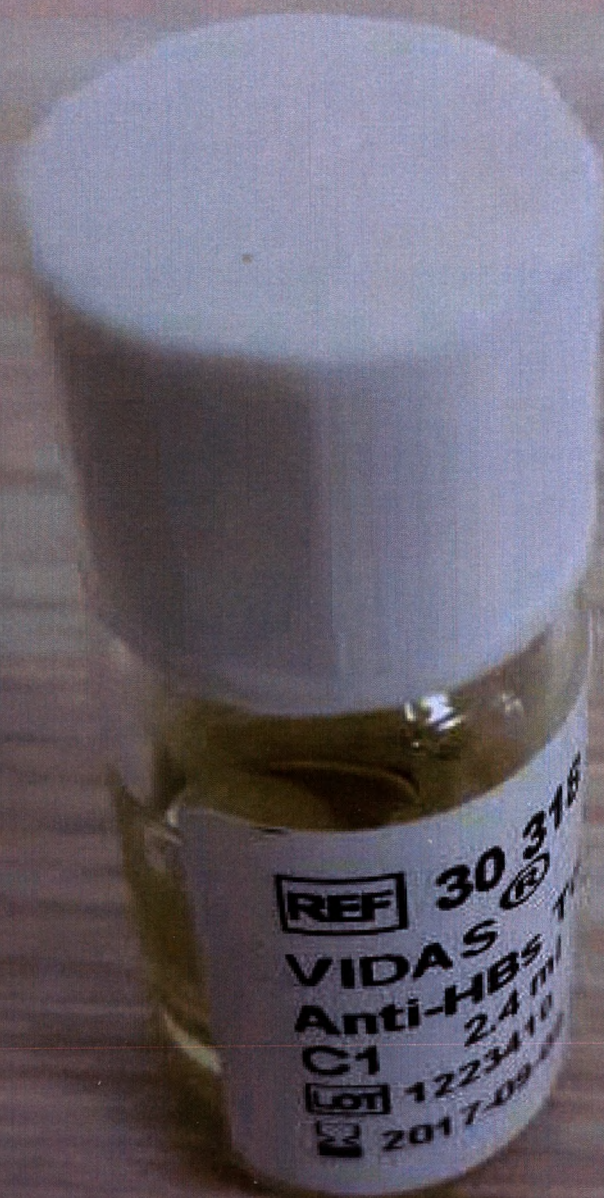

4. Контроль отрицательный АНБС (C2) – 1 флакон х 5,8 мл (жидкий).

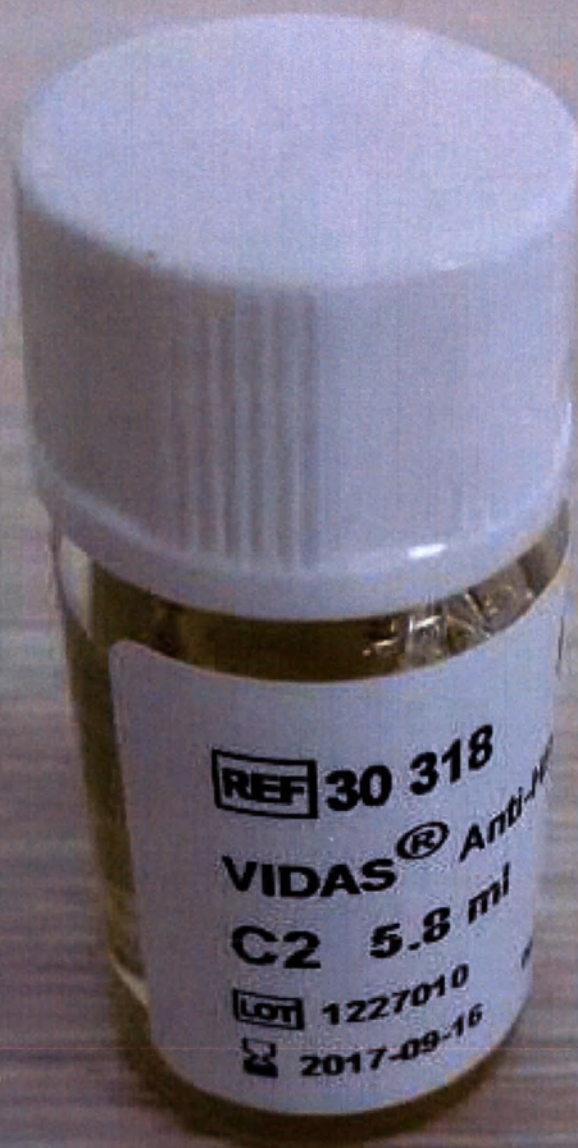

5. Стандарт калибровочный АНБС (S1) – 2 флакона х 2,4 мл (жидкий).



Прошито и пронумеровано

7 листов

"18" 05 2012 года

Генеральный директор

Бердникова Н.В.

