

Управляющий
ЗАО НПП «МедИнж»




С. В. Евдокимов

«МедИнж» 10 декабря 2017 г.

Фотографические изображение медицинского изделия:

«Материал шовный хирургический рассасывающийся, стерильный, с иглами и без игл,
«МЕДИНЖ» по МЛЦК.942241.001 ТУ»,
Производства компании ЗАО НПП «МедИнж»

2017 год

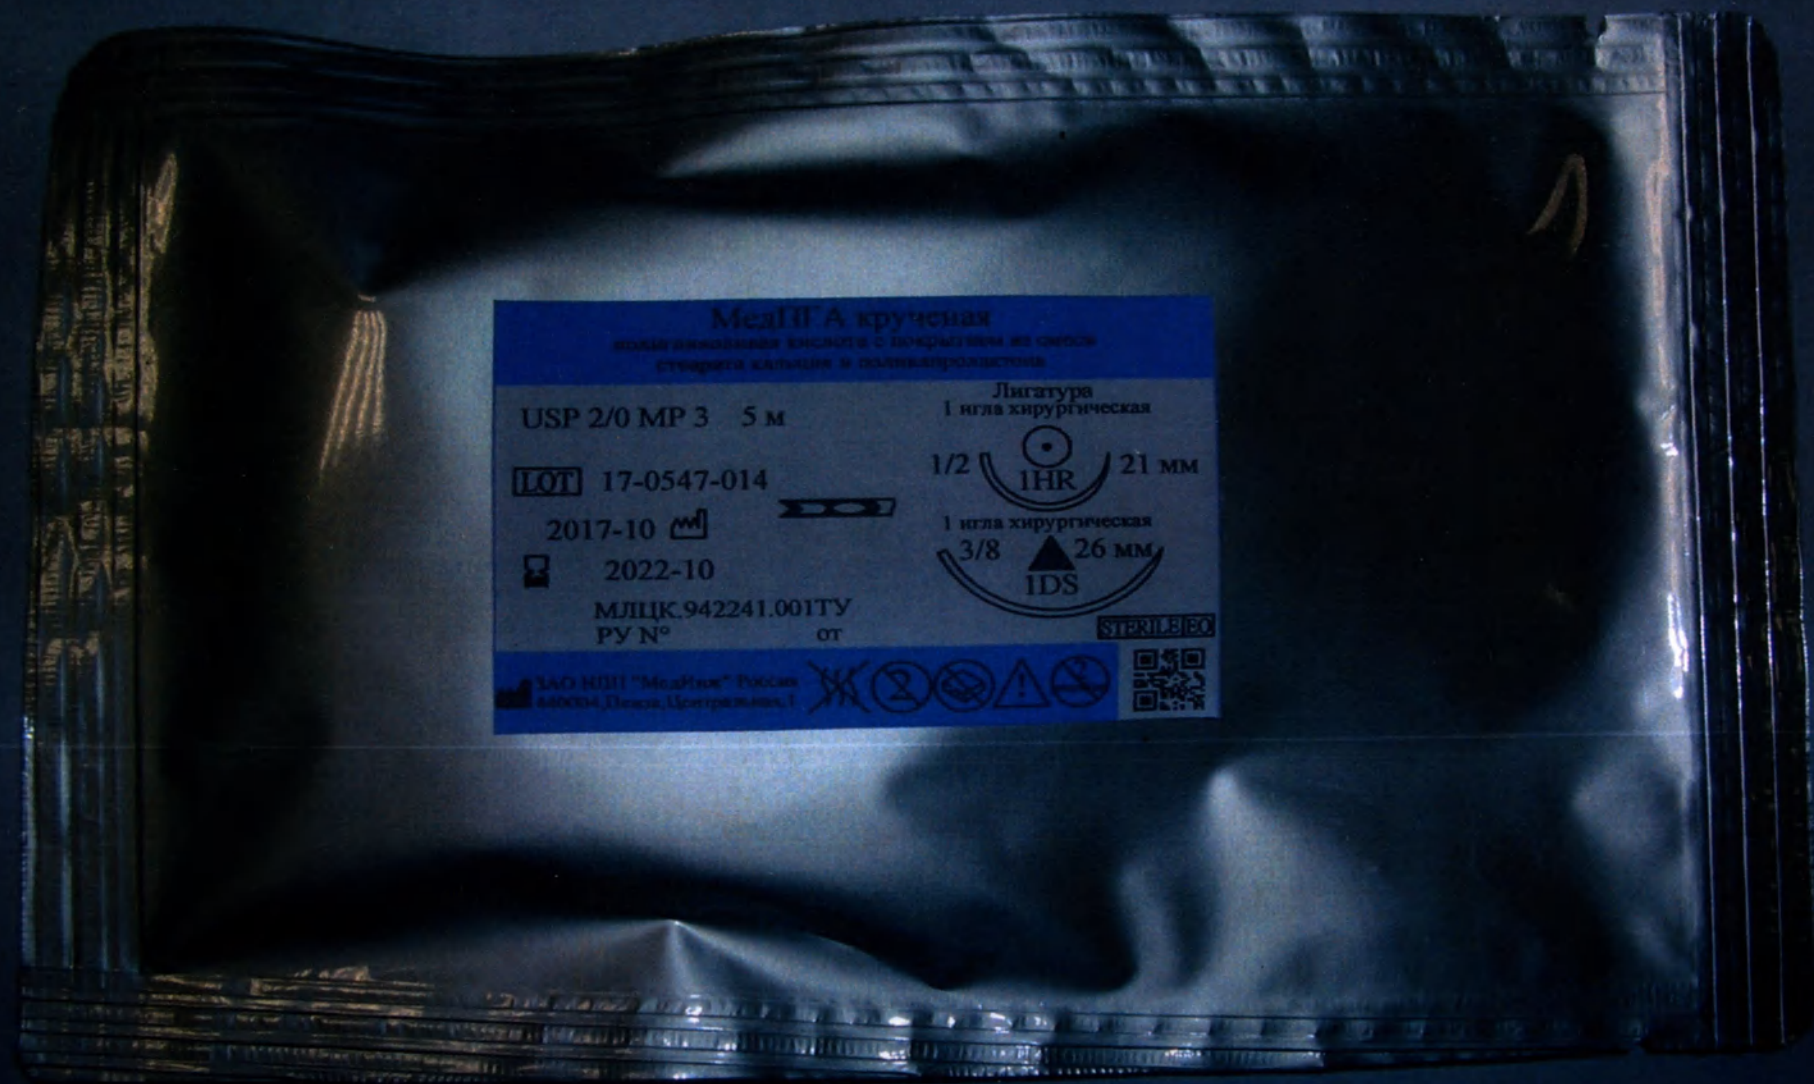

МедИГА крученая
полиимидная нить с покрытием из смеси
стирола, каптона и полиакрилонитрила

USP 2/0 MP 3 5 м

Лигатура
1 игла хирургическая

LOT 17-0547-014

1/2 1HR 21 мм

2017-10  2022-10

1 игла хирургическая

3/8 1DS 26 мм

МЛЦК 942241.001ТУ

ПУ № от


STERILE EO

АО НПП "МедИж" Россия
400004 Пенза, Центральная, 1







Вариант маркировки индивидуальной тары медицинского изделия «Материал шовный хирургический рассасывающийся, стерильный, с иглами и без игл «МЕДИНЖ» по МЛЦК.942241.001 ТУ

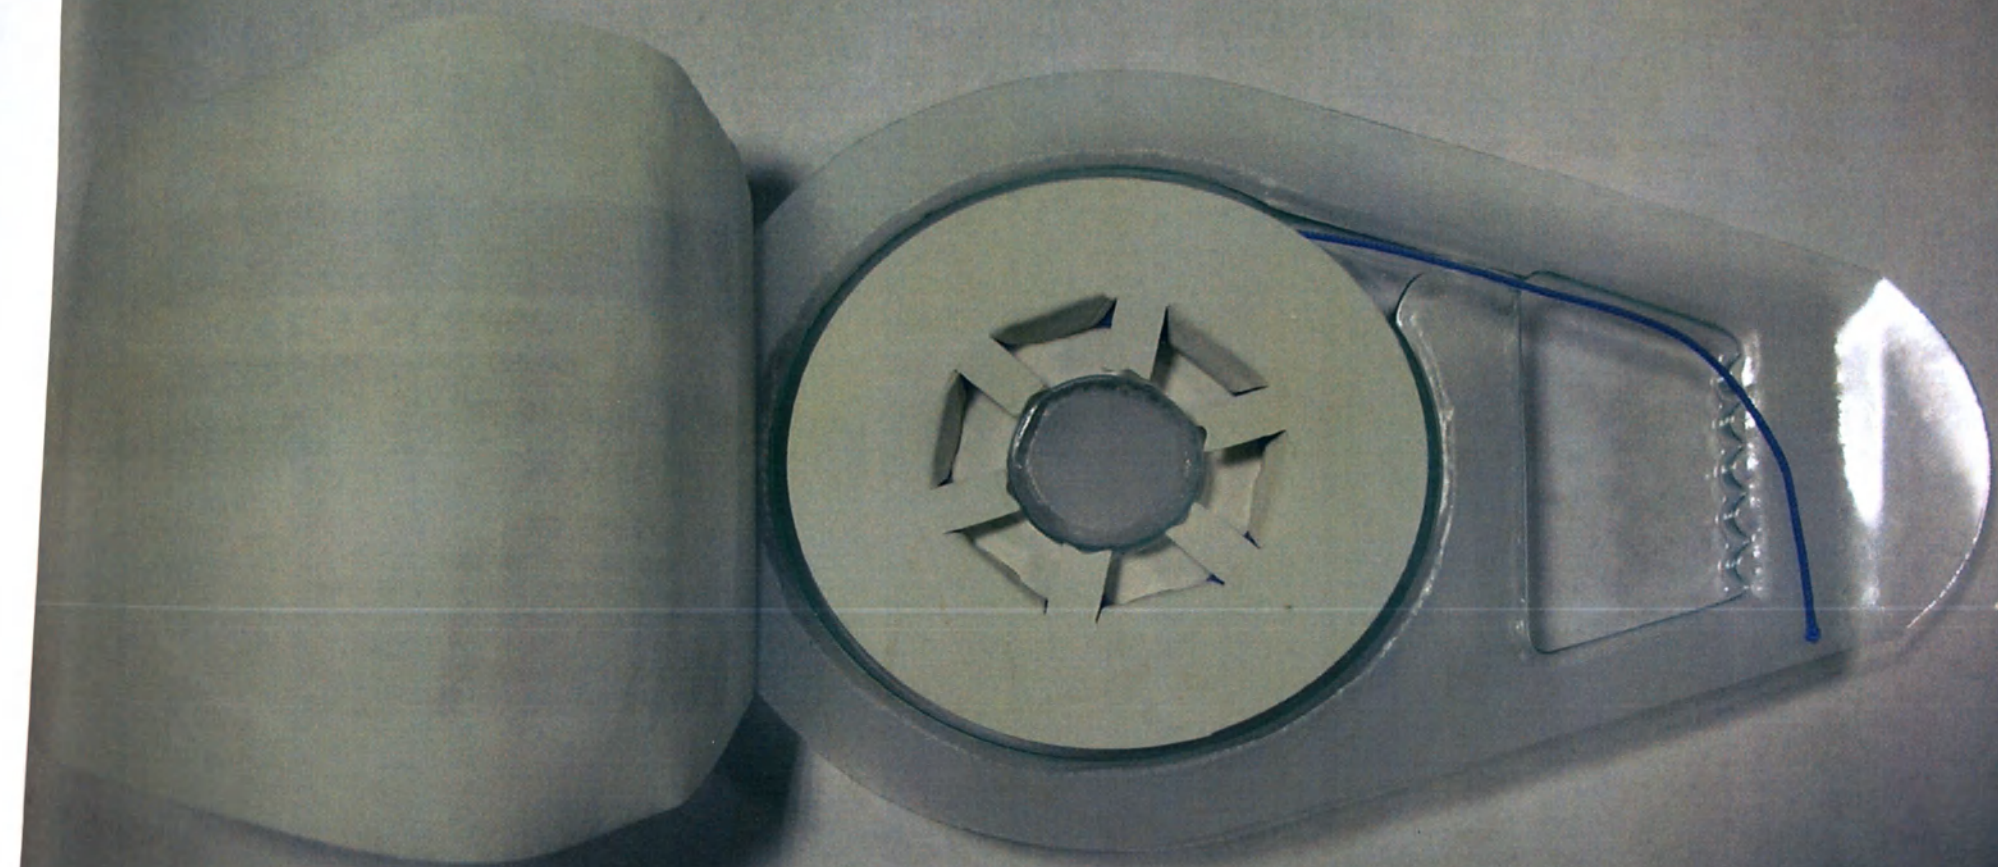


Вариант упаковки медицинского изделия «Материал шовный хирургический рассасывающийся, стерильный, с иглами и без игл «МЕДИНЖ» по МЛЦК.942241.001 ТУ:
нить окрашенная (фиолетовая) намотанная на катушку

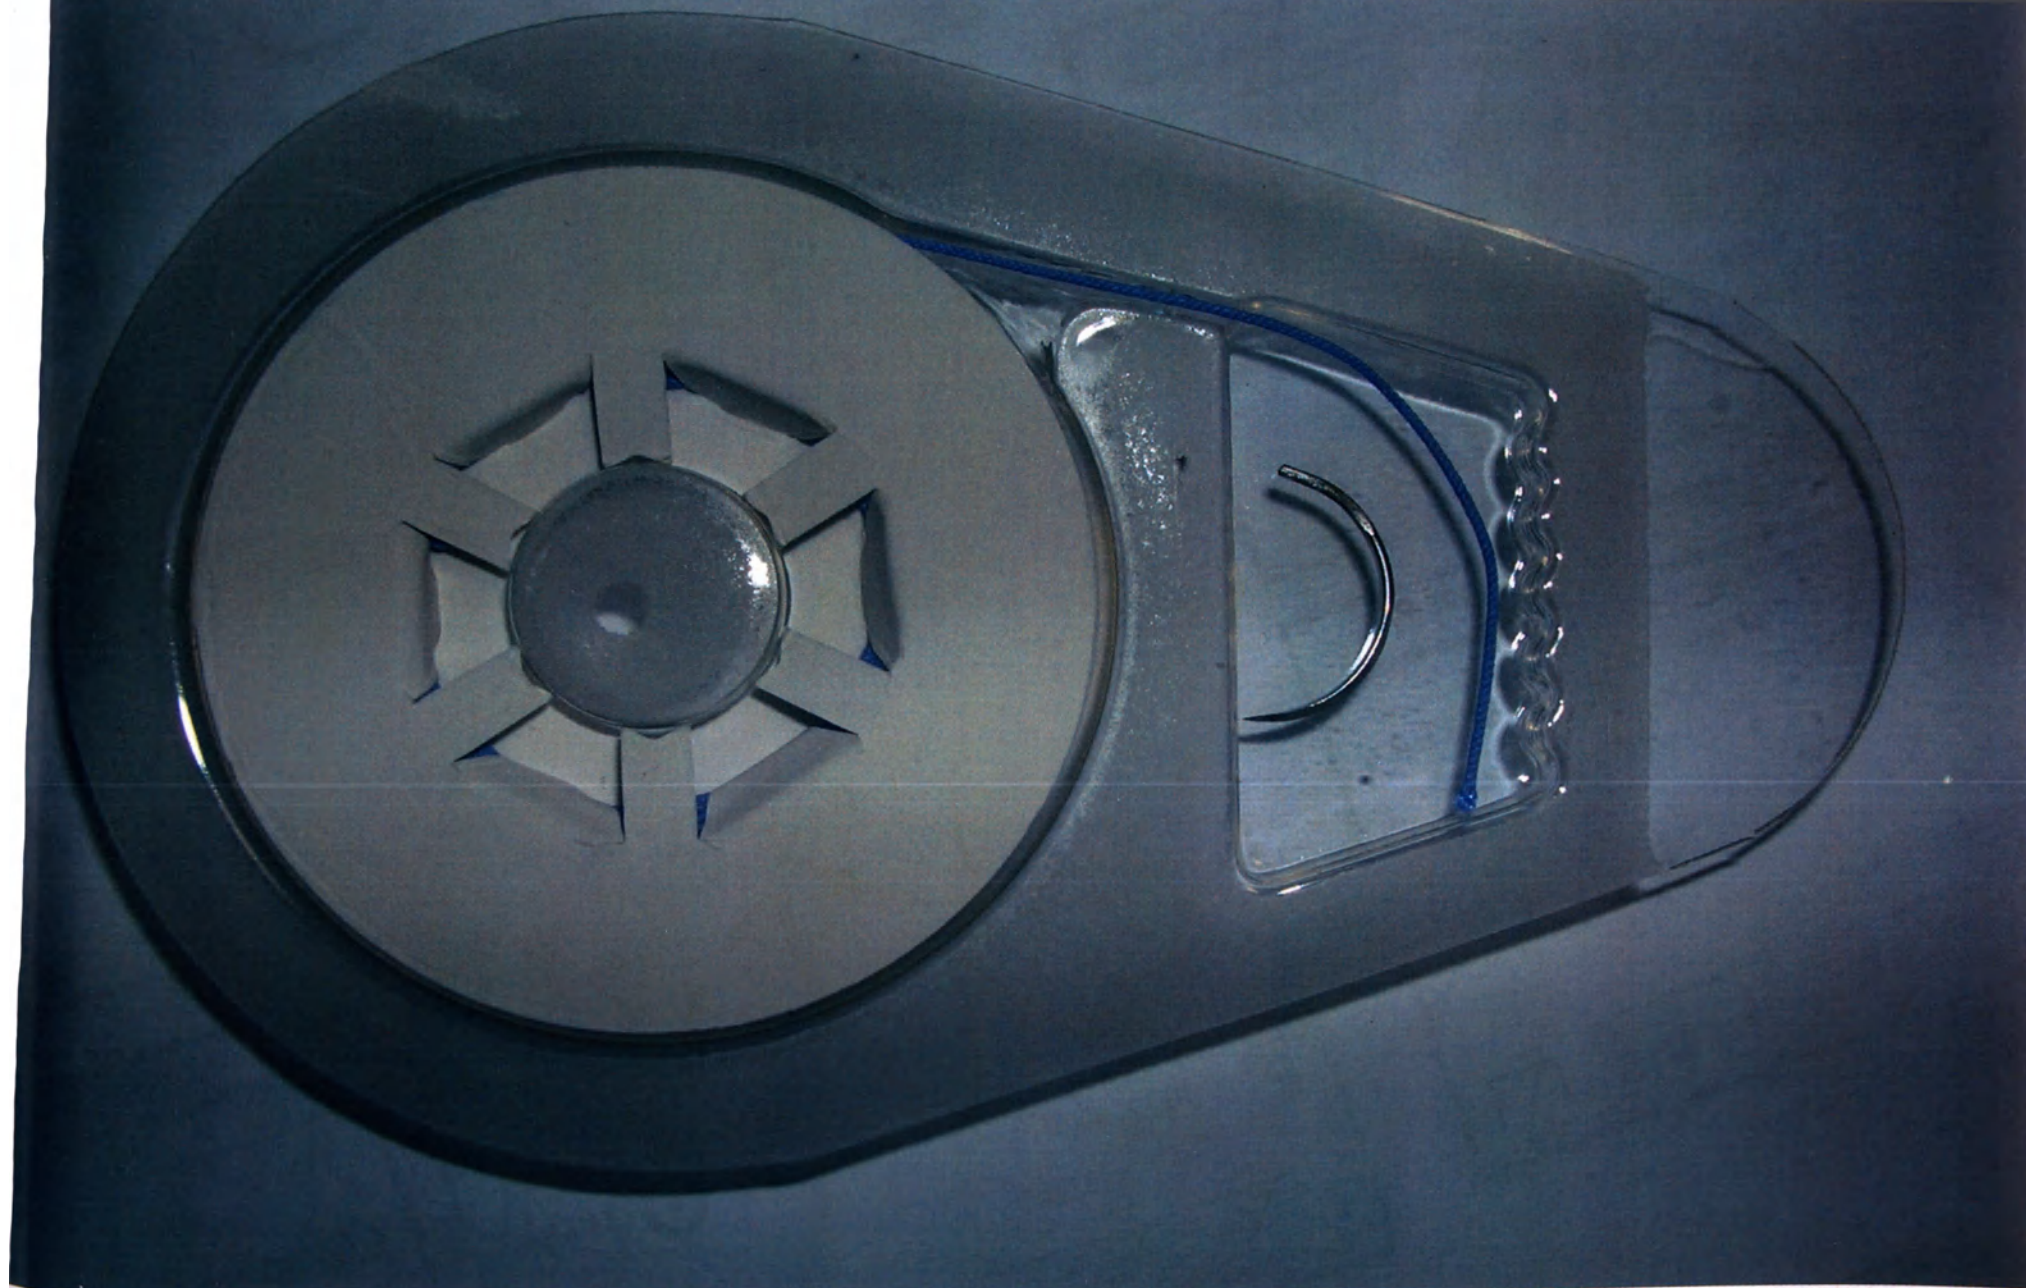


Вариант упаковки медицинского изделия «Материал шовный хирургический рассасывающийся, стерильный, с иглами и без игл «МЕДИНЖ» по МЛЦК.942241.001 ТУ: нить окрашенная (фиолетовая) намотанная на катушку, с иглой хирургической

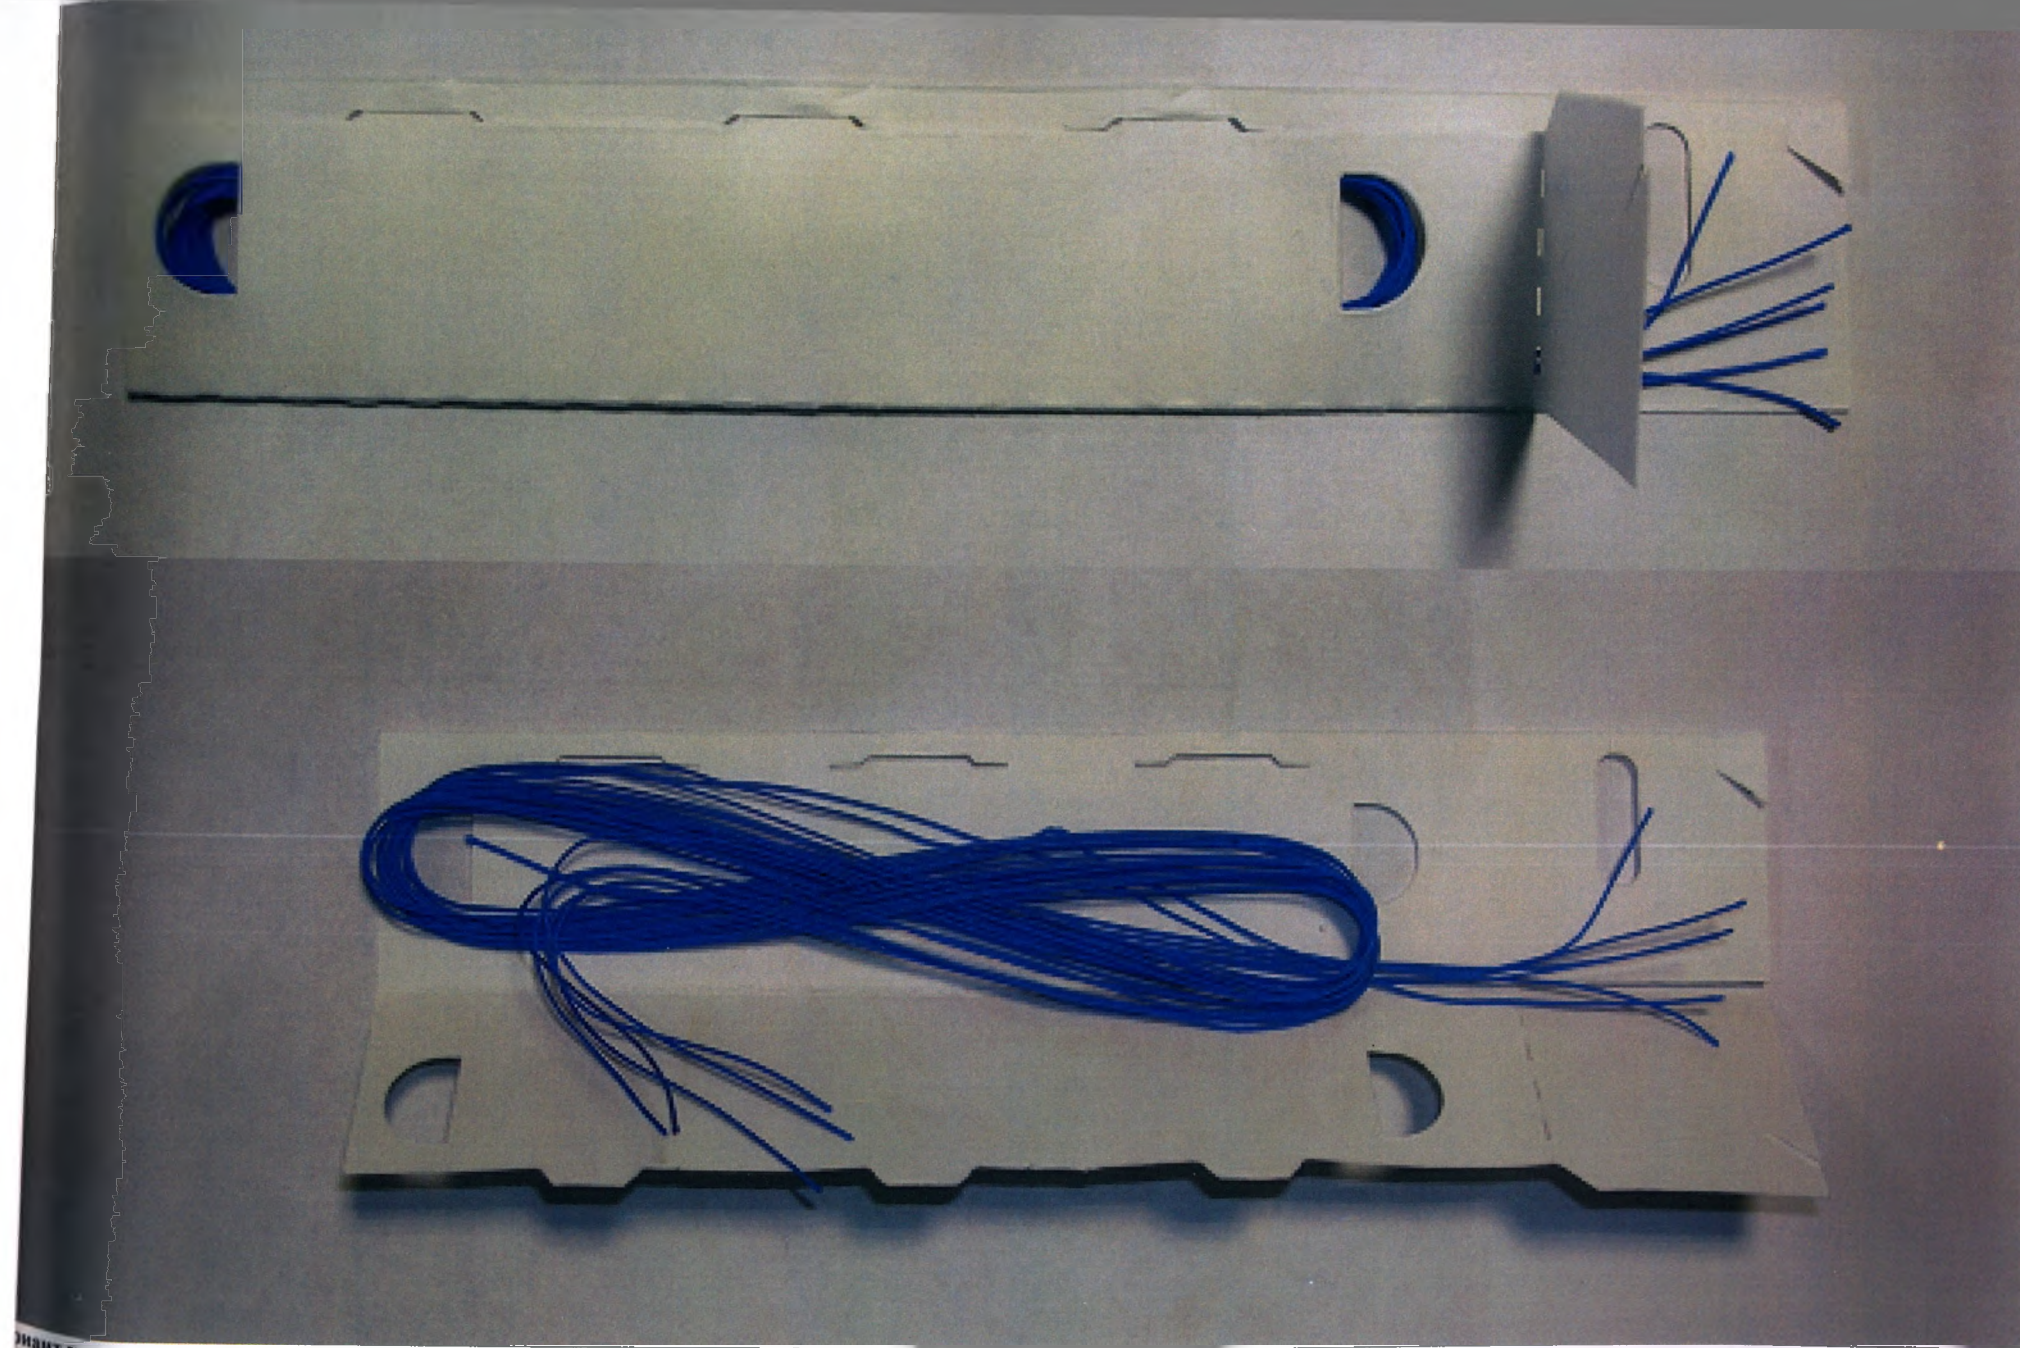



Вариант упаковки и внешний вид медицинского изделия «Материал шовный хирургический рассасывающийся, стерильный, с иглами и без игл «МЕДИНЖ» по МЛЦК.942241.001 ТУ: нить окрашенная (фиолетовая) (6 шт.) уложенная на фиксатор

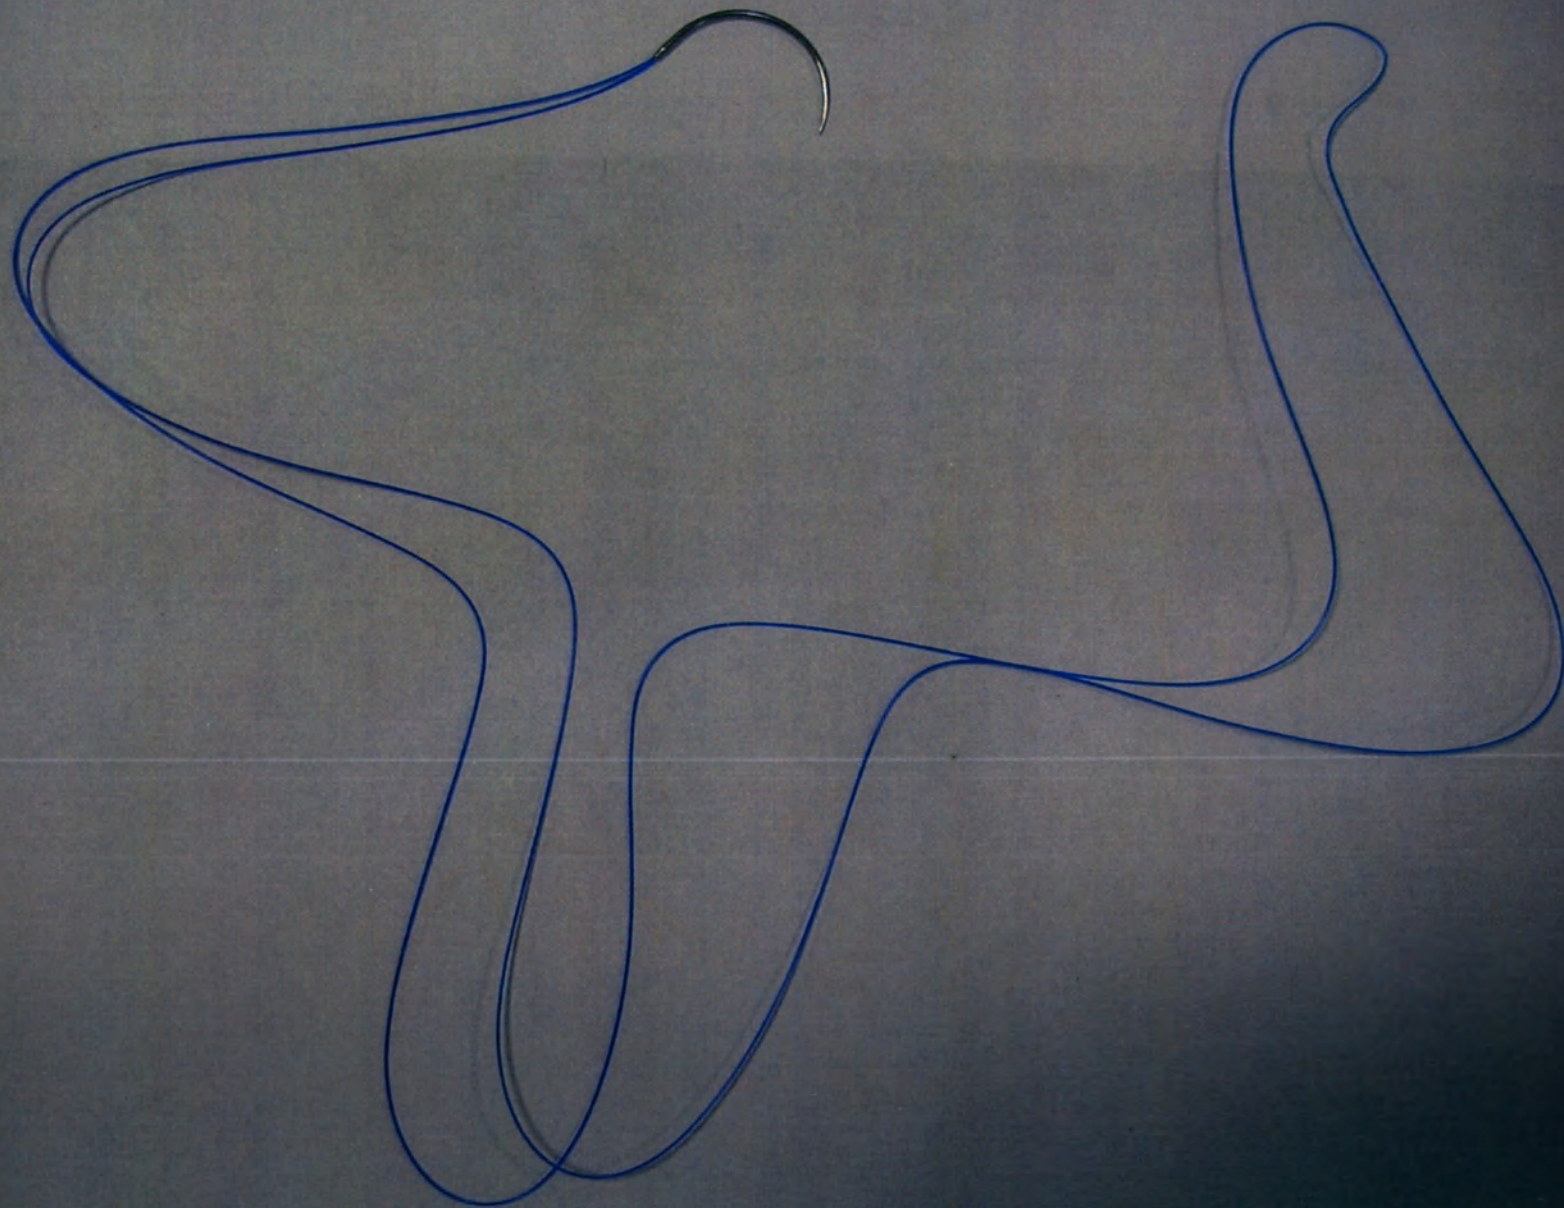

Внешний вид медицинского изделия «Материал шовный хирургический рассасывающийся, стерильный, с иглами и без игл «МЕДИНЖ» по МЛЦК.942241.001 ТУ: нить окрашенная (фиолетовая) с иглой атравматической (петля)

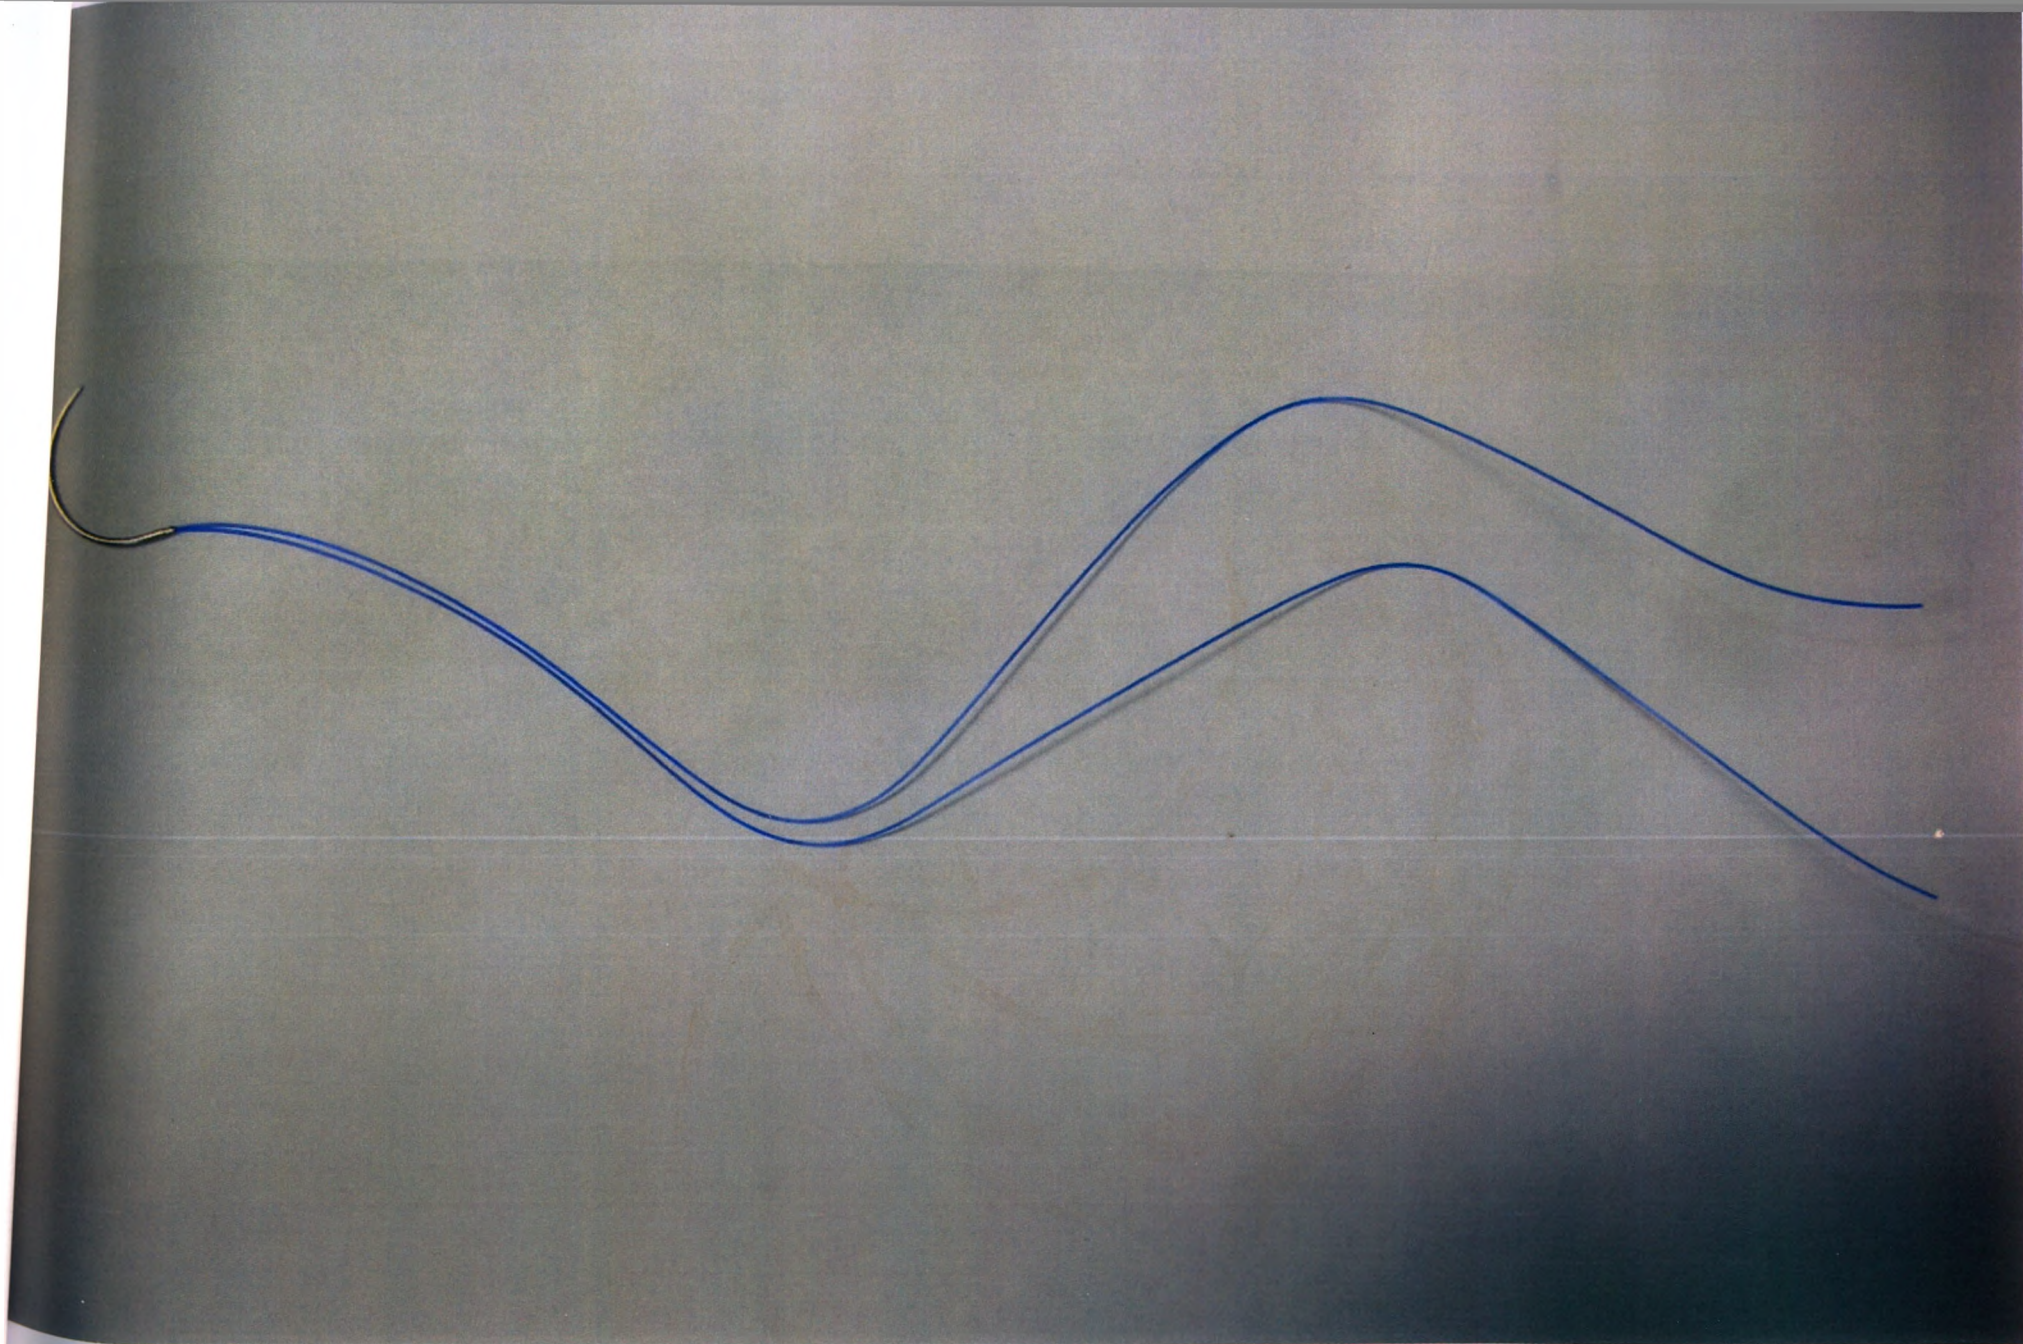

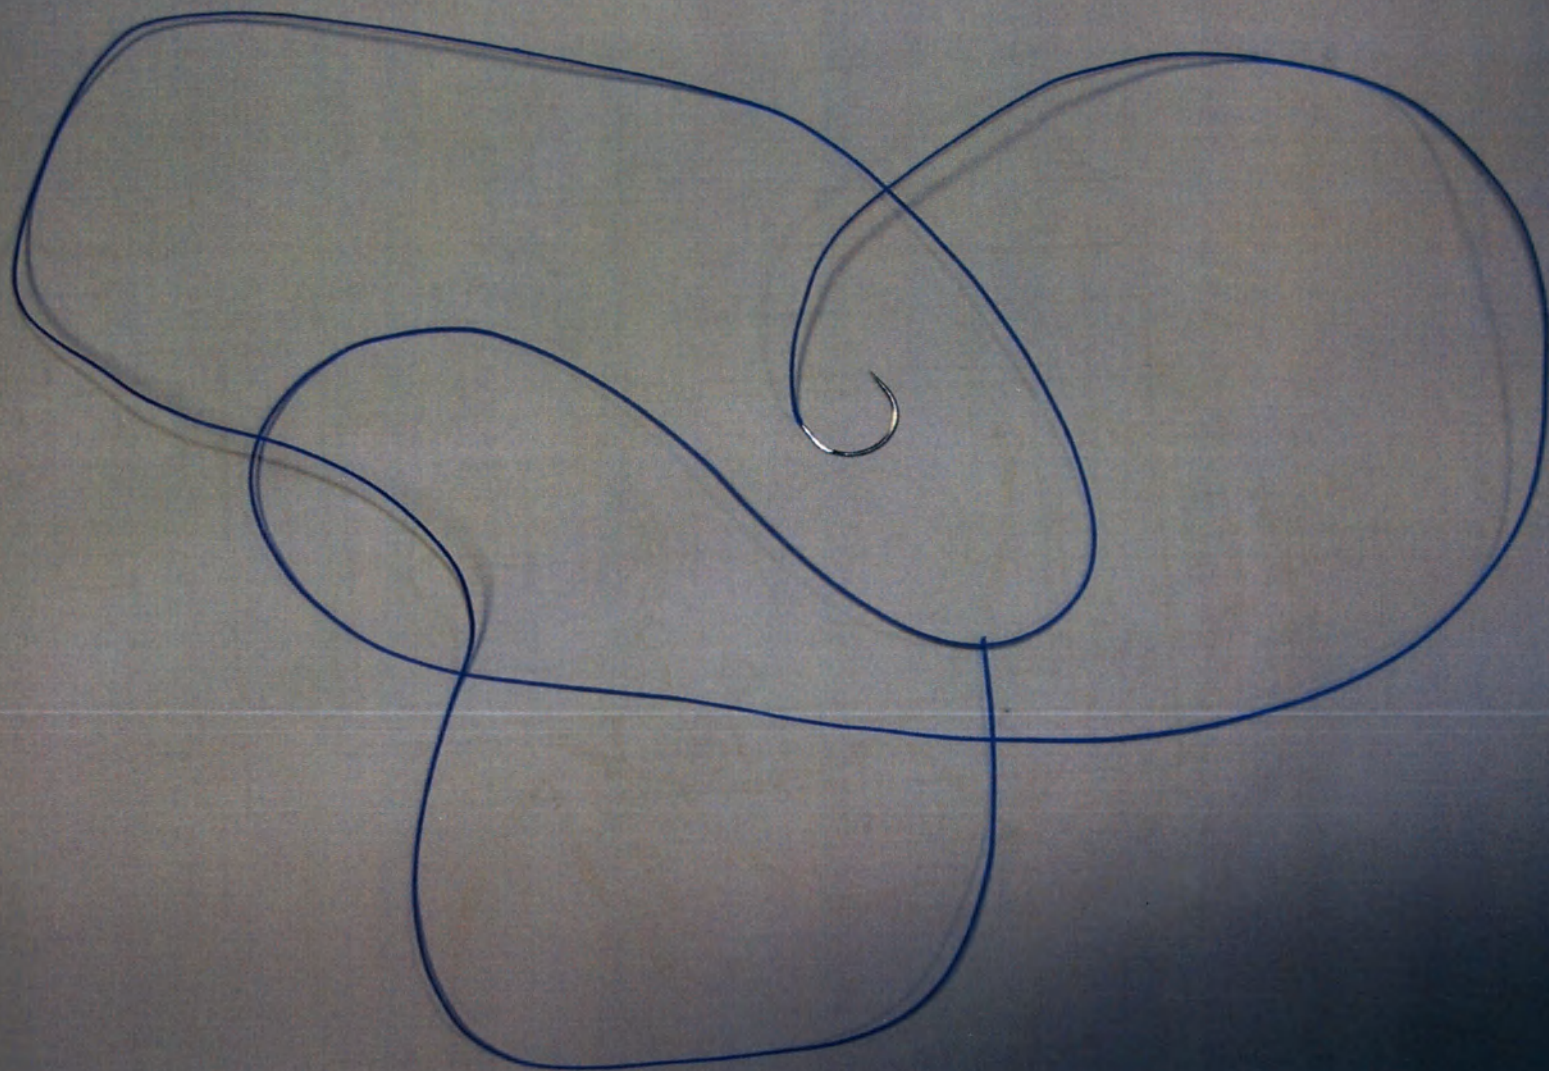

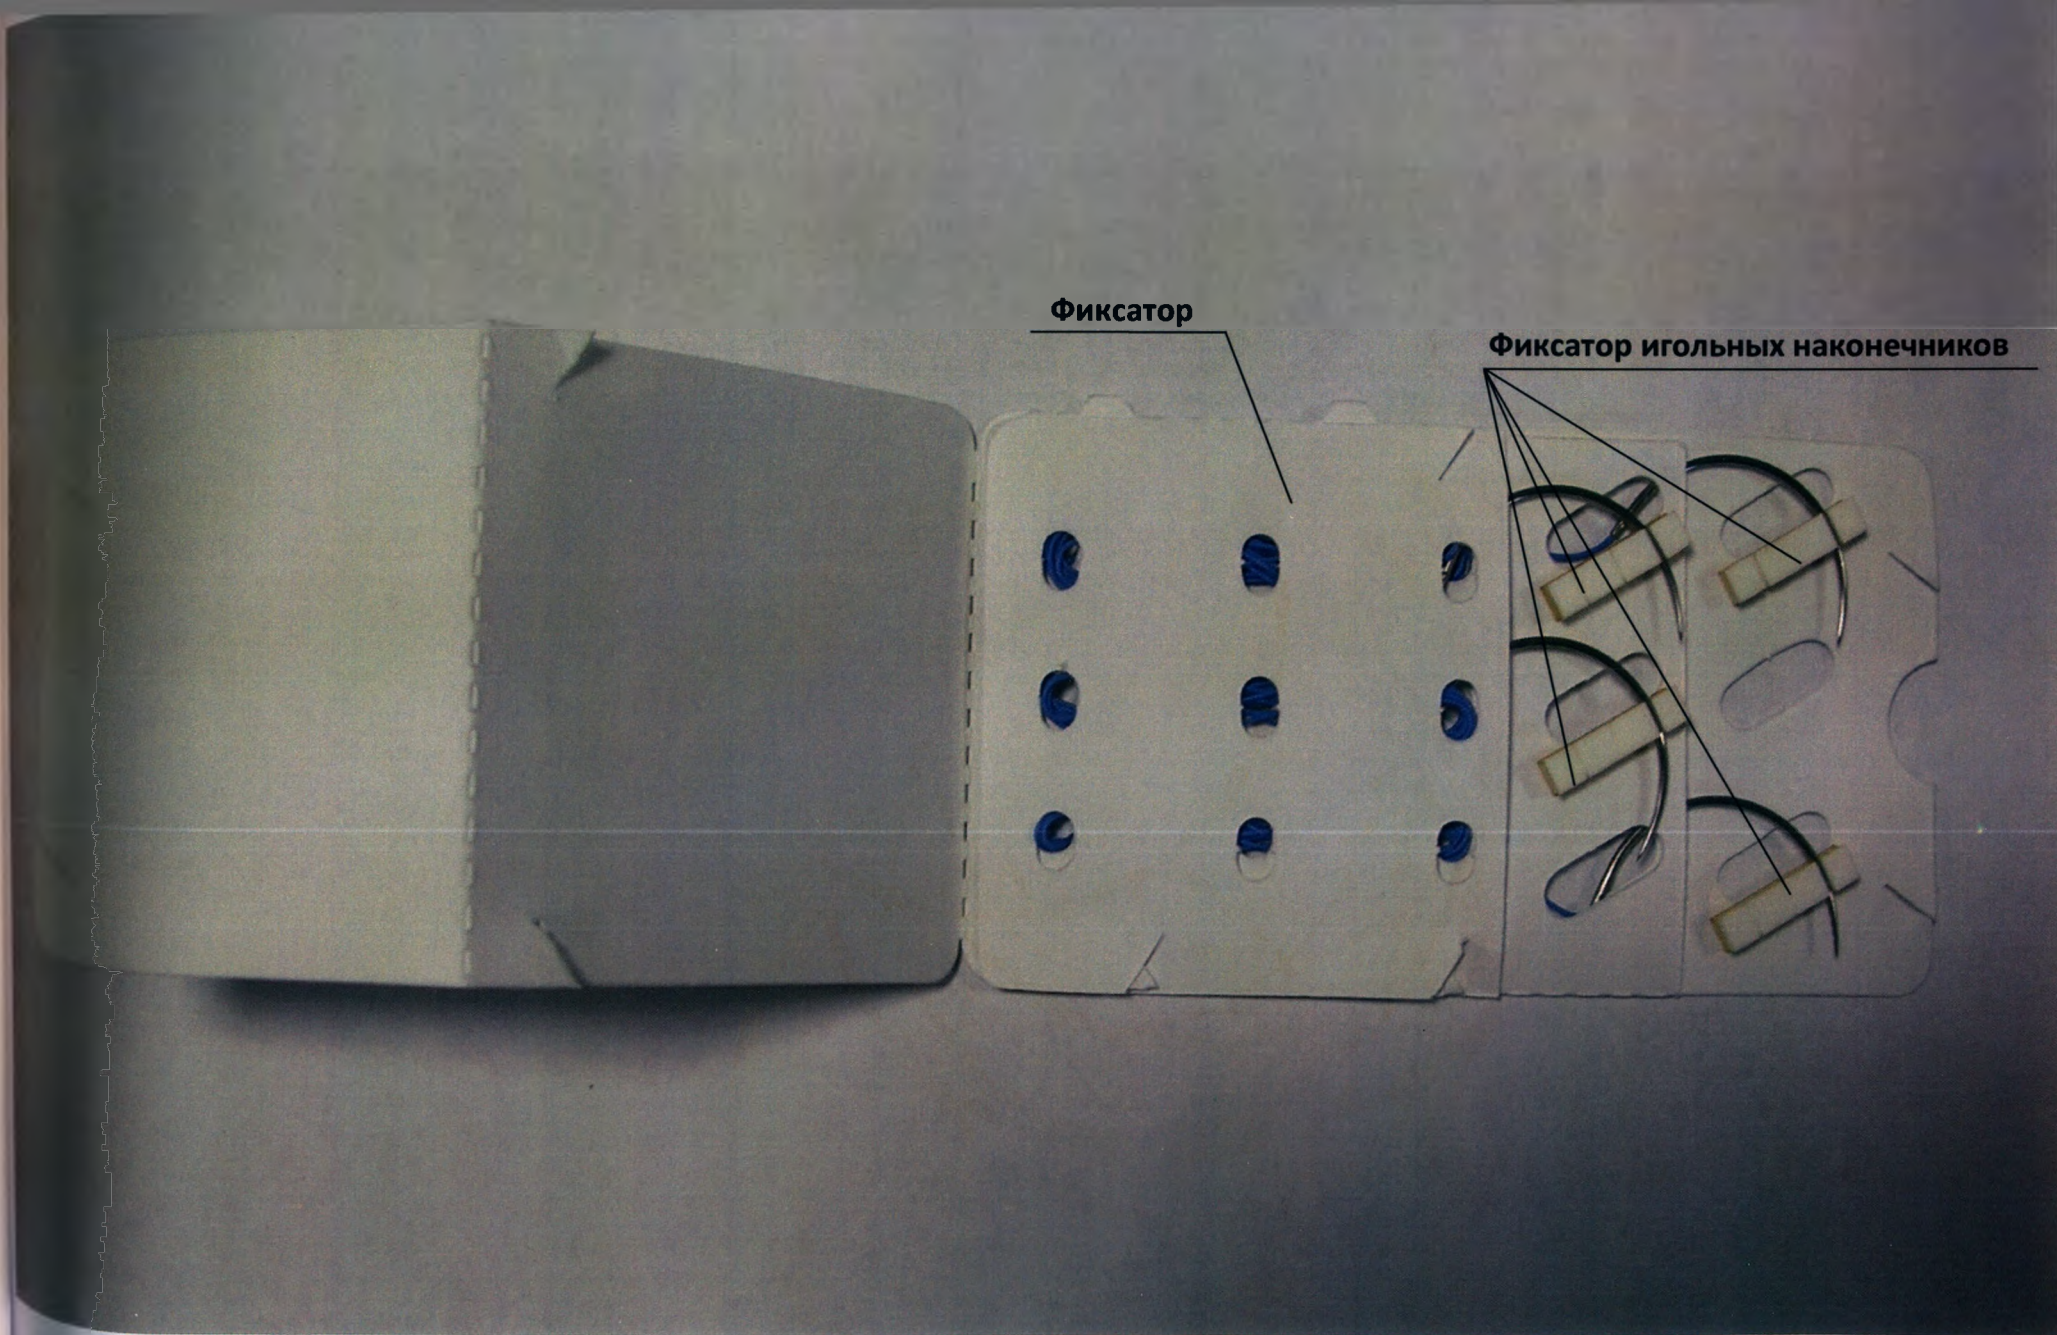

Фиксатор игольных наконечников

Фиксатор



Вариант упаковки и внешний вид медицинского изделия «Материал шовный хирургический рассасывающийся, стерильный, с иглами и без игл «МЕДИНЖ» по МЛЦК.942241.001 ТУ:
ООО Цирми (Филатовая) с иглами атравматическими (2 шт.) закрепленными на фиксаторе игольных наконечников, зафиксированными в фиксаторе

МедПГА Р крученая
полигликоливая кислота с покрытием из смеси
стеарата кальция и поликапролактона

USP 2/0 MP 3 5 м

Лигатура

1 игла хирургическая

LOT 17-0245-013

2017-10 

 2022-10

МЛЦК.942241.001ТУ
РУ N° от




STERILE EO

 ЗАО НПП "МедИнж" Россия
440004, Пенза, Центральная, 1



изображение упаковки и внешний вид медицинского изделия «Материал шовный хирургический рассасывающийся, стерильный, с иглами и без игл «МЕДИНЖ» по МЛЦК.942241.001 ТУ:

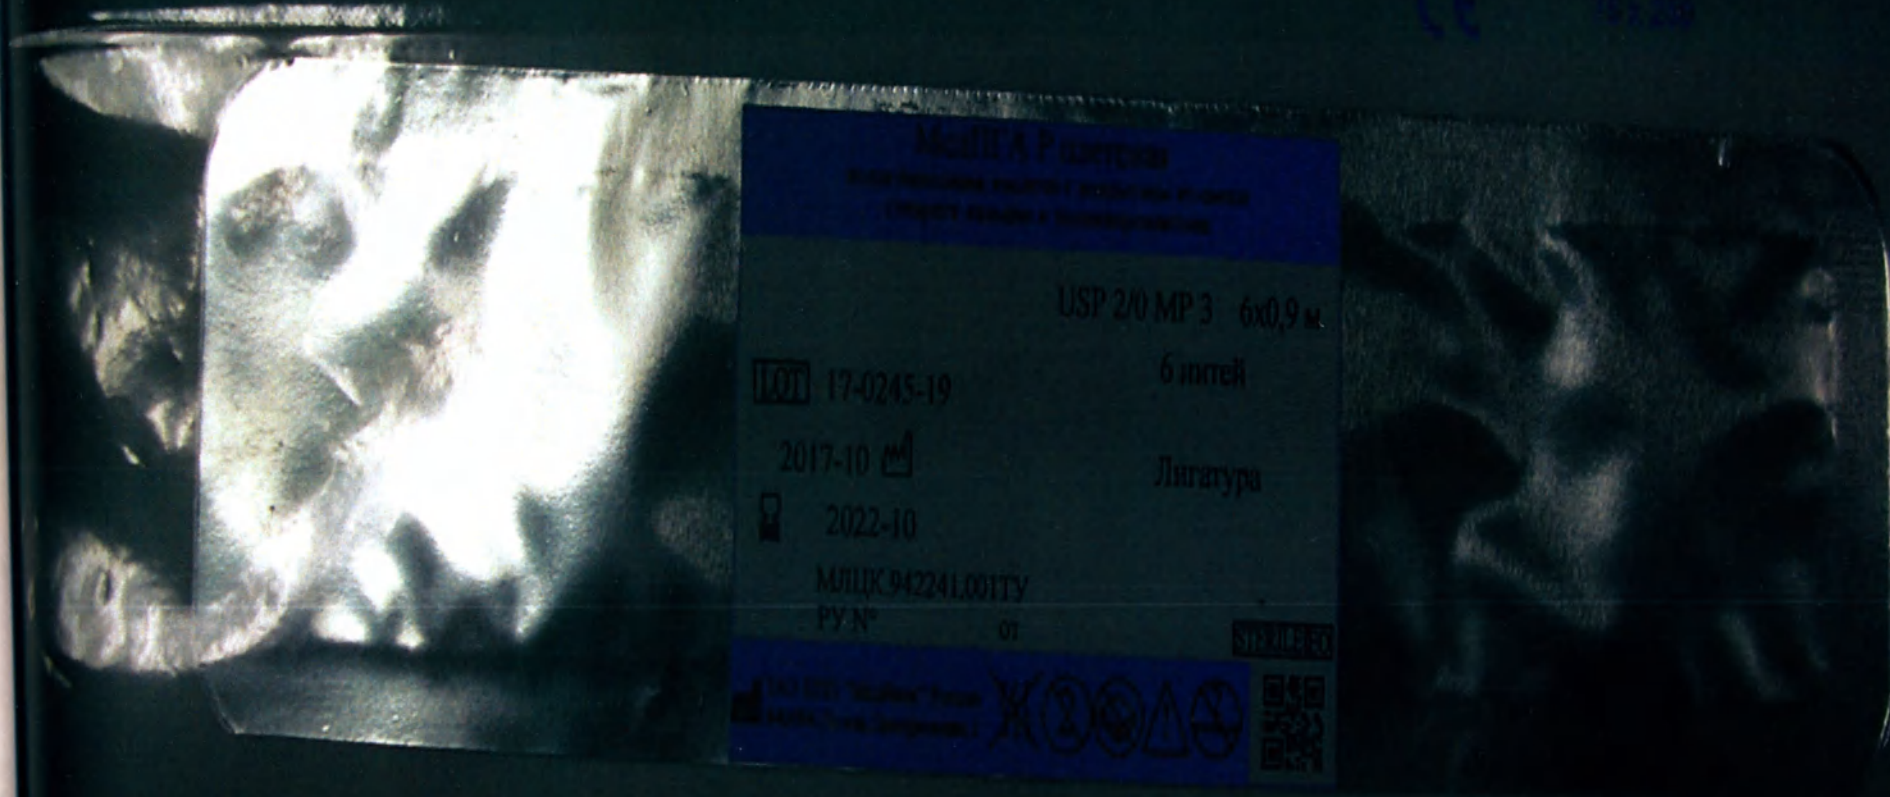

маркировки индивидуальной тары медицинского изделия «Материал шовный хирургический рассасывающийся, стерильный, с иглами и без игл «МЕДИНЖ» по МЛЦК.942241.001 ТУ

желтый
после
стерилизации

ГОЛ В 2523 00X120

МедИЖ А Р пластмассовая

медицинское изделие, предназначенное для хирургических операций по рассасыванию швов и наложению швов

USP 2/0 MP 3 3 м

LOT 17-0547-014


прямая 29 мм

2017-10

GP



2022-10



black

МЛЦК.942241.001ТУ

РУ N^о

от

КНИПМ.1001


ООО ЦИРМИ "МедИЖ" Россия
г. Москва, ул. Мясницкая, д. 1




ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

маркировки индивидуальной тары медицинского изделия «Материал шовный хирургический рассасывающийся, стерильный, с иглами и без игл «МЕДИНЖ» по МЛЦК.942241.001 ТУ




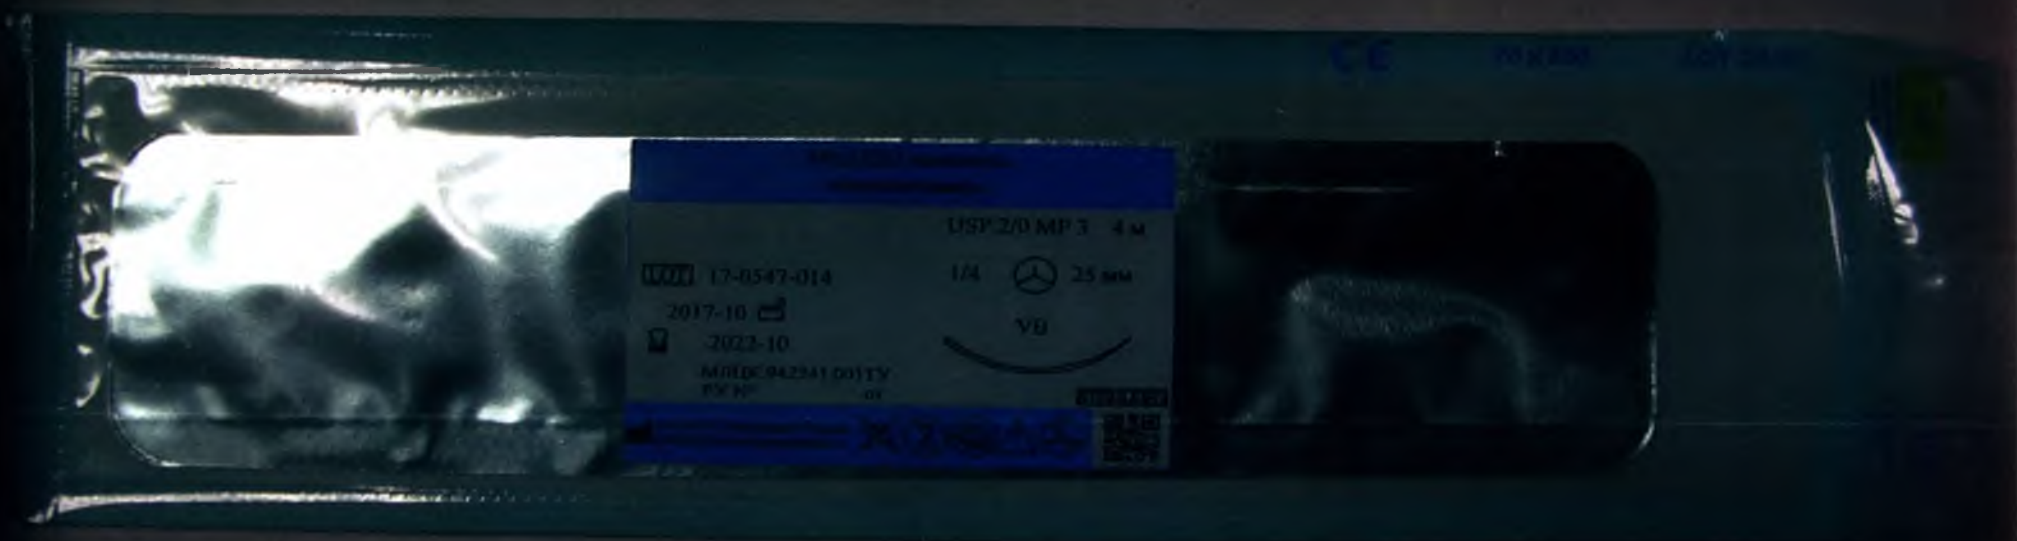


маркировки индивидуальной тары медицинского изделия «Материал шовный хирургический рассасывающийся, стерильный, с иглами и без игл «МЕДИНЖ» по МЛЦК.942241.001 ТУ

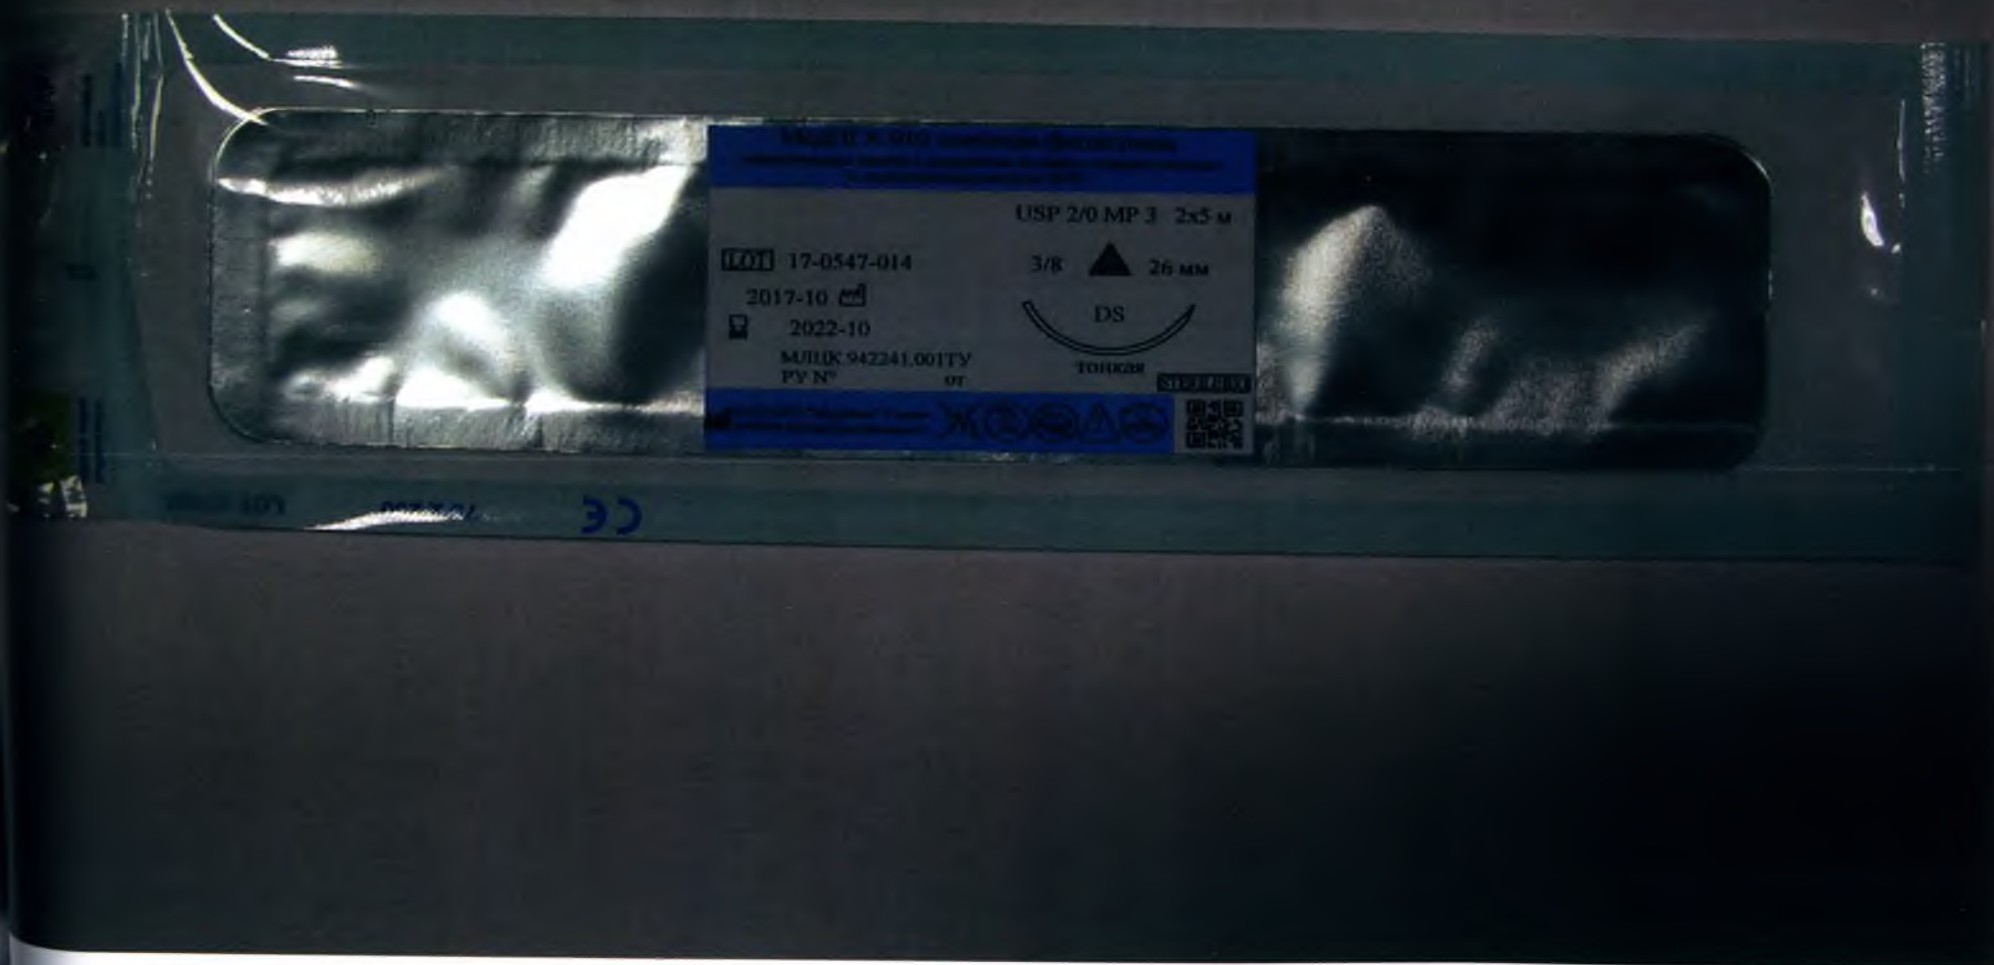

Маркировки индивидуальной тары медицинского изделия «Материал шовный хирургический рассасывающийся, стерильный, с иглами и без игл «МЕДИНЖ» по МЛЦК.942241.001 ТУ

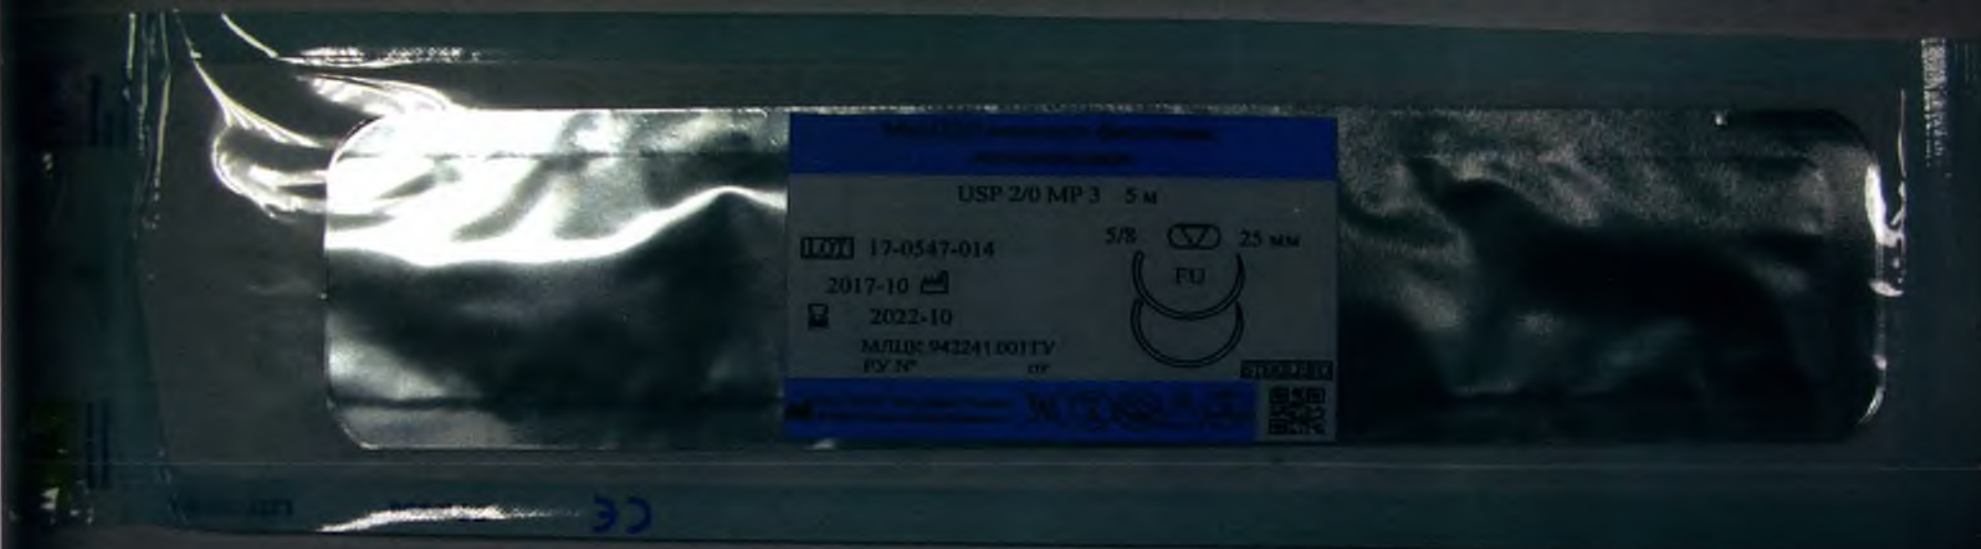

Вариант маркировки индивидуальной тары медицинского изделия «Материал шовный хирургический рассасывающийся, стерильный, с иглами и без игл «МЕДИНЖ» по МЛЦК.942241.001 ТУ

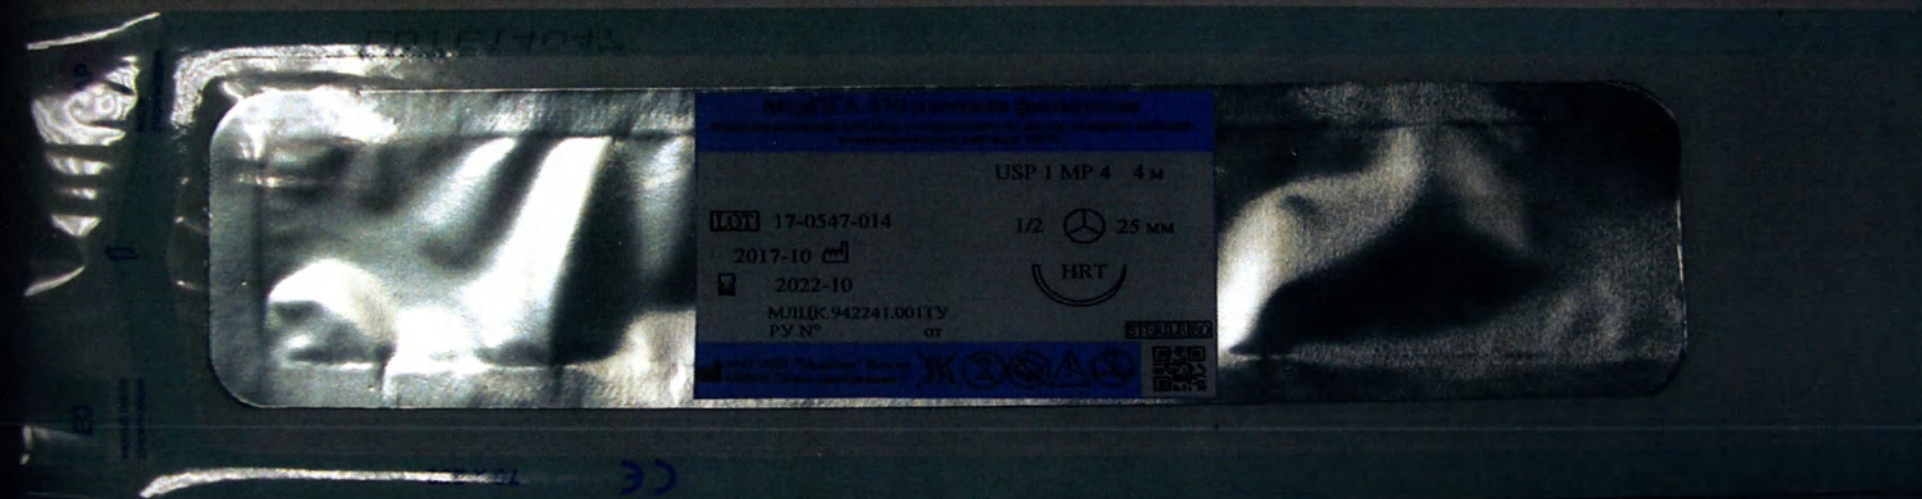

Элемент маркировки индивидуальной тары медицинского изделия «Материал шовный хирургический рассасывающийся, стерильный, с иглами и без игл «МЕДИНЖ» по МЛЦК.942241.001 ТУ



Содержит маркировки индивидуальной тары медицинского изделия «Материал шовный хирургический рассасывающийся, стерильный, с иглами и без игл «МЕДИНЖ» по МЛЦК.942241.001 ТУ

Мед/ШХХ-М материал рассасывающийся

USP 1 MP 4 2x3 м петля

LOT 17-0547-014

2017-10

2022-10

МЛЦК.942241.001ТУ

РУ N° 07



МАССИВНОСТЬ

STERILE

ООО ЦРМИ "Медтехника" Санкт-Петербург, Россия, (Санкт-Петербург)



Вариант маркировки индивидуальной тары медицинского изделия «Материал шовный хирургический рассасывающийся, стерильный, с иглами и без игл «МЕДИНЖ» по МЛЦК.942241.001 ТУ

МедИАР

Стерилизованный хирургический материал

USP 2/0 MP 3 1/5 м

Лигатура

LOT 17-0245-014

2017-10

2022-10

МЛЦК.942241.001ТУ

РУ № 01

3/8 26 мм



STERILE

МЛЦК.942241.001ТУ





057 X 51

33

маркировки индивидуальной тары медицинского изделия «Материал шовный хирургический рассасывающийся, стерильный, с иглами и без игл «МЕДИНЖ» по МЛЦК.942241.001 ТУ

000 ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

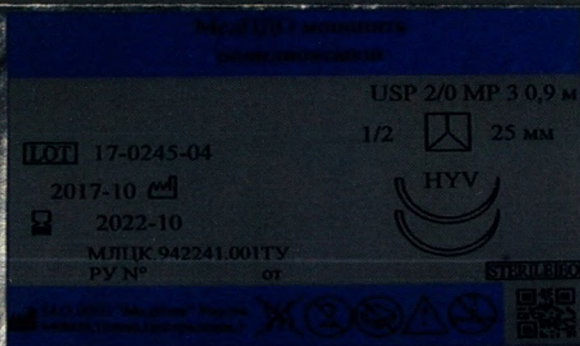

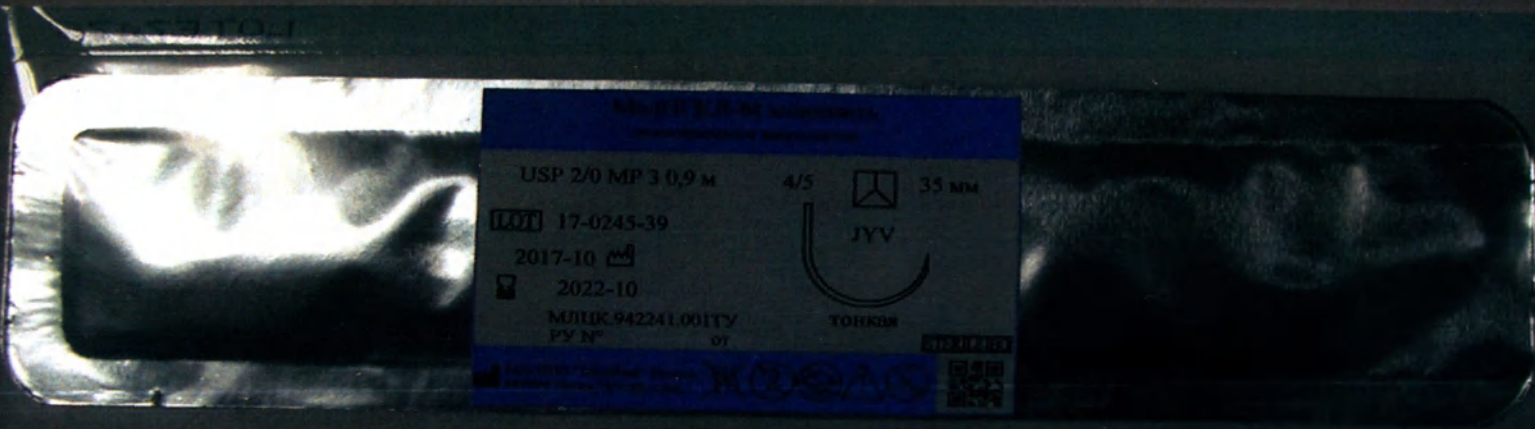

МедПЛАР крученая
 полигликолиновая кислота с покрытием из смеси
 стеарата кальция и поликапролактона

USP 2/0 MP 3 5 м Лигатура

LOT 17-0245-013

2017-10 

 2022-10

МЛЦК.942241.001ТУ
 РУ N° от

 1/2  21 mm
 1HK

STERILE EO

 ЗАО НПП "МедНиж" Россия
 440004 Пенза, Центральная, 1



Медицинская филетовая
упаковка с застежкой-молнией из полипропилена
с защитным покрытием и антистатическими свойствами

USP 2/0 MP 3 15 м

Лигатура

LOT 17-0245-05

2017-10

2022-10

МЛЦК.942241.001ТУ

РУ №

СТ

1/2 25 мм

IHB

STERILE

ВНИМАНИЕ! При использовании упаковки необходимо соблюдать правила стерилизации и хранения.

ЖИЗНИ

QR CODE

Не применять, если упаковка повреждена

МедПГА 910 плетеная фиолетовая
полигликолид ластик с покрытием из смеси стеарата кальция
и полигликолид ластика 30/70

USP 2/0 MP 3 0,9 м

LOT 17-0245-05

3/8 ▼ 26 мм

2022-10

DQ

2022-10

МЛЦК.942241.001ТУ

РУ N°

от

STERILE EO

ЗАО НПФ "МедНика" Россия
440004 Пенза, Пензенская обл.



EO

желтый
после
стерилизации

LOT B 2522 60X120

Материал шовный хирургический рассасывающийся,
стерильный, с иглами и без игл "МЕДИНЖ"

МедПГА плетеная фиолетовая 20 шт.
полигликолиевая кислота с покрытием из
смеси стеарата кальция и поликапролактона

USP 3/0 MP 2 0,7 м 1/2  25 мм

LOT 17-0228-13

2017-04   2022-04

МЛЦК.942241.001ТУ

РУ N° от



МедИнж



МедИнж

Хирургический
шовный материал

СТЕРИЛЬНО • АПМОТЕННИО • ПЕРИОДИЧЕСКОЕ



МедИнж

ЗАО НПП «МедИнж»

440004, Россия


г. Пенза, а/я 2913

Тел.: +7(8412)93-47-63

Факс: +7(8412)38-09-68


meng@sura.ru

www.medeng.ru



STERILE EO



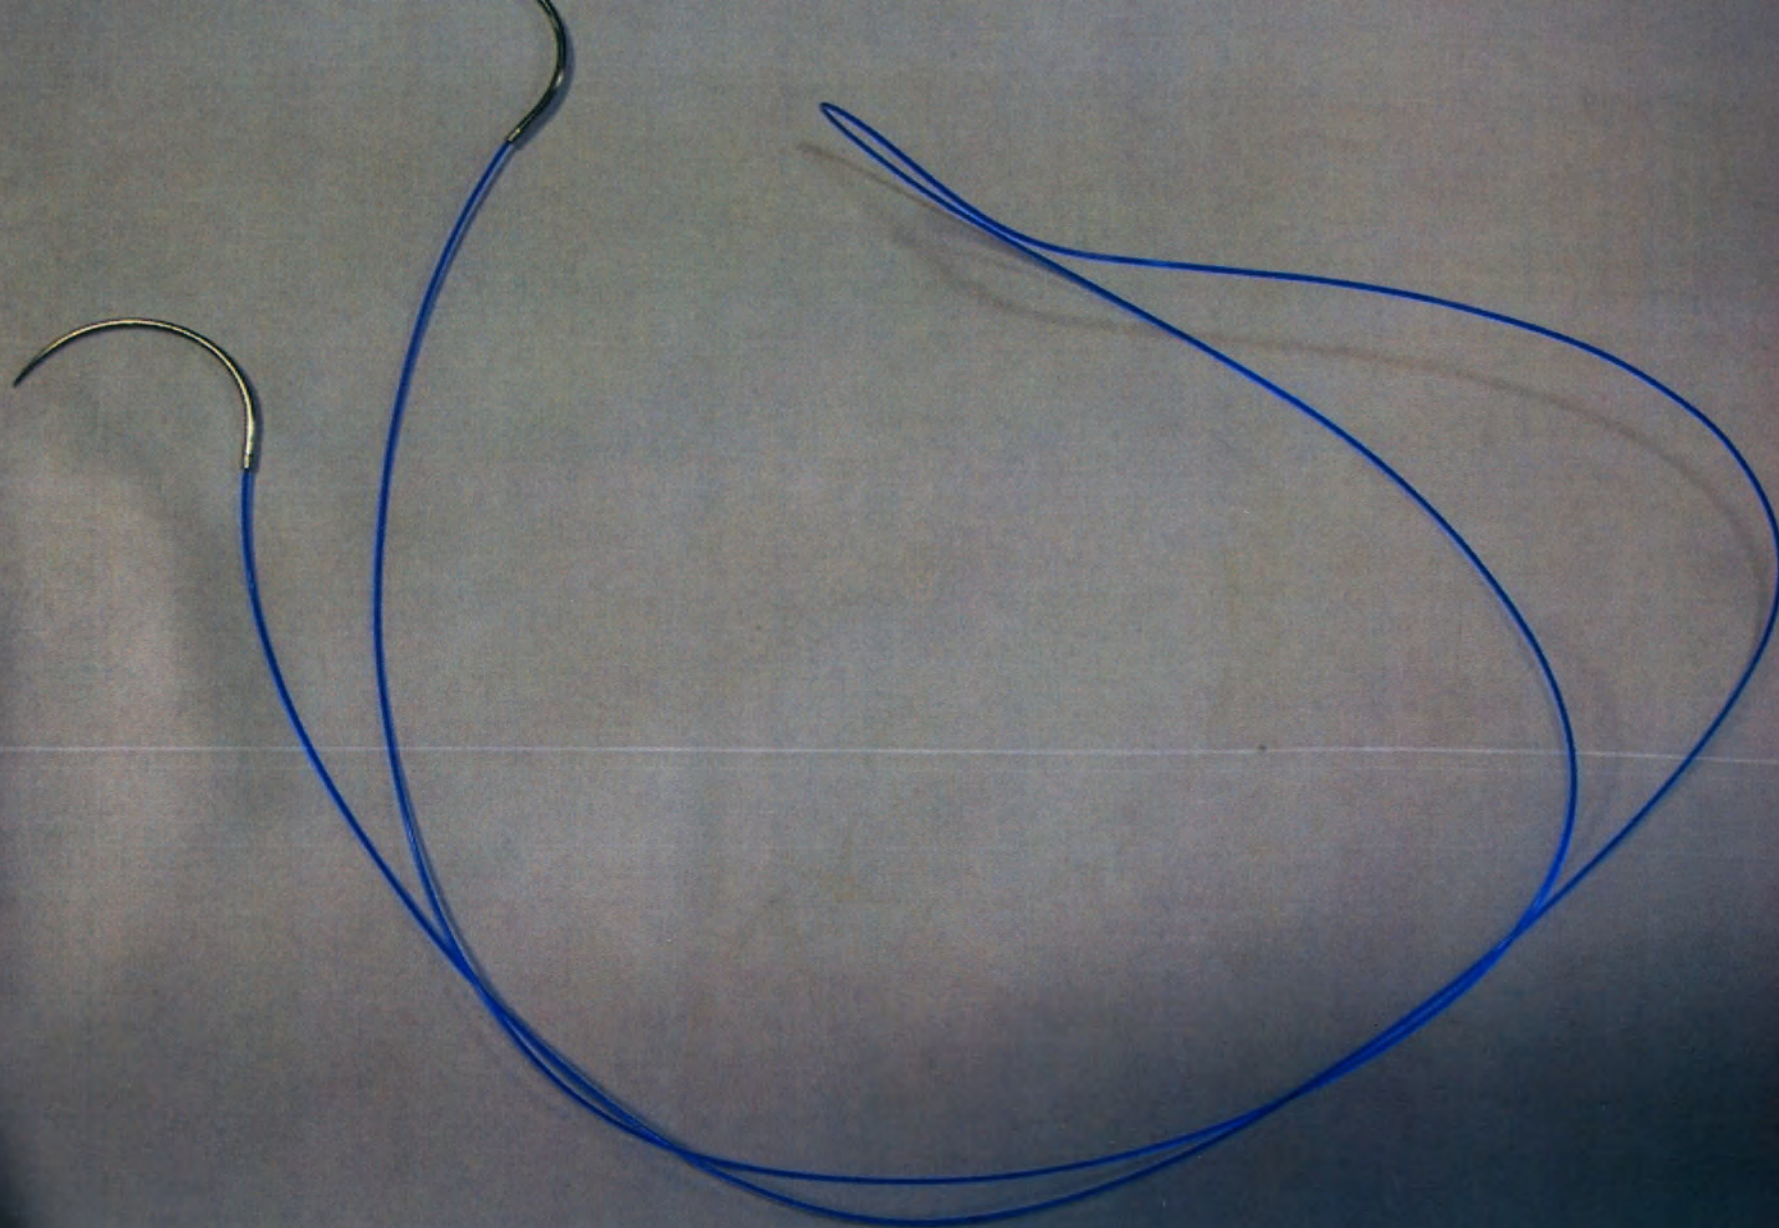

Внешний вид медицинского изделия «Материал шовный хирургический рассасывающийся, стерильный, с иглами и без игл «МЕДИНЖ» по МЛЦК.942241.001 ТУ: нить окрашенная (фиолетовая) с иглой атравматической (2 шт.)

прошнуровано и
скреплено печатью

29

листов

