

Фотографические изображения
медицинского изделия

***Прокладки урологические для женщин SENI LADY,
размеры: micro, mini, mini plus, normal, extra, super,
plus***

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «БЕЛЛА Восток»



Ежи Горковенко

« 20 » сентября 2017 г.

Прокладки урологические для женщин SENI LADY, размер: micro; 20 шт. Изделия предназначены для впитывания и удерживания мочи у женщин с лёгкой и средней формой недержания. Состав: Целлюлоза, суперабсорбент, нетканый материал, паропроницаемый ламинат, силиконизированная бумага, краситель, клей. Способ применения: расправить прокладку; снять ленту, защищающую липкий слой прокладки, который расположен в её внешней части; наложить прокладку её клеевой внешней частью на трусы (в нижнюю часть трусов) таким образом, чтобы внутренняя часть прокладки, после надевания трусов, удобно прилегала к телу; надеть трусы с прокладкой; при загрязнении прокладку необходимо удалить; Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие; Дата изготовления – см. в номере партии на упаковке (гггг.мм.дд); Годен до см. рядом с номером партии (гггг.мм). Не использовать после окончания срока годности; Хранить в сухих помещениях.

При расхождении информации на стикере и на упаковке, верным считать стикер.


Рег. № ФСЗ 2007/00071 от _____.

Изготовитель: TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.

(АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРІАЛУВ ОПАТРУНКОВИХ С.А.») TZMO SA./ (АО «ТЗМО С.А.»), 87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego, 20/26, Polska. Продавец / Импортёр / Уполномоченный представитель изготовителя: ООО «БЕЛЛА Восток», 140300, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9.





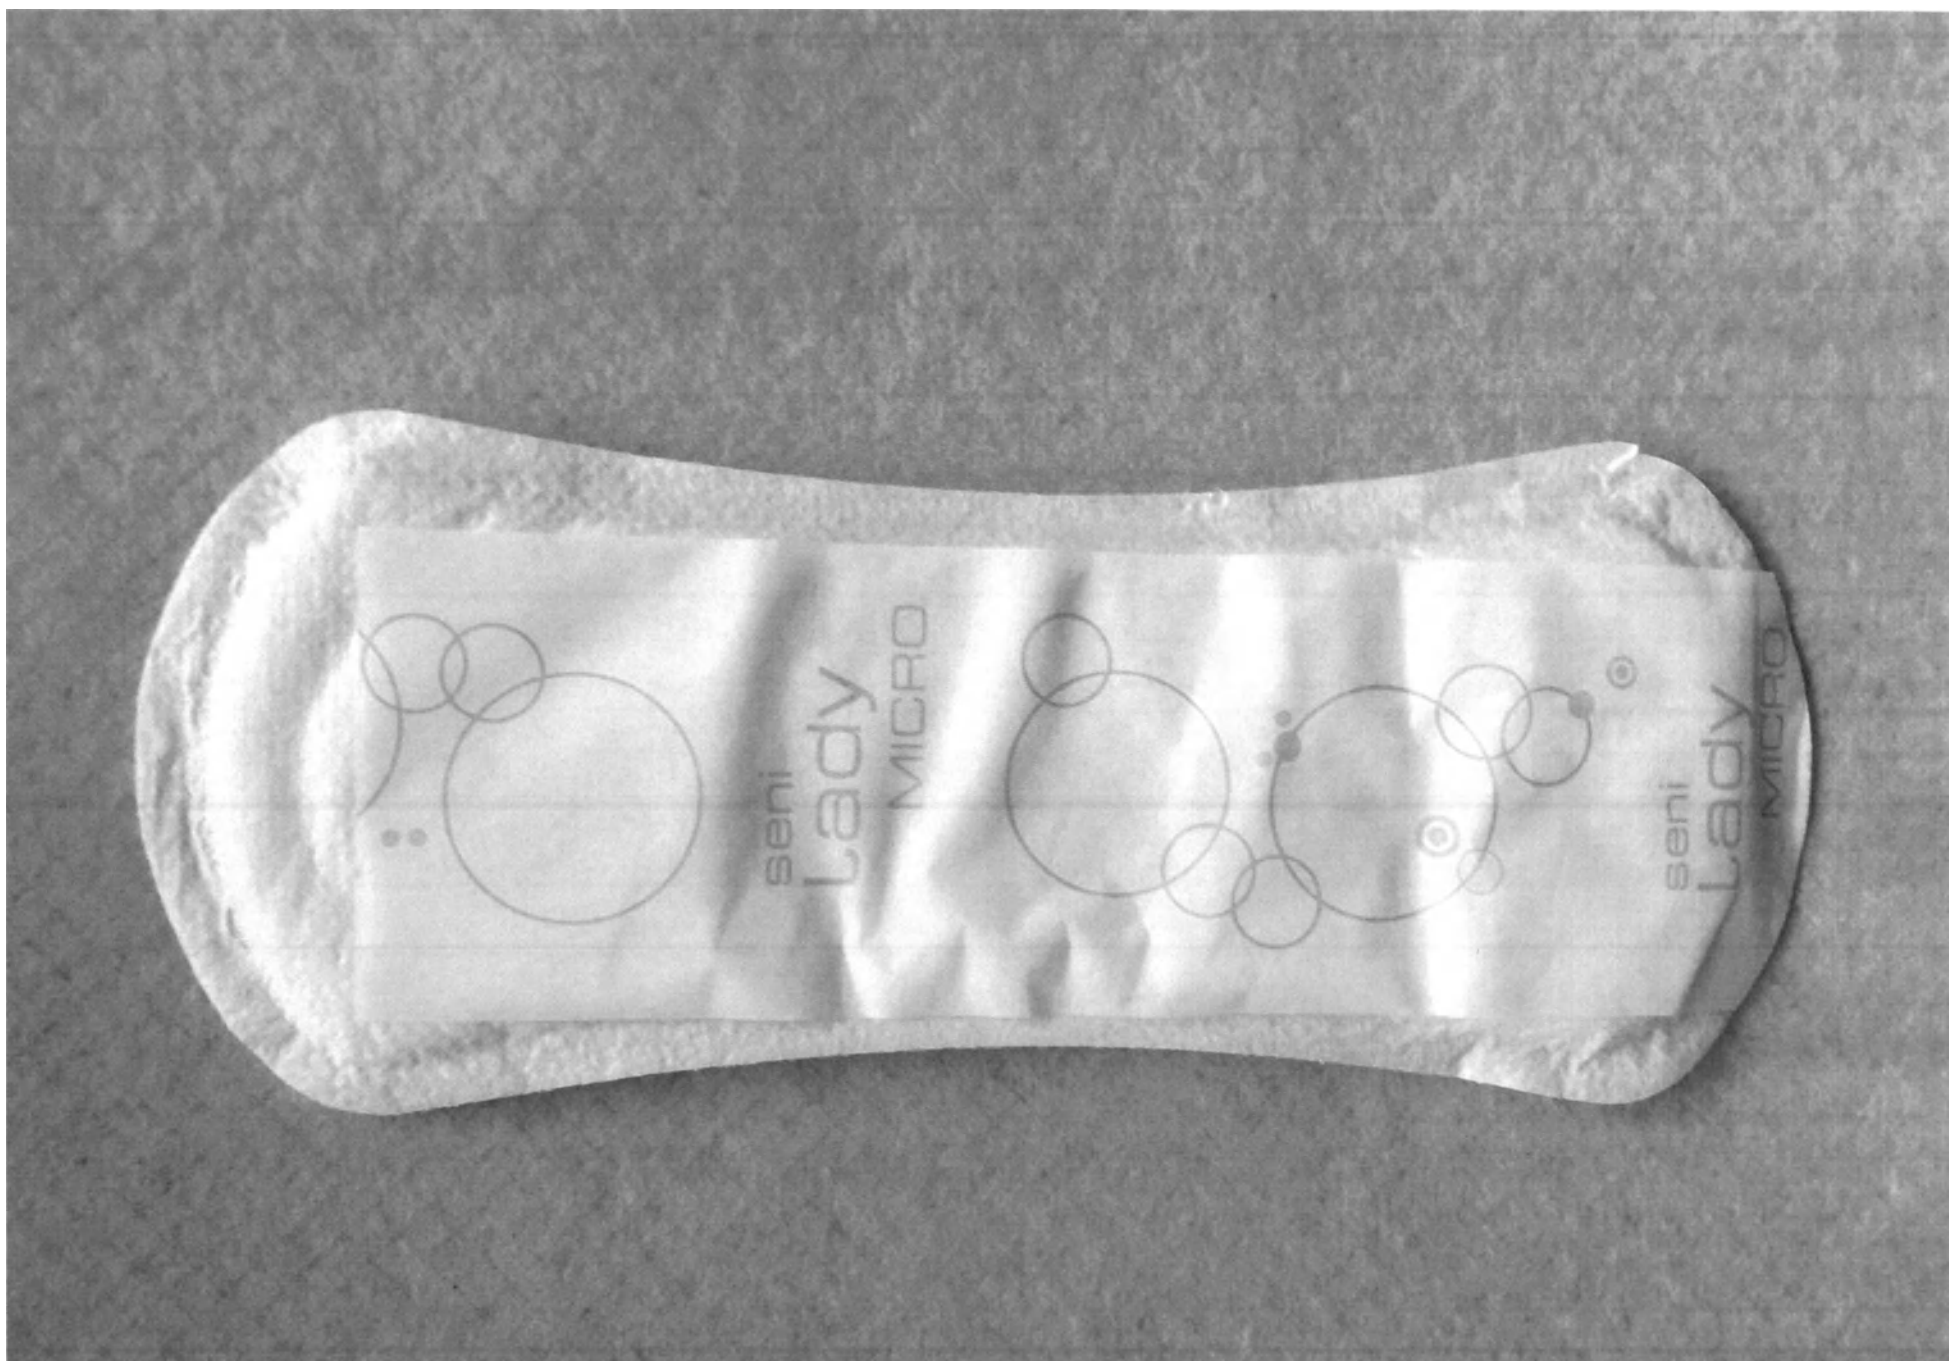

Прокладки урологические для женщин SENI LADY, размер: mini; 20 шт. Изделия предназначены для впитывания и удерживания мочи у женщин с лёгкой и средней формой недержания. Состав: Целлюлоза, суперабсорбент, нетканый материал, паропроницаемый ламинат, силиконизированная бумага, эластановая пряжа, эластичная резинка, краситель, клей. Способ применения: расправить прокладку; снять ленту, защищающую липкий слой прокладки, который расположен в её внешней части; наложить прокладку её клеевой внешней частью на трусы (в нижнюю часть трусов) таким образом, чтобы внутренняя часть прокладки, после надевания трусов, удобно прилегала к телу; надеть трусы с прокладкой; при загрязнении прокладку необходимо удалить; Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие; Дата изготовления – см. в номере партии на упаковке (гггг.мм.дд); Годен до см. рядом с номером партии (гггг.мм). Не использовать после окончания срока годности; Хранить в сухих помещениях.

При расхождении информации на стикере и на упаковке, верным считать стикер.

Рег. № ФСЗ 2007/00071 от _____.

Изготовитель: TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.
(АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРІАЛУВ ОПАТРУНКОВИХ С.А.») TZMO SA./ (АО «ТЗМО С.А.»), 87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego, 20/26, Polska. Продавец / Импортёр / Уполномоченный представитель изготовителя: ООО «БЕЛЛА Восток», 140300, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9.






seni
Lady
MINI


pcs. 20 Bladder control pads
Stk. Inkontinenzeinlagen
шт. Урологические прокладки
szt. Anatomiczne wkładki
urologiczne

URO Protect

Breathable
Atmungsaktiv
Дышащие
Oddychające

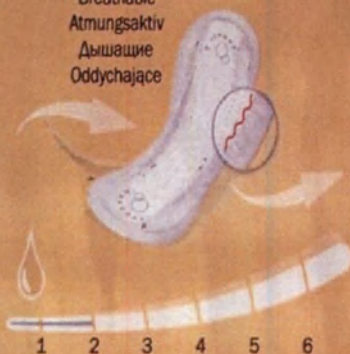

Прокладки урологические для женщин SENI LADY, размеры: Mini

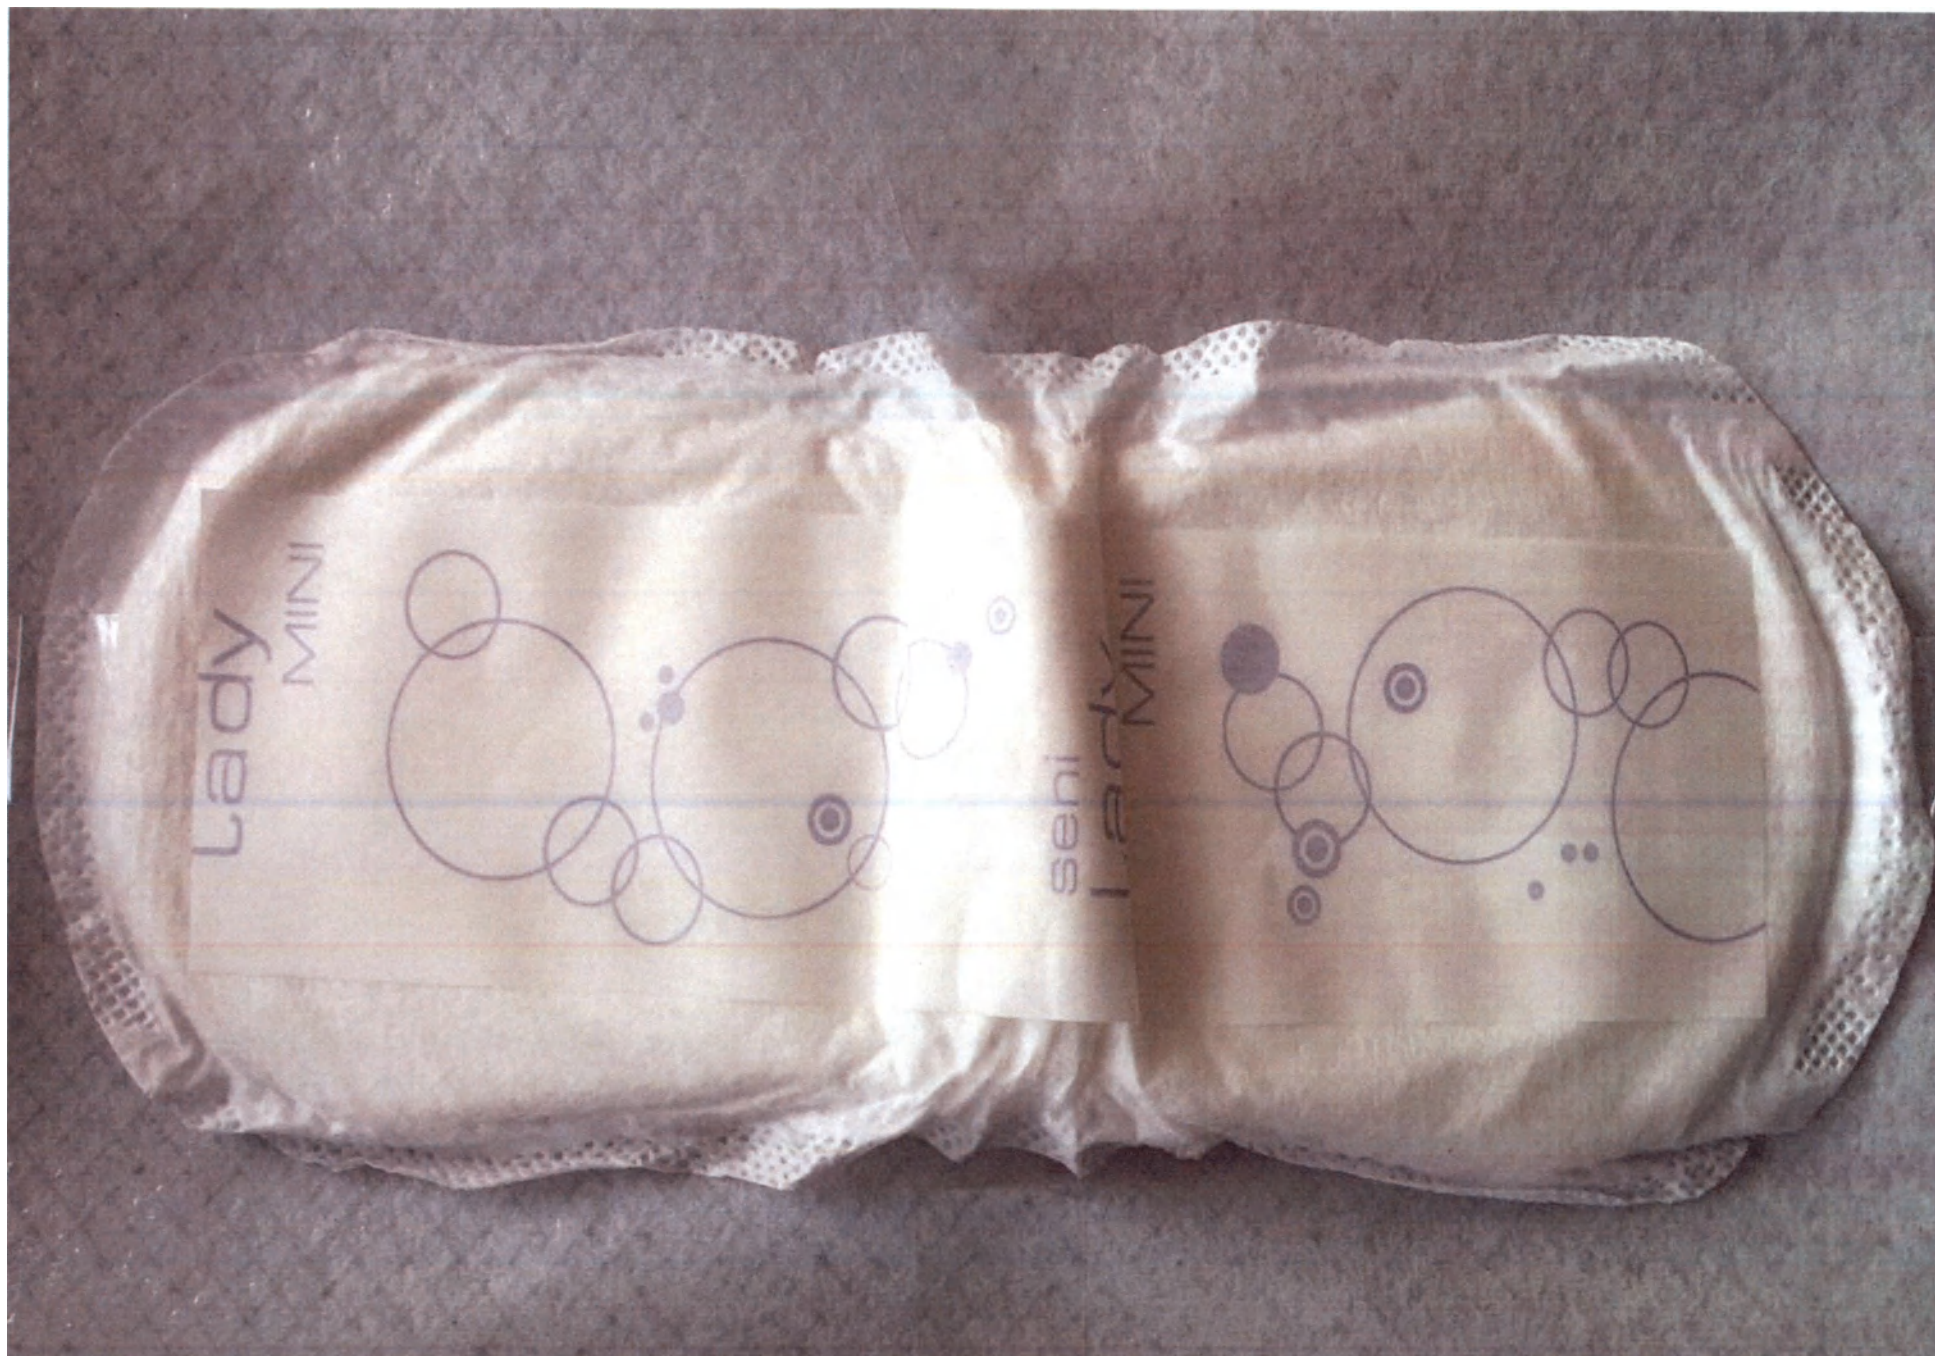

Прокладки урологические для женщин SENI LADY, размер: mini plus; 20 шт. Изделия предназначены для впитывания и удерживания мочи у женщин с лёгкой и средней формой недержания. Состав: Целлюлоза, суперабсорбент, нетканый материал, паропроницаемый ламинат, силиконизированная бумага, эластановая пряжа, краситель, клей. Способ применения: расправить прокладку; снять ленту, защищающую липкий слой прокладки, который расположен в её внешней части; наложить прокладку её клеевой внешней частью на трусы (в нижнюю часть трусов) таким образом, чтобы внутренняя часть прокладки, после надевания трусов, удобно прилегала к телу; надеть трусы с прокладкой; при загрязнении прокладку необходимо удалить; Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие; Дата изготовления – см. в номере партии на упаковке (гггг.мм.дд); Годен до см. рядом с номером партии (гггг.мм). Не использовать после окончания срока годности; Хранить в сухих помещениях.

При расхождении информации на стикере и на упаковке, верным считать стикер.

Рег. № ФСЗ 2007/00071 от _____.

Изготовитель: TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.

(АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРІАЛУВ ОПАТРУНКОВИХ С.А.») TZMO SA./ (АО «ТЗМО С.А.»), 87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego, 20/26, Polska. Продавец / Импортёр / Уполномоченный представитель изготовителя: ООО «БЕЛЛА Восток», 140300, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9.




PREMIUM QUALITY

seni

seni
Lady

URO
PROTECT

Breathable
Atmungsaktiv
Дышащие
Oddychające



MINI PLUS

pcs
Stk.
шт.
szt. 20



Bladder control pads / Inkontinenzeinlagen
Урологические прокладки / Anatomiczne
wkłady urologiczne



Прокладки урологические для женщин SENI LADY, размер: normal; 20 шт. Изделия предназначены для впитывания и удерживания мочи у женщин с лёгкой и средней формой недержания. Состав: Целлюлоза, суперабсорбент, нетканый материал, паропроницаемый ламинат, силиконизированная бумага, эластановая пряжа, краситель, клей. Способ применения: расправить прокладку; снять ленту, защищающую липкий слой прокладки, который расположен в её внешней части; наложить прокладку её клеевой внешней частью на трусы (в нижнюю часть трусов) таким образом, чтобы внутренняя часть прокладки, после надевания трусов, удобно прилегала к телу; надеть трусы с прокладкой; при загрязнении прокладку необходимо удалить; Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие; Дата изготовления – см. в номере партии на упаковке (гггг.мм.дд); Годен до см. рядом с номером партии (гггг.мм). Не использовать после окончания срока годности. Хранить в сухих помещениях.

При расхождении информации на стикере и на упаковке, верным считать стикер.


Рег. № ФСЗ 2007/00071 от _____.

Изготовитель: TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.

(АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРІАЛУВ ОПАТРУНКОВИХ С.А.») TZMO SA./ (АО «ТЗМО С.А.»), 87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego, 20/26, Polska. Продавец / Импортёр / Уполномоченный представитель изготовителя: ООО «БЕЛЛА Восток», 140300, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9.





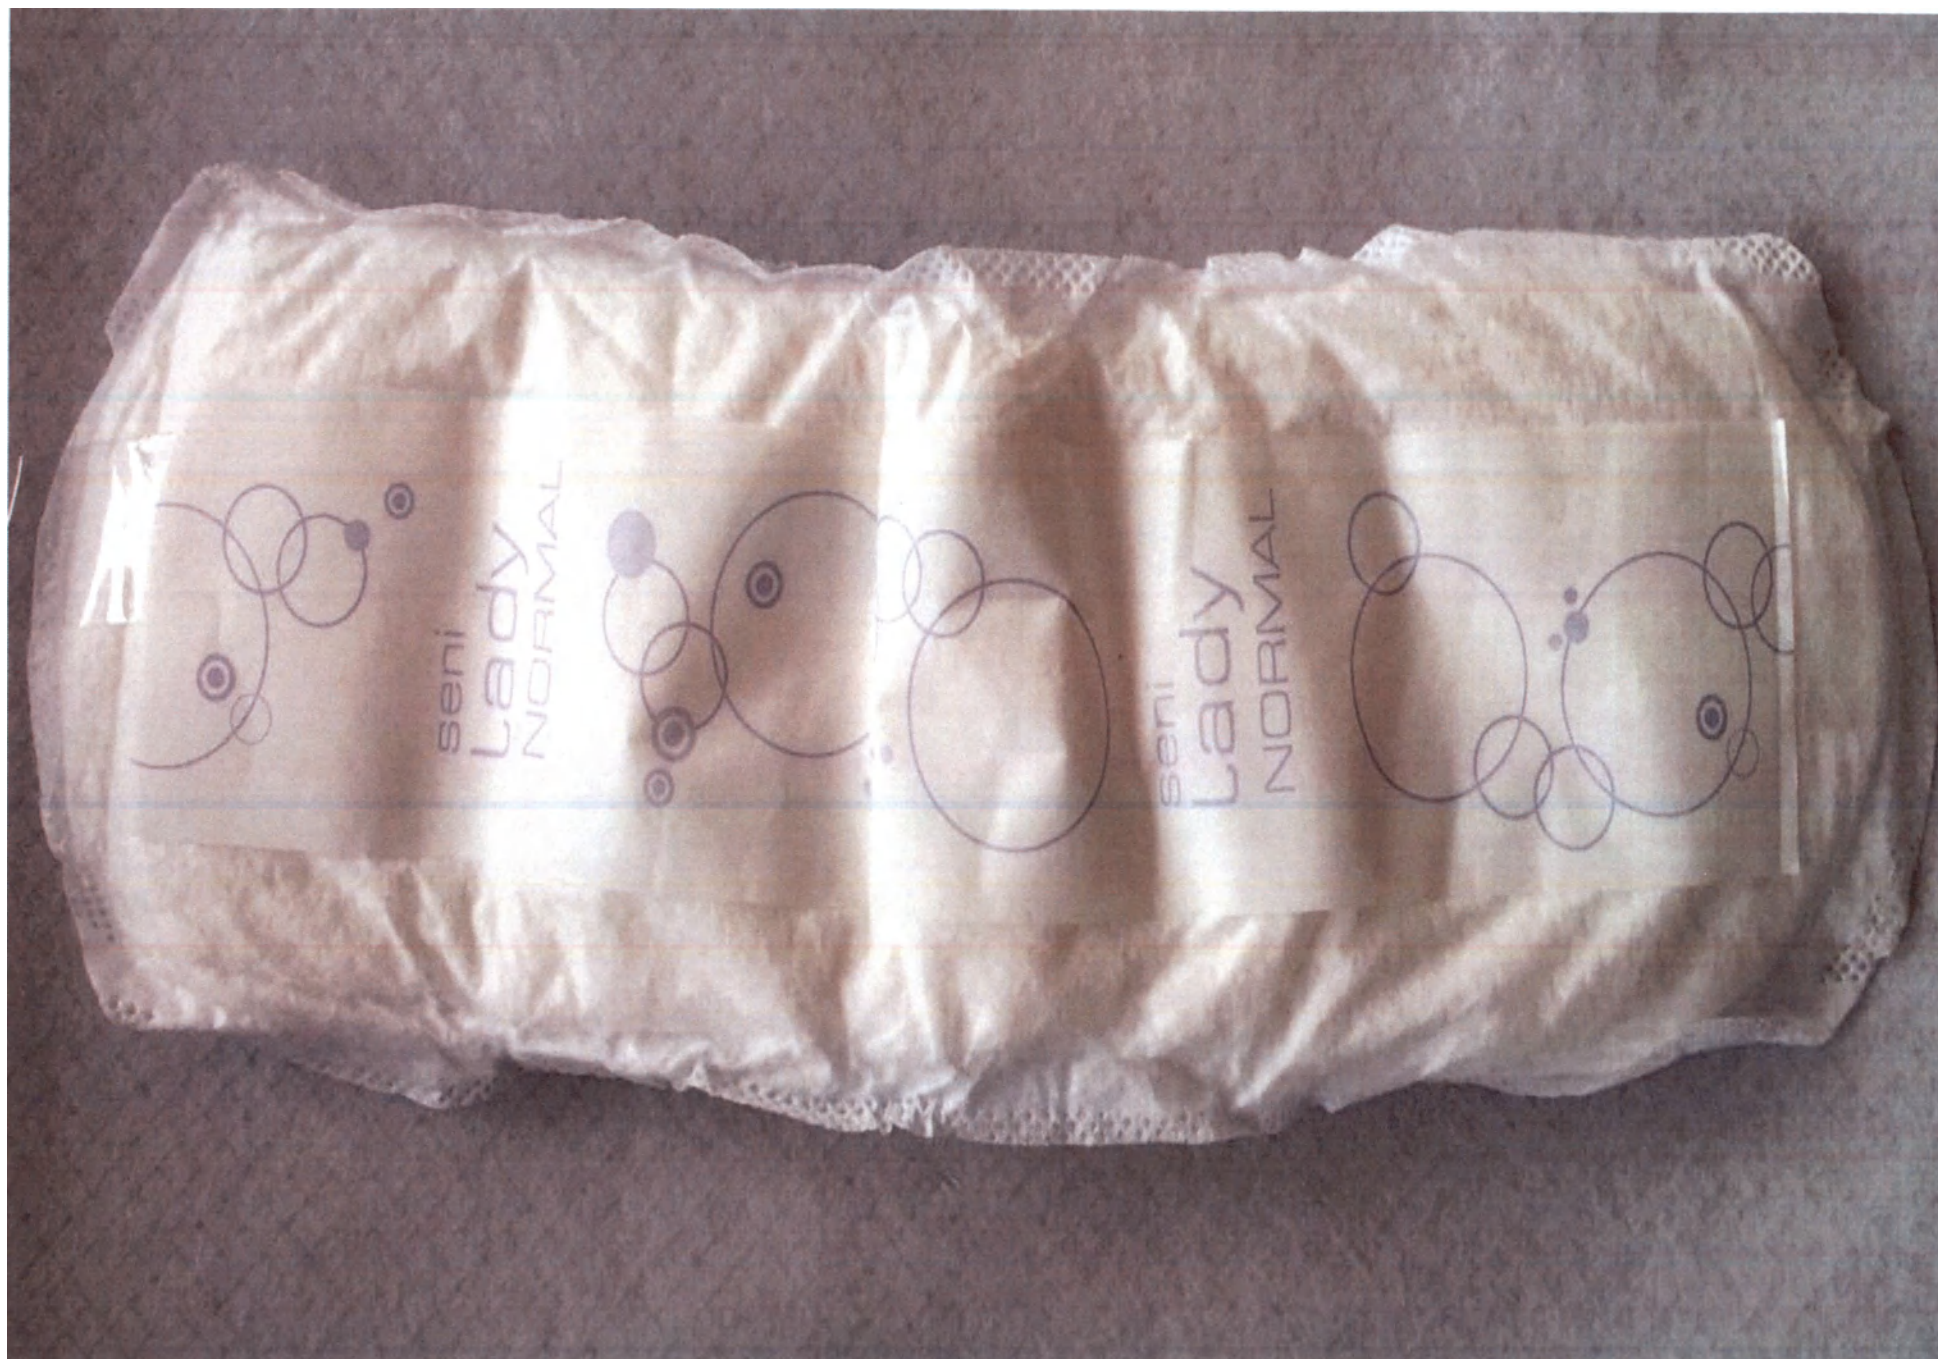

Прокладки урологические для женщин SENI LADY, размер: extra; 15 шт. Изделия предназначены для впитывания и удерживания мочи у женщин с лёгкой и средней формой недержания. Состав: Целлюлоза, суперабсорбент, нетканый материал, паропроницаемый ламинат, силиконизированная бумага, эластановая пряжа, эластичная резинка, краситель, клей. Способ применения: расправить прокладку; снять ленту, защищающую липкий слой прокладки, который расположен в её внешней части; наложить прокладку её клеевой внешней частью на трусы (в нижнюю часть трусов) таким образом, чтобы внутренняя часть прокладки, после надевания трусов, удобно прилегала к телу; надеть трусы с прокладкой; при загрязнении прокладку необходимо удалить; Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие; Дата изготовления – см. в номере партии на упаковке (гггг.мм.дд); Годен до см. рядом с номером партии (гггг.мм). Не использовать после окончания срока годности; Хранить в сухих помещениях.

При расхождении информации на стикере и на упаковке, верным считать стикер.

Рег. № ФСЗ 2007/00071 от _____.

Изготовитель: TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.


(АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРІАЛУВ ОПАТРУНКОВИХ С.А.») TZMO SA./ (АО «ТЗМО С.А.»), 87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego, 20/26, Polska. Продавец / Импортёр / Уполномоченный представитель изготовителя: ООО «БЕЛЛА Восток», 140300, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9.



Прокладки урологические для женщин SENI LADY, размеры: Extra



Прокладки урологические для женщин SENI LADY, размеры: Extra

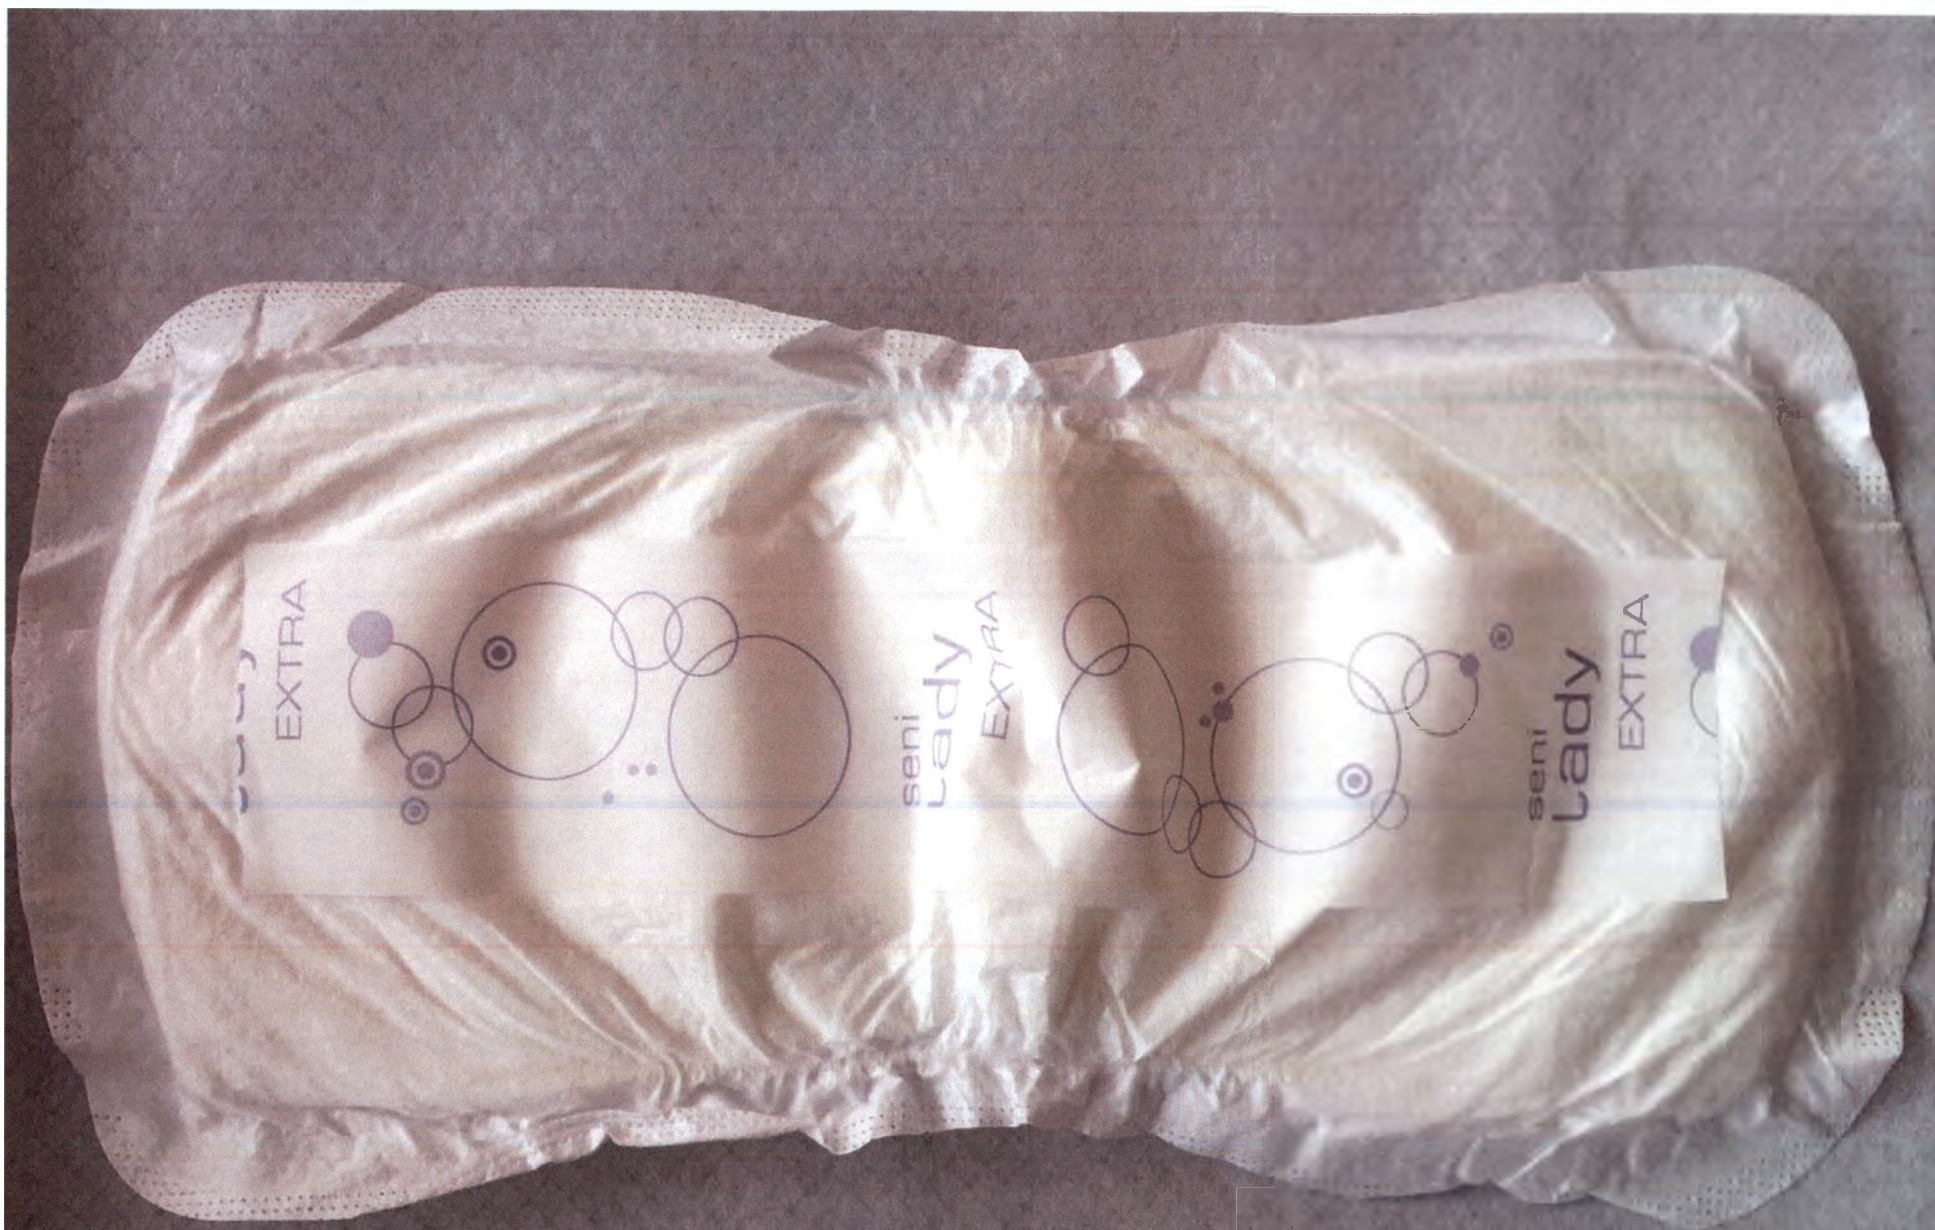

Прокладки урологические для женщин SENI LADY, размер: super; 15 шт. Изделия предназначены для впитывания и удерживания мочи у женщин с лёгкой и средней формой недержания. Состав: Целлюлоза, суперабсорбент, нетканый материал, паропроницаемый ламинат, силиконизированная бумага, эластановая пряжа, эластичная резинка, краситель, клей. Способ применения: расправить прокладку; снять ленту, защищающую липкий слой прокладки, который расположен в её внешней части; наложить прокладку её клеевой внешней частью на трусы (в нижнюю часть трусов) таким образом, чтобы внутренняя часть прокладки, после надевания трусов, удобно прилегала к телу; надеть трусы с прокладкой; при загрязнении прокладку необходимо удалить; Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие; Дата изготовления – см. в номере партии на упаковке (гггг.мм.дд); Годен до см. рядом с номером партии (гггг.мм). Не использовать после окончания срока годности; Хранить в сухих помещениях.

При расхождении информации на стикере и на упаковке, верным считать стикер.

Reg. № ФСЗ 2007/00071 от _____.

Изготовитель: TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.


(АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРІАЛУВ ОПАТРУНКОВИХ С.А.») TZMO SA./ (АО «ТЗМО С.А.»), 87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego, 20/26, Polska. Продавец / Импортёр / Уполномоченный представитель изготовителя: ООО «БЕЛЛА Восток», 140300, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9.



Прокладки урологические для женщин SENI LADY, размеры: Super



Прокладки урологические для женщин SENI LADY, размеры: Super

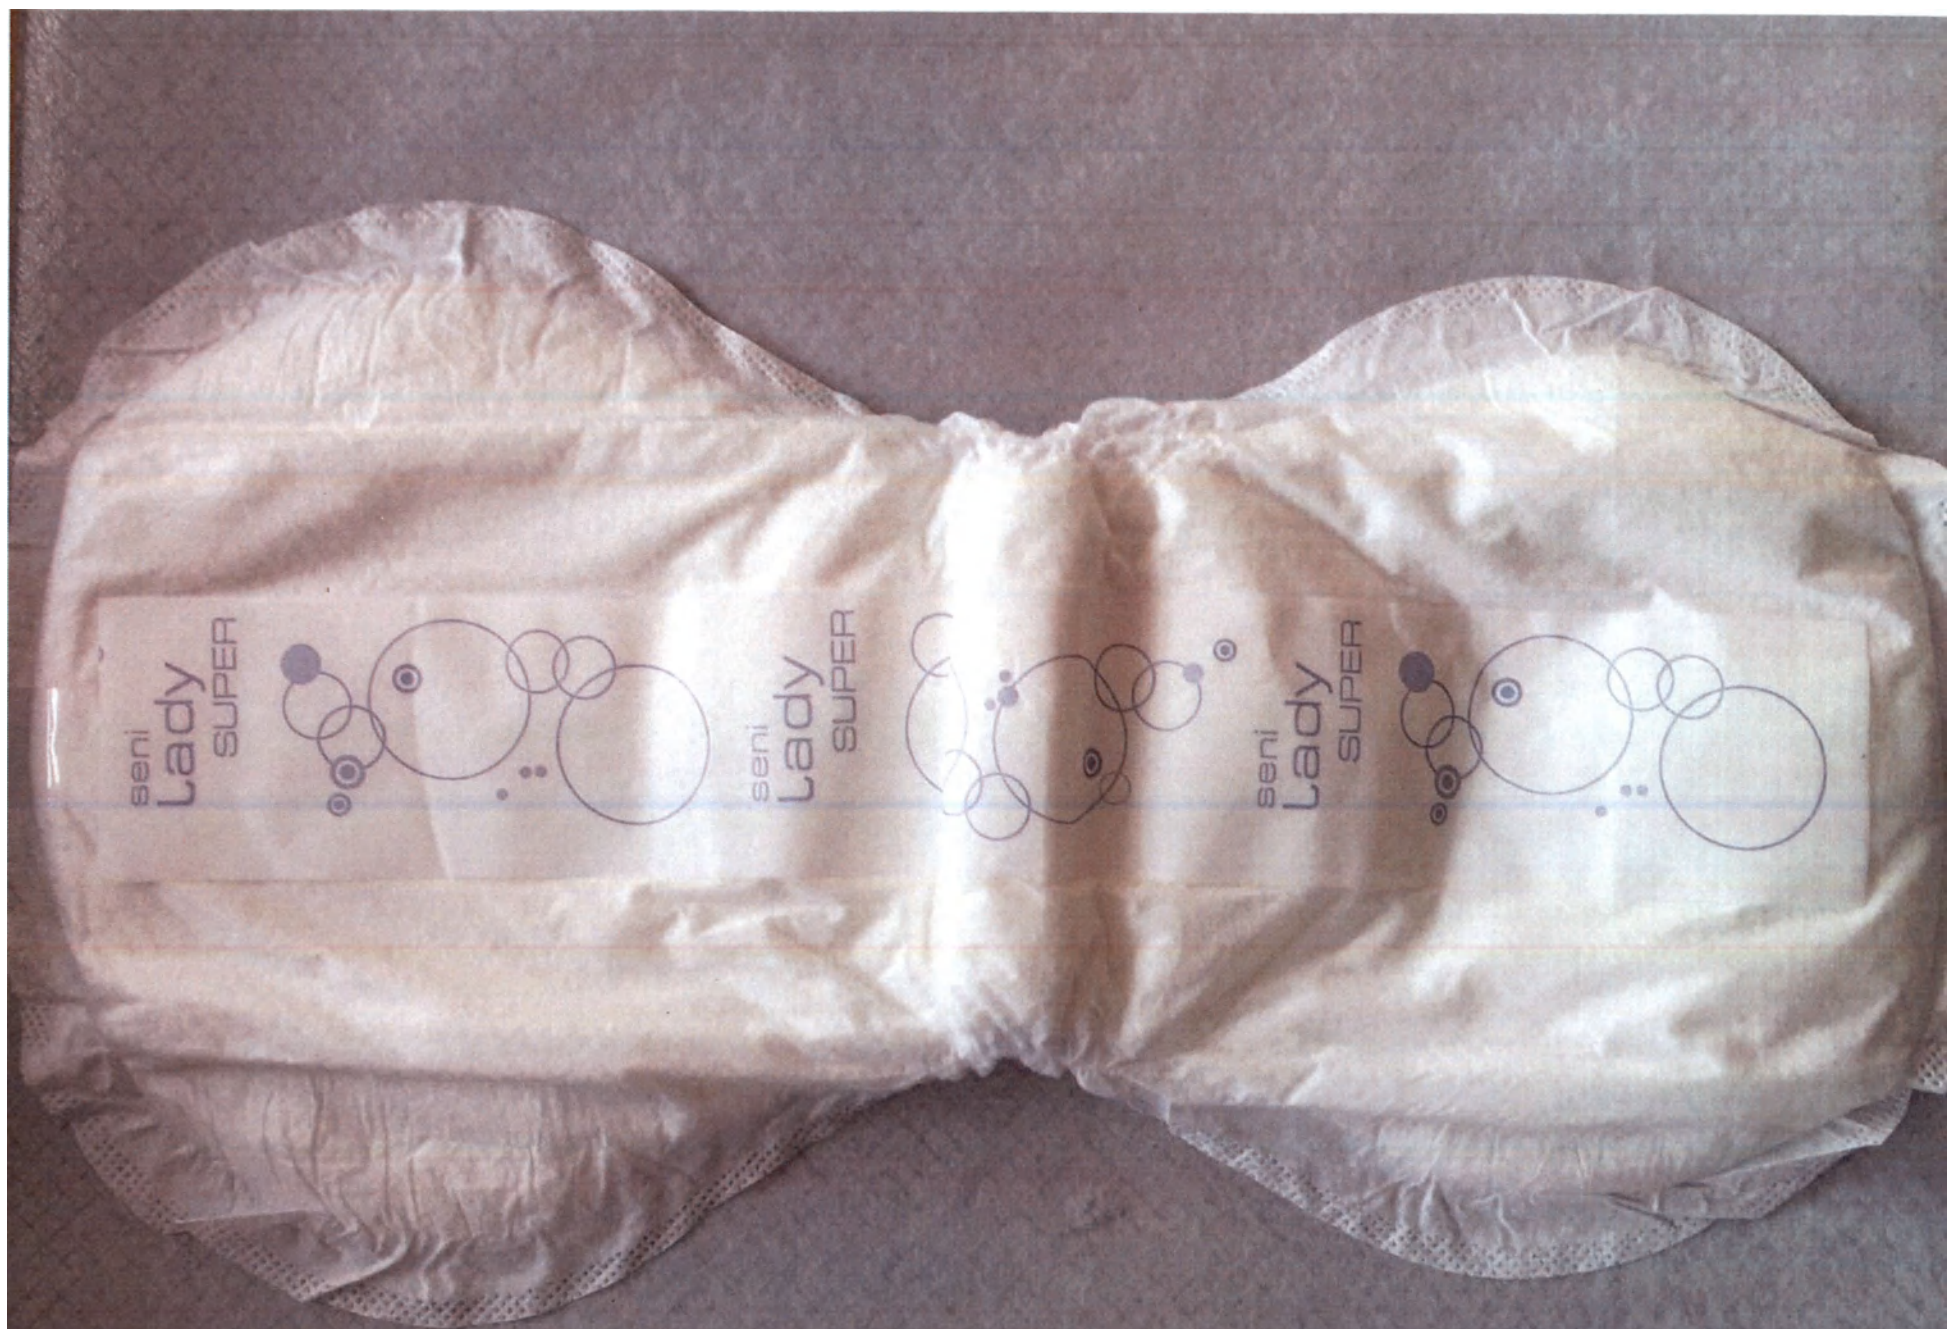

Прокладки урологические для женщин SENI LADY, размер: plus; 15 шт. Изделия предназначены для впитывания и удерживания мочи у женщин с лёгкой и средней формой недержания. Состав: Целлюлоза, суперабсорбент, нетканый материал, паропроницаемый ламинат, силиконизированная бумага, эластановая пряжа, эластичная резинка, краситель, клей. Способ применения: расправить прокладку; снять ленту, защищающую липкий слой прокладки, который расположен в её внешней части; наложить прокладку её клеевой внешней частью на трусы (в нижнюю часть трусов) таким образом, чтобы внутренняя часть прокладки, после надевания трусов, удобно прилегала к телу; надеть трусы с прокладкой; при загрязнении прокладку необходимо удалить; Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие; Дата изготовления – см. в номере партии на упаковке (гггг.мм.дд); Годен до см. рядом с номером партии (гггг.мм). Не использовать после окончания срока годности; Хранить в сухих помещениях.

При расхождении информации на стикере и на упаковке, верным считать стикер.

Рег. № ФСЗ 2007/00071 от _____.


Изготовитель: TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.

(АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРІАЛУВ ОПАТРУНКОВИХ С.А.») TZMO SA./ (АО «ТЗМО С.А.»), 87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego, 20/26, Polska. Продавец / Импортёр / Уполномоченный представитель изготовителя: ООО «БЕЛЛА Восток», 140300, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9.



Прокладки урологические для женщин SENI LADY, размеры: Plus



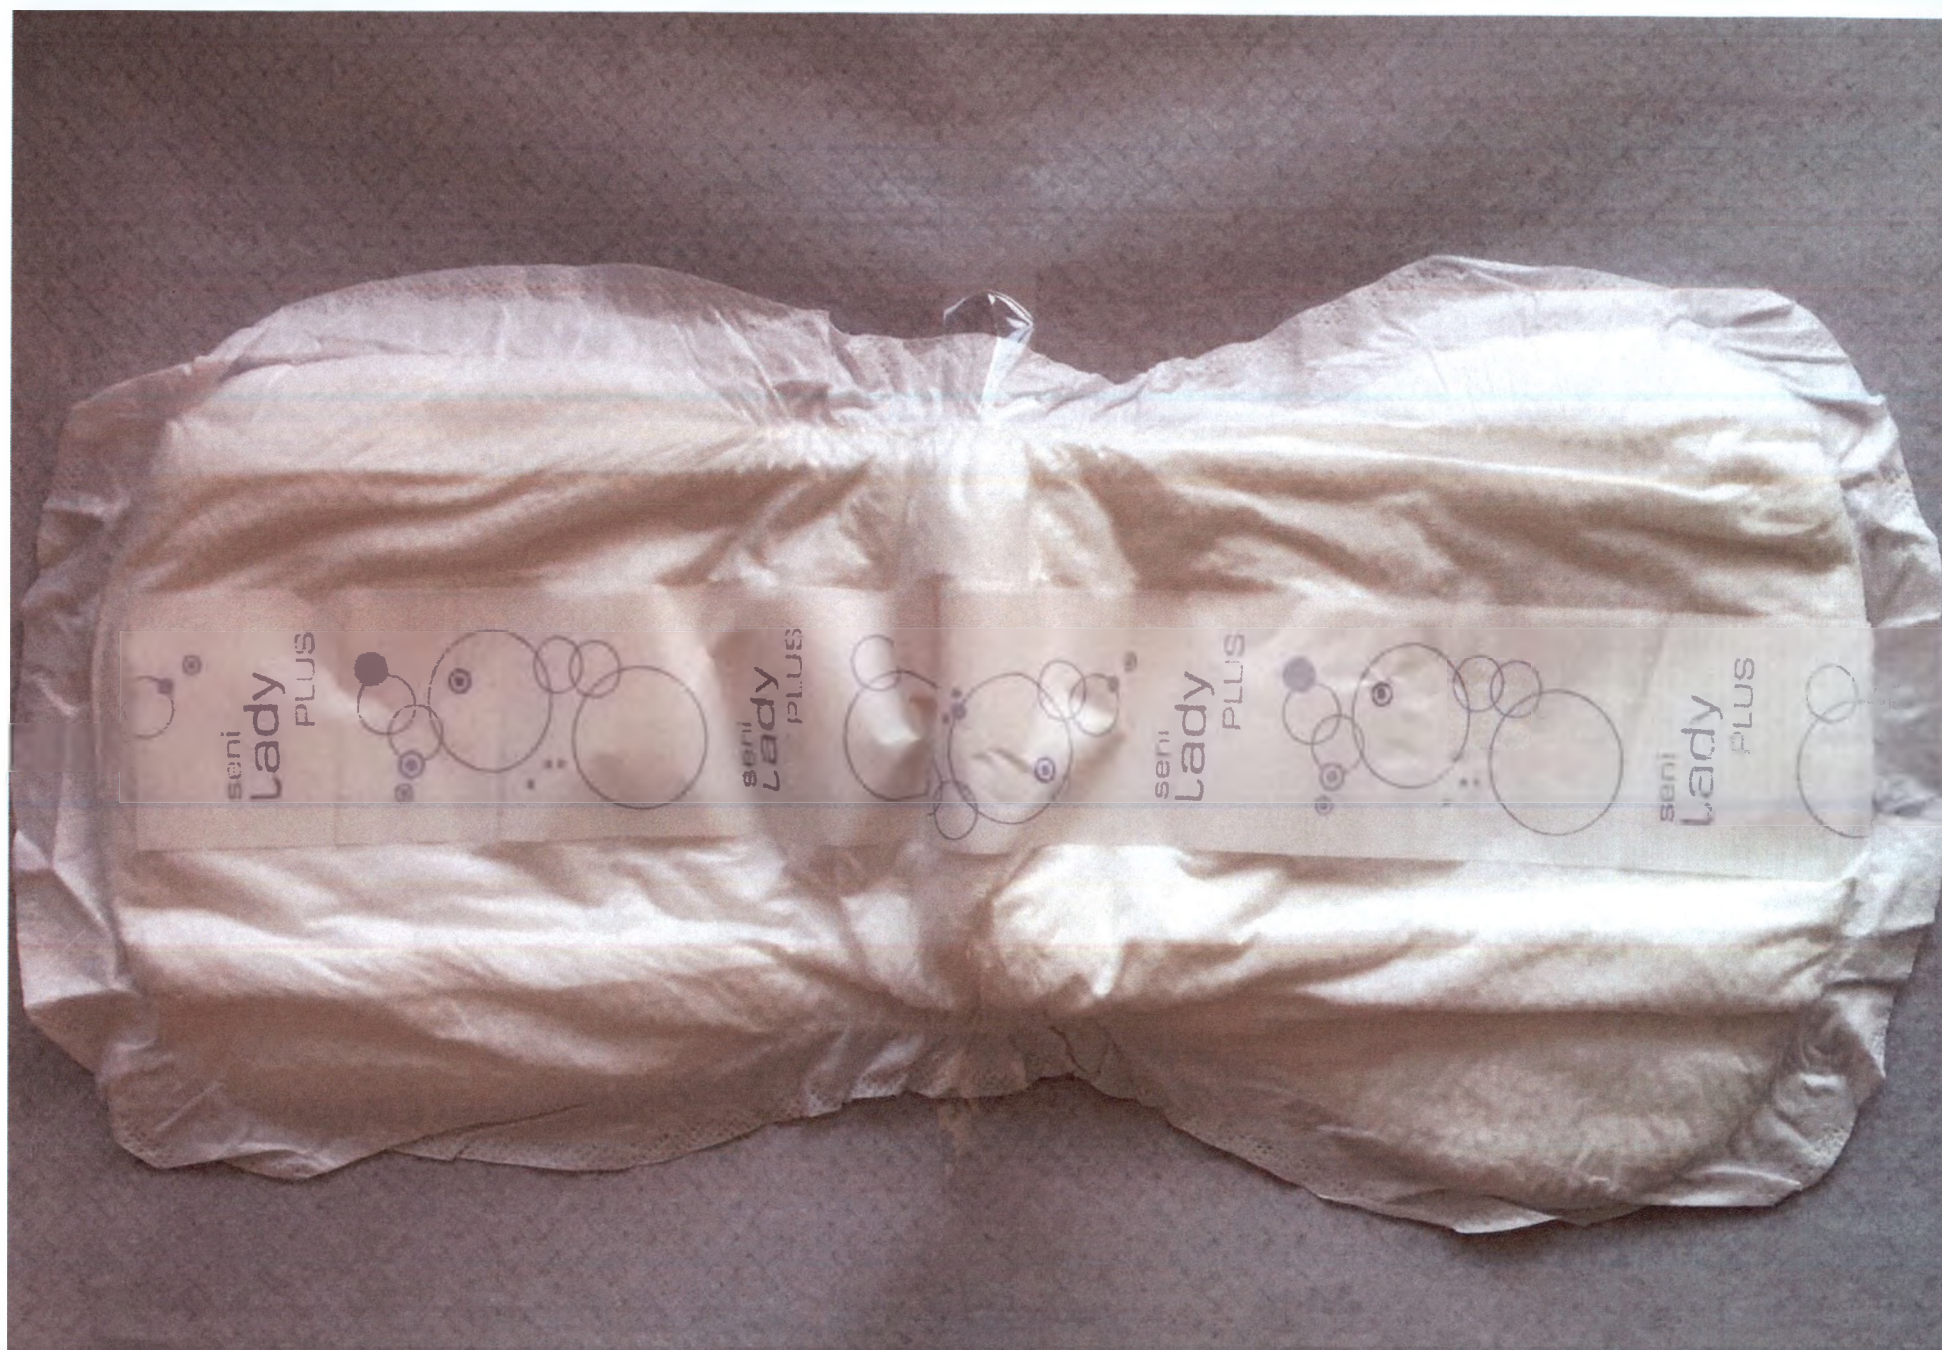

Прошито и пронумеровано
скреплено печатью 2 стр



С.И. Родченко