

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «АБВ-ТЕСТ»

А.А. Продеус

201 г.



**Фотографические изображения общего вида медицинского изделия для диагностики
in vitro**

**Набор реагентов для диагностики in vitro «БиТ-тест» для количественного определения
ДНК TREC и KREC методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени
по ТУ 21.20.23-001-17608775-2017**

Комплект 1

143026, Москва г, Сколково Инновационного Центра тер. Нобели ул., дом № 7, этаж 2 Часть Помещ. 51

ООО «АБВ-ТЕСТ»

ИНСТРУКЦИЯ

по применению

Набора реагентов для диагностики *in vitro*

«БиТ-тест»

для количественного определения ДНК TREC и KREC методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени по ТУ 21.20.23-001-17608775-2017

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов для диагностики *in vitro* «БиТ-тест» для количественного определения ДНК TREC и KREC методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени по ТУ 21.20.23-001-17608775-2017 (далее по тексту – набор реагентов), предназначен для количественного определения ДНК TREC¹ и KREC² в образцах нуклеиновых кислот, полученных из цельной крови или сухих пятен крови человека методом полимеразной цепной реакции с гибридно-флуоресцентной детекцией продуктов реакции в режиме реального времени (далее по тексту – РВ).

агент используется для количественного определения ДНК TREC и KREC в образцах нуклеиновых кислот, полученных из цельной крови или сухих пятен крови человека методом полимеразной цепной реакции с гибридно-флуоресцентной детекцией продуктов реакции в режиме реального времени (далее по тексту – РВ).

стат. 3 к. всех реагентов набора реагентов «БиТ-тест» и по инструкции.

цион. изы. прих. – к. ая л. орная стика.

С

5xПЦР-бу ПЦР-смесь K1 K2 K3 K4 K-

LOT 17001 LOT 17001 LOT 17001 LOT 17001 LOT 17001

19.2017 08.2017 07.2017 09.2017 09.2017 09.2017

АБВ
ТЕСТ

Россия, 143026, Москва г, Сколково Инновационного Центра тер. Нобели ул., дом № 7, этаж 2 Часть Помещ. 51

E-mail: info@abv-test.ru
Телефон: 8 495 970 77 69

Набор реагентов для диагностики *in vitro*

«БиТ-тест»

для количественного определения ДНК TREC и KREC
методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени
по ТУ 21.20.23-001-17608775-2017
Комплект 1

Состав набора реагентов:

БПЦР-буфер – буфер для полимеразной цепной реакции	1 x 0,3 мл
ПЦР-смесь – смесь для полимеразной цепной реакции	1 x 0,5 мл
Taq-полимераза – Taq-полимераза	1 x 0,06 мл
K1 – калибратор 1	1 x 0,16 мл
K2 – калибратор 2	1 x 0,16 мл
K3 – калибратор 3	1 x 0,16 мл
K4 – калибратор 4	1 x 0,16 мл
K+ – отрицательный контроль	1 x 0,16 мл
Инструкция по применению	1 шт.


Для клинической лабораторной диагностики

REF	БиТ-1
LOT	XXXXX
MFG	XX.XXXX
EXP	XX.XXXX

РУ XXXX-XXXX-XXXX



Комплект 2

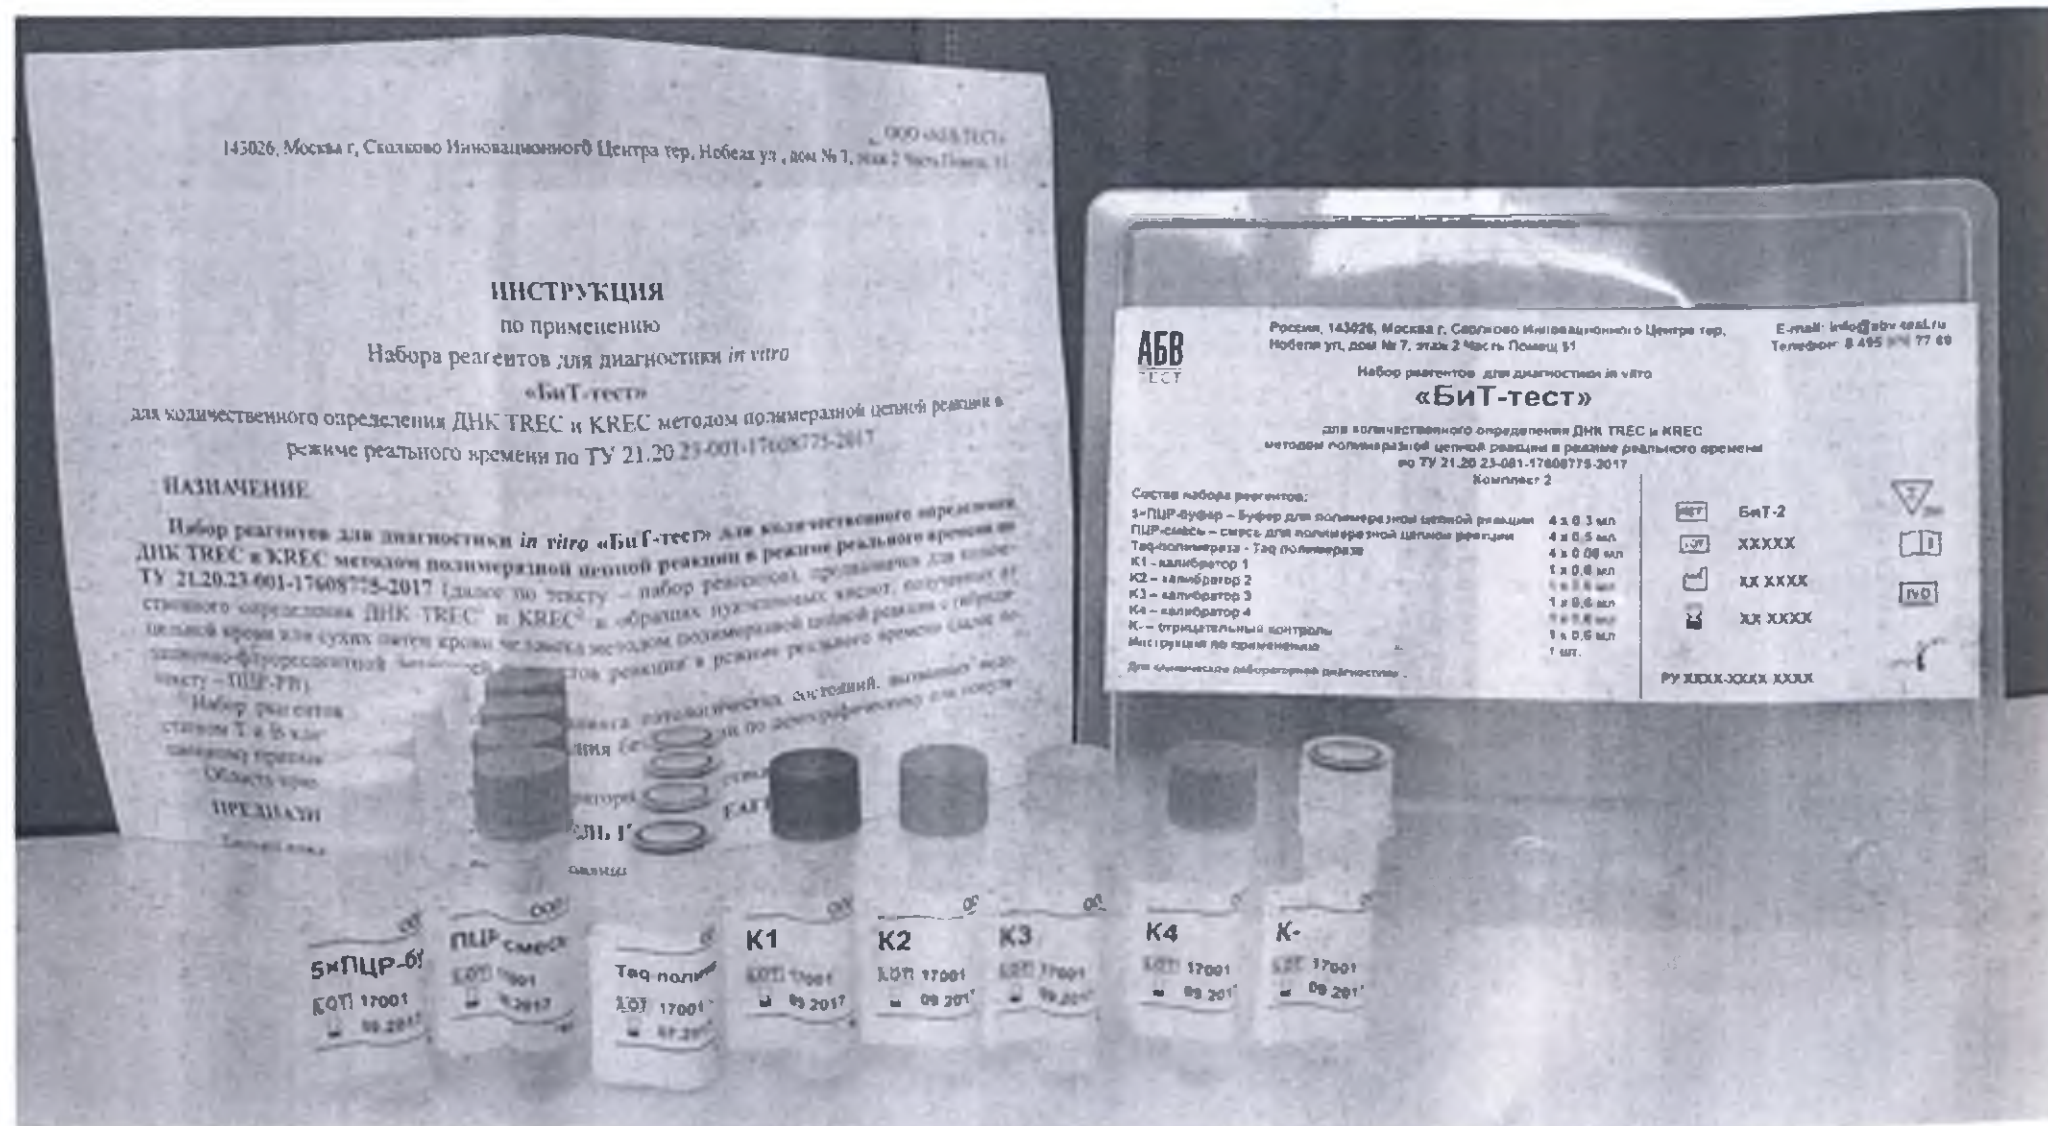



Прошито пронумеровано скреплено
печатью на (3) листах
Директор ООО «АБВ-ТЕСТ»
А.А.Продаус