


i_Open 0.4T

i_Open 0.4T

C-Shape Super Open Permanent MRI System

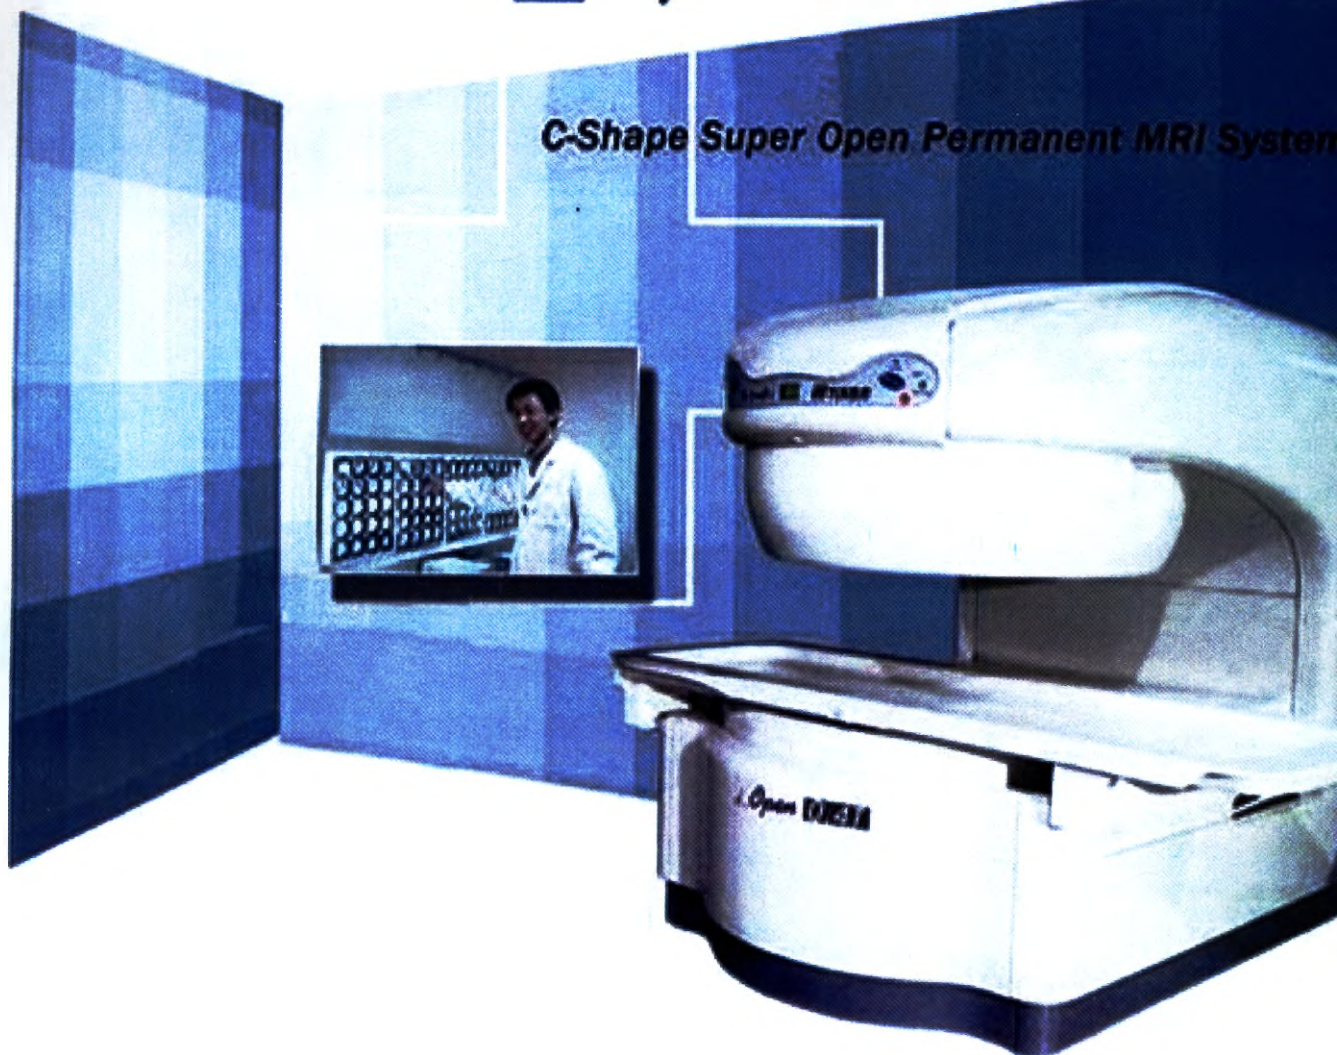

i_Open 0.5T

329



(базовый состав):

1. Гантри:

- Постоянный магнит открытого типа.



431
лишка гантри передняя декоративная с пультом управления перемещениями стола, в сборе.



332
2011

- Крышка гантри задняя декоративная в сборе.




333


шпака гантри правая боковая, не более 2 шт.



- Крышка гантри левая боковая, не более 2 шт.

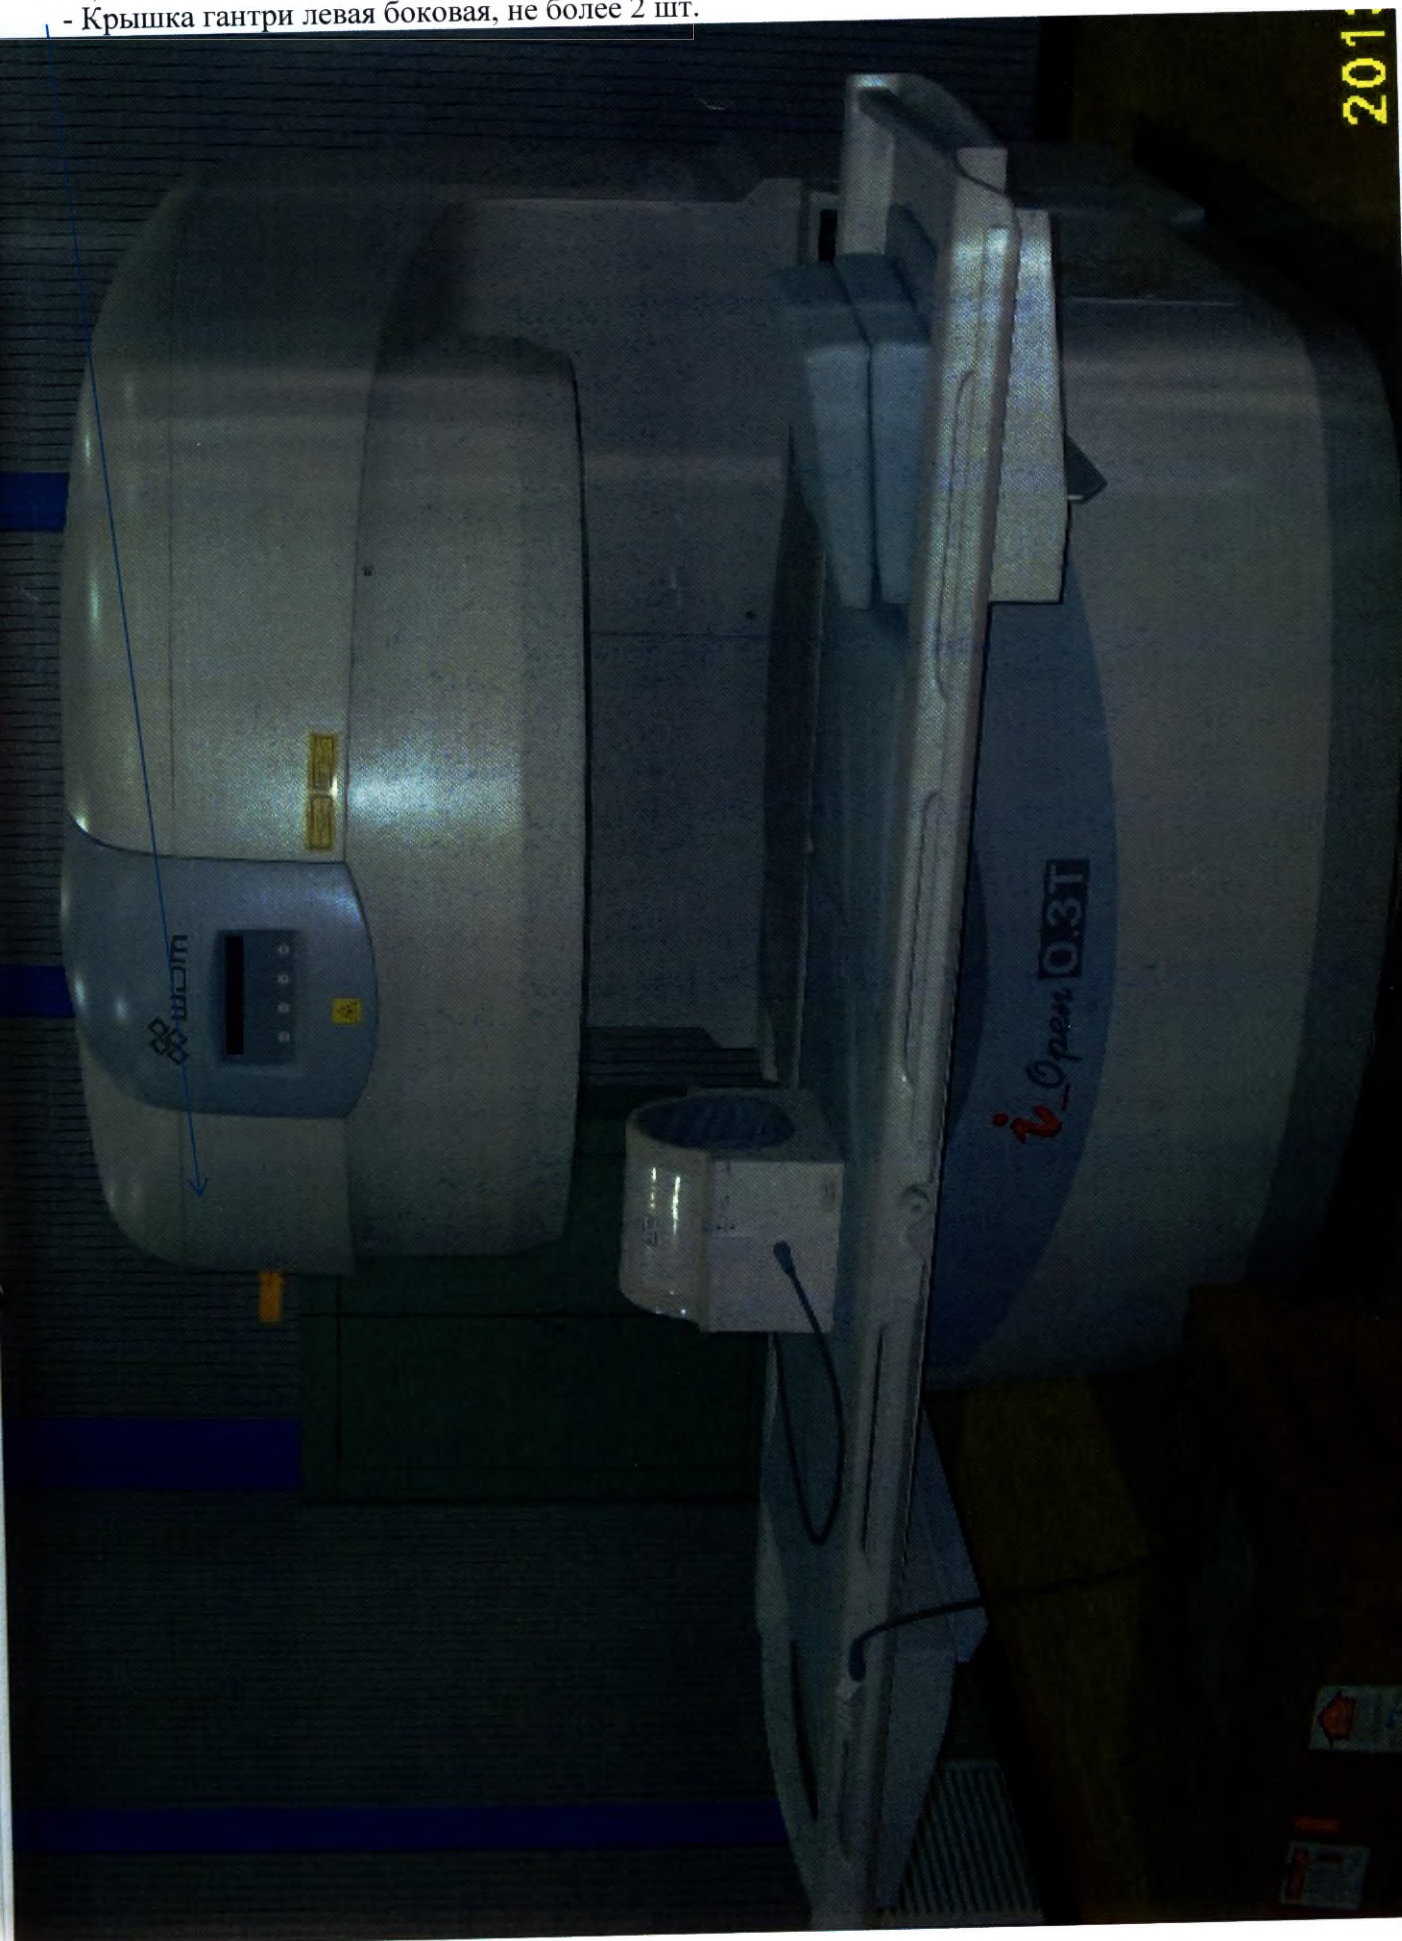


- 335
- Комплект системы крепления навесных элементов гантри:
 - Держатель кабелей градиентных катушек.
 - Опоры деки стола, не более 2 шт.
 - Направляющая деки стола, не более 2 шт.

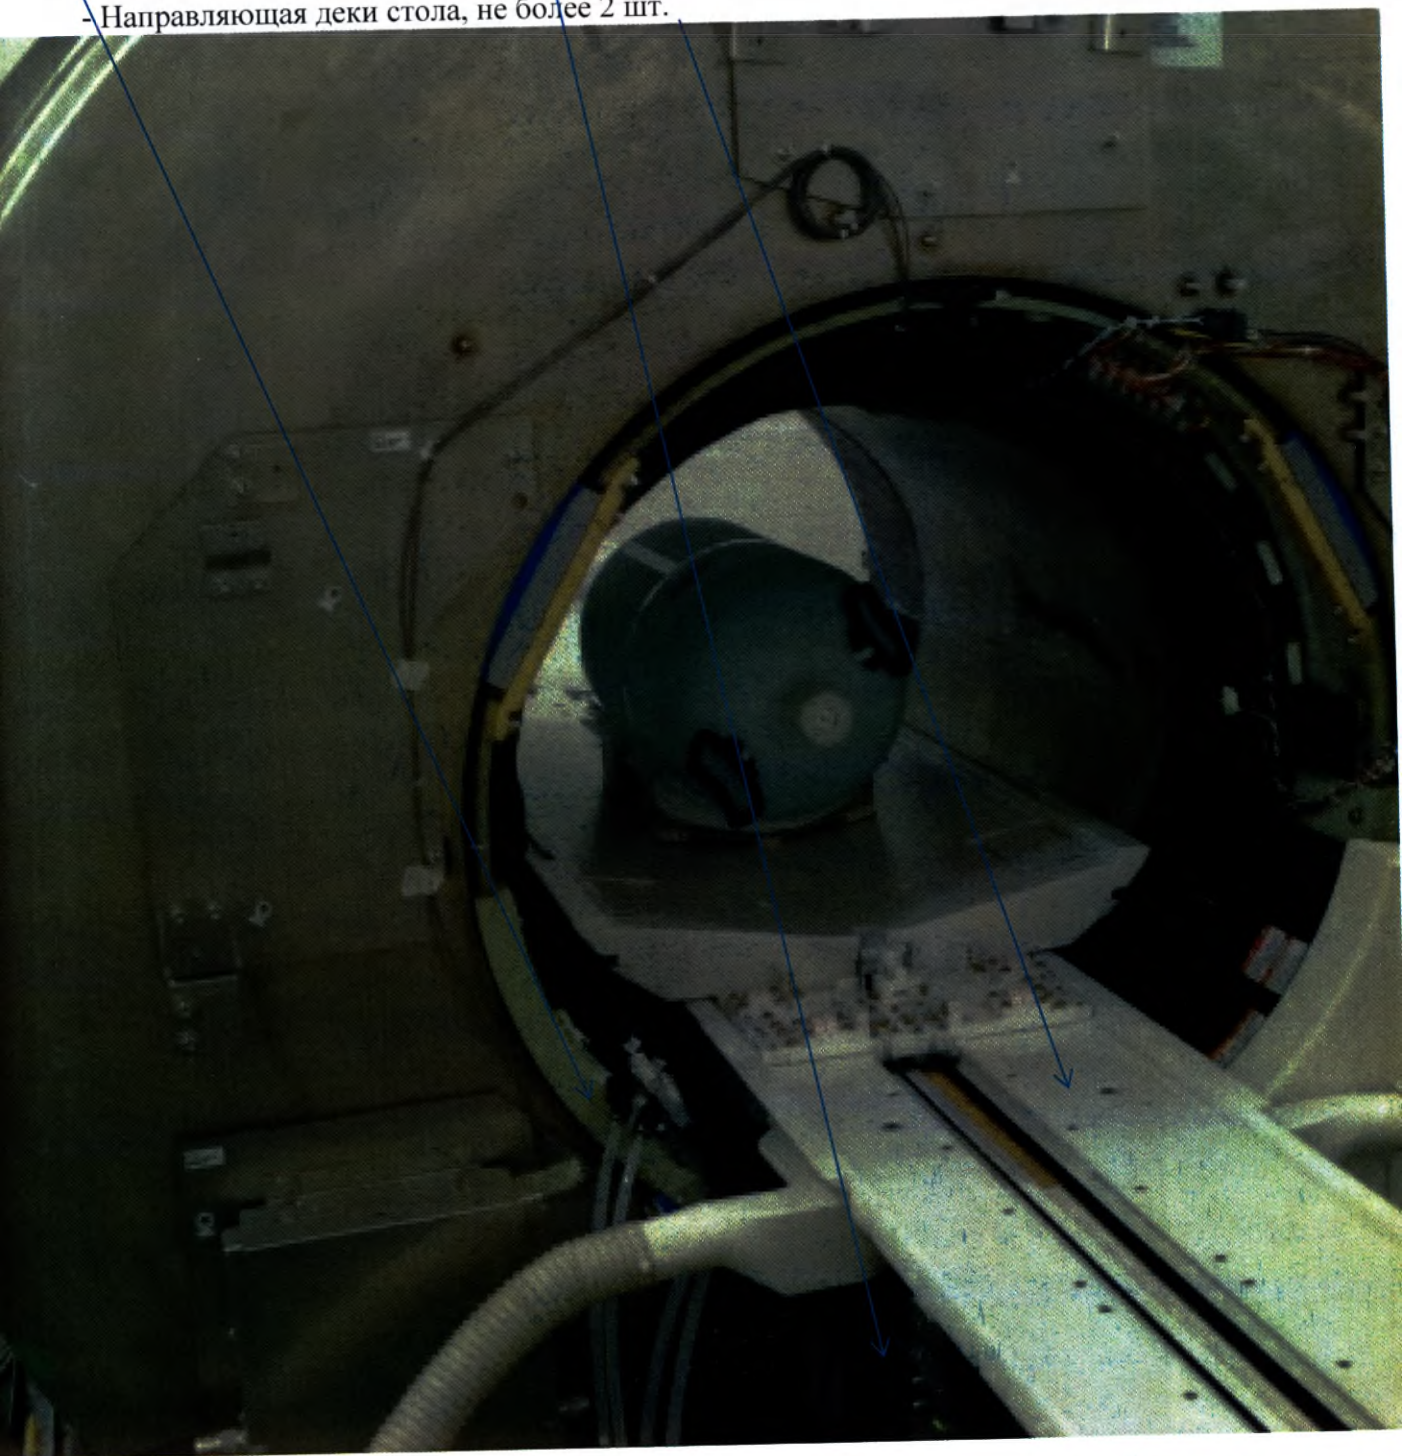

336

- Вентиляторы системы обдува пациента, не более 2 шт.

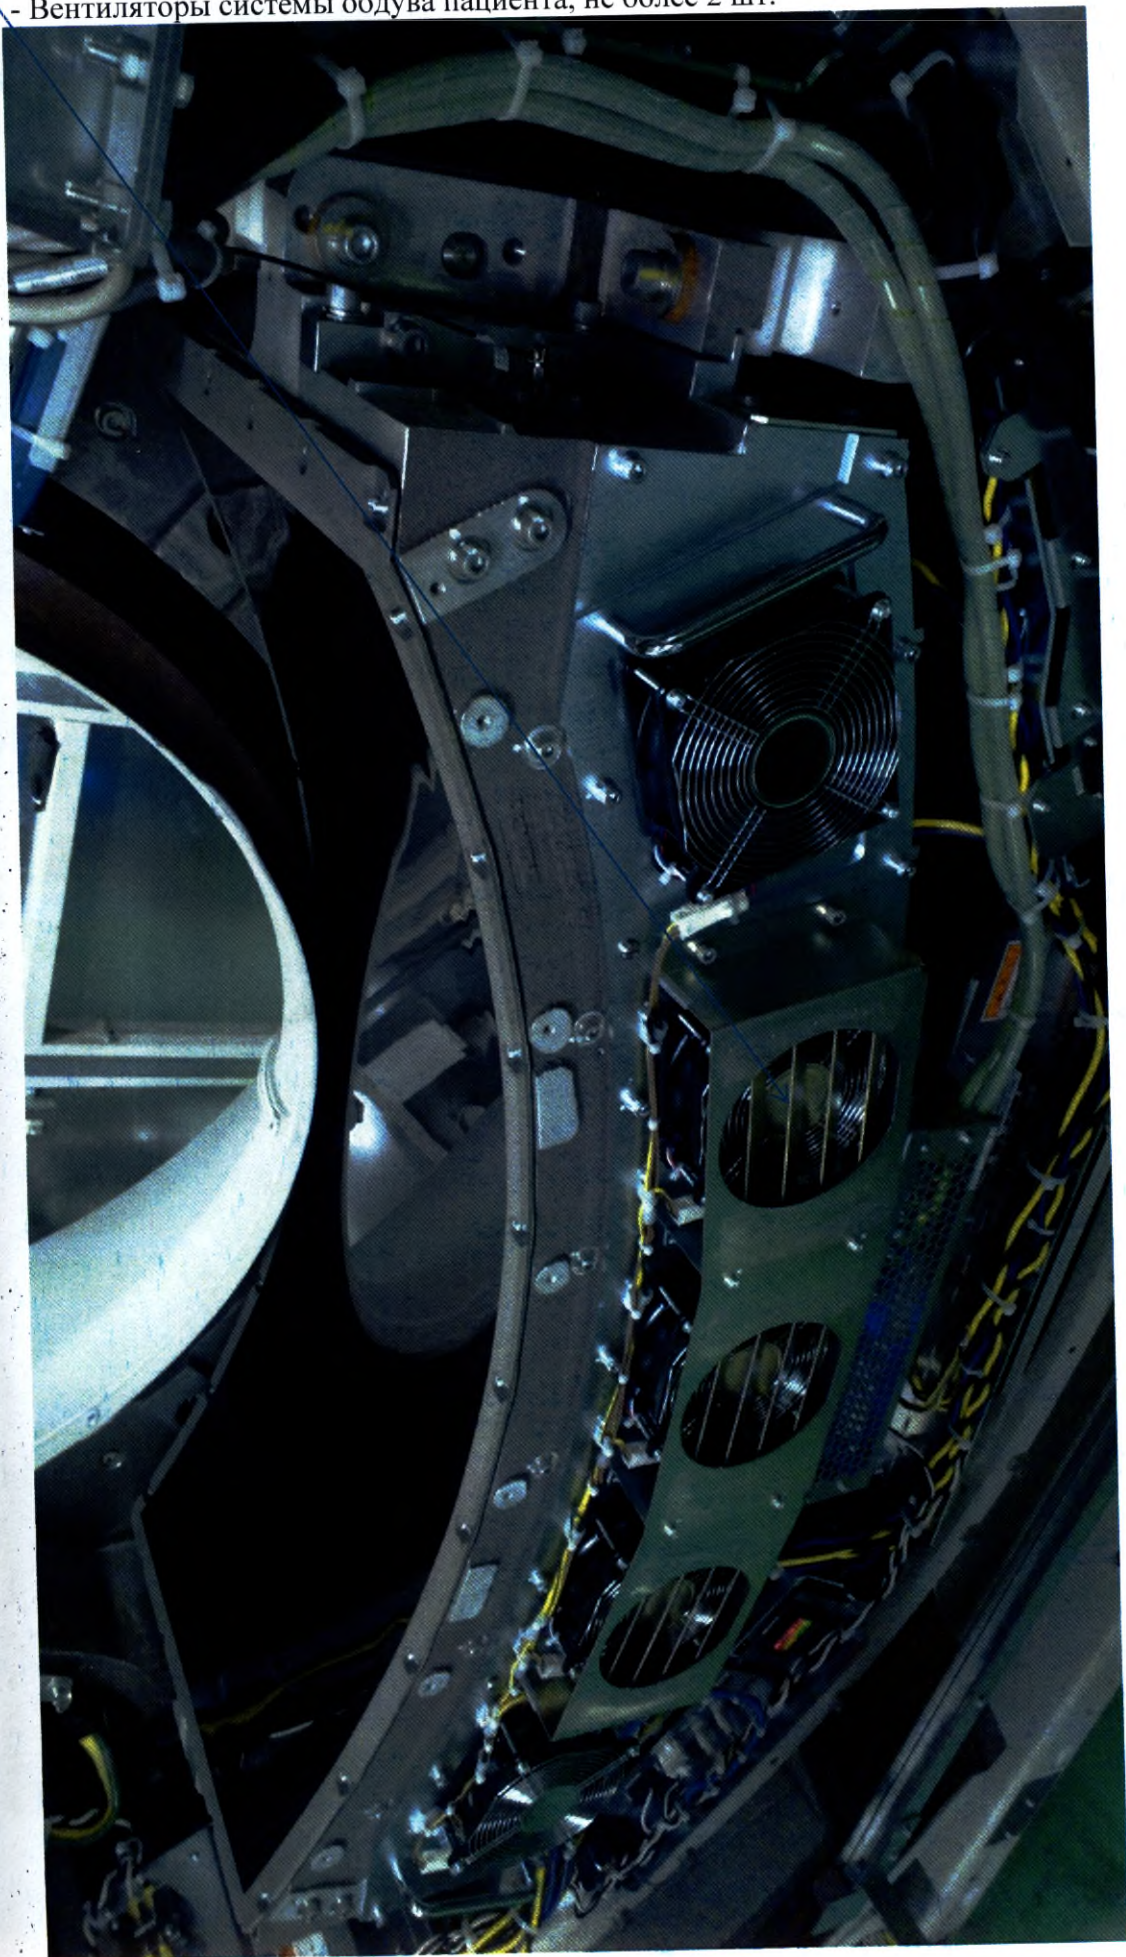


337




- Блок рассеяния излишков отраженного радиочастотного сигнала (Dummy Load).

338

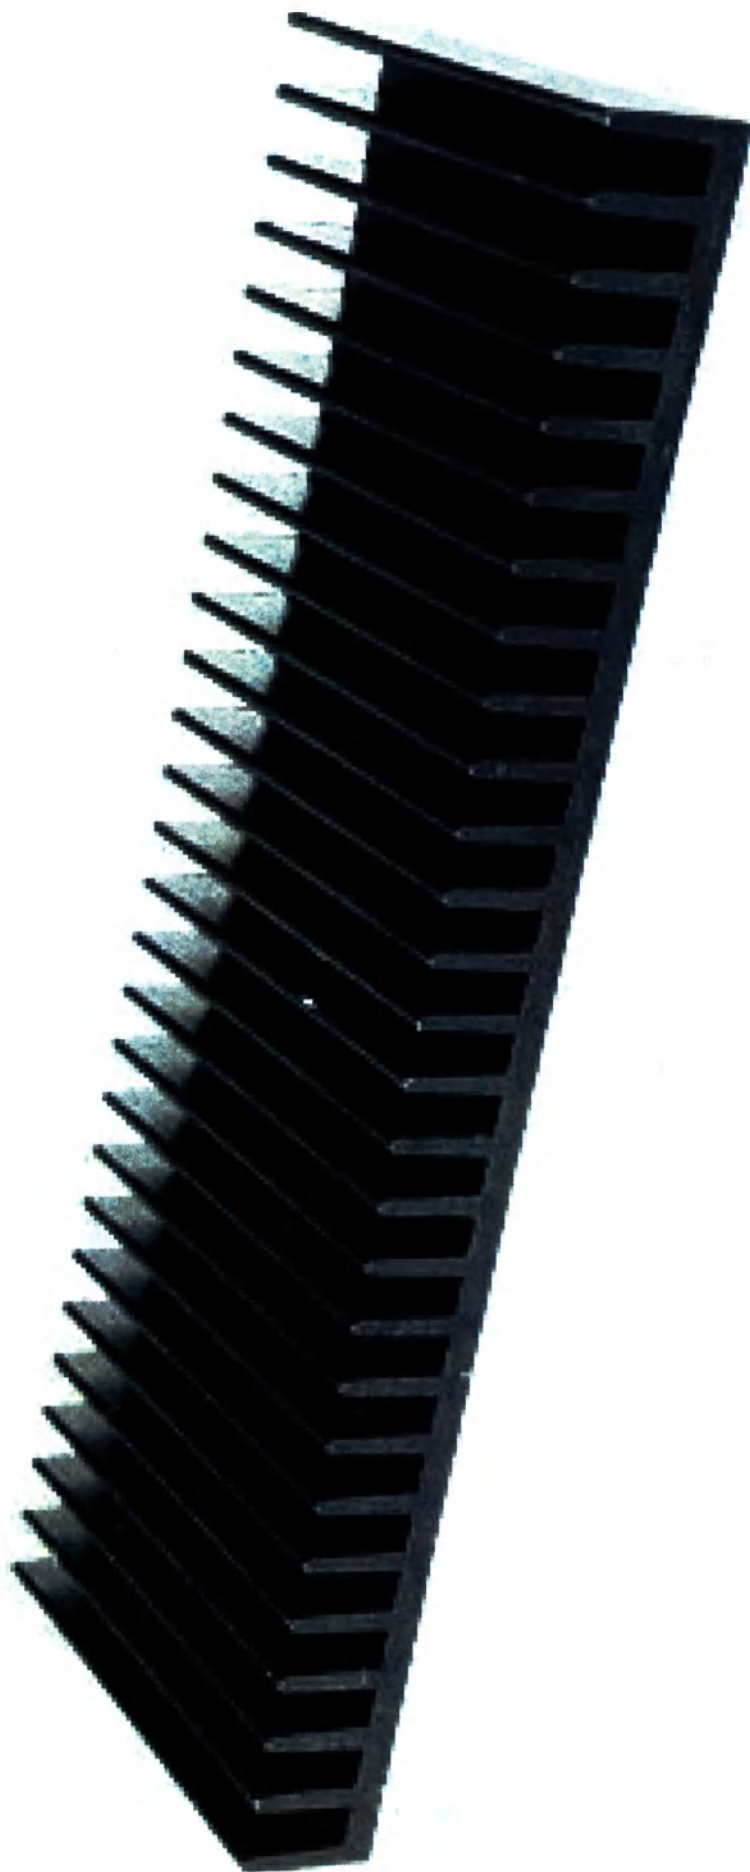

- Блок переключателя режимов приём/передача (T/R Switch).

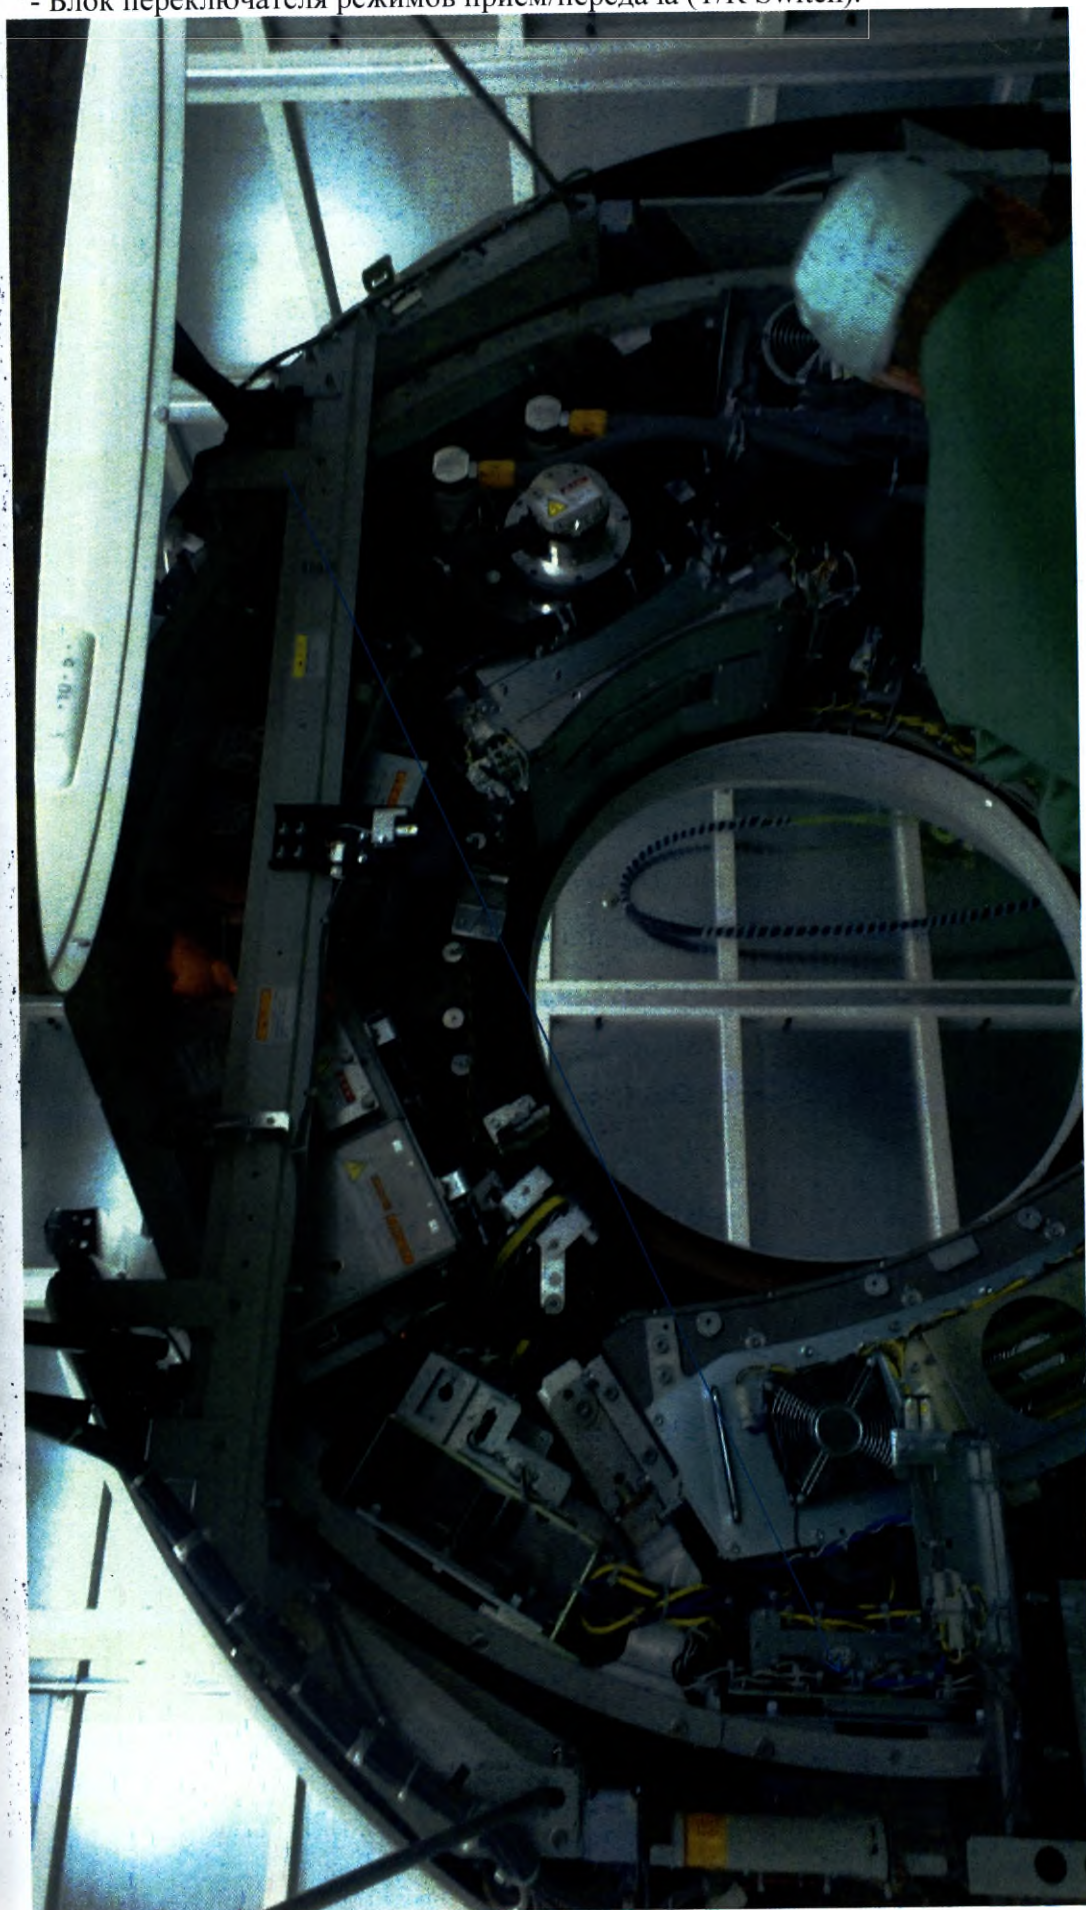


340

2. Устройство водяного/ воздушного охлаждения градиентных катушек и градиентных усилителей.



3. Градиентные катушки, встроенные для осей (X, Y, Z) – не более 2 штук.

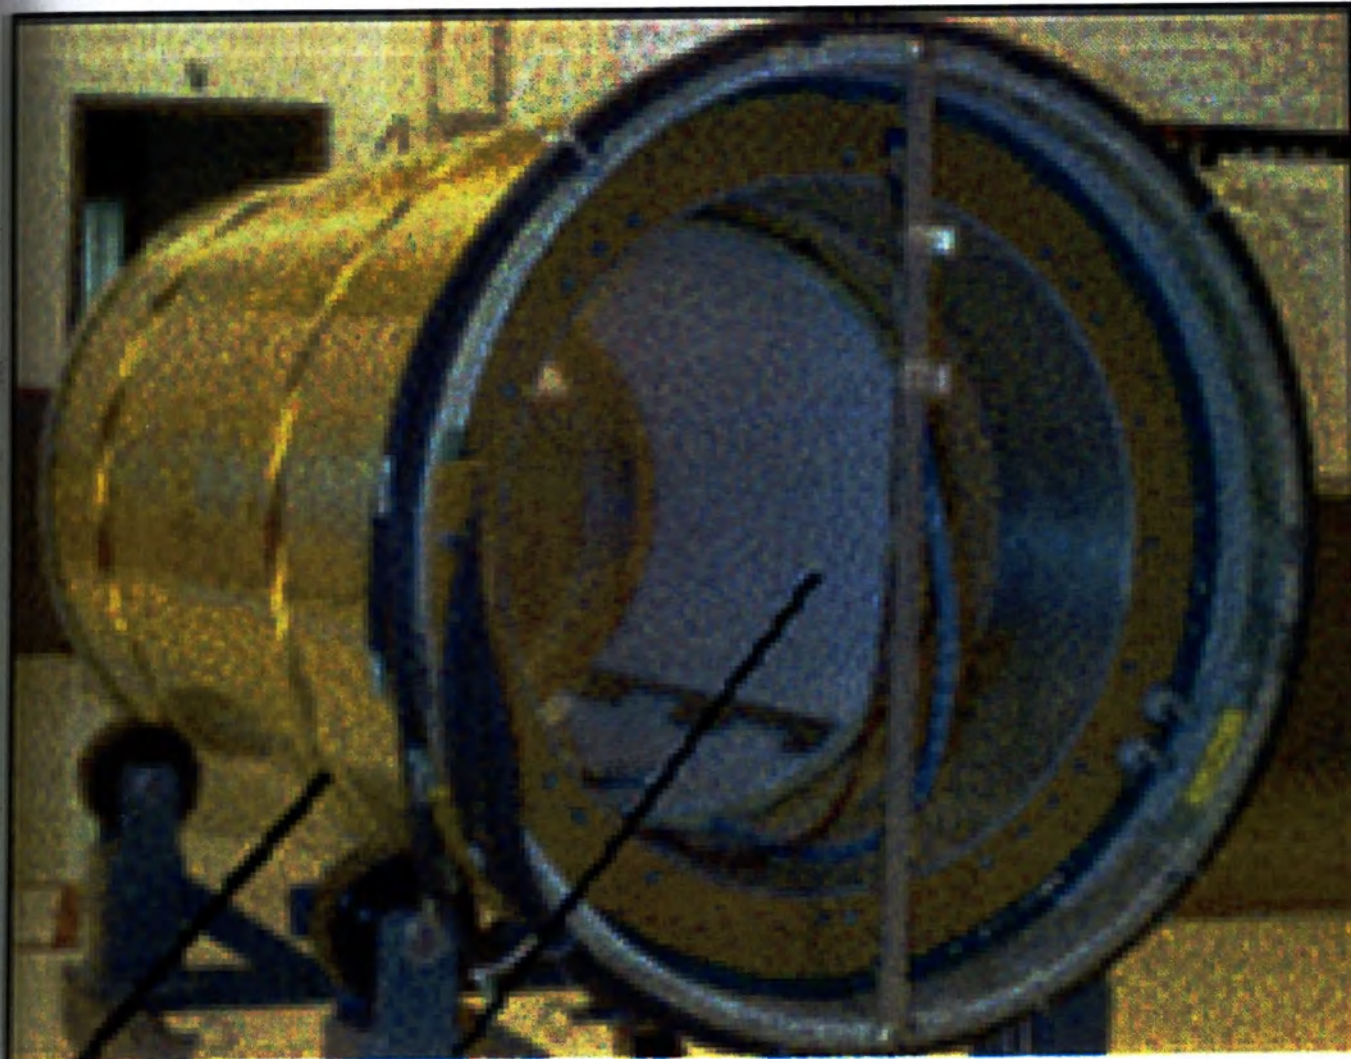


4. Система градиентных усилителей:

- Усилители градиентные для осей X, Y, Z – не более 3 штук.
- Модуль силовой для градиентного усилителя.



343

5. Катушка передающая квадратурная плоская.

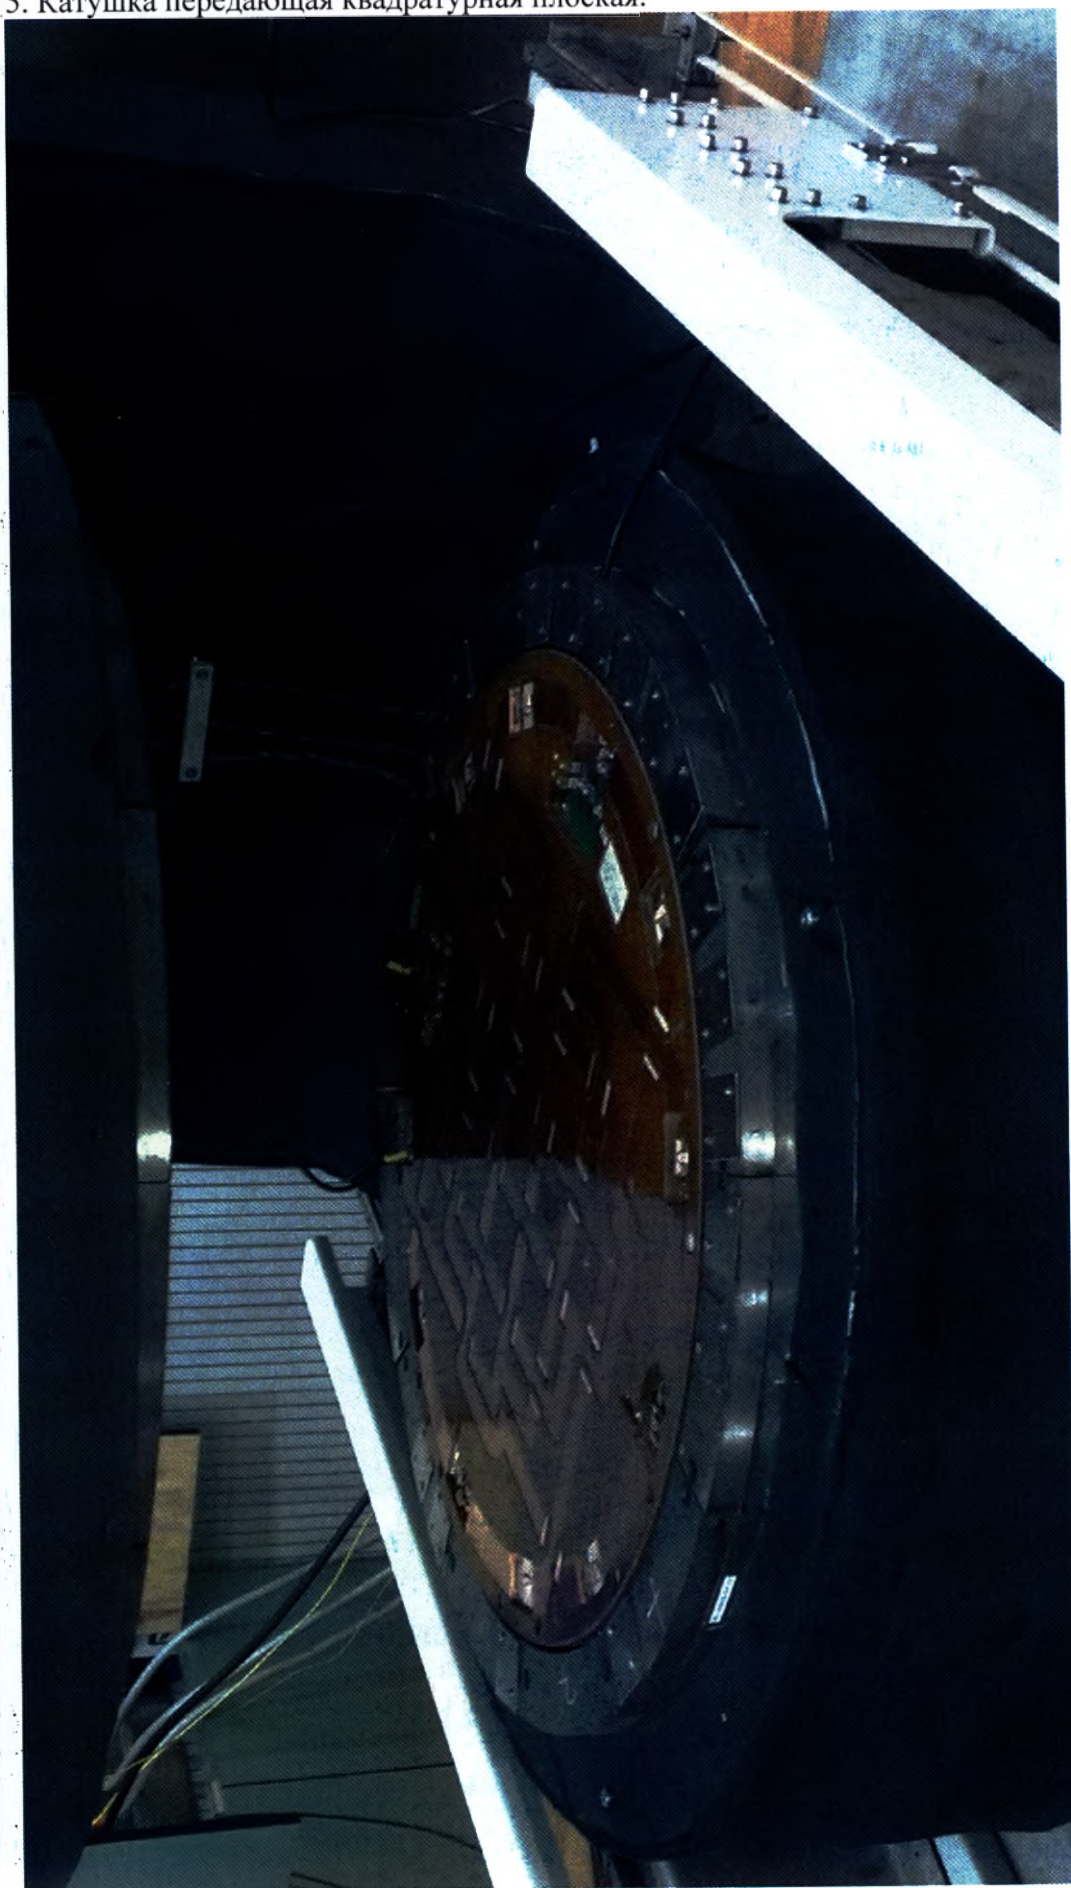


344

6. Усилитель радиочастотный.



344

6. Усилитель радиочастотный.

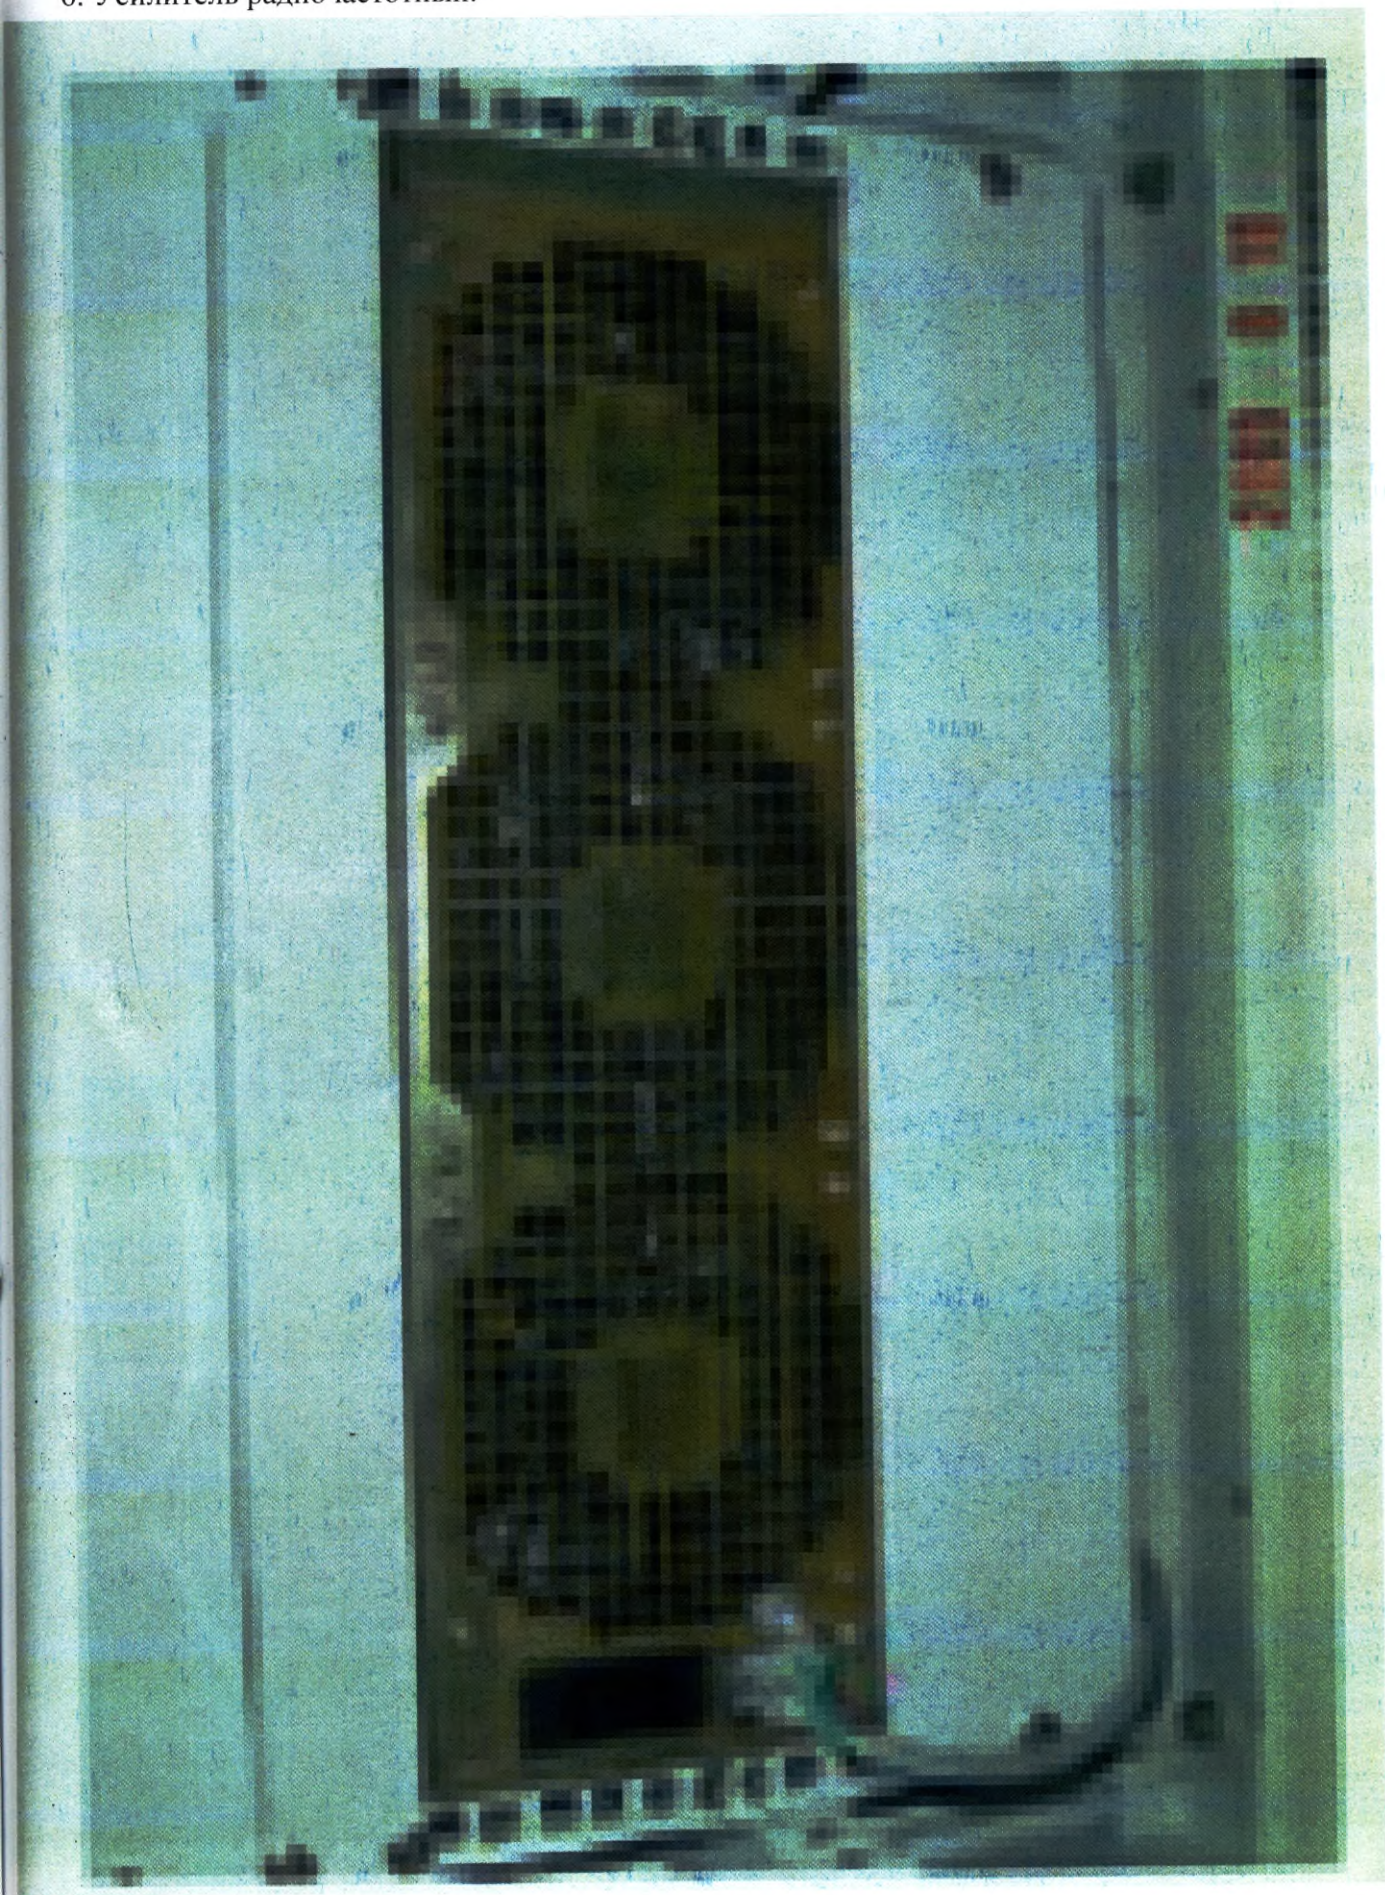

7. Устройство распределения питания, радиочастотное.



346

8. Многоканальная цифровая консоль PKSpec:


- Модуль сетевого обмена.
- Модуль двухканальный/четырёхканальный приема данных.
- Модуль контролирующей цифровой.
- Модуль расчета градиентов.
- Модуль градиентного выхода.
- Модуль радиочастотного выхода.
- Модуль радиочастотного входа и настройки.
- Модуль силовой.



9. Катушка приемная для головы фазированная двухканальная/четырёхканальная.




10. Катушка приемная цервикальная (шейная) фазированная двухканальная.

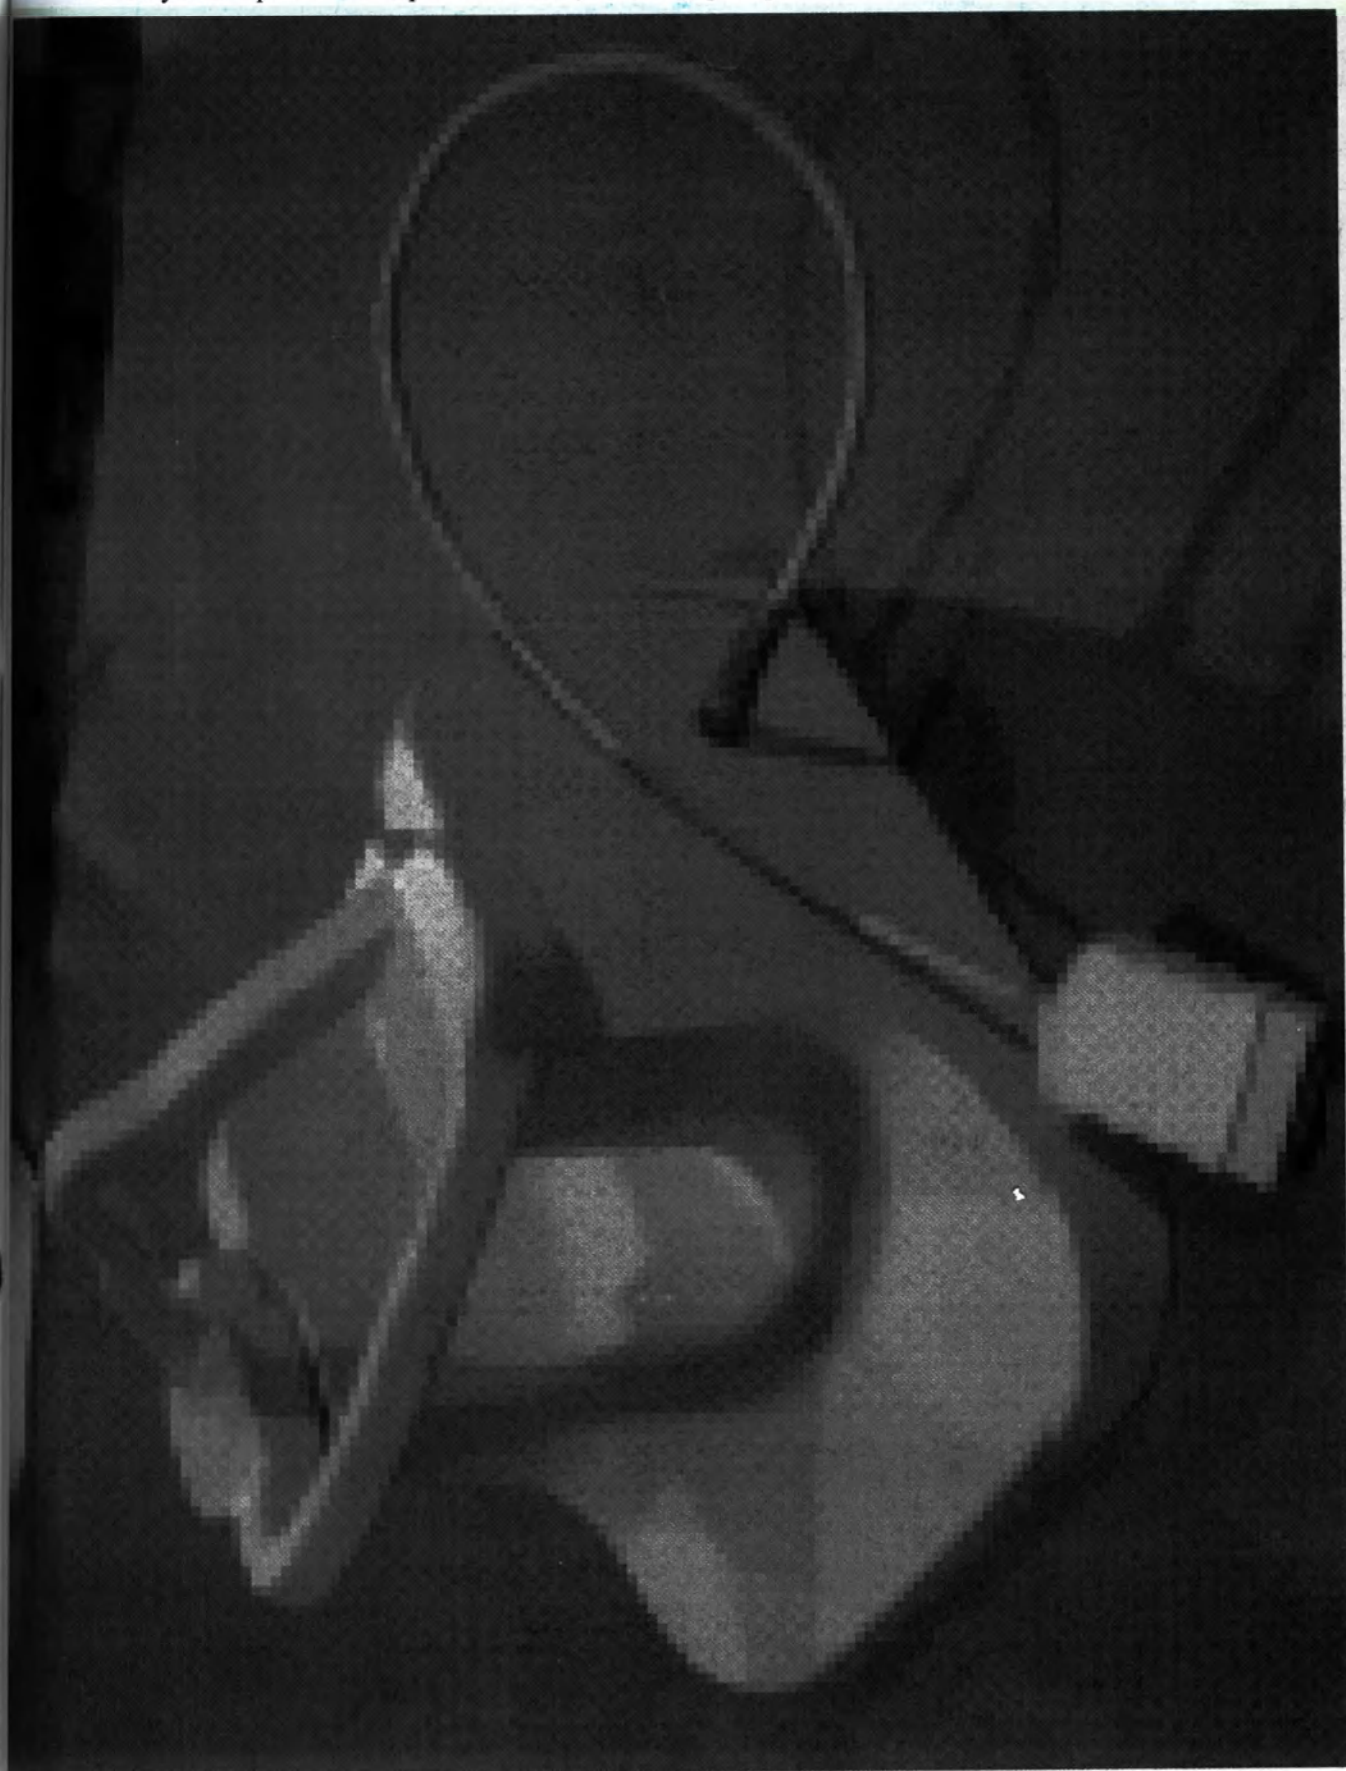


349

11. Катушка приемная для колена фазированная двухканальная/четырёхканальная.

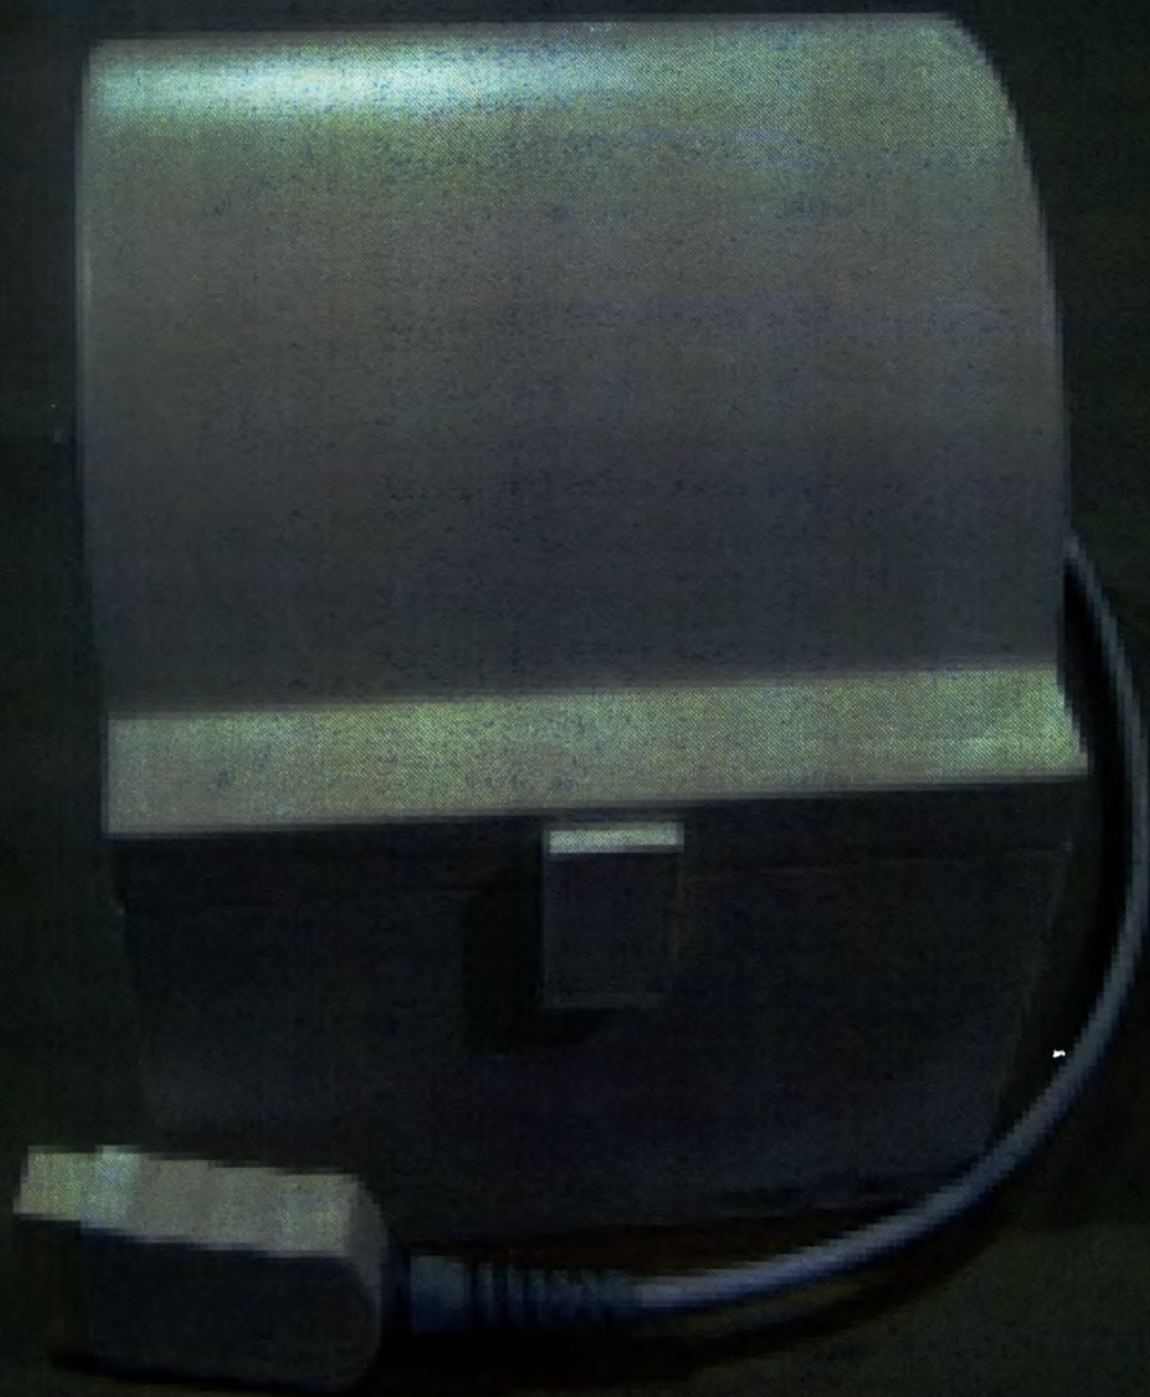


350

12. Катушка приемная для тела фазированная двухканальная/четырёхканальная, большая.

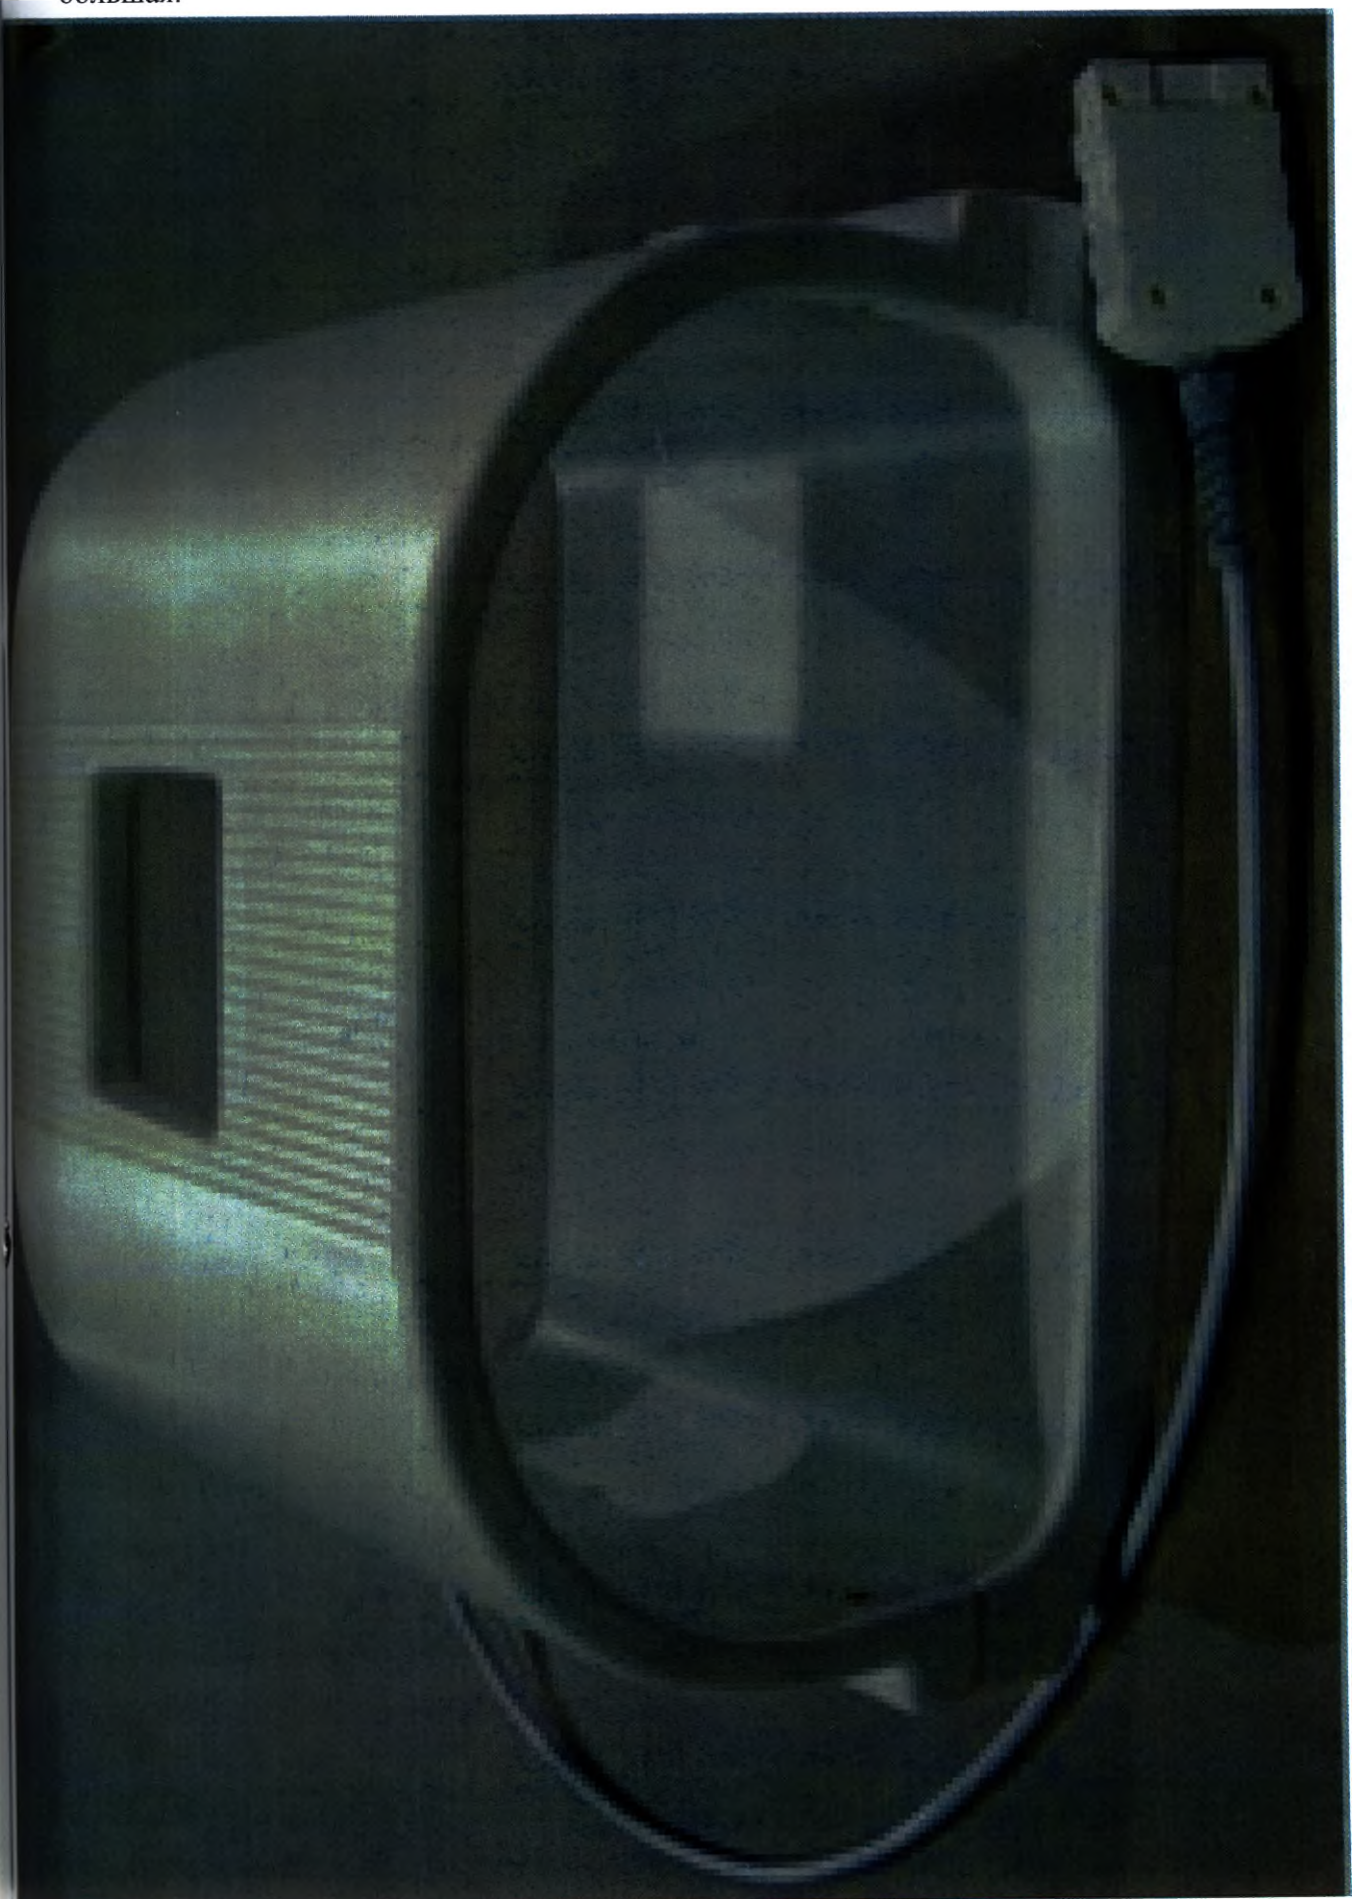


13. Катушка приемная для тела фазированная двухканальная/четырёхканальная, средняя.

351

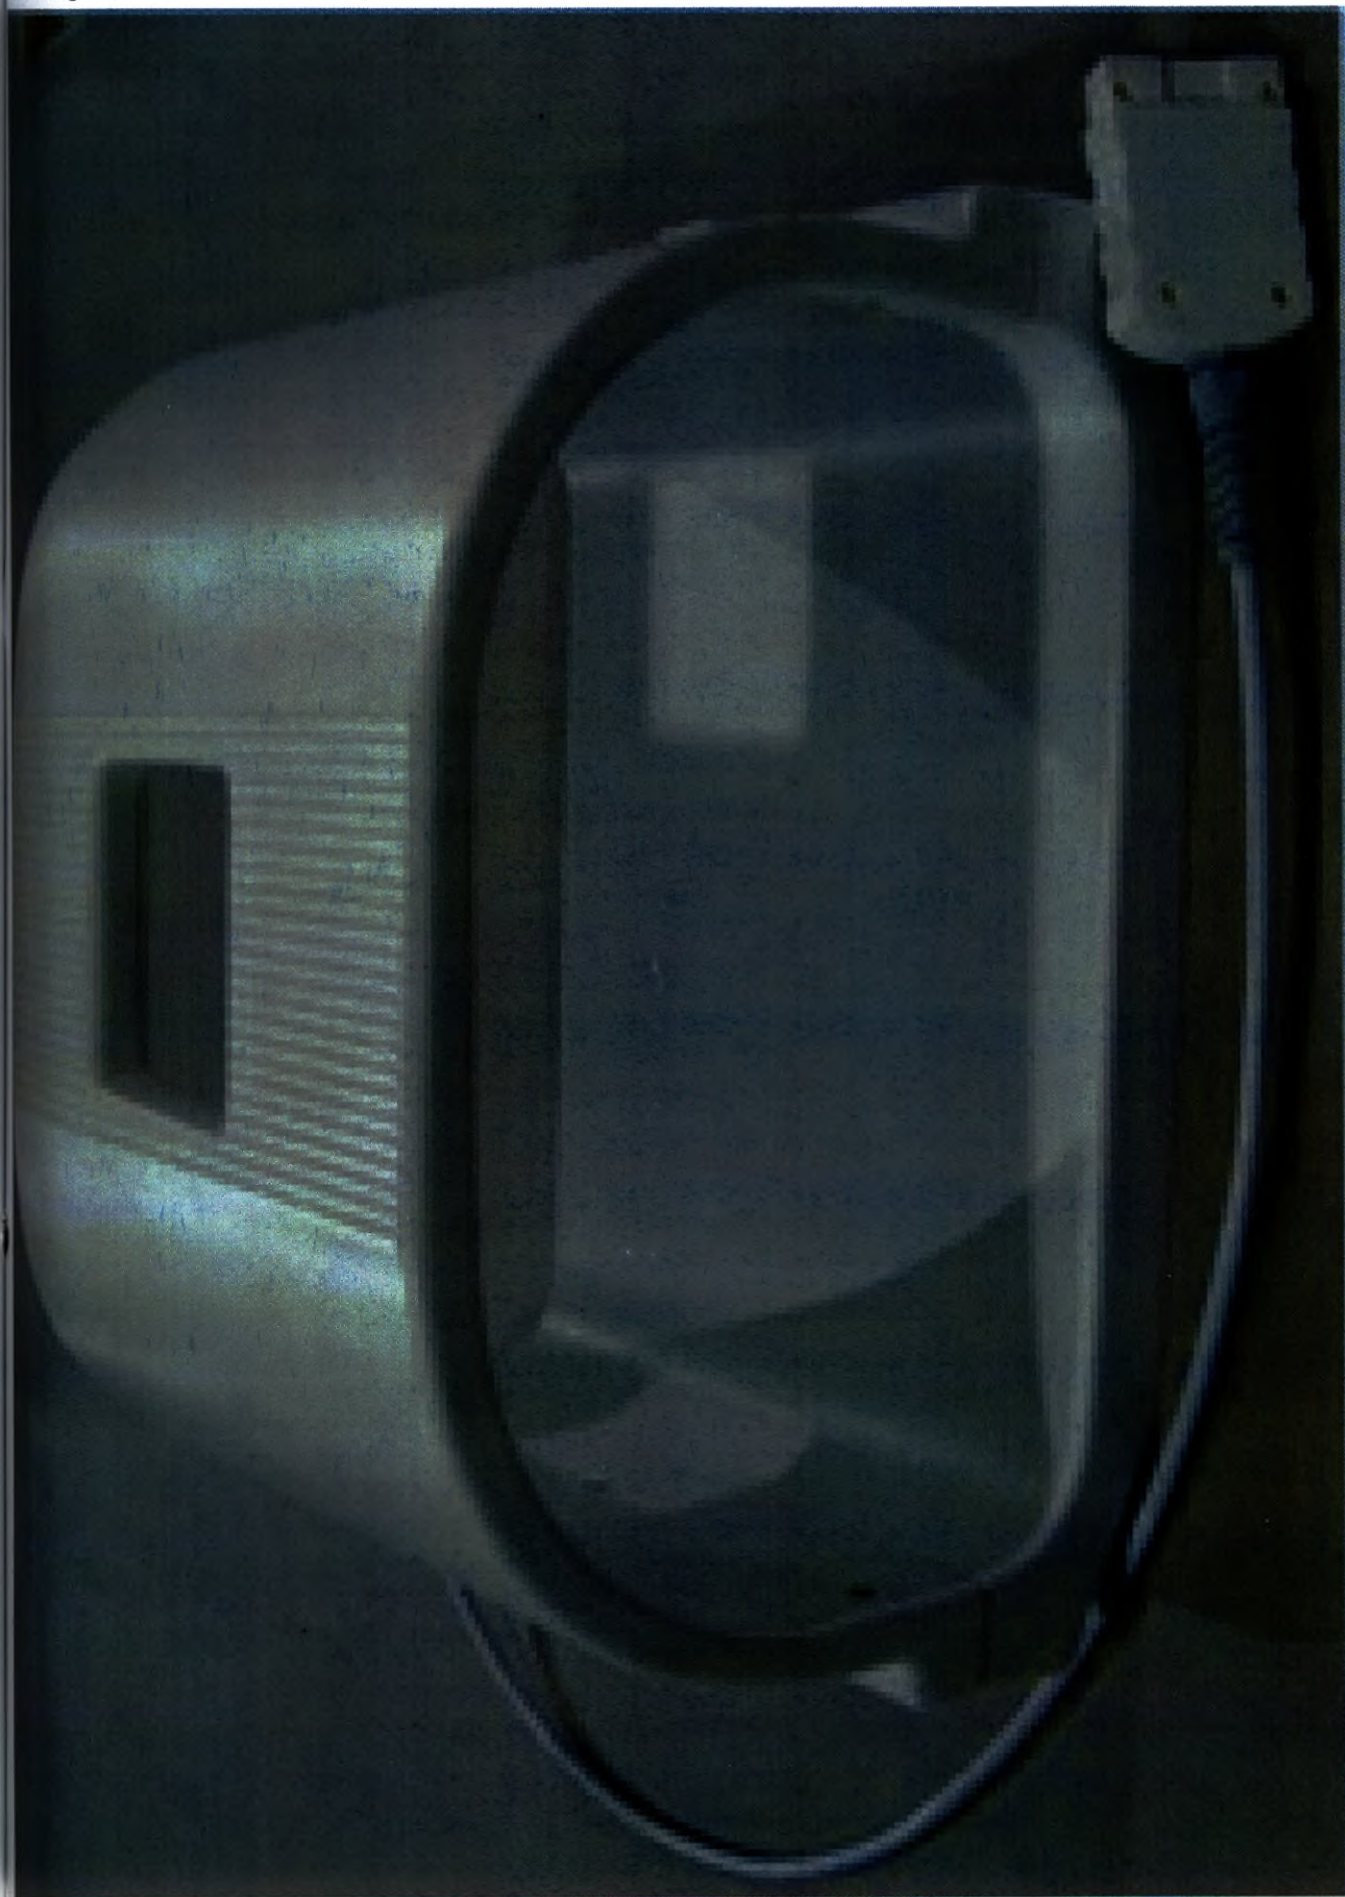

14. Катушка приемная для плеч фазированная двухканальная.

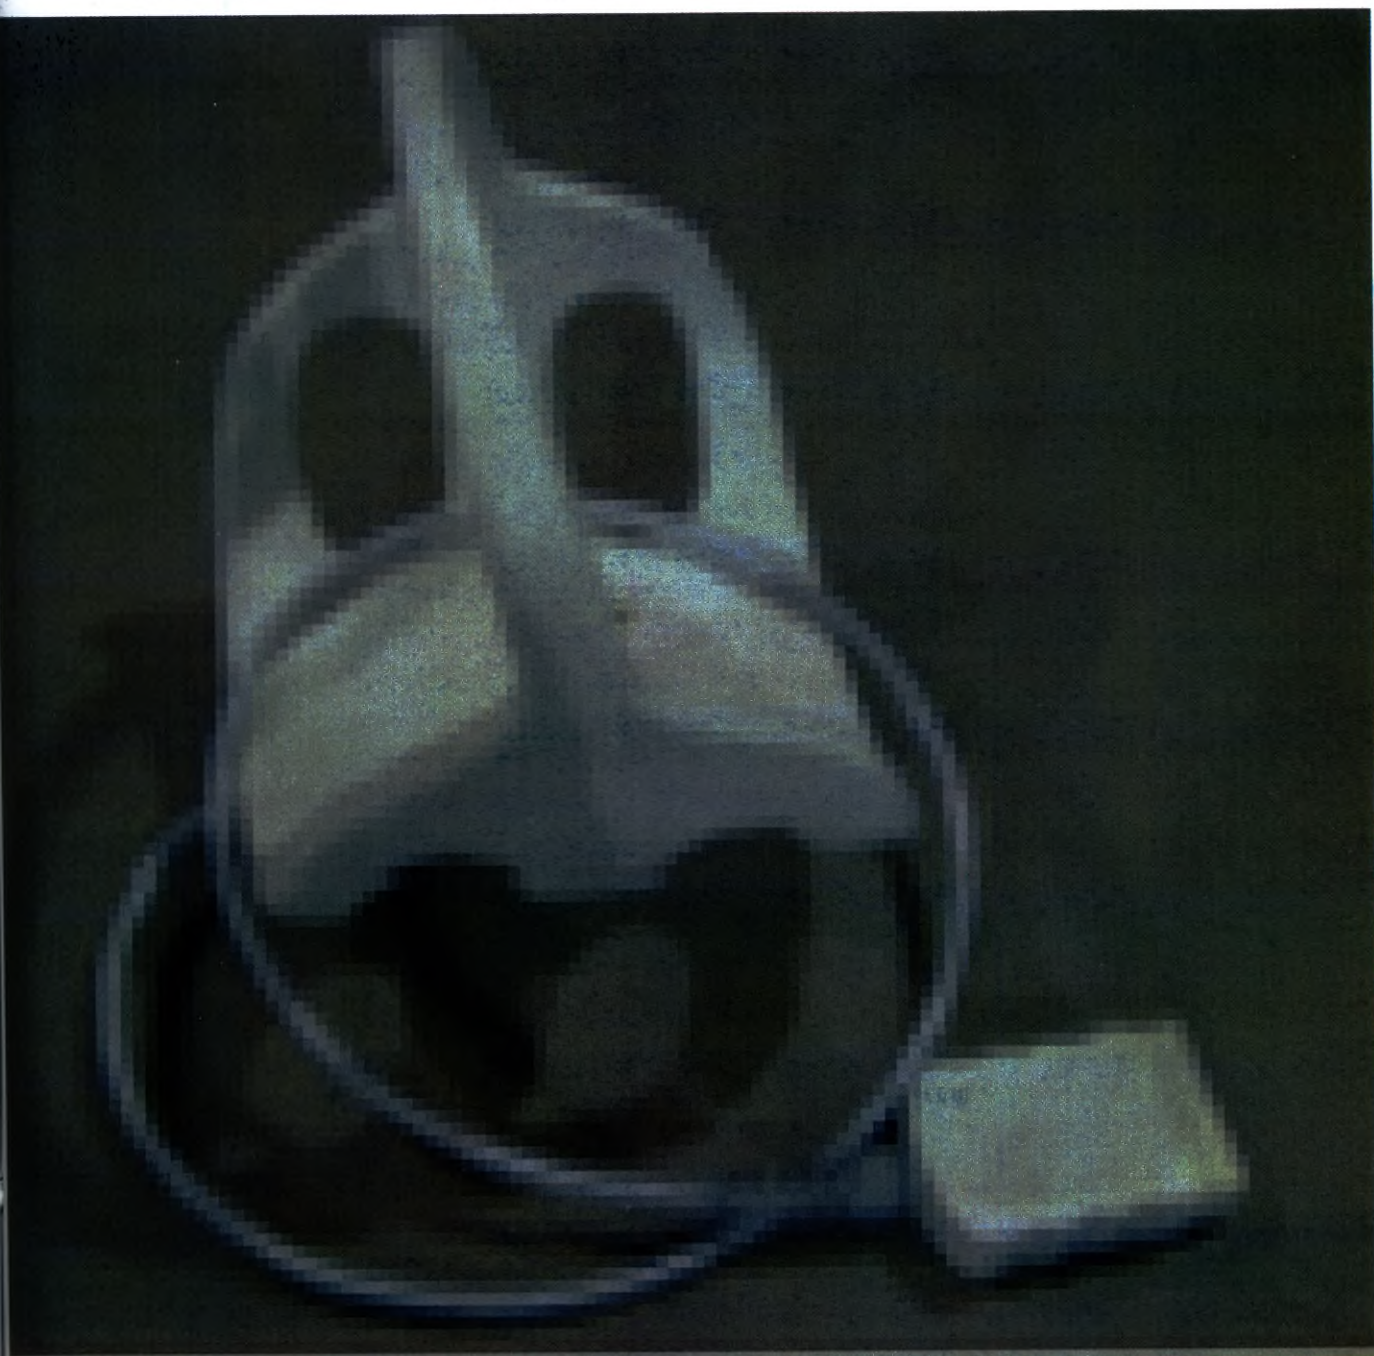




16. Предусилители, не более 10 шт.




17. Станция рабочая компьютерная.

35

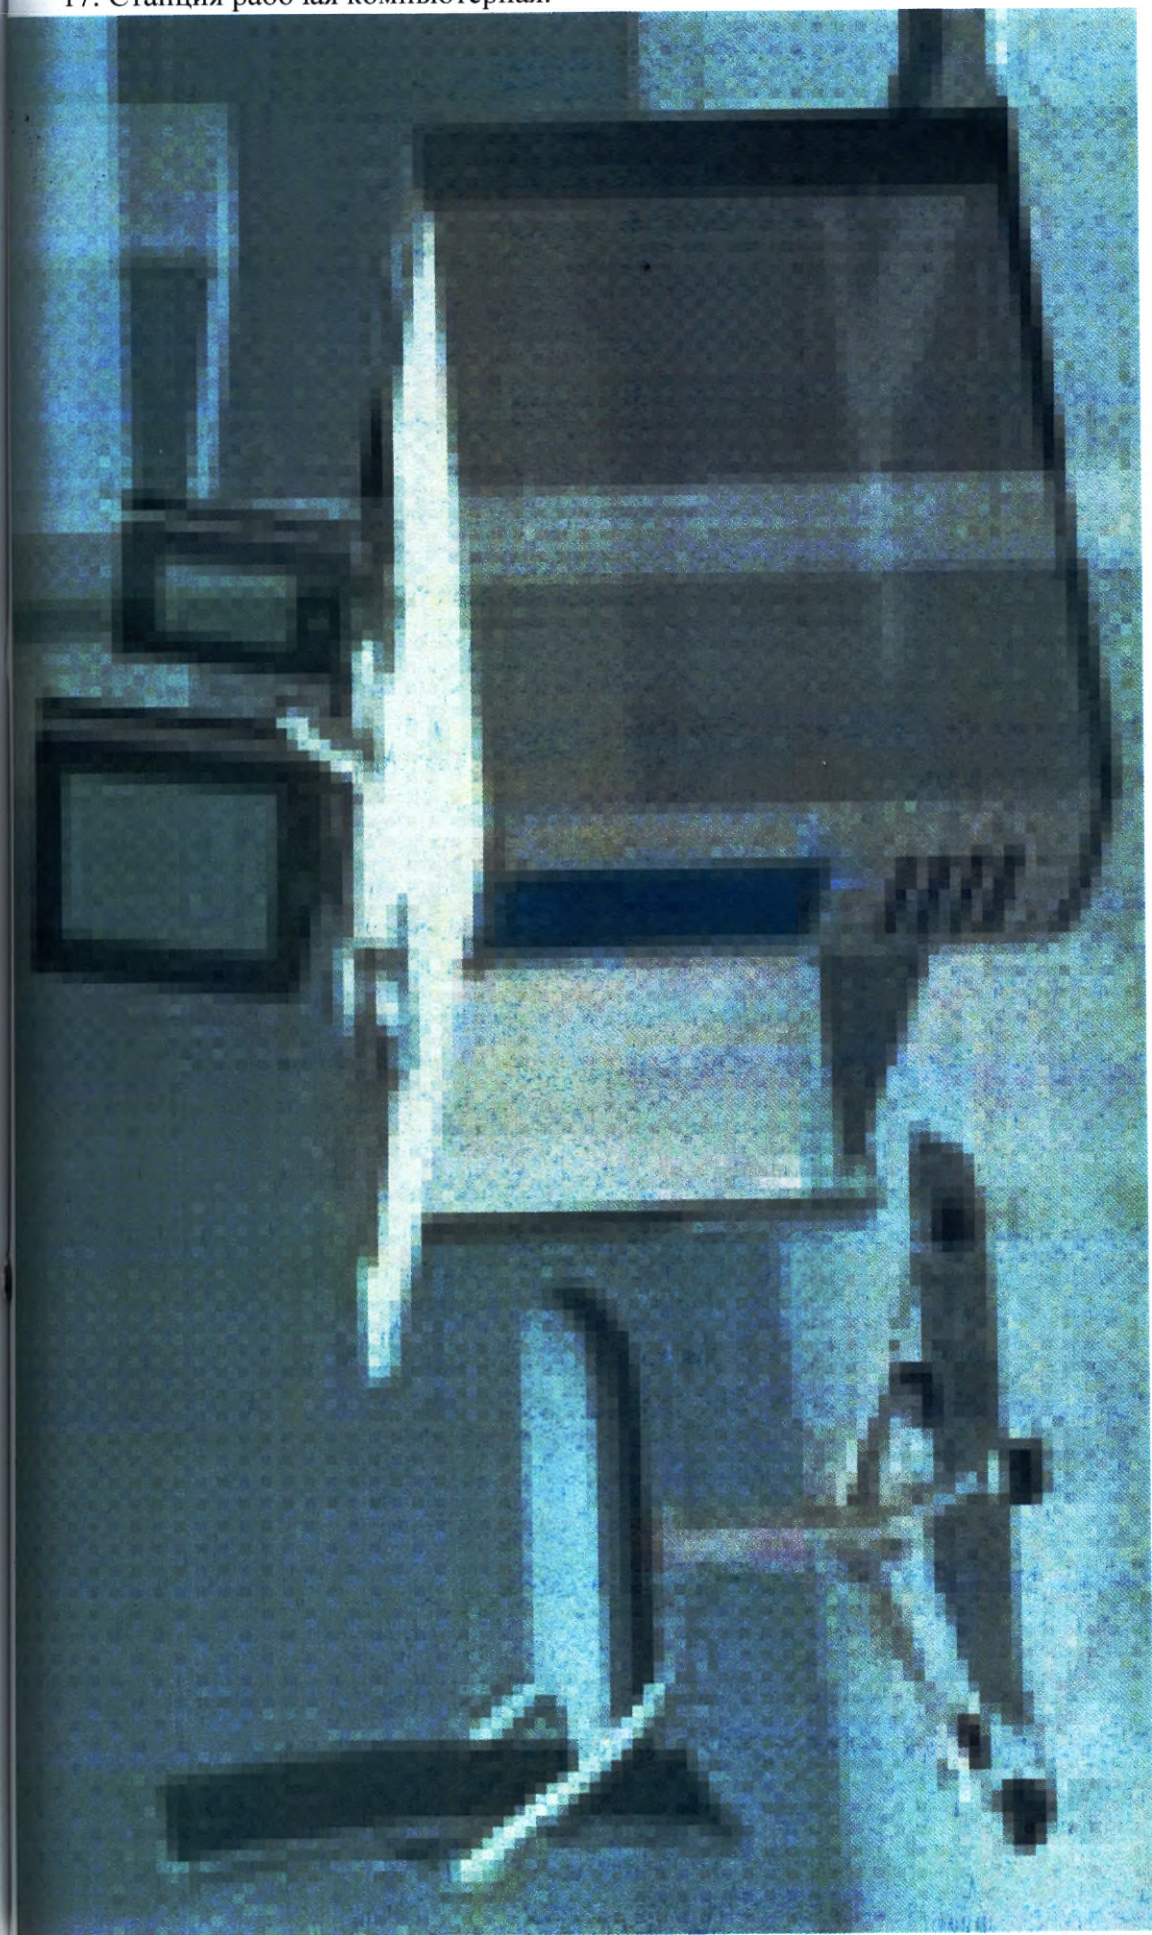


356

18. Монитор жидкокристаллический TFT-LCD 19 дюймов.

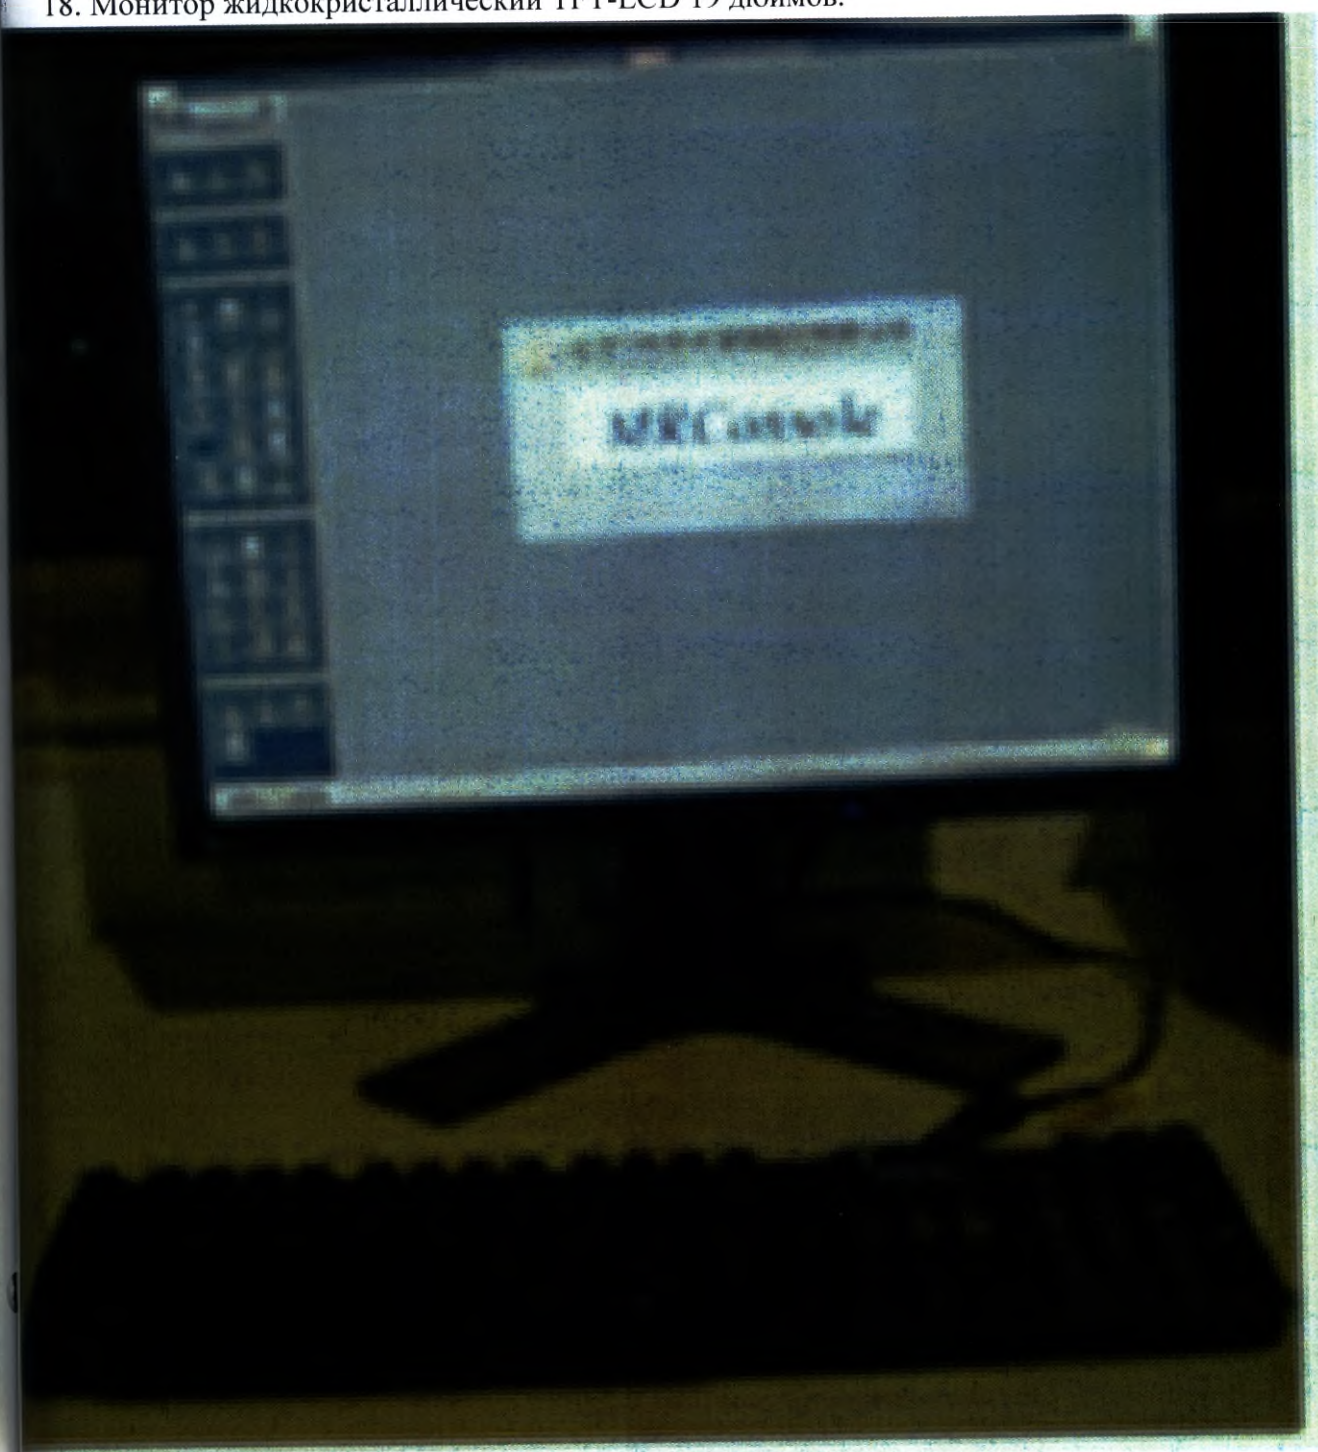

357

19. Сетевая карта (коммутатор 10/100M).

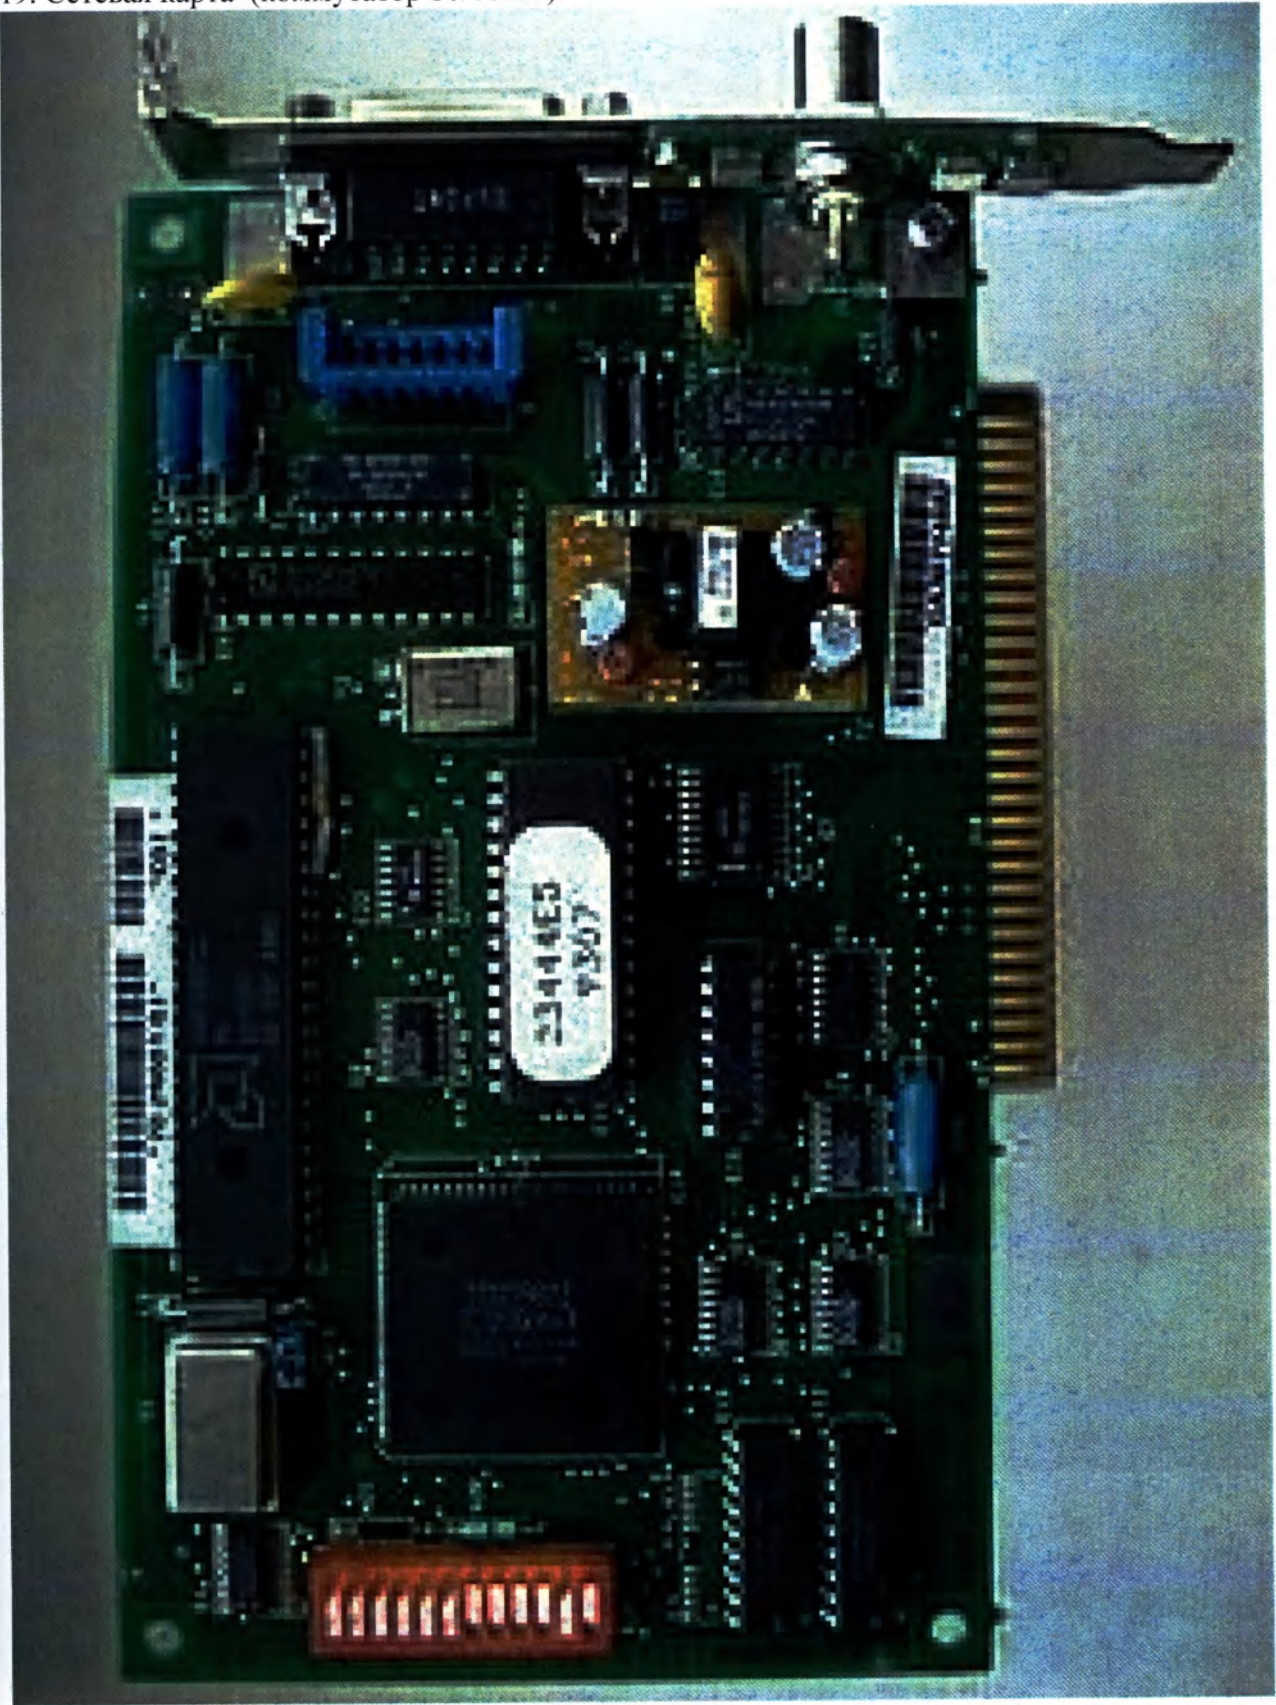

20. Стабилизатор напряжения.




3.6.0

21. Блок (шкаф) электроники для управления томографом.




22. Устройство для записи CD диска с информацией для пациента.

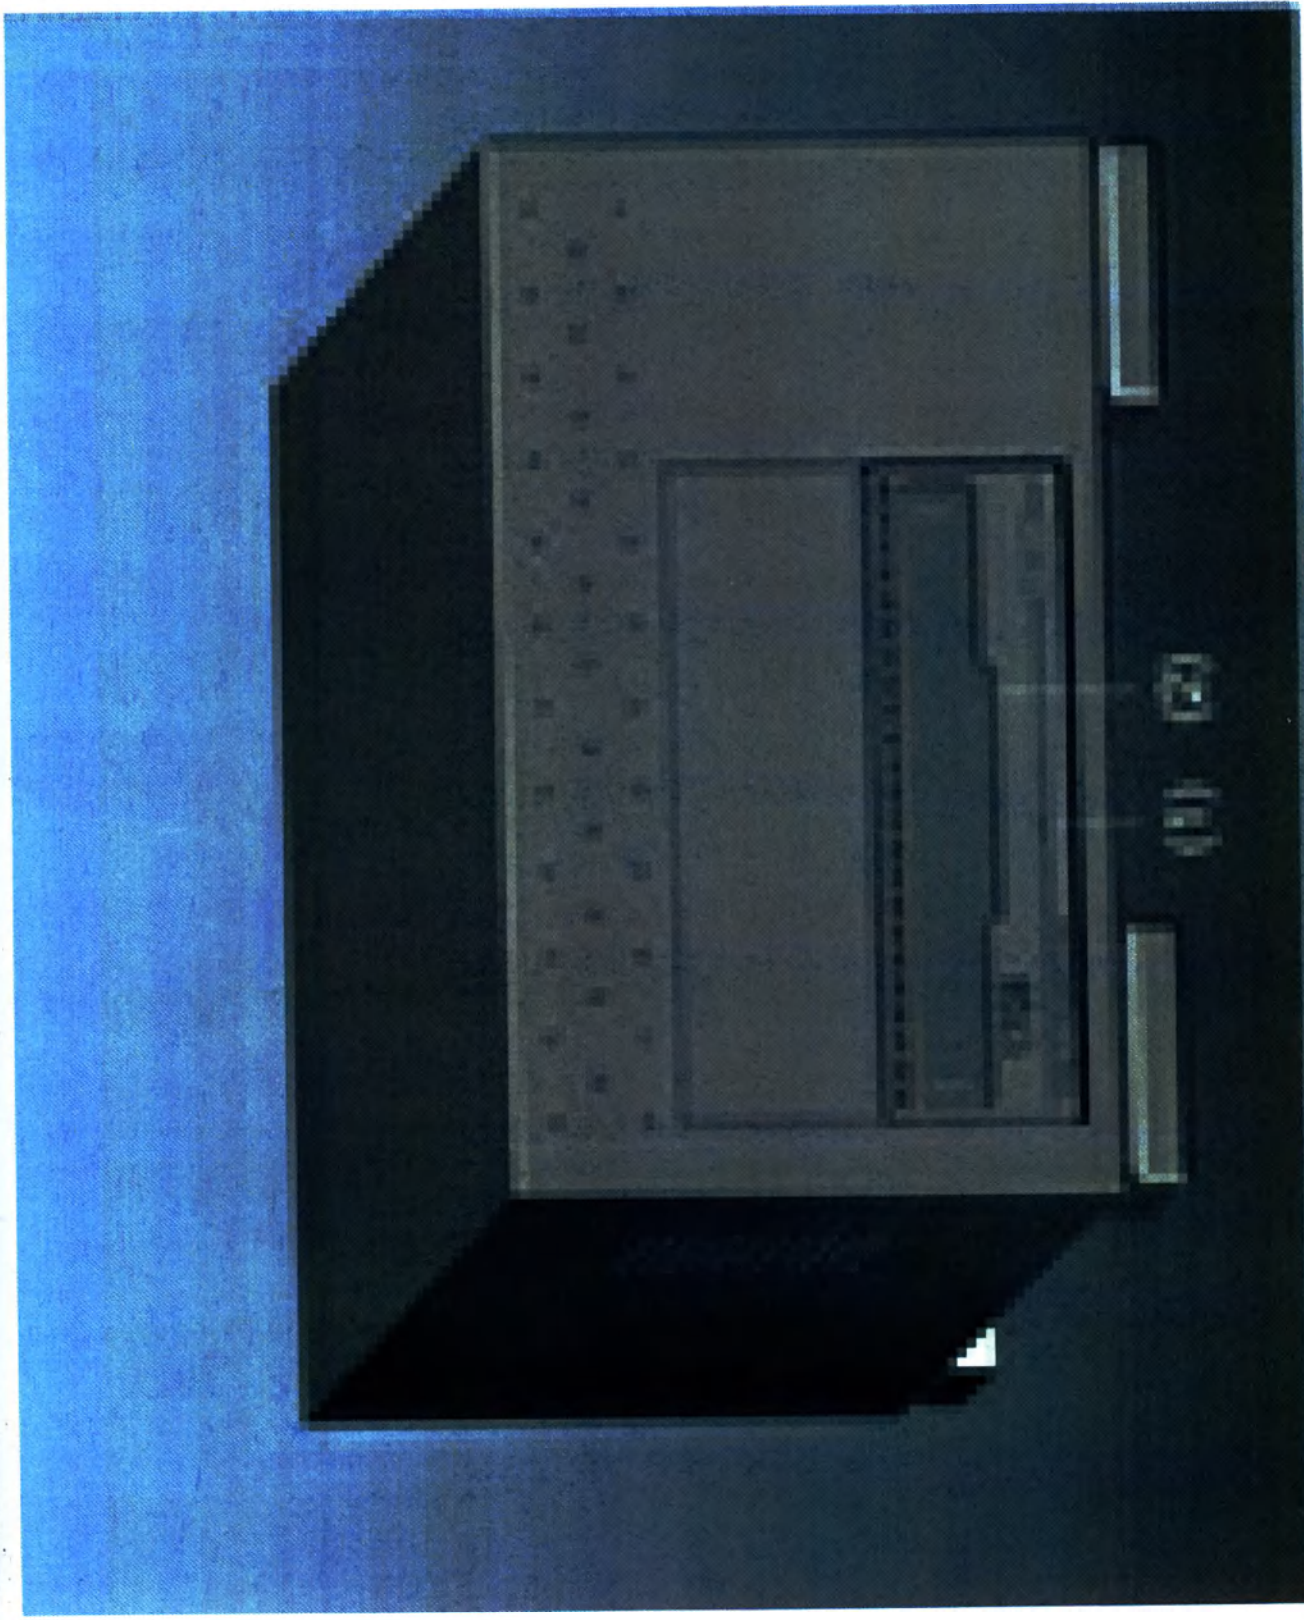


23. Кожух магнита.
0.36T



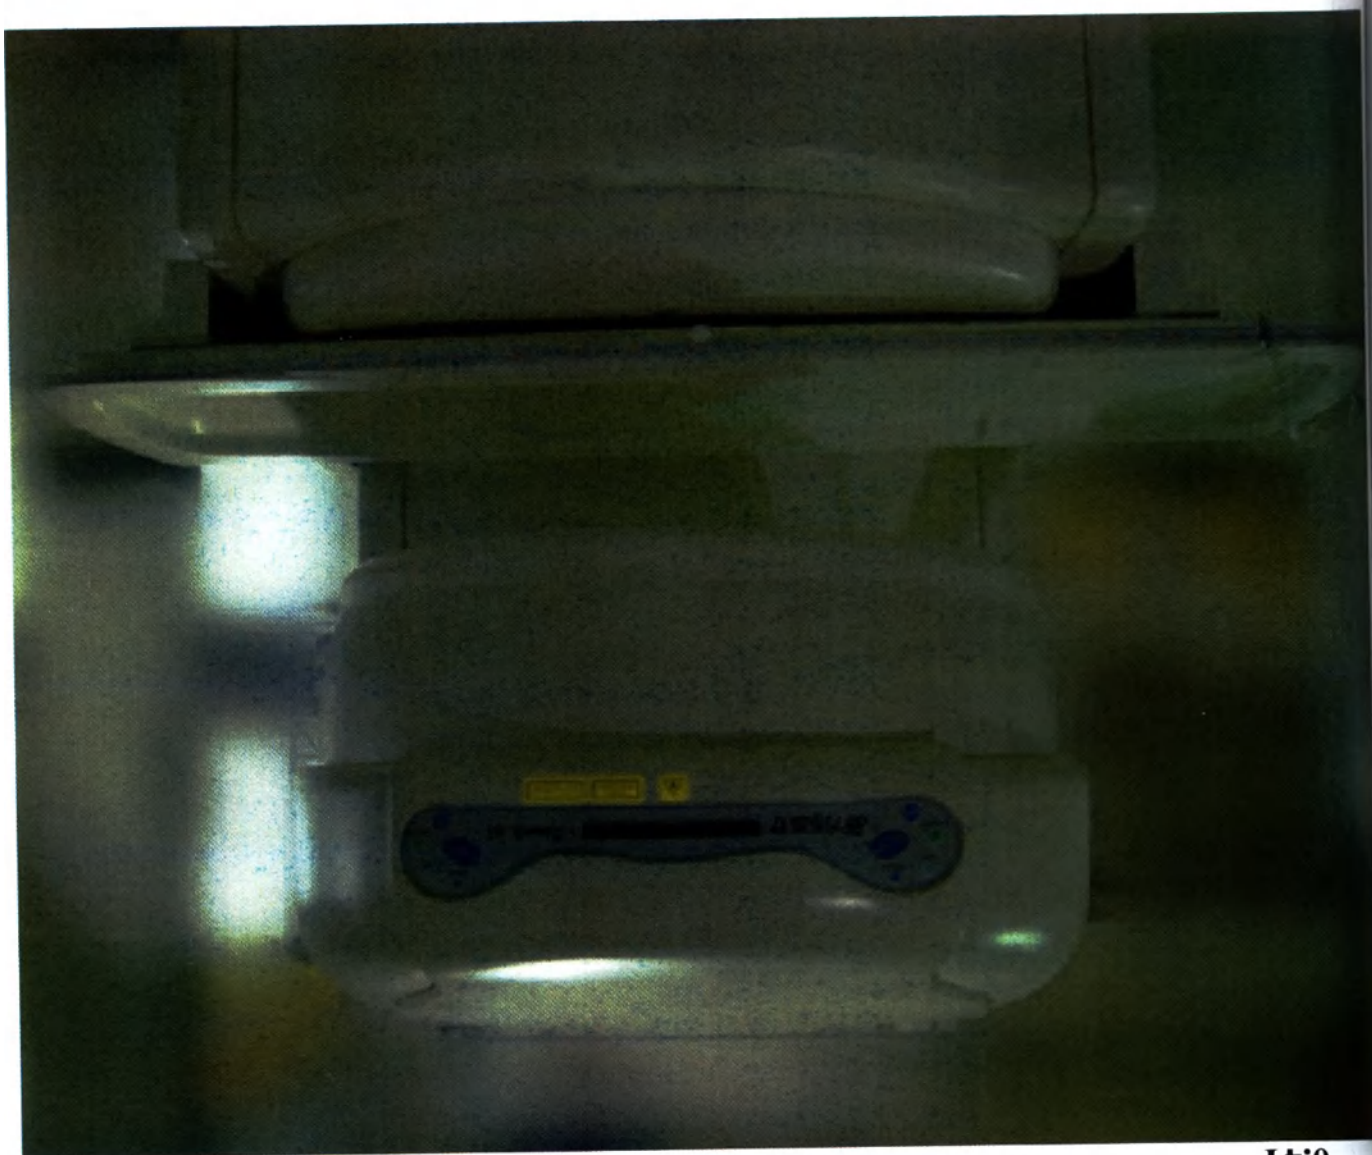

0.4T

295

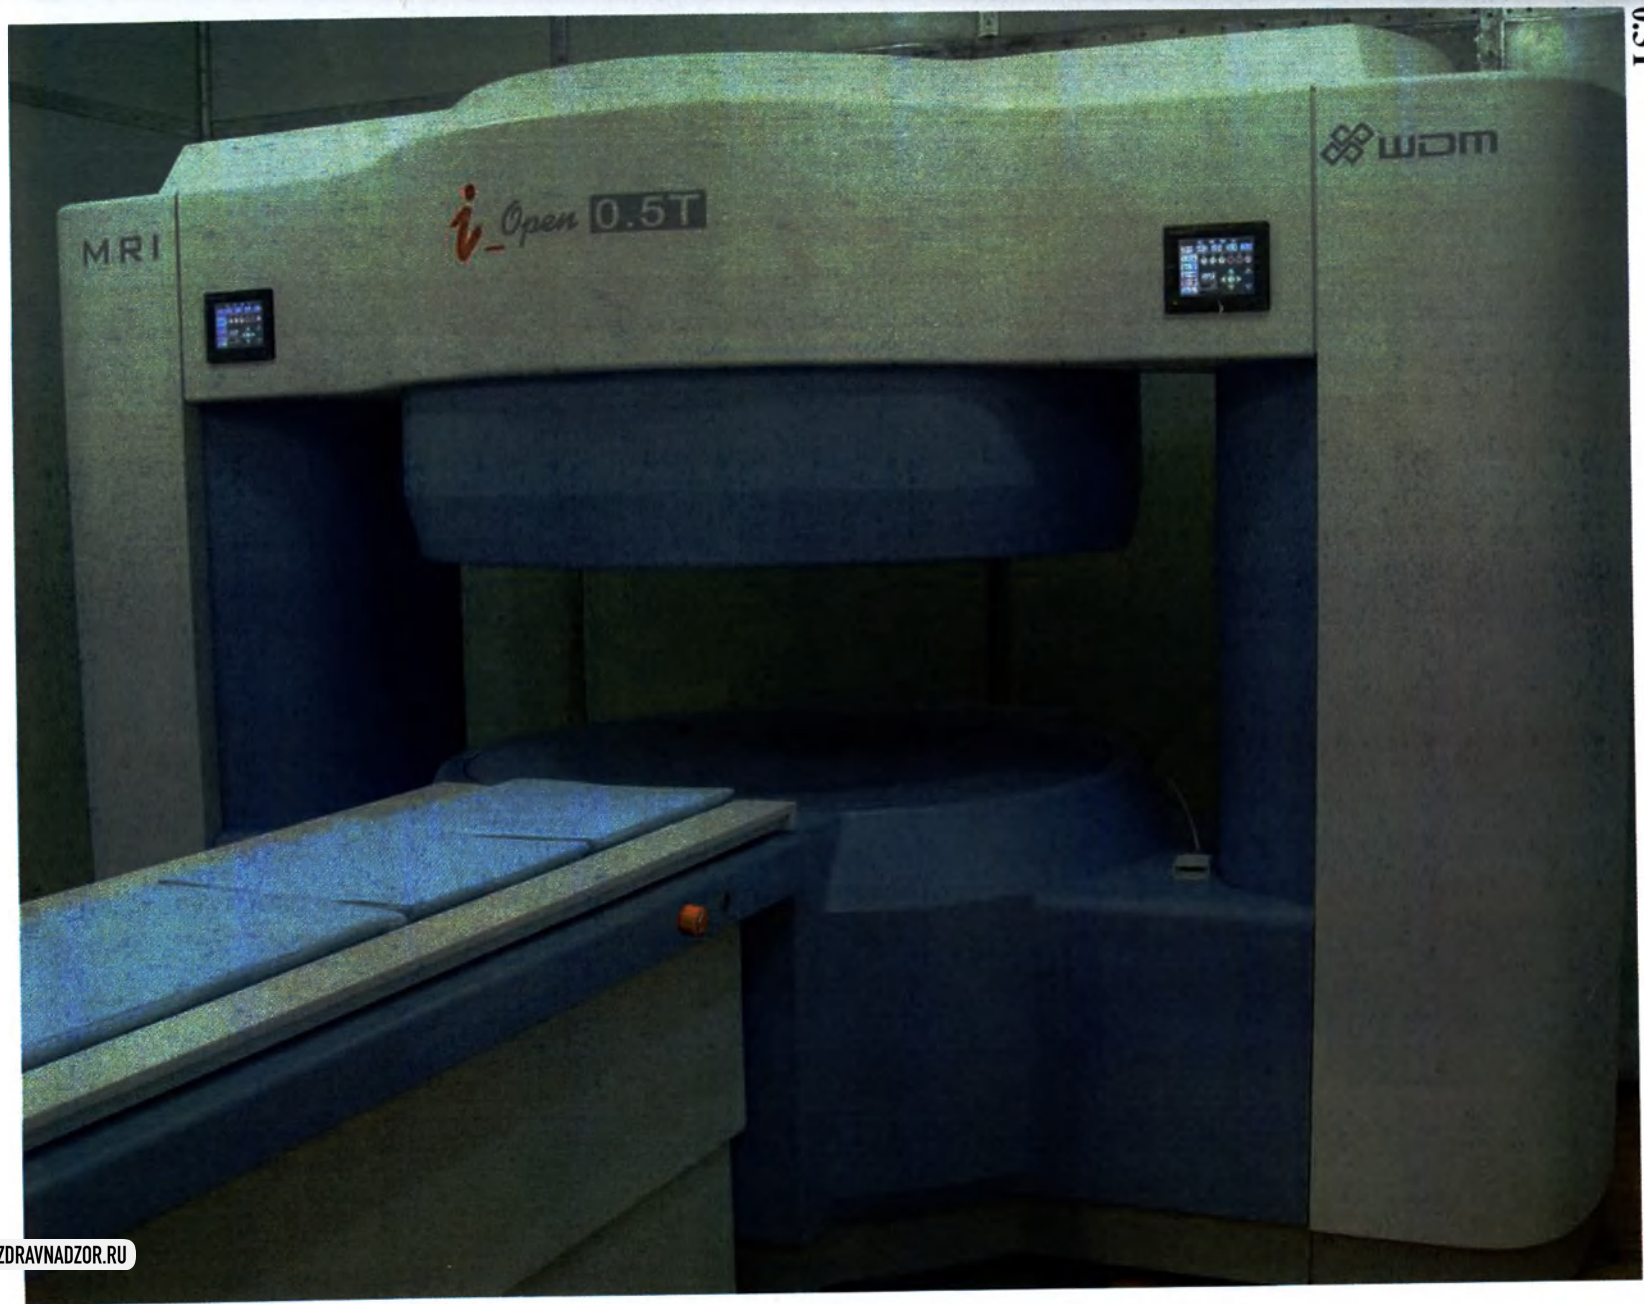

0.5T

363


24. Стол пациента.



25. Устройство лазерного позиционирования пациента.



26. Устройство для двухсторонней связи с пациентом.

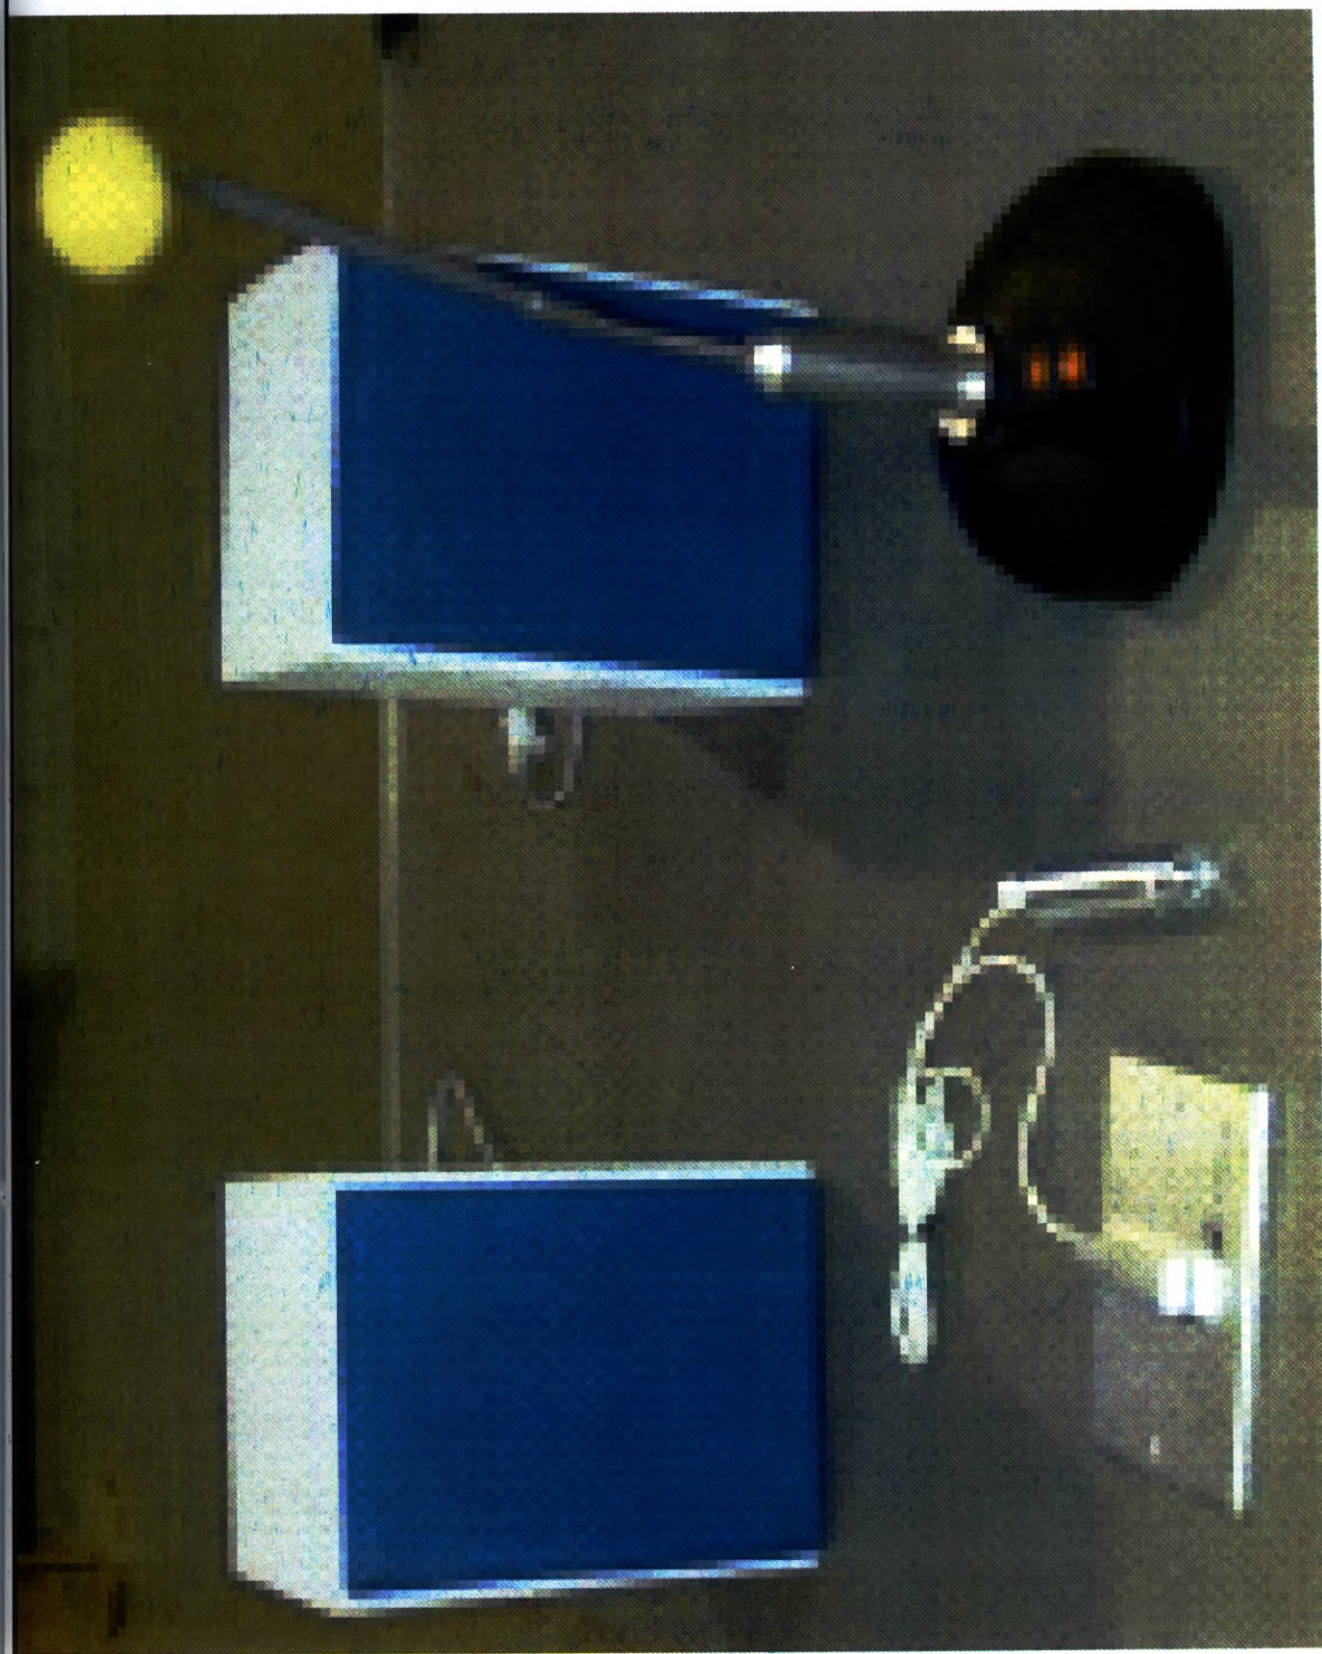

367

27. Матрас для пациента.




28. Стол оператора.




30

29. Интерфейс подключения приемных катушек.

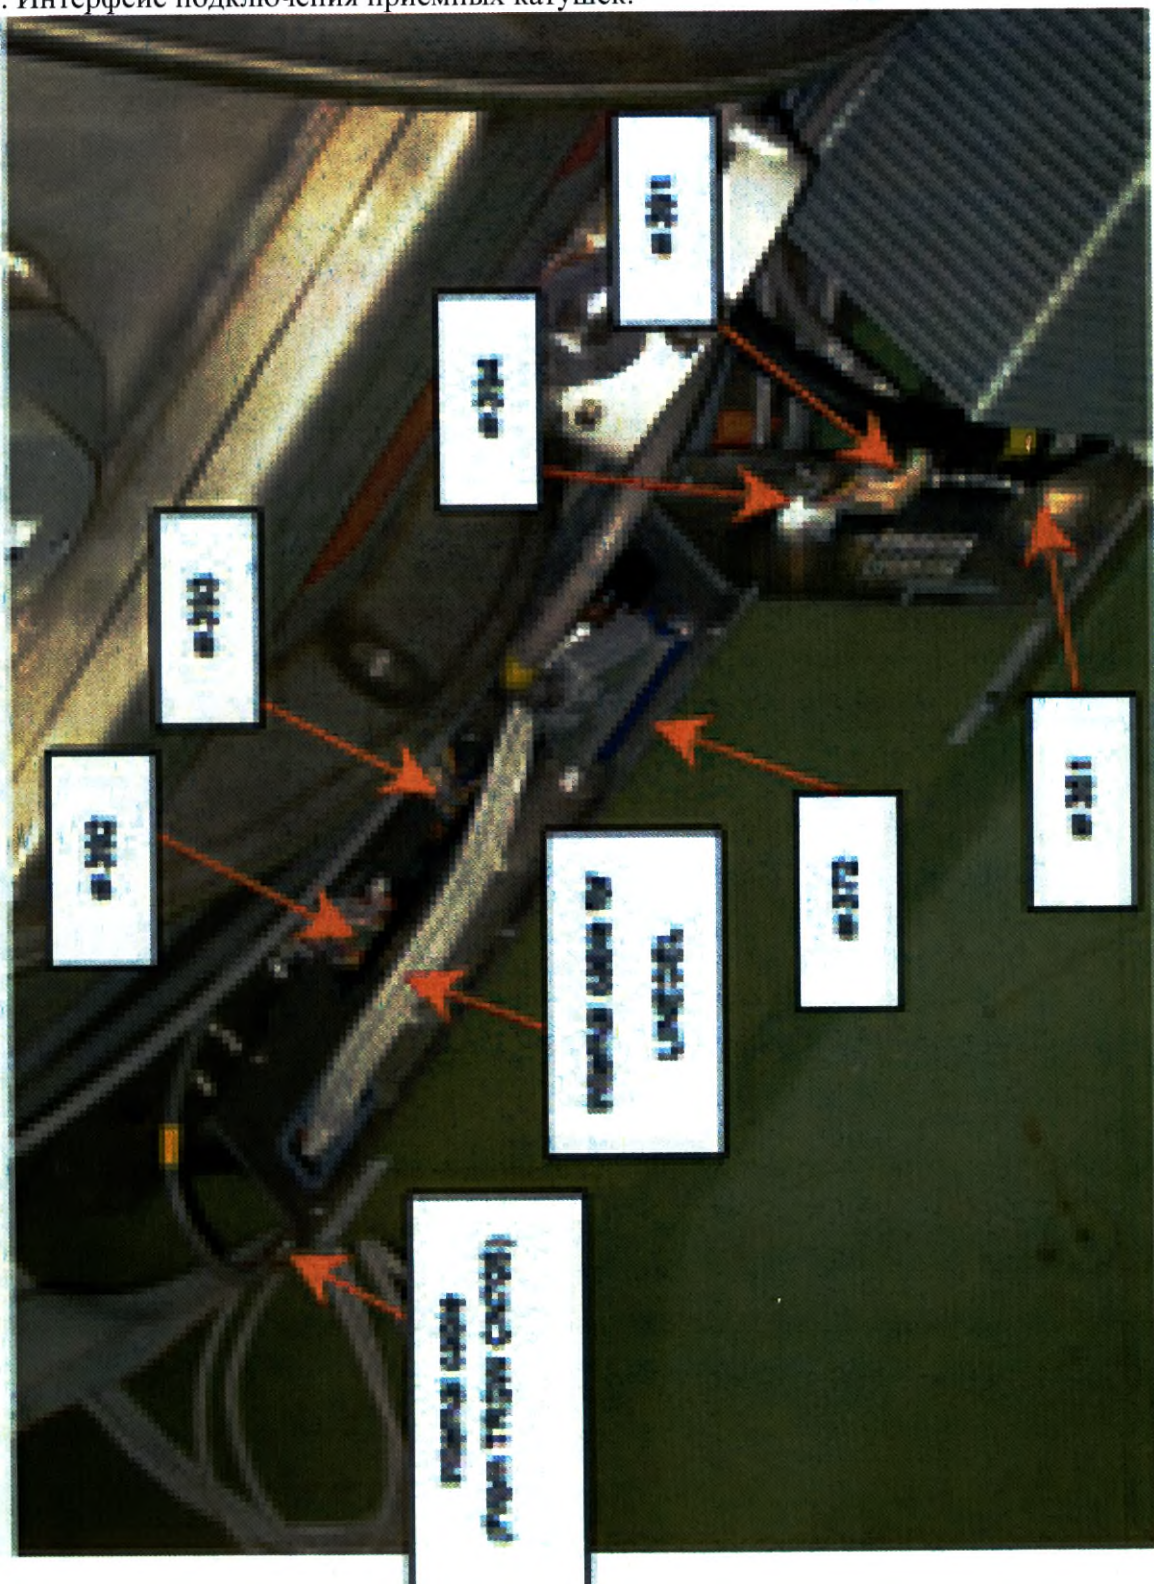


37

30. Фантомы калибровочные для настройки катушек, не более 5 шт.:
- Фантом "Куб", большой;

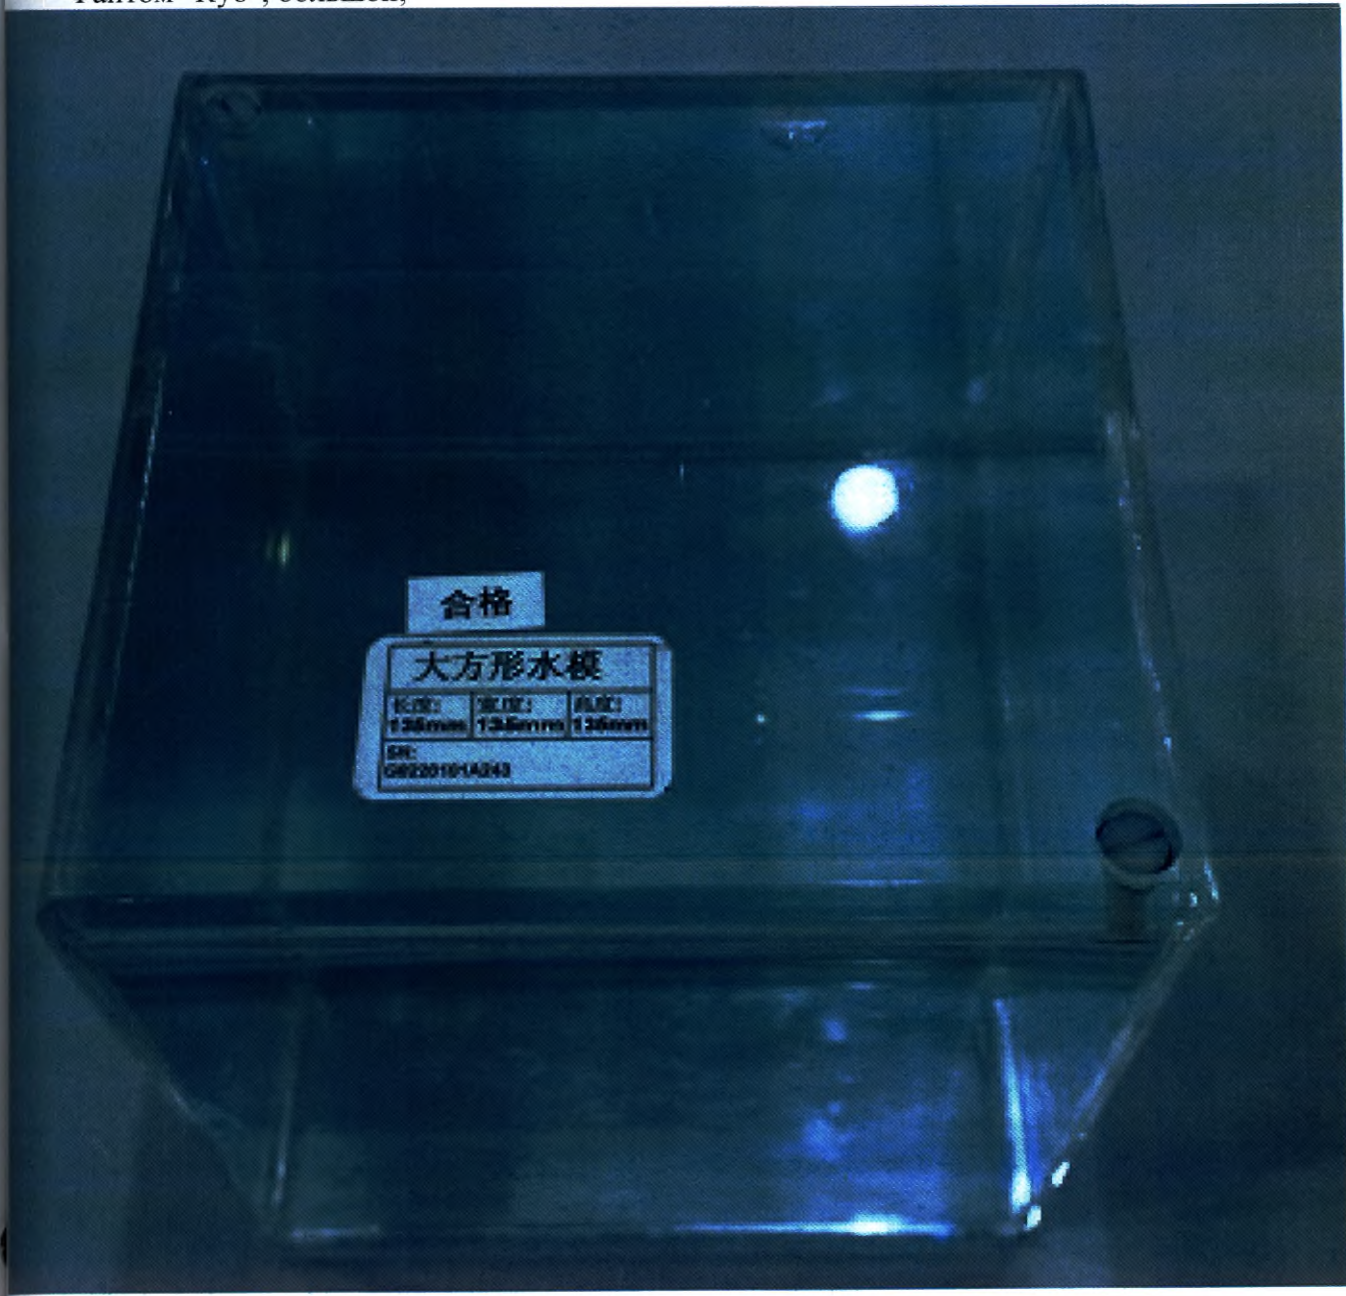


- Фантом "Куб", малый;

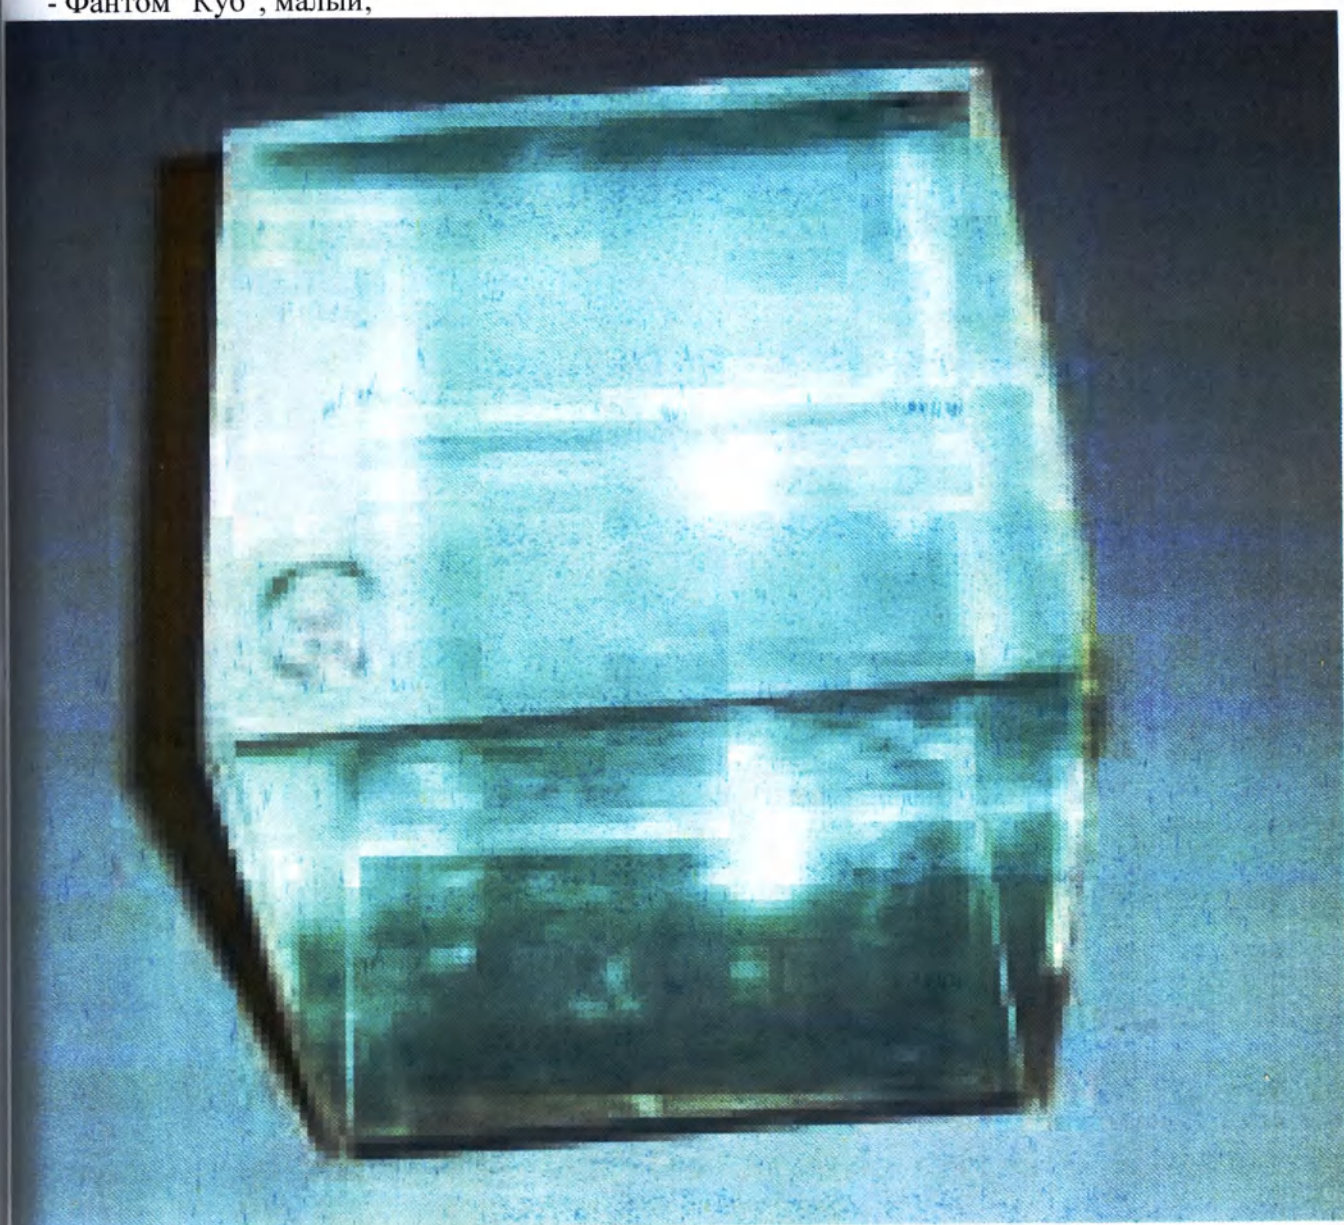

- Фантом "Цилиндр";




- Фантом "Полусфера" с катушкой для грудной клетки.

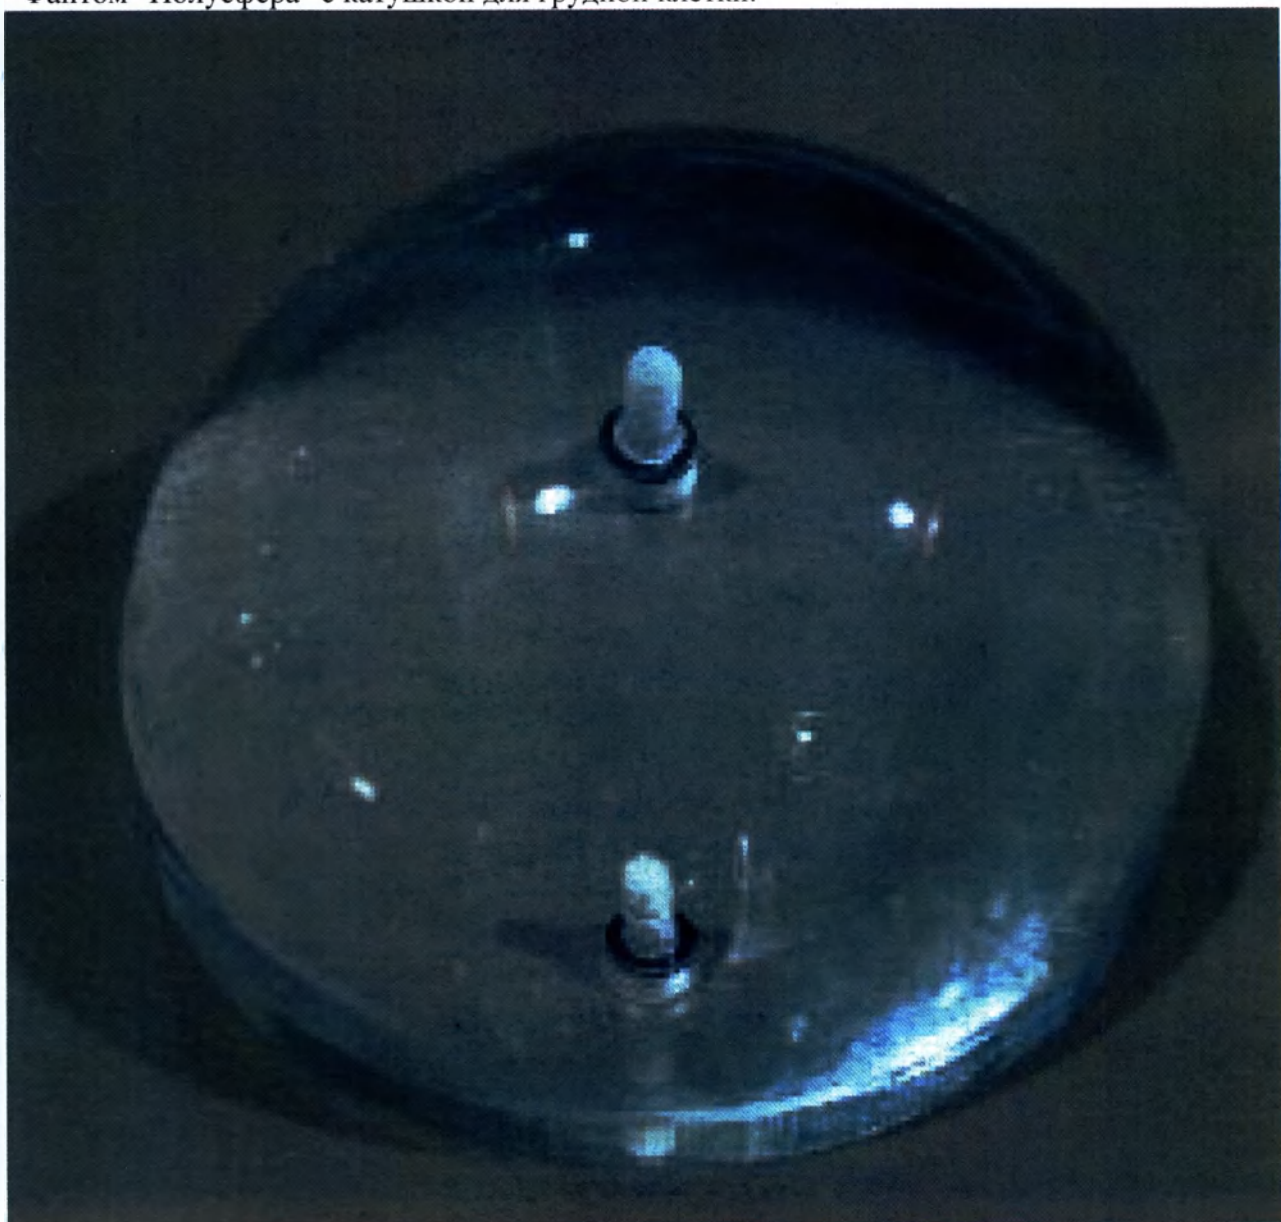

31. Система обслуживания:

- Панель с фильтрами;
- Фильтры, не более 10 шт.

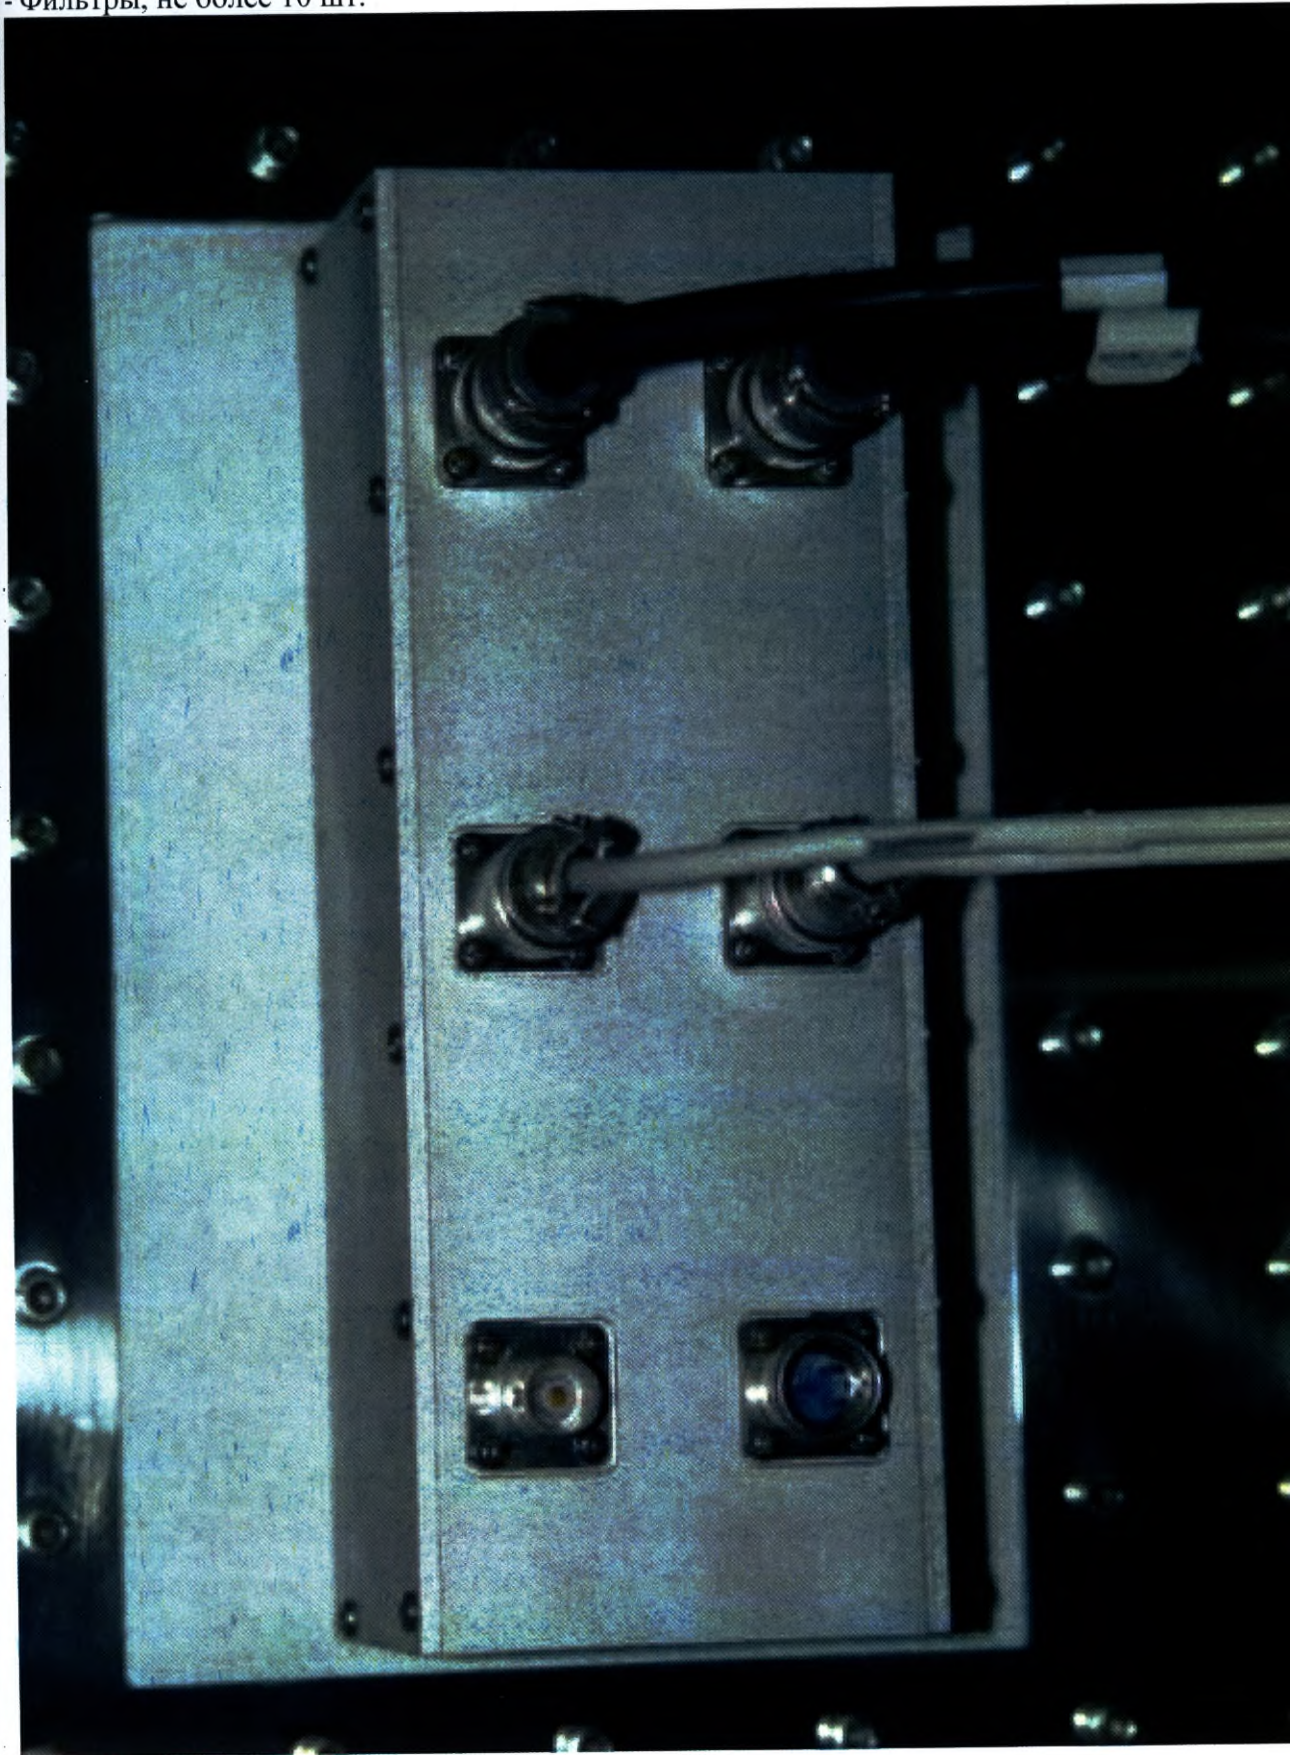

Соединительные кабели, не более 10 шт.



32. Руководство пользователя в виде печатной брошюры.

33. Интерфейс на русском языке.

34. Программное обеспечение системное MP консоль.

376

II. Принадлежности:


1. Катушка гибкая фазированная двухканальная.




2. Катушка для грудной клетки фазированная двухканальная.




3. Катушка цервикальная (шейная) фазированная четырехканальная.

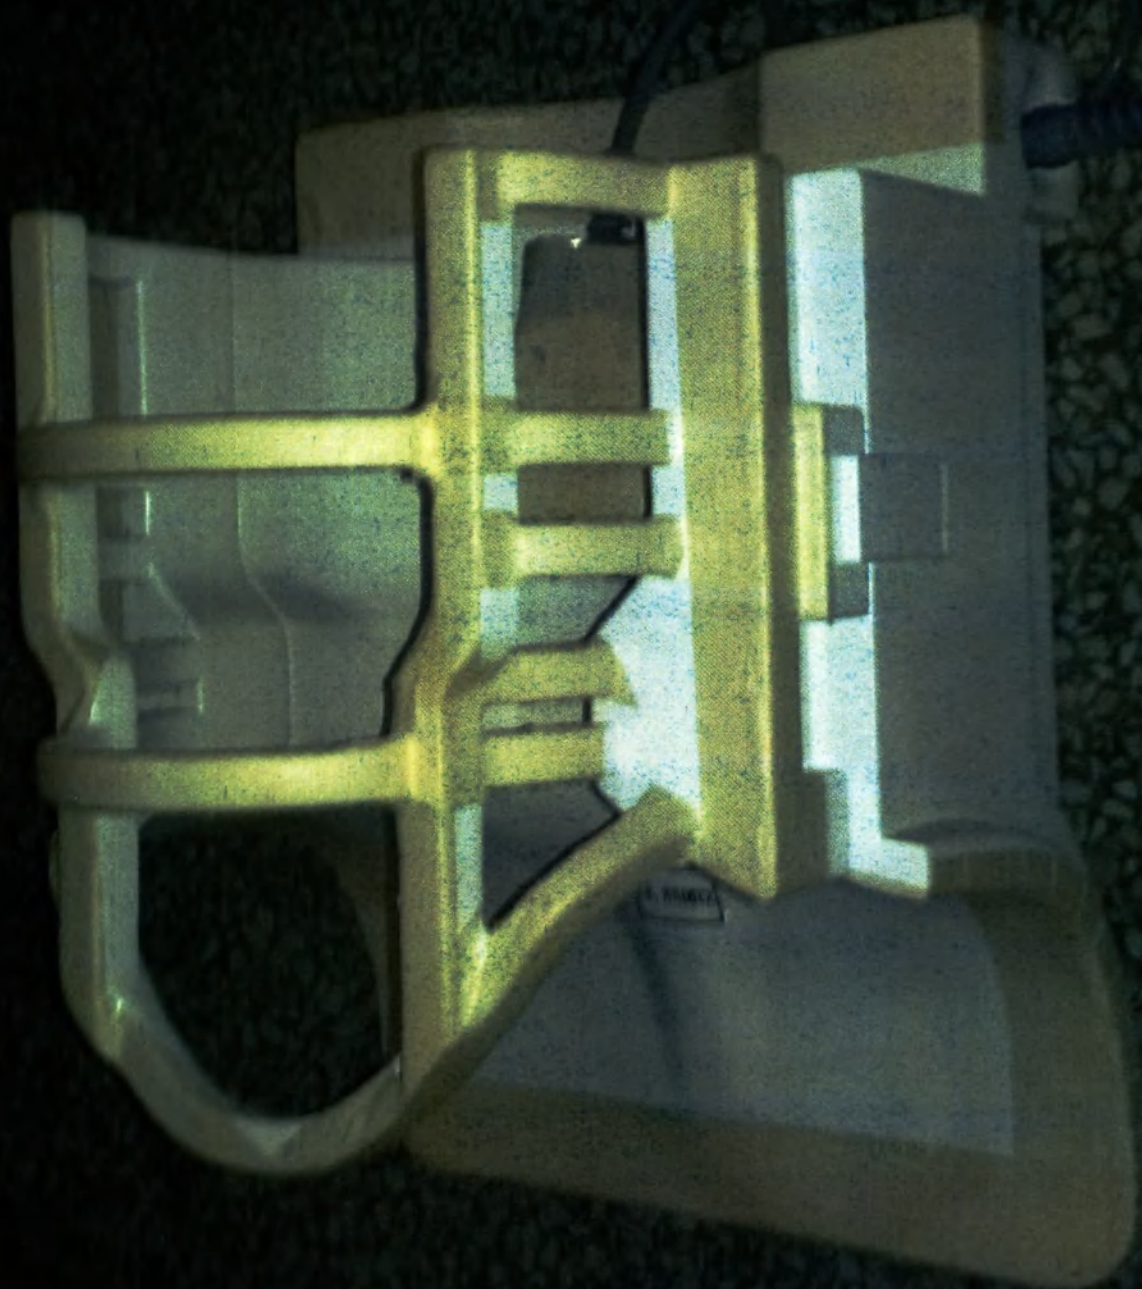



4. Устройство аварийной сигнализации пациента.
запись параметров, контролирующих процесс снятия

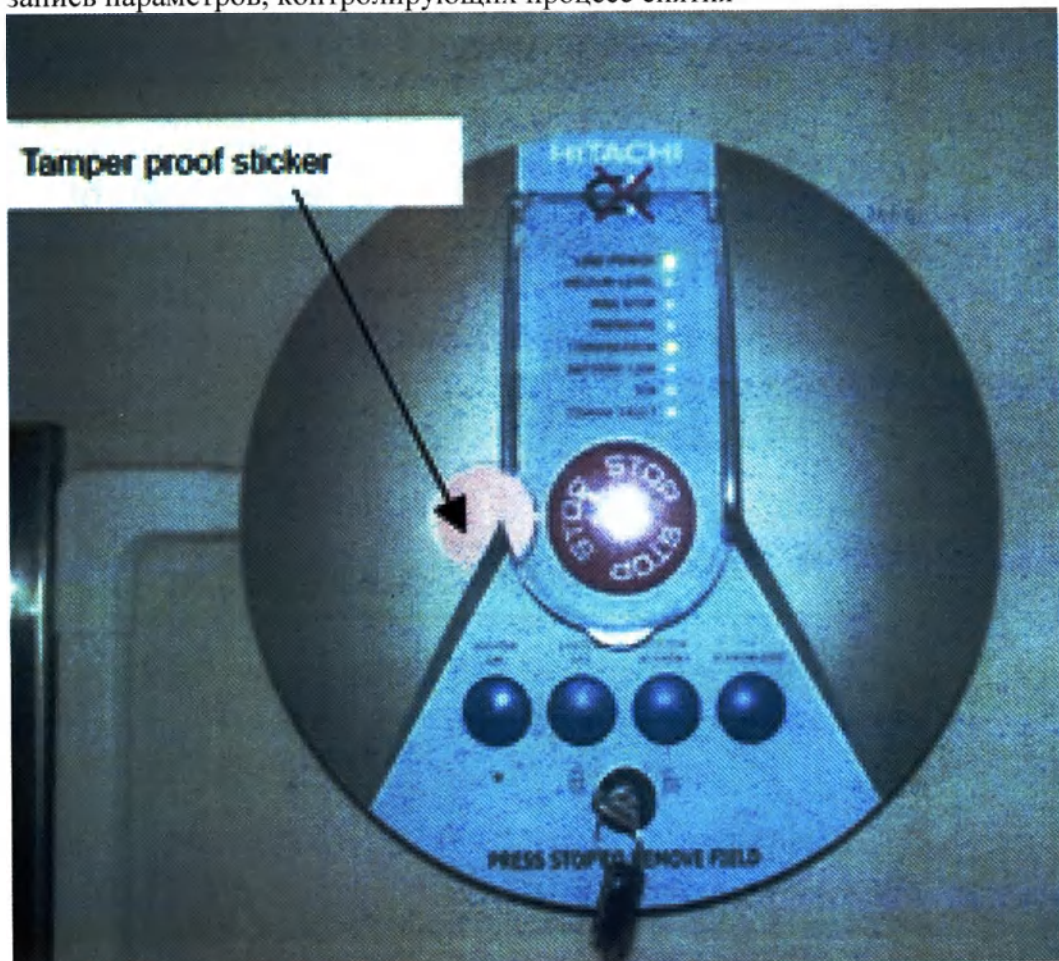


ERDU button is inside the plastic cover.

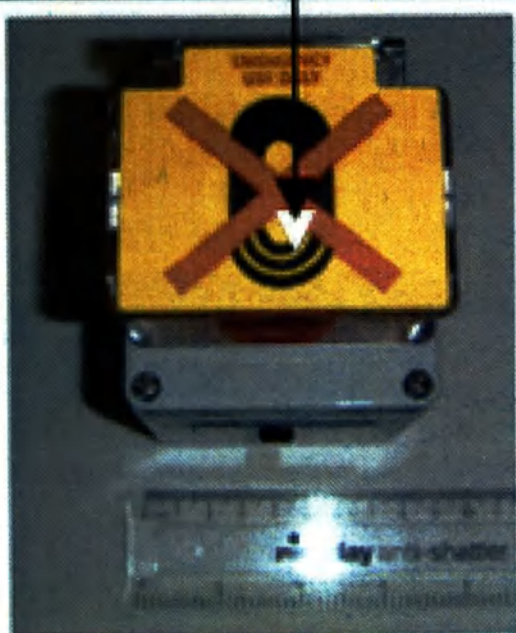

5. Камера для экранирования радиочастот (пол, стена, потолок, окно, двери).

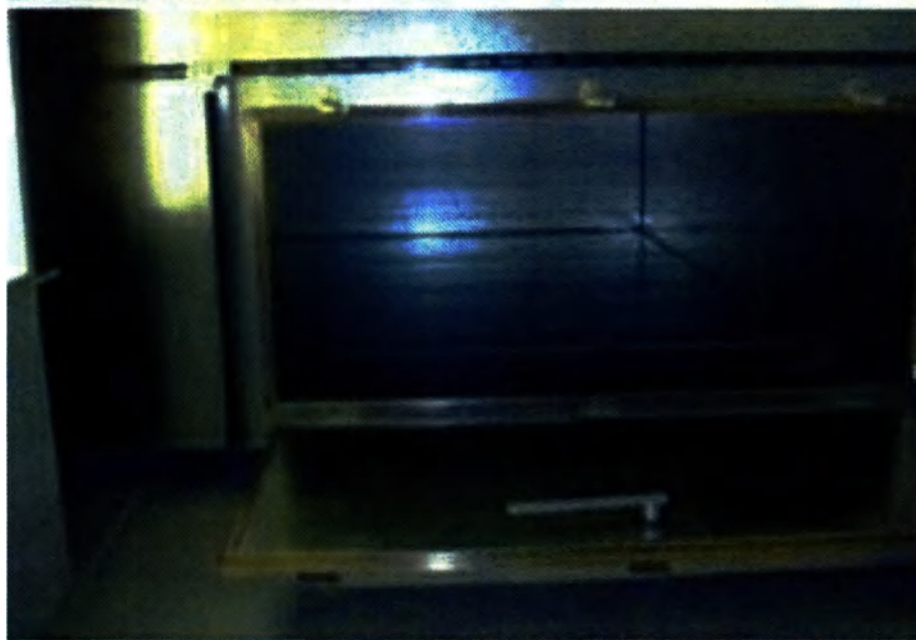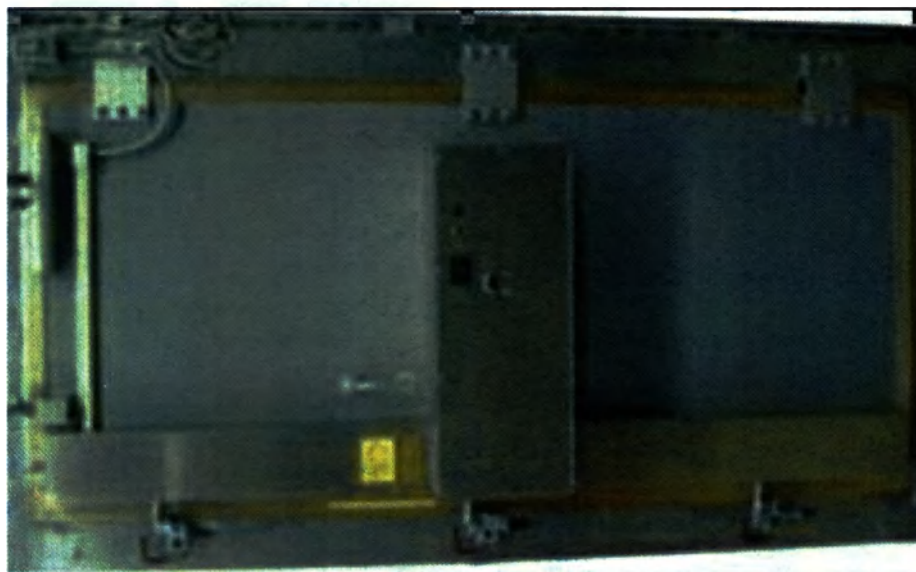

6. Система кондиционирования воздуха .

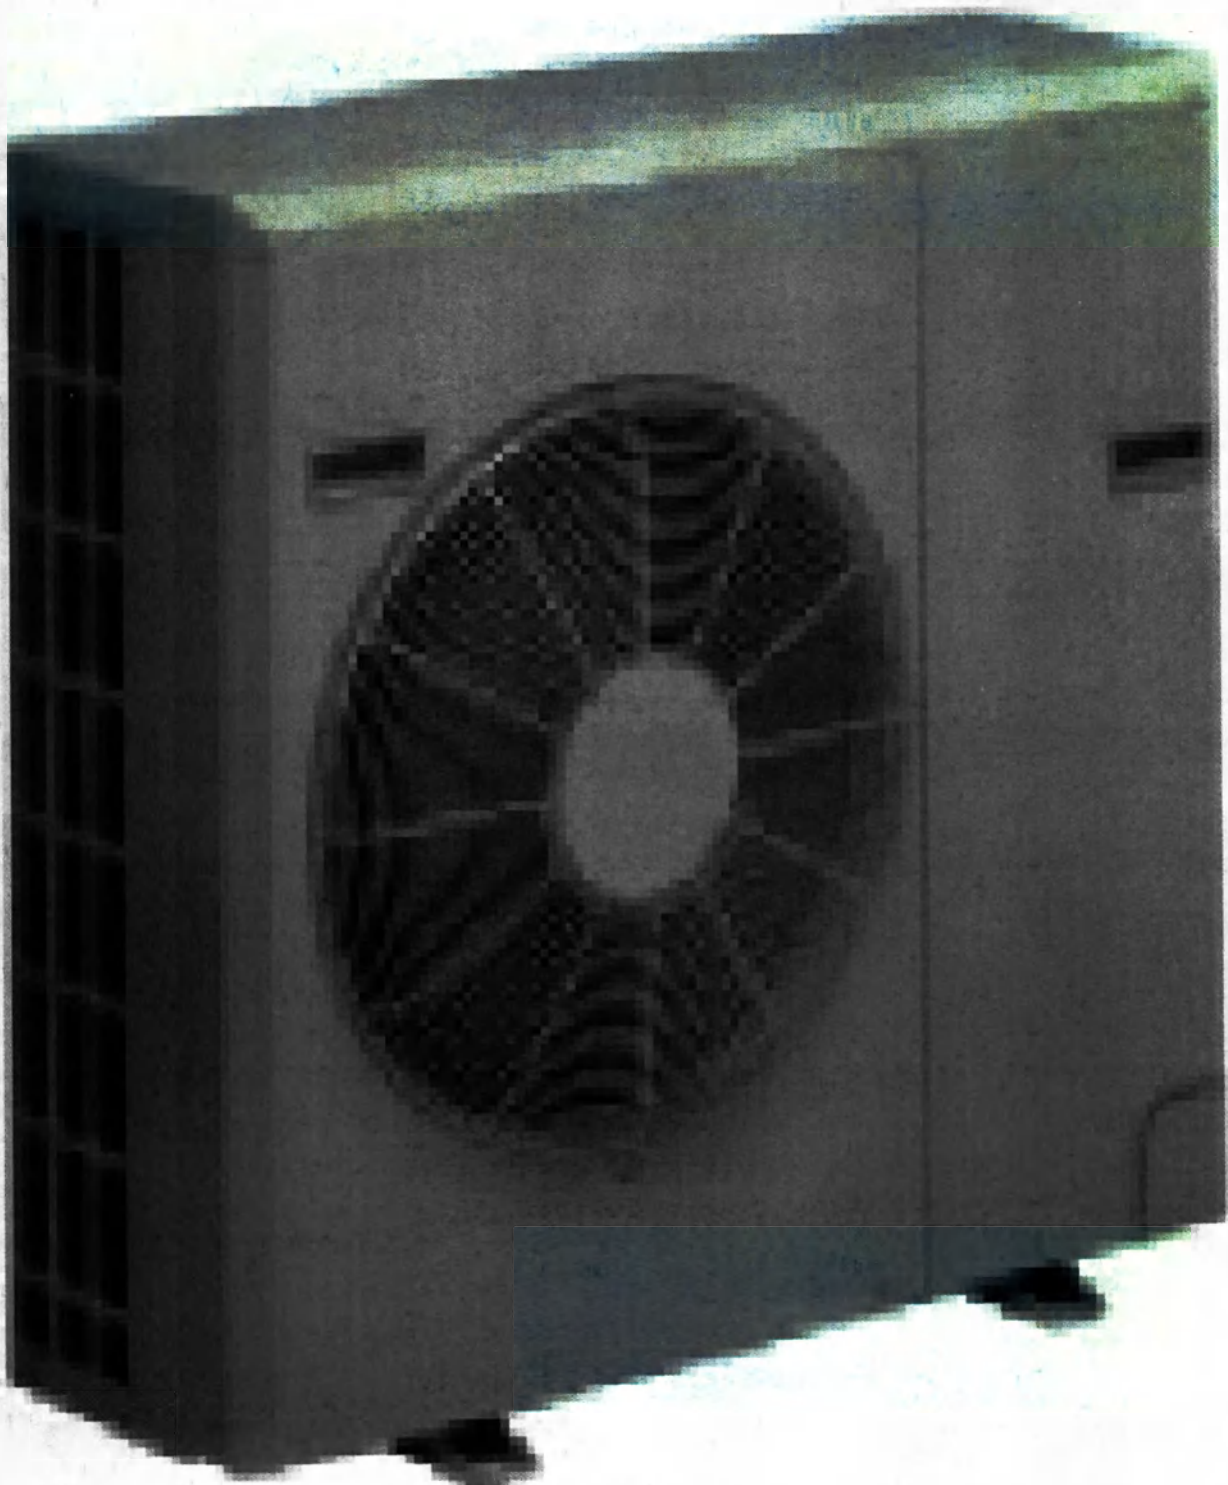

7. Устройство телескопического выдвижения стола пациента с программным обеспечением.



8. Программное обеспечение для трехмерной фазированной контрастной ангиографии.
9. Программное обеспечение для автоматического контроля отклонений.
10. Клавиатура/мышь.



11. Стеллаж для хранения катушек и фантомов.




12. Лазерная камера (устройство для печати медицинских изображений).




13. Источник резервного (бесперебойного) питания.



14. Каталка немагнитная.

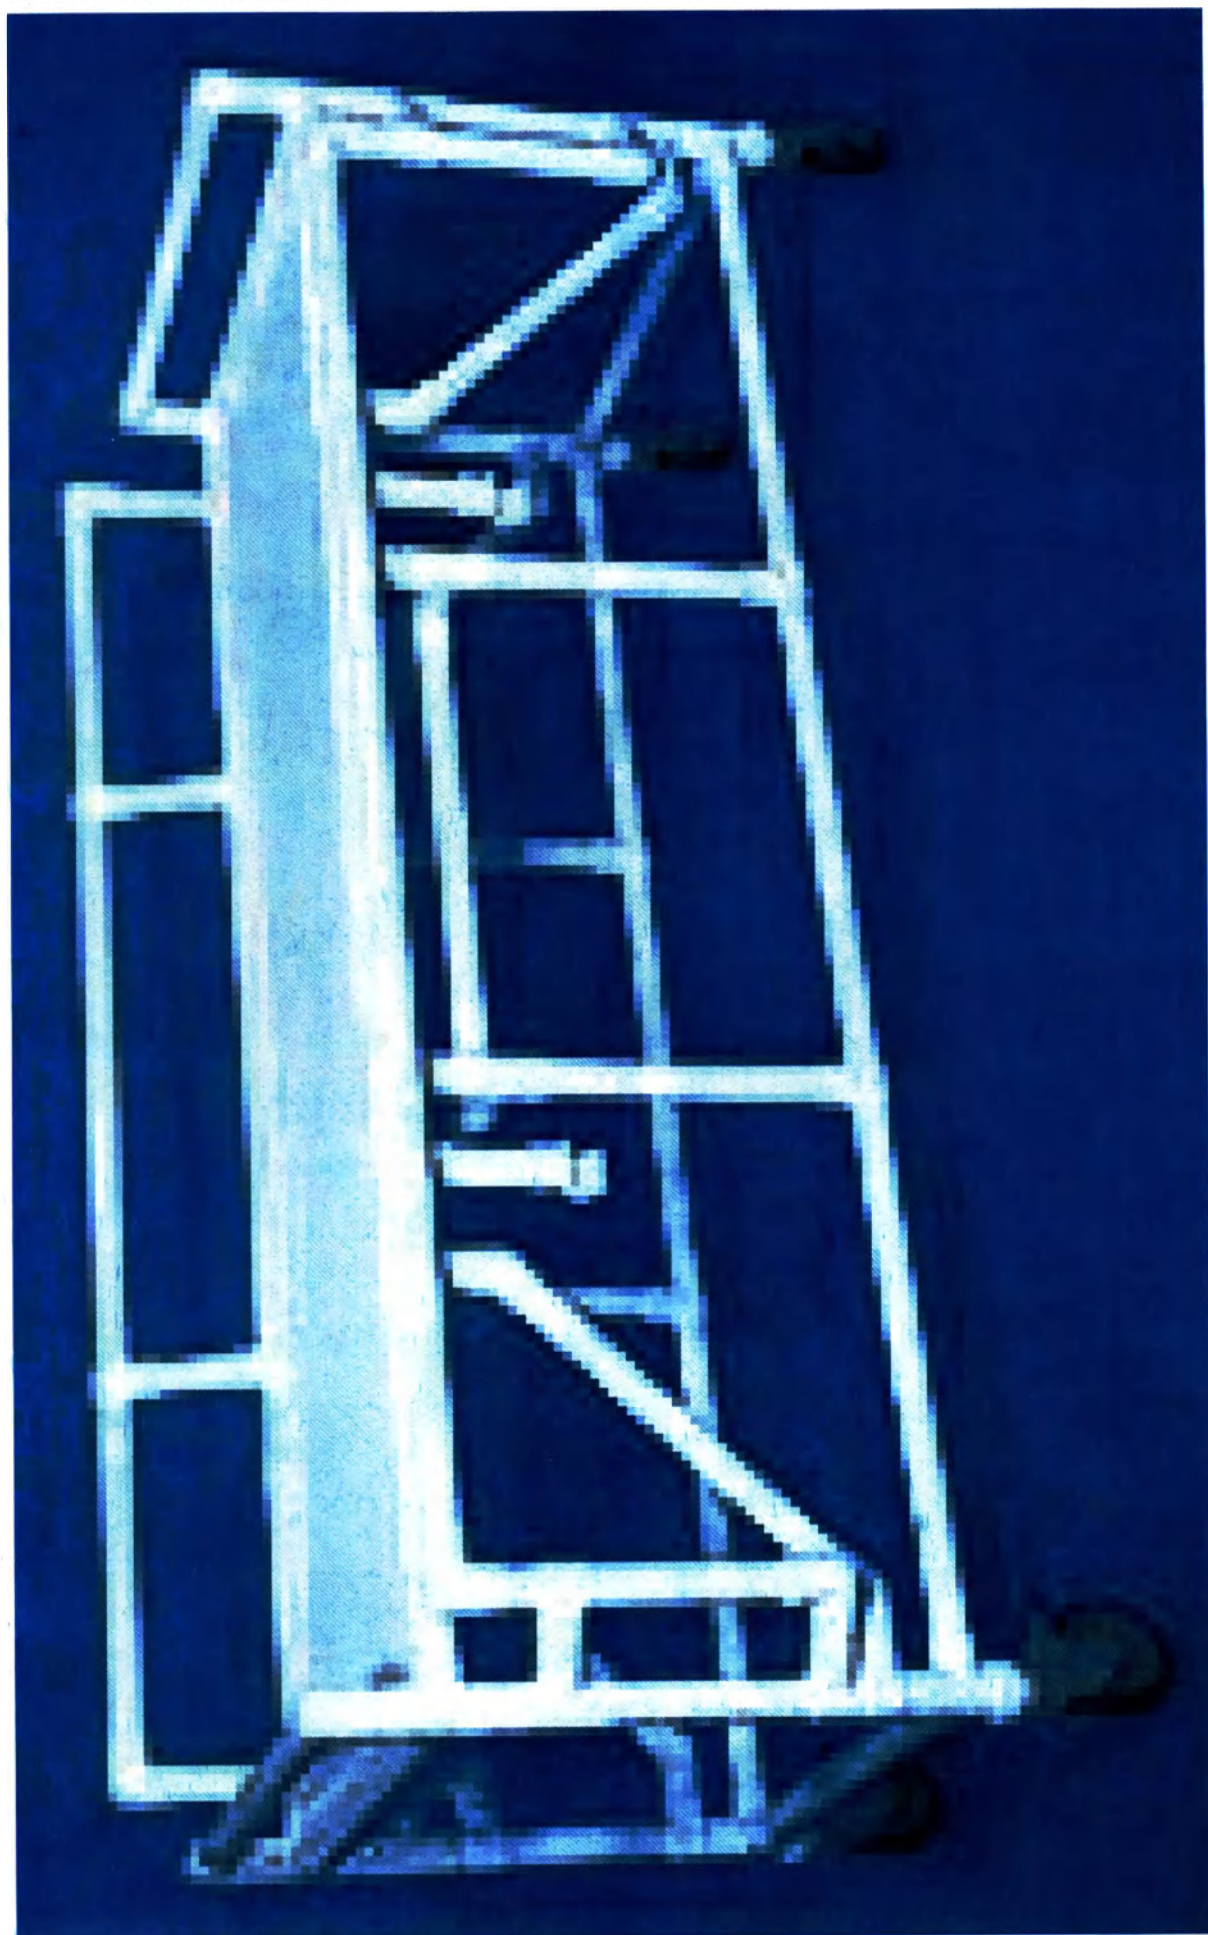

15. Приспособление немагнитное для перекладки пациента.

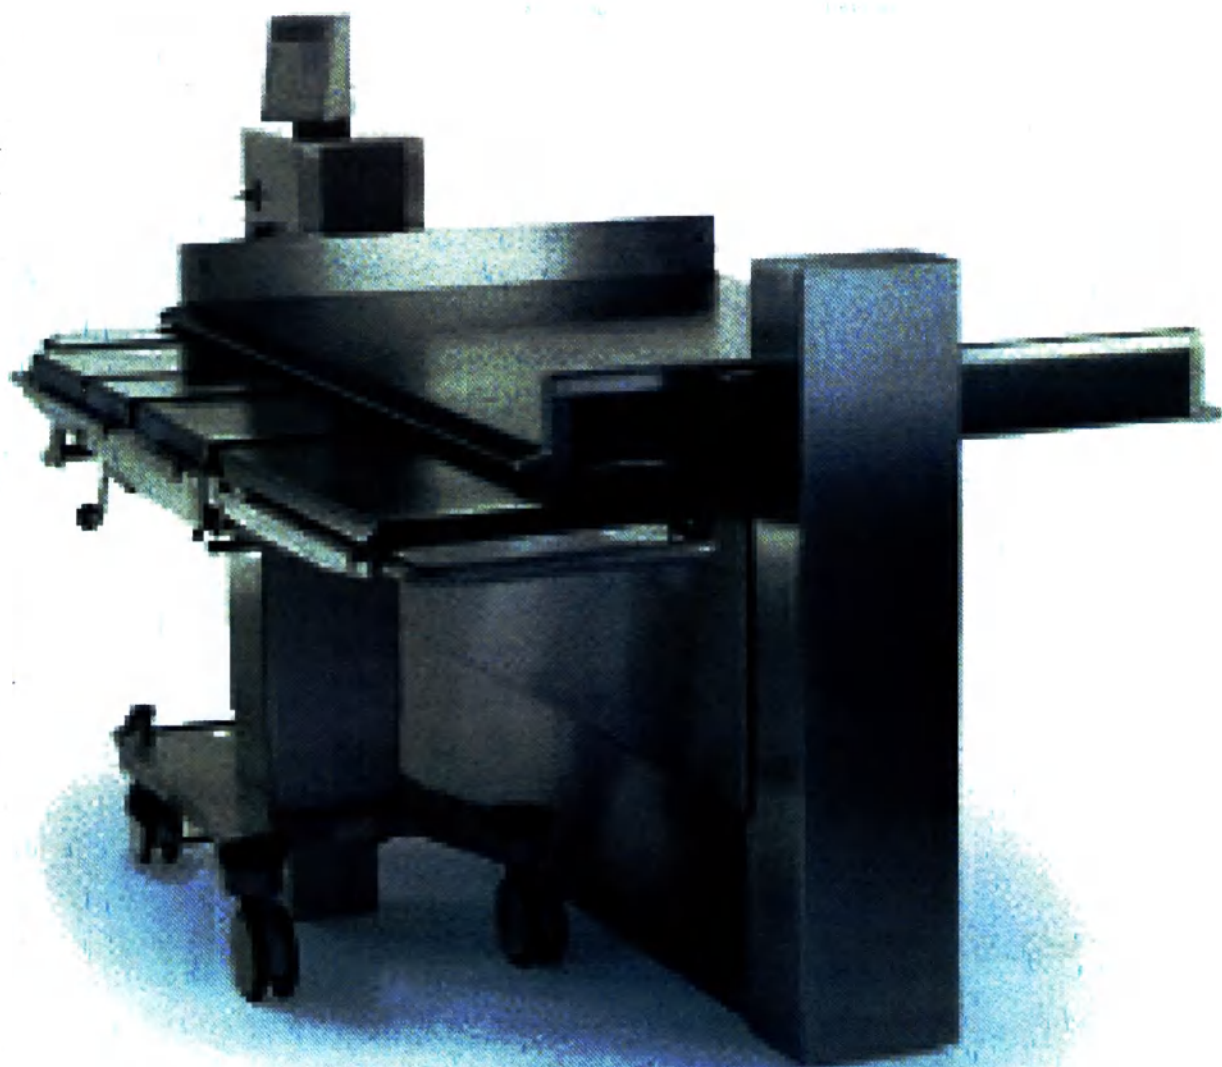

16. Рабочая станция для обработки медицинских изображений (дополнительная).




16. Рабочая станция для обработки медицинских изображений (дополнительная).





17. Набор для монтажа:

- Электрический кабель силовой и сигнальный, не более 60 шт.

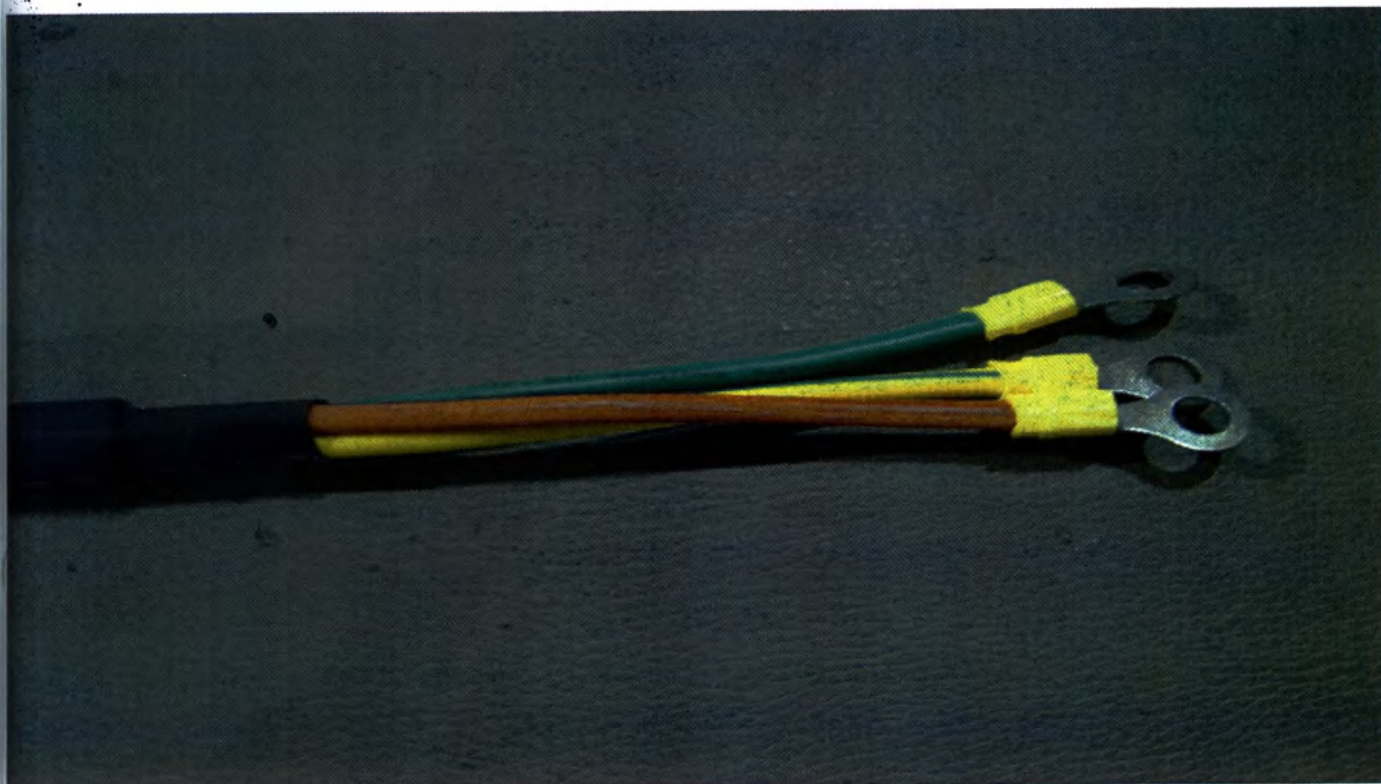

- Переключатель, не более 20 шт.



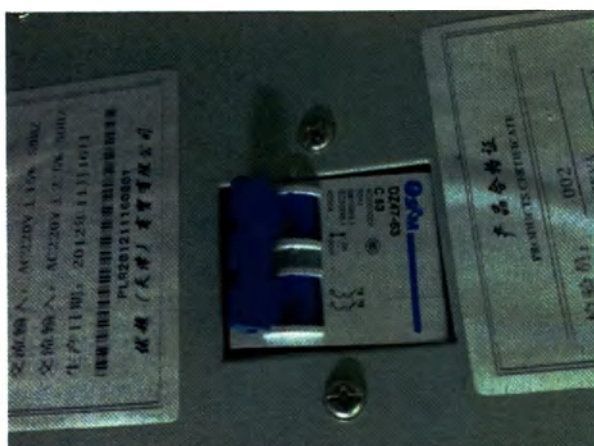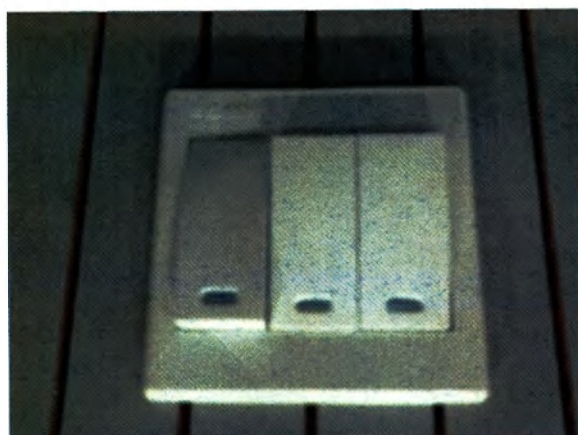

- Реле, не более 10 шт.



394

- Тележка транспортировочная, не более 4 шт.





395


- Балка транспортировочная, не более 4 шт.



- Крепеж из немагнитных материалов, не более 60 шт.

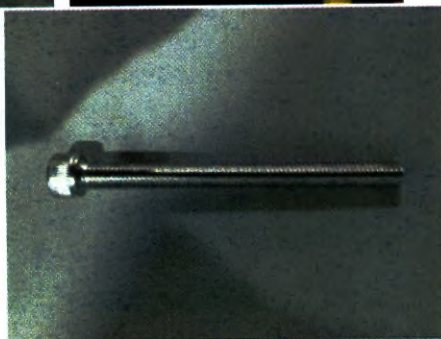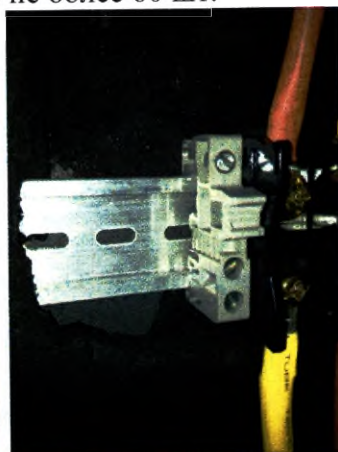

- Шланги силиконовые с армированием текстильной нитью для подключения водяного контура охлаждения, не более 4 шт.

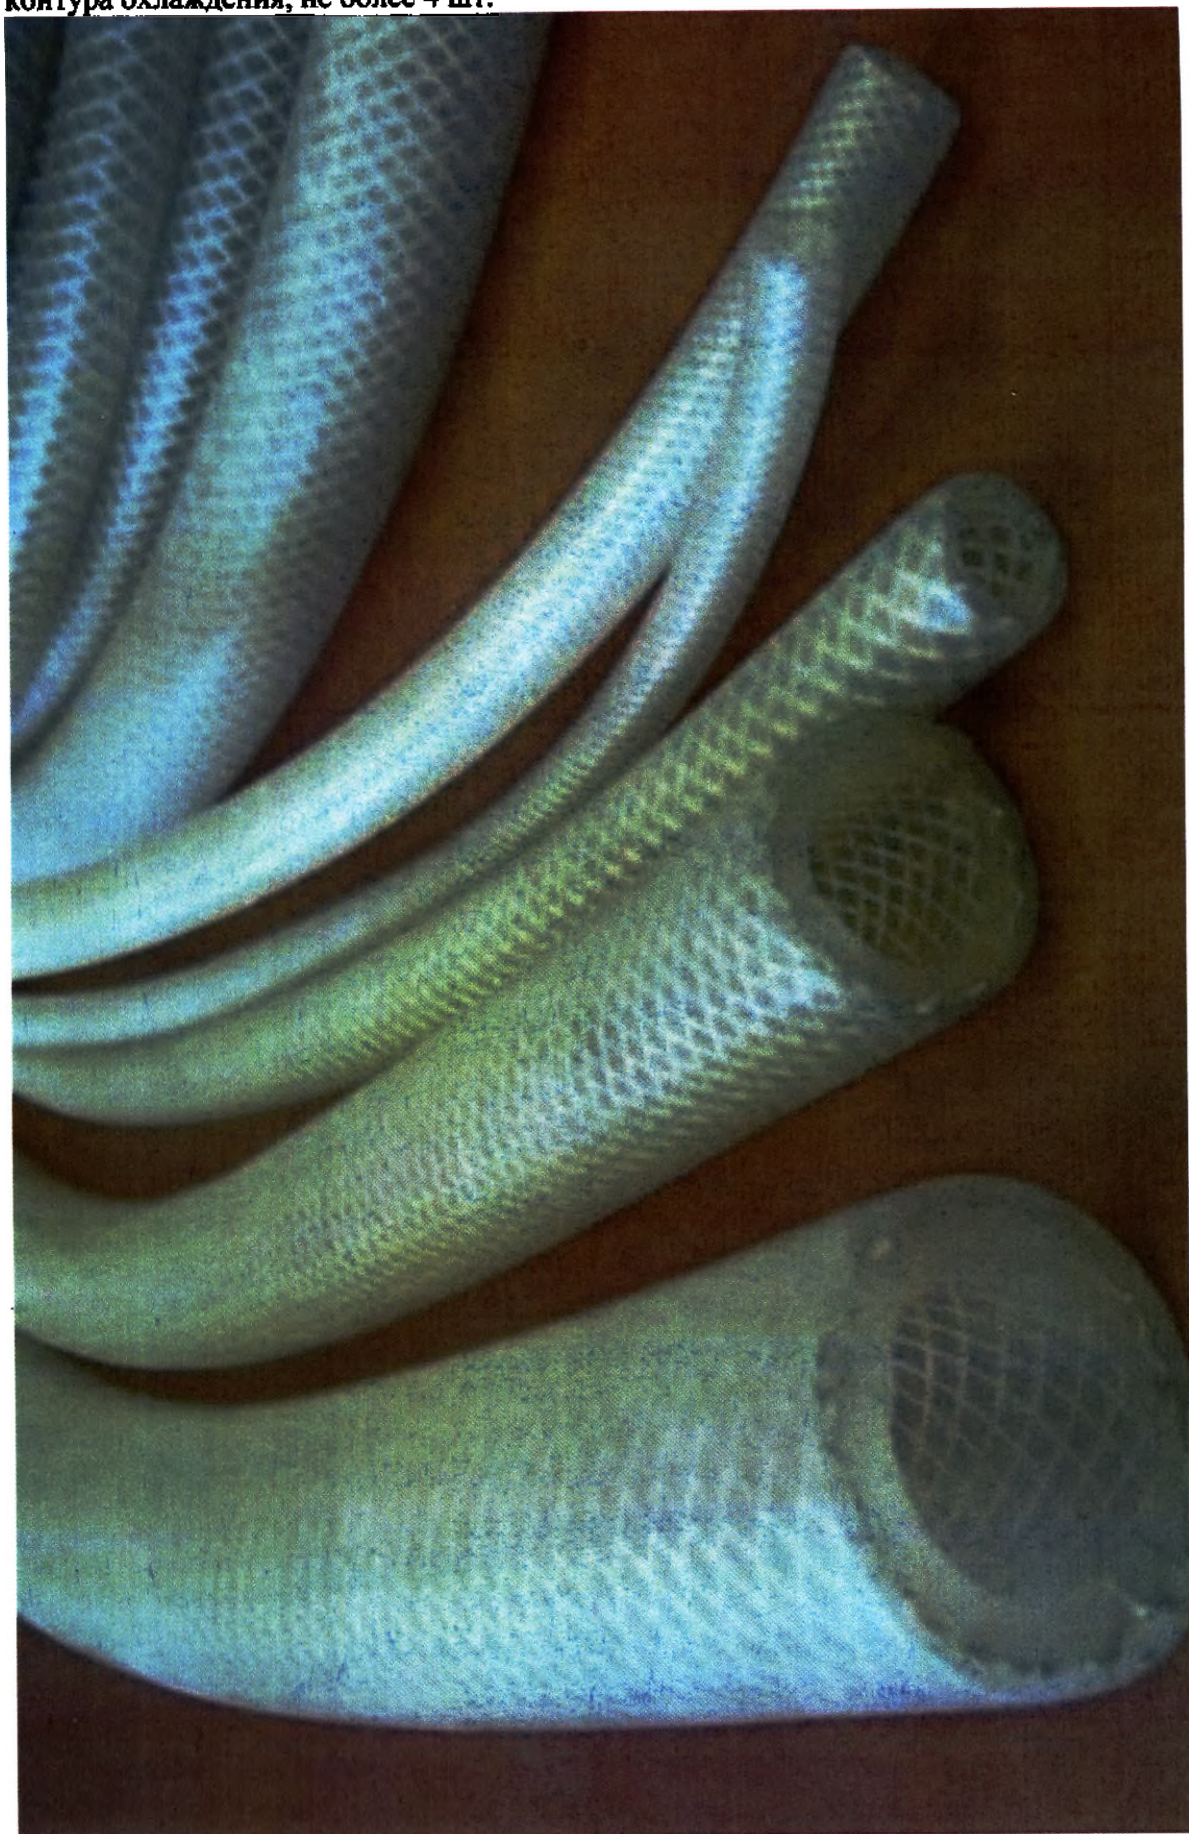

18. Специальный немагнитный инструмент для монтажа МРТ (ключи, отвёртки, плоскогубцы, шестигранные ключи, кусачки) – не более 20 шт.



Генеральный директор
ООО "Первая медицинская компания"



Д.Ф. Зубарев

Всего пронумеровано,
пронумеровано и
скреплено печатью
1097
«Первая медицинская
компания»
ООО * ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * МОСКВА * 503356