

ПОДТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ФУДЖИФИЛЬМ РУС»

Кеничи Танака



Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики in vitro

**«Слайды для количественного определения липазы поджелудочной железы FUJI DRI-CHEM SLIDE
LIP-P на анализаторе FUJI DRI-CHEM в составе»**

производства «ФУДЖИФИЛЬМ Корпорейшн». Япония (FUJIFILM Corporation)

Фото 1. Слайды для количественного определения липазы поджелудочной железы FUJI DRI-CHEM SLIDE LIP-P на анализаторе FUJI DRI-CHEM в составе

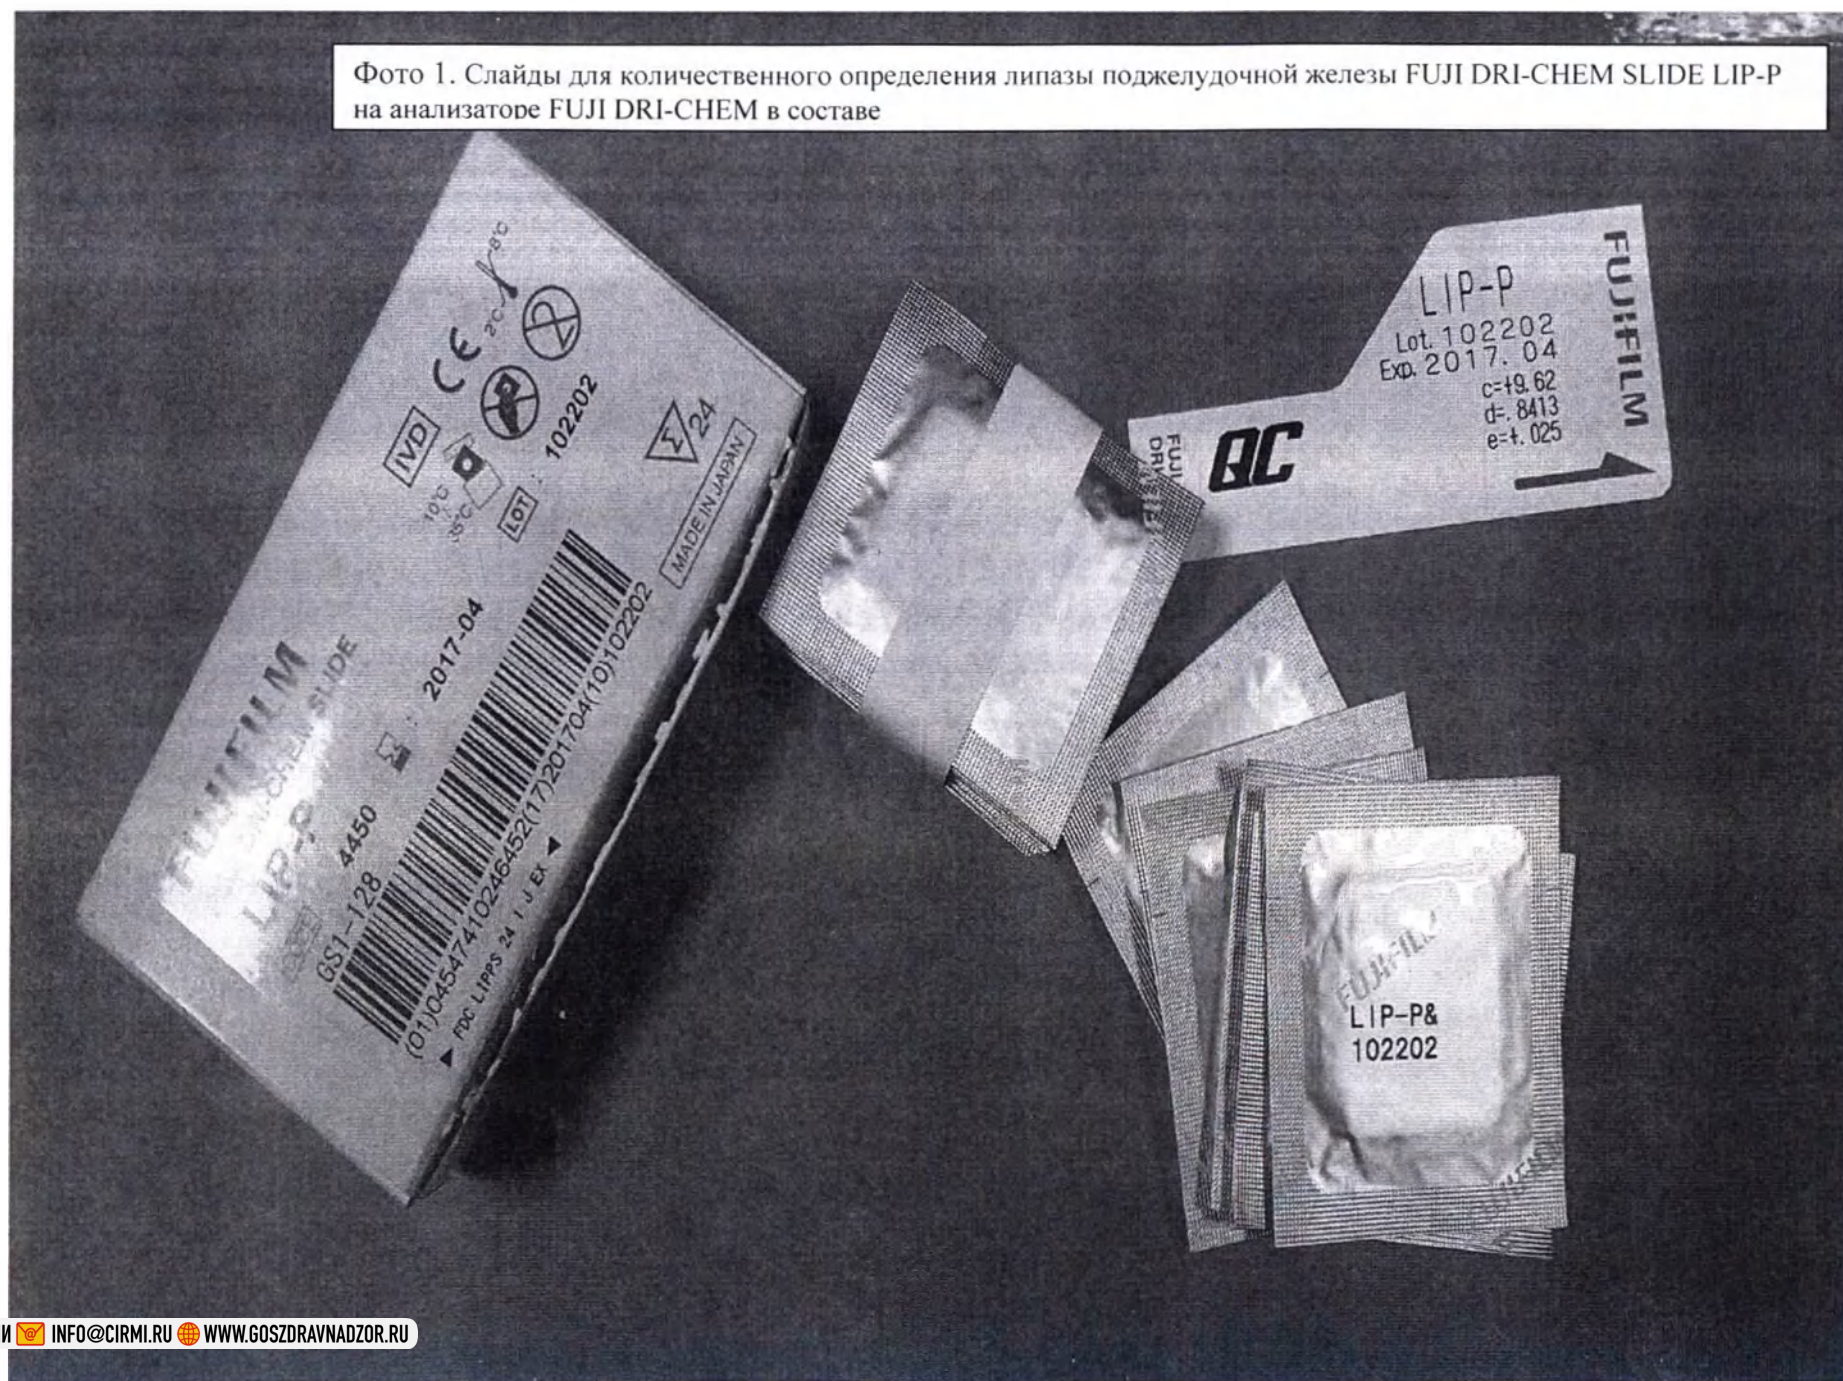


Фото 2. Слайды для количественного определения липазы поджелудочной железы FUJI DRI-CHEM
SLIDE LIP-P на анализаторе FUJI DRI-CHEM


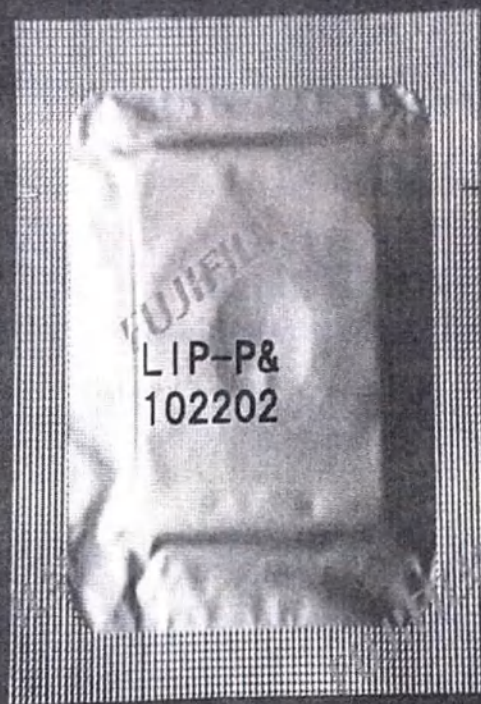


Фото 3. Контрольная карта



Всего пронумеровано, прошито и
скреплено печатью 4 лист (a)

Генеральный директор

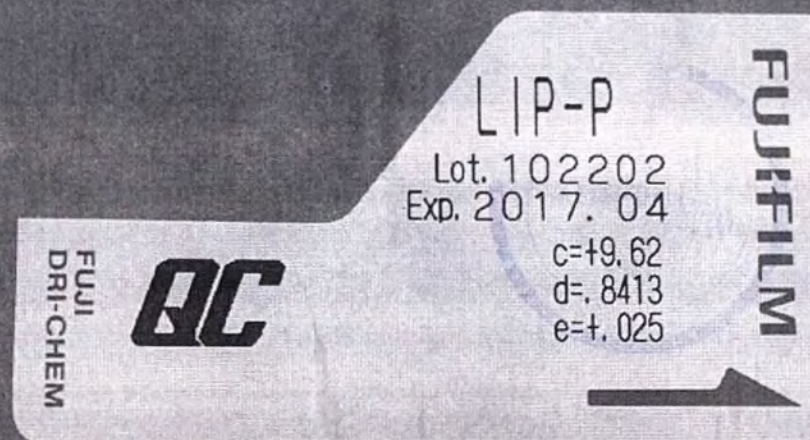

Кеничи Танака

