


1. Блок основной Т5 RUS, ТЭСМ.943119.011-01






1. Блок основной Т5 RUS, ТЭСМ.943119.0111-01

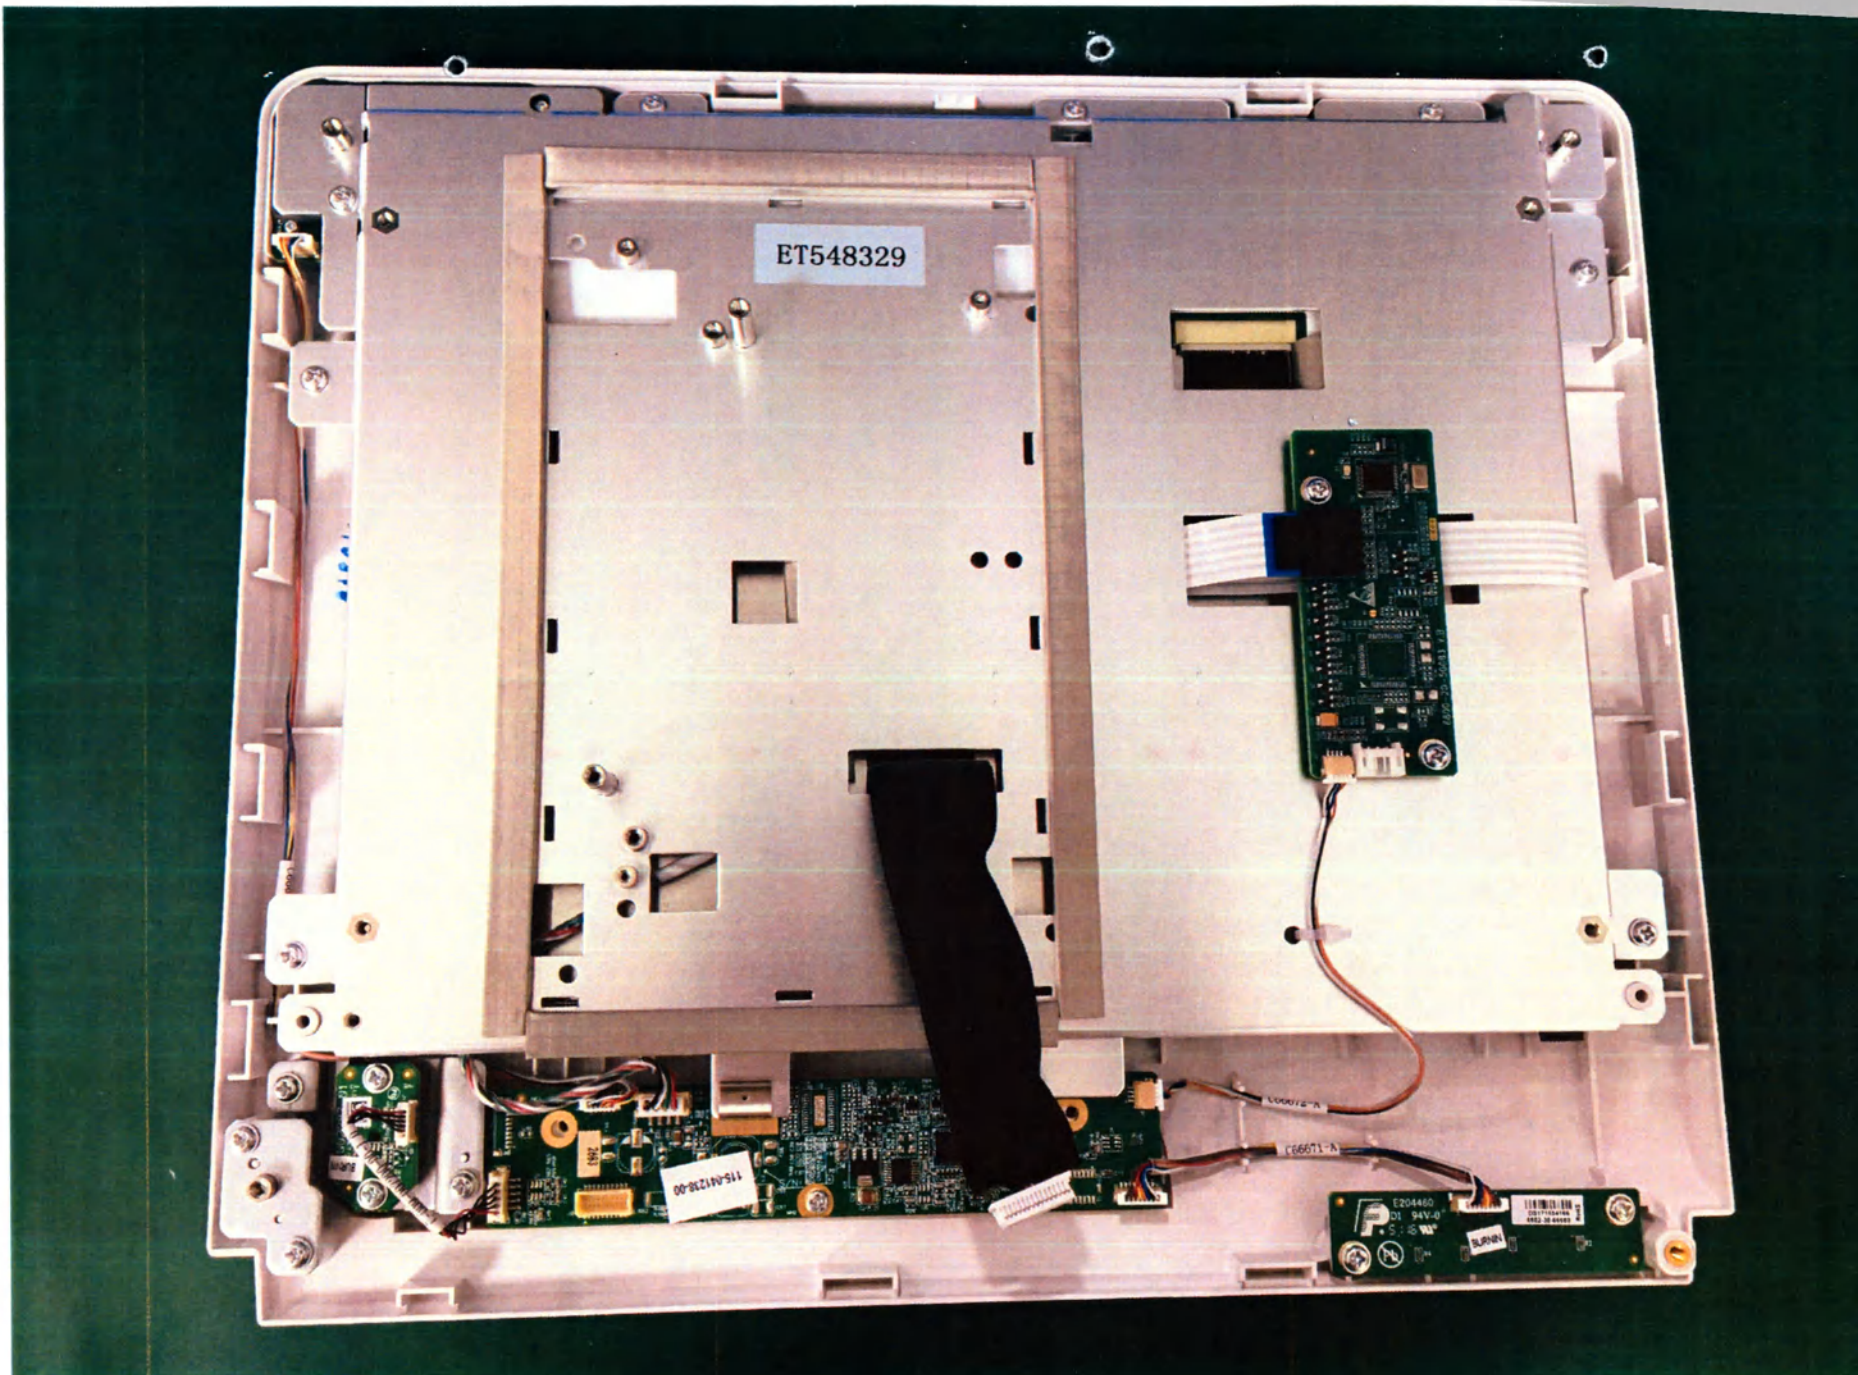



1.2. Дисплейный модуль T5, ET548329

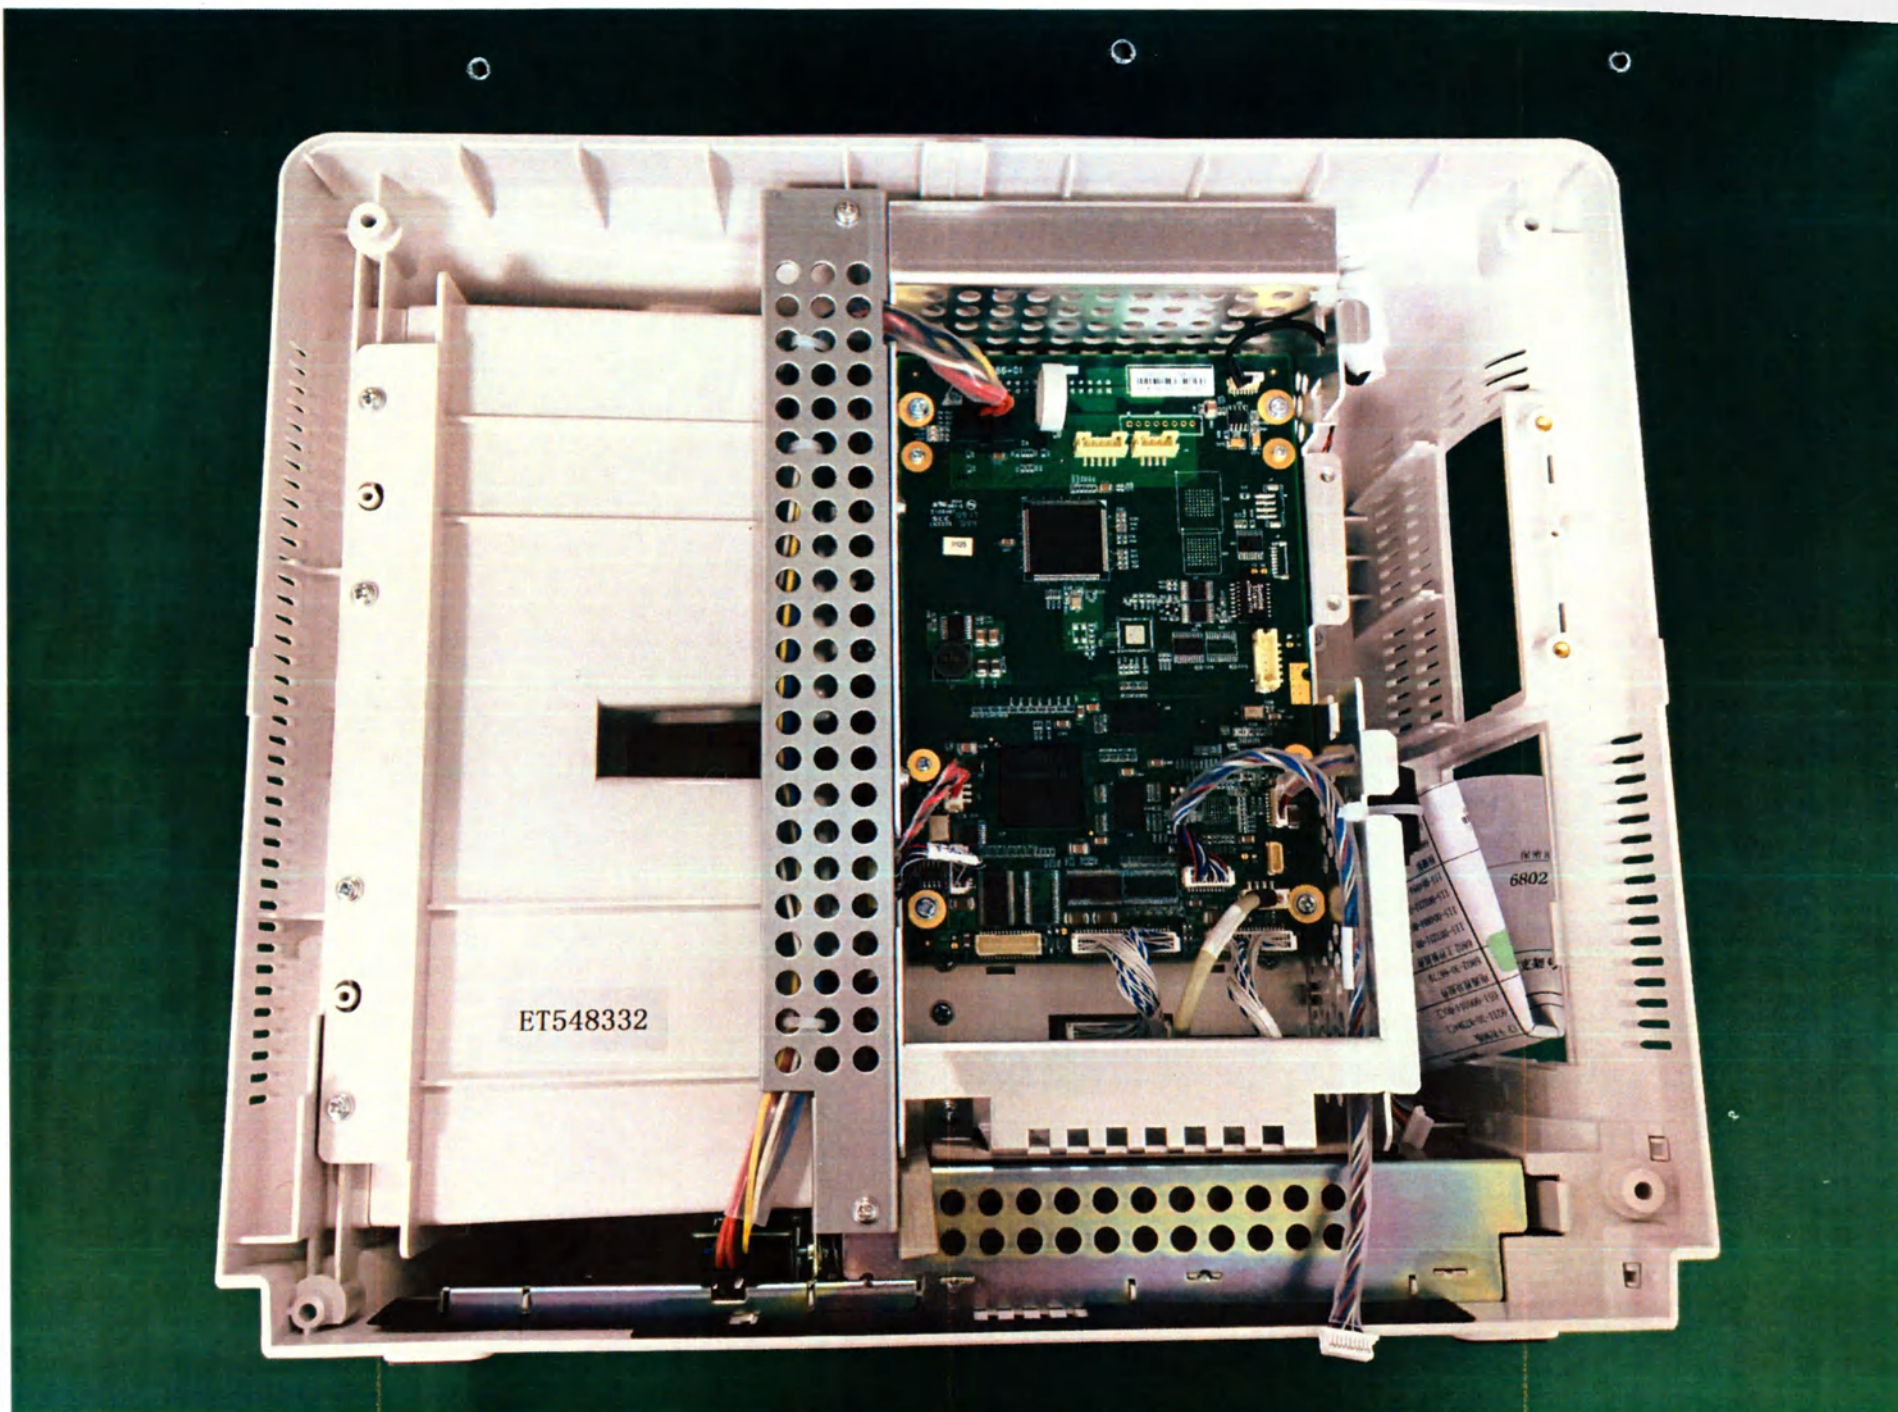


1.3. Электронно-коммуникационный модуль Т5, ET548332

1.4. Термопринтер

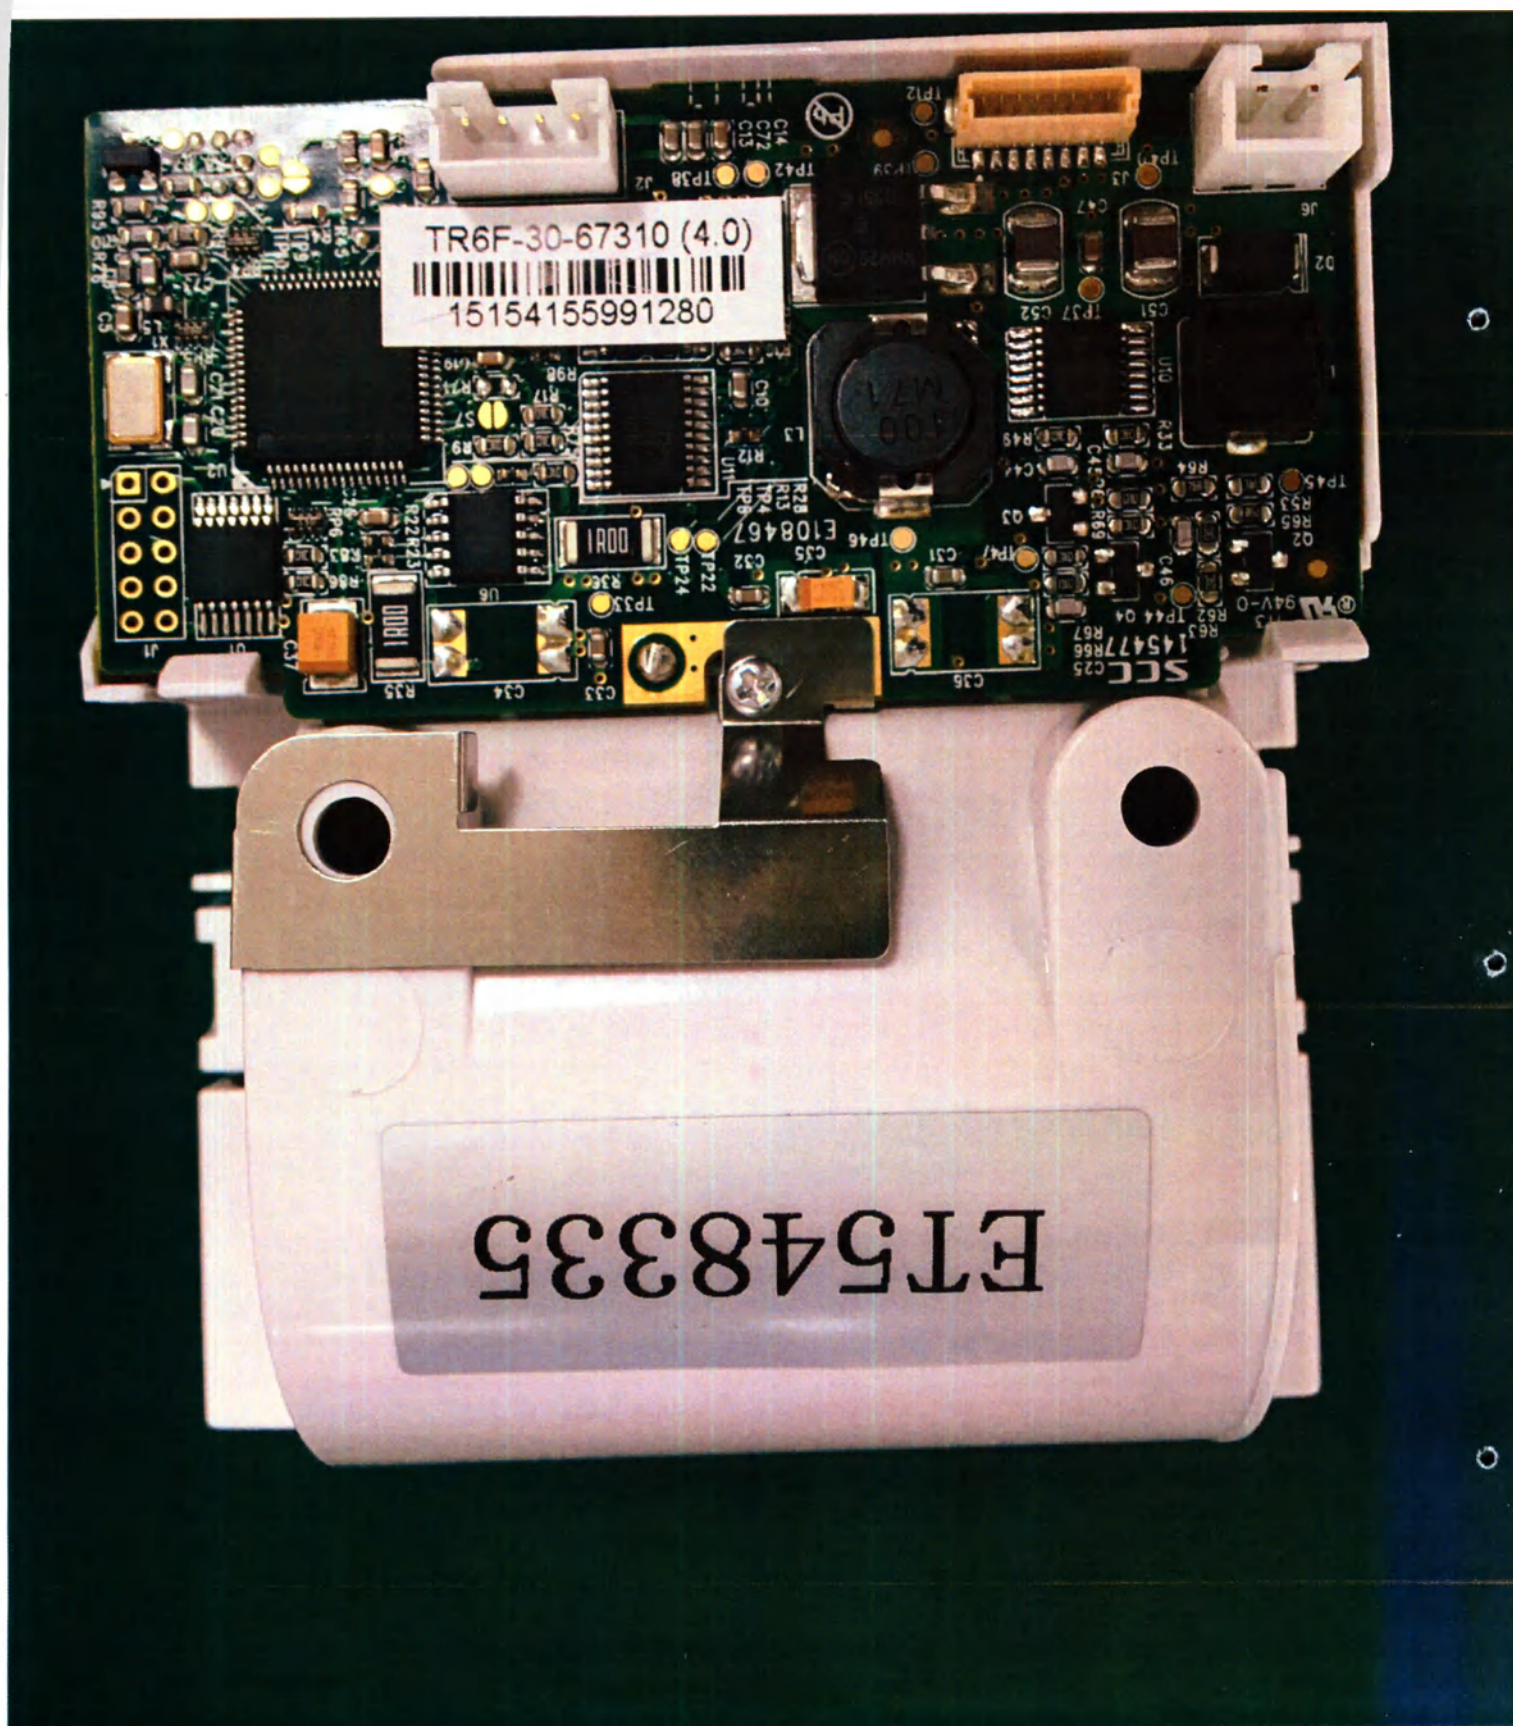


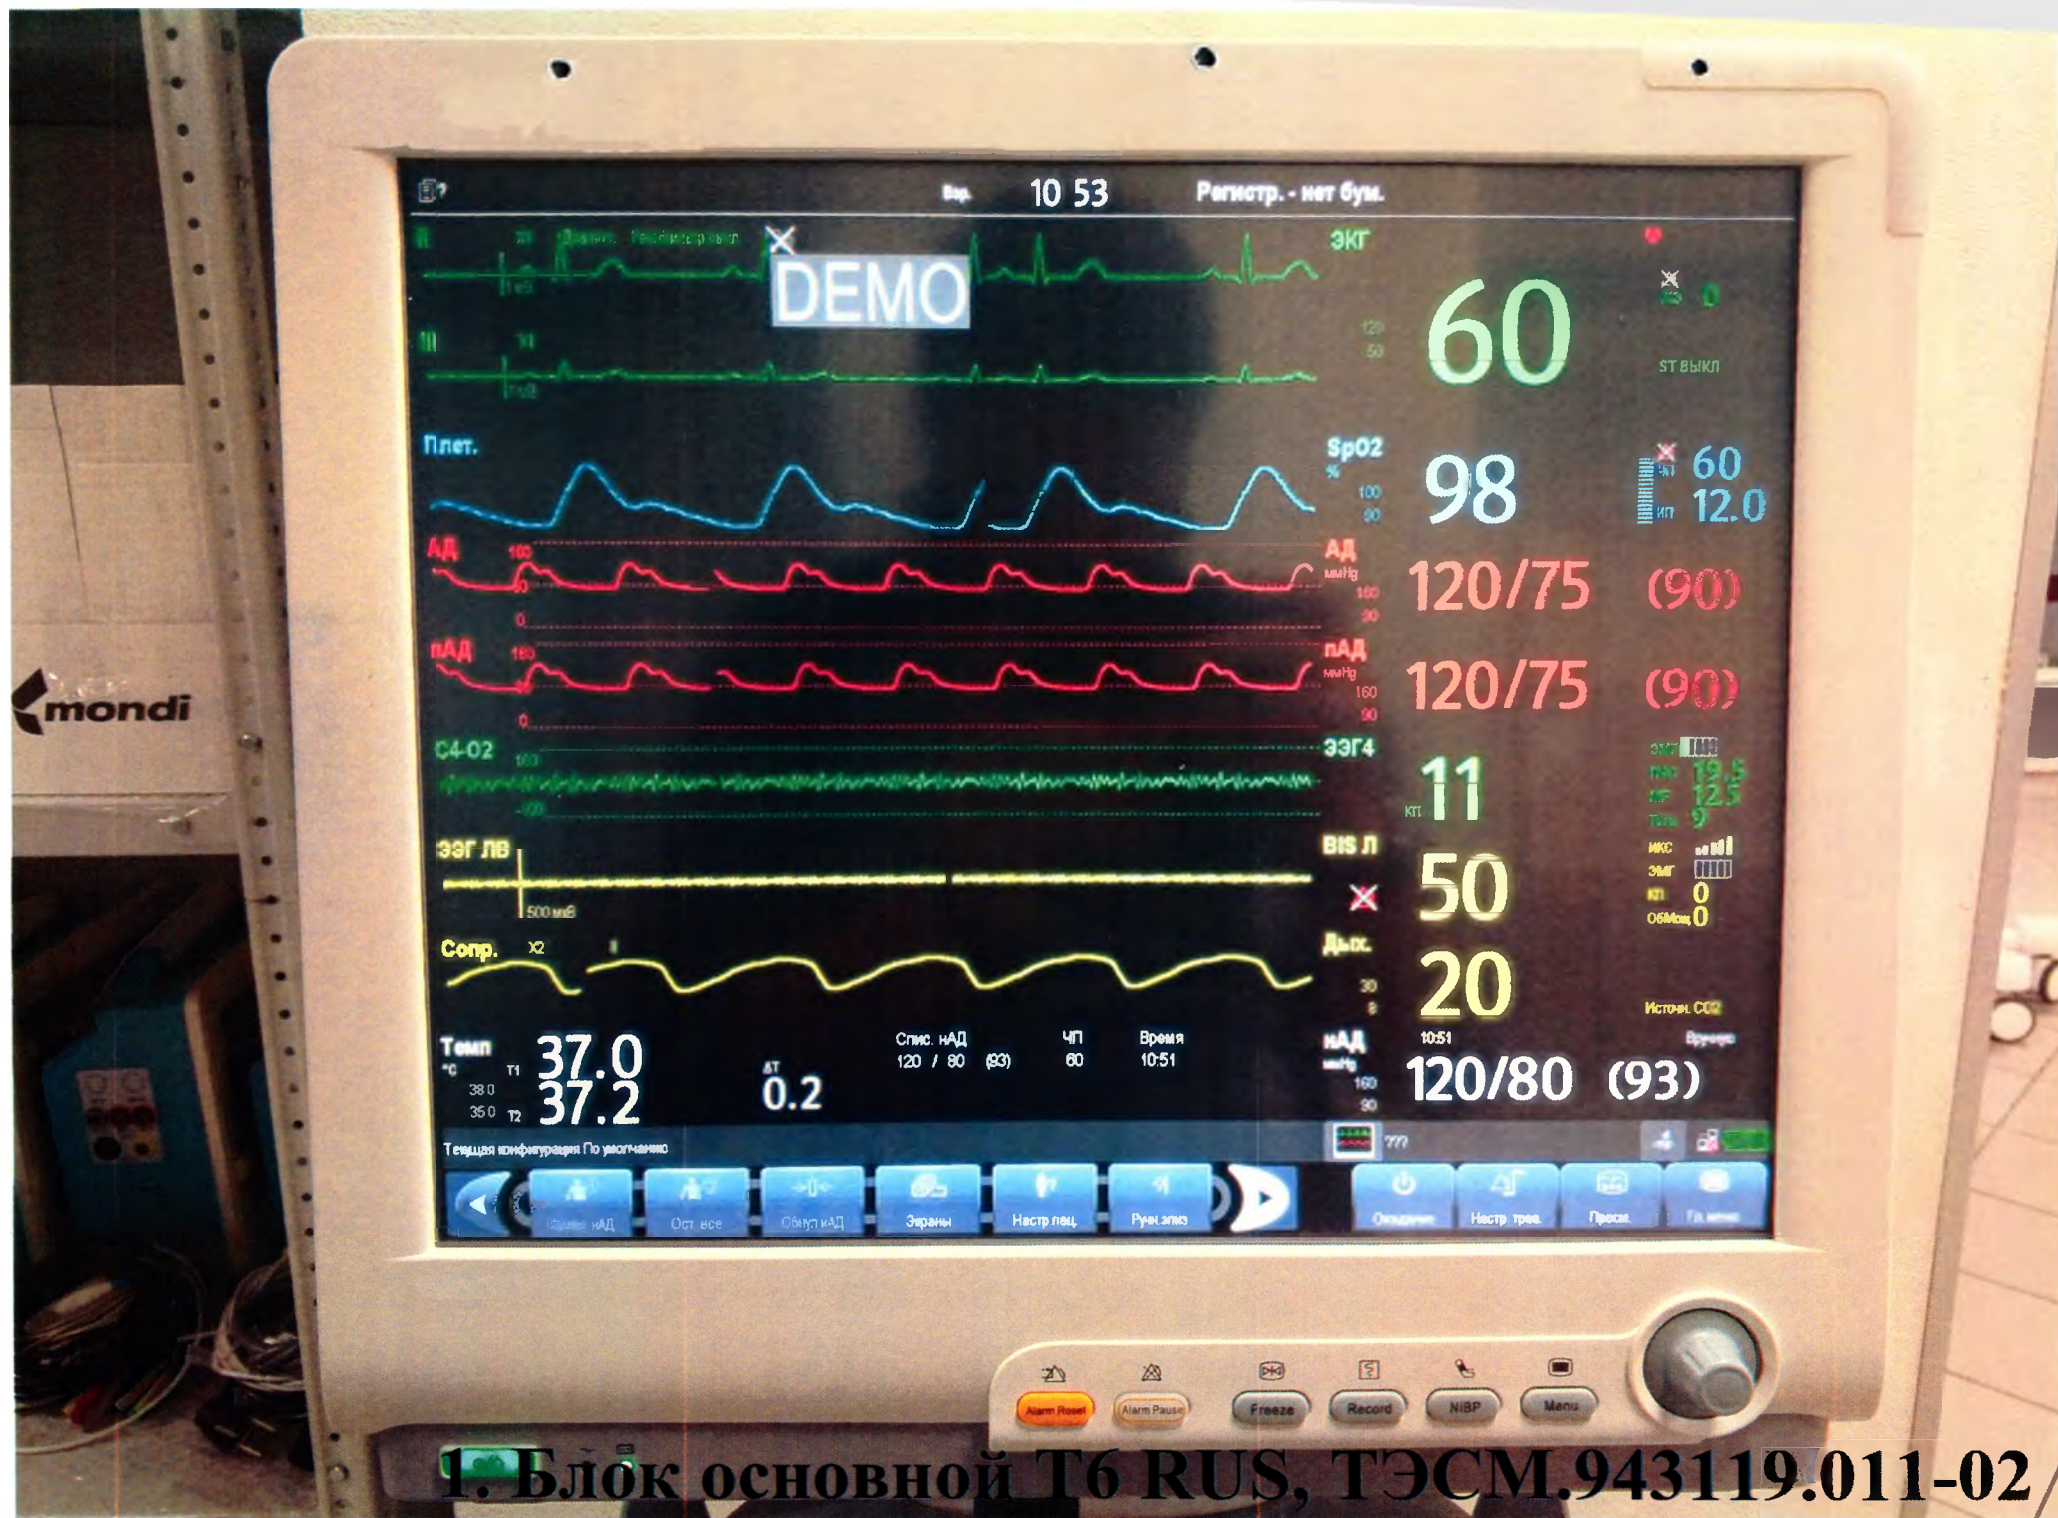


1. Блок основной Т6 RUS, ТЭСМ.943119.011-02/

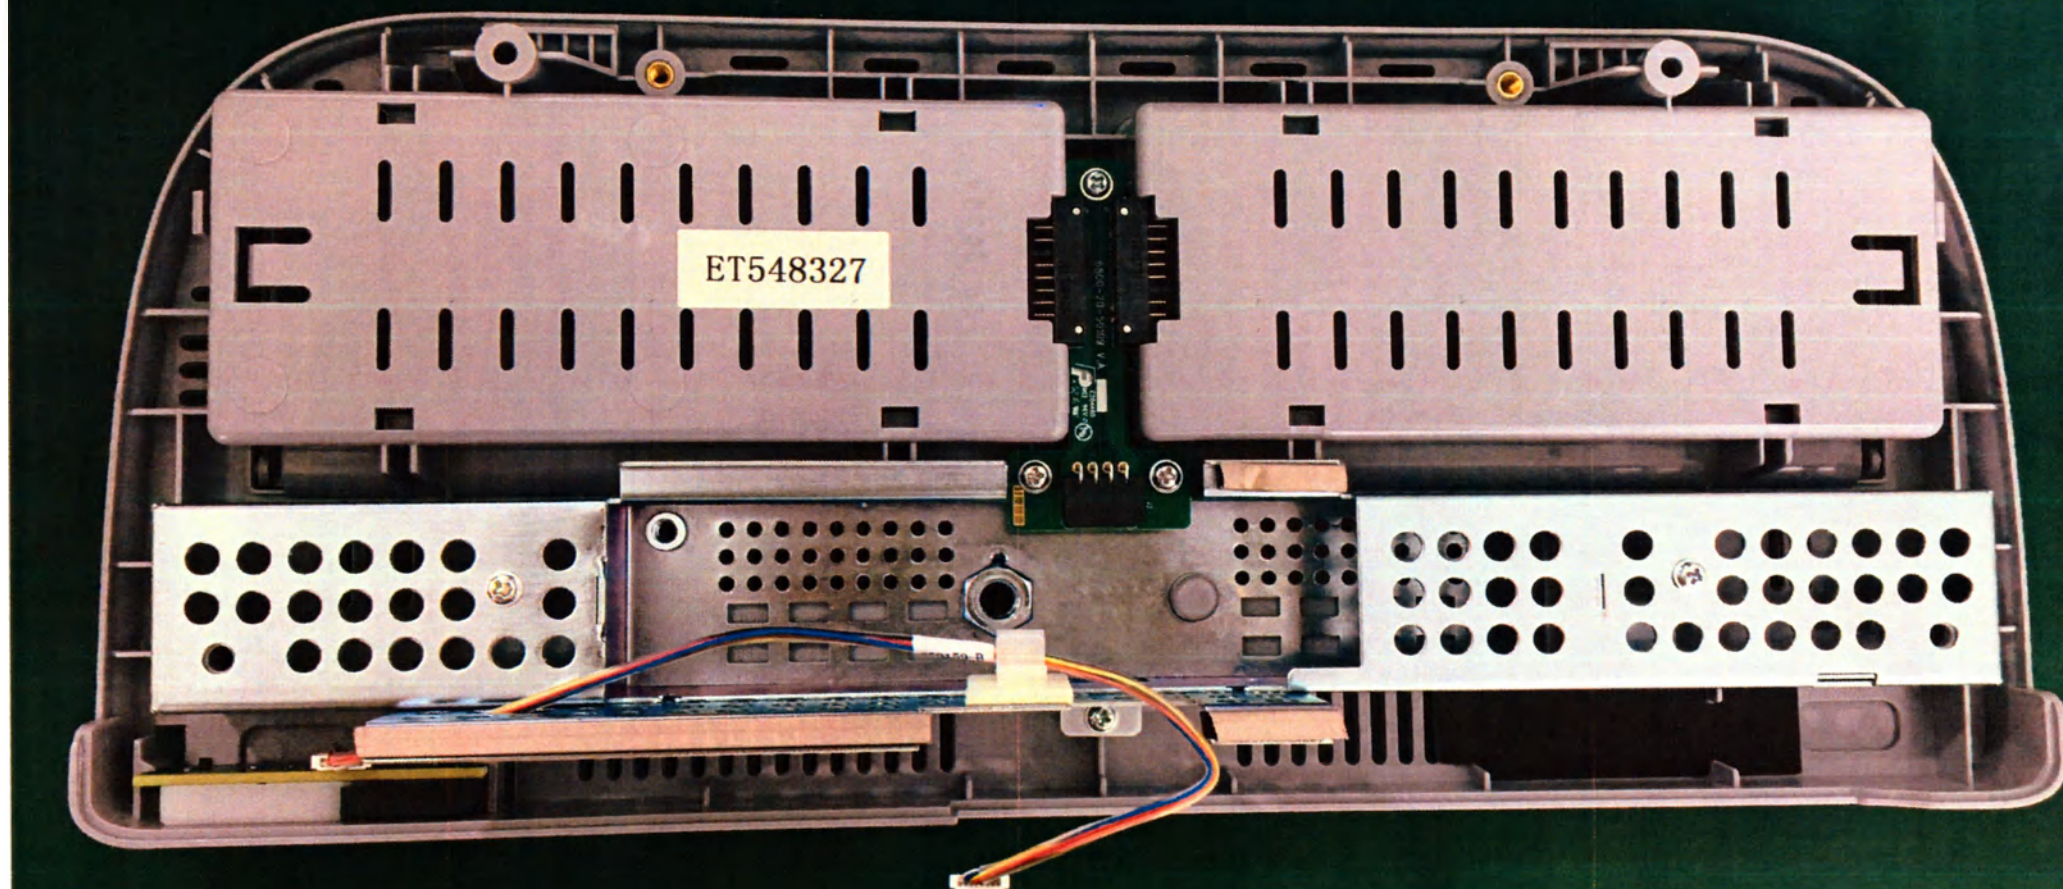

1.1. Модуль питания Т6, ET548327

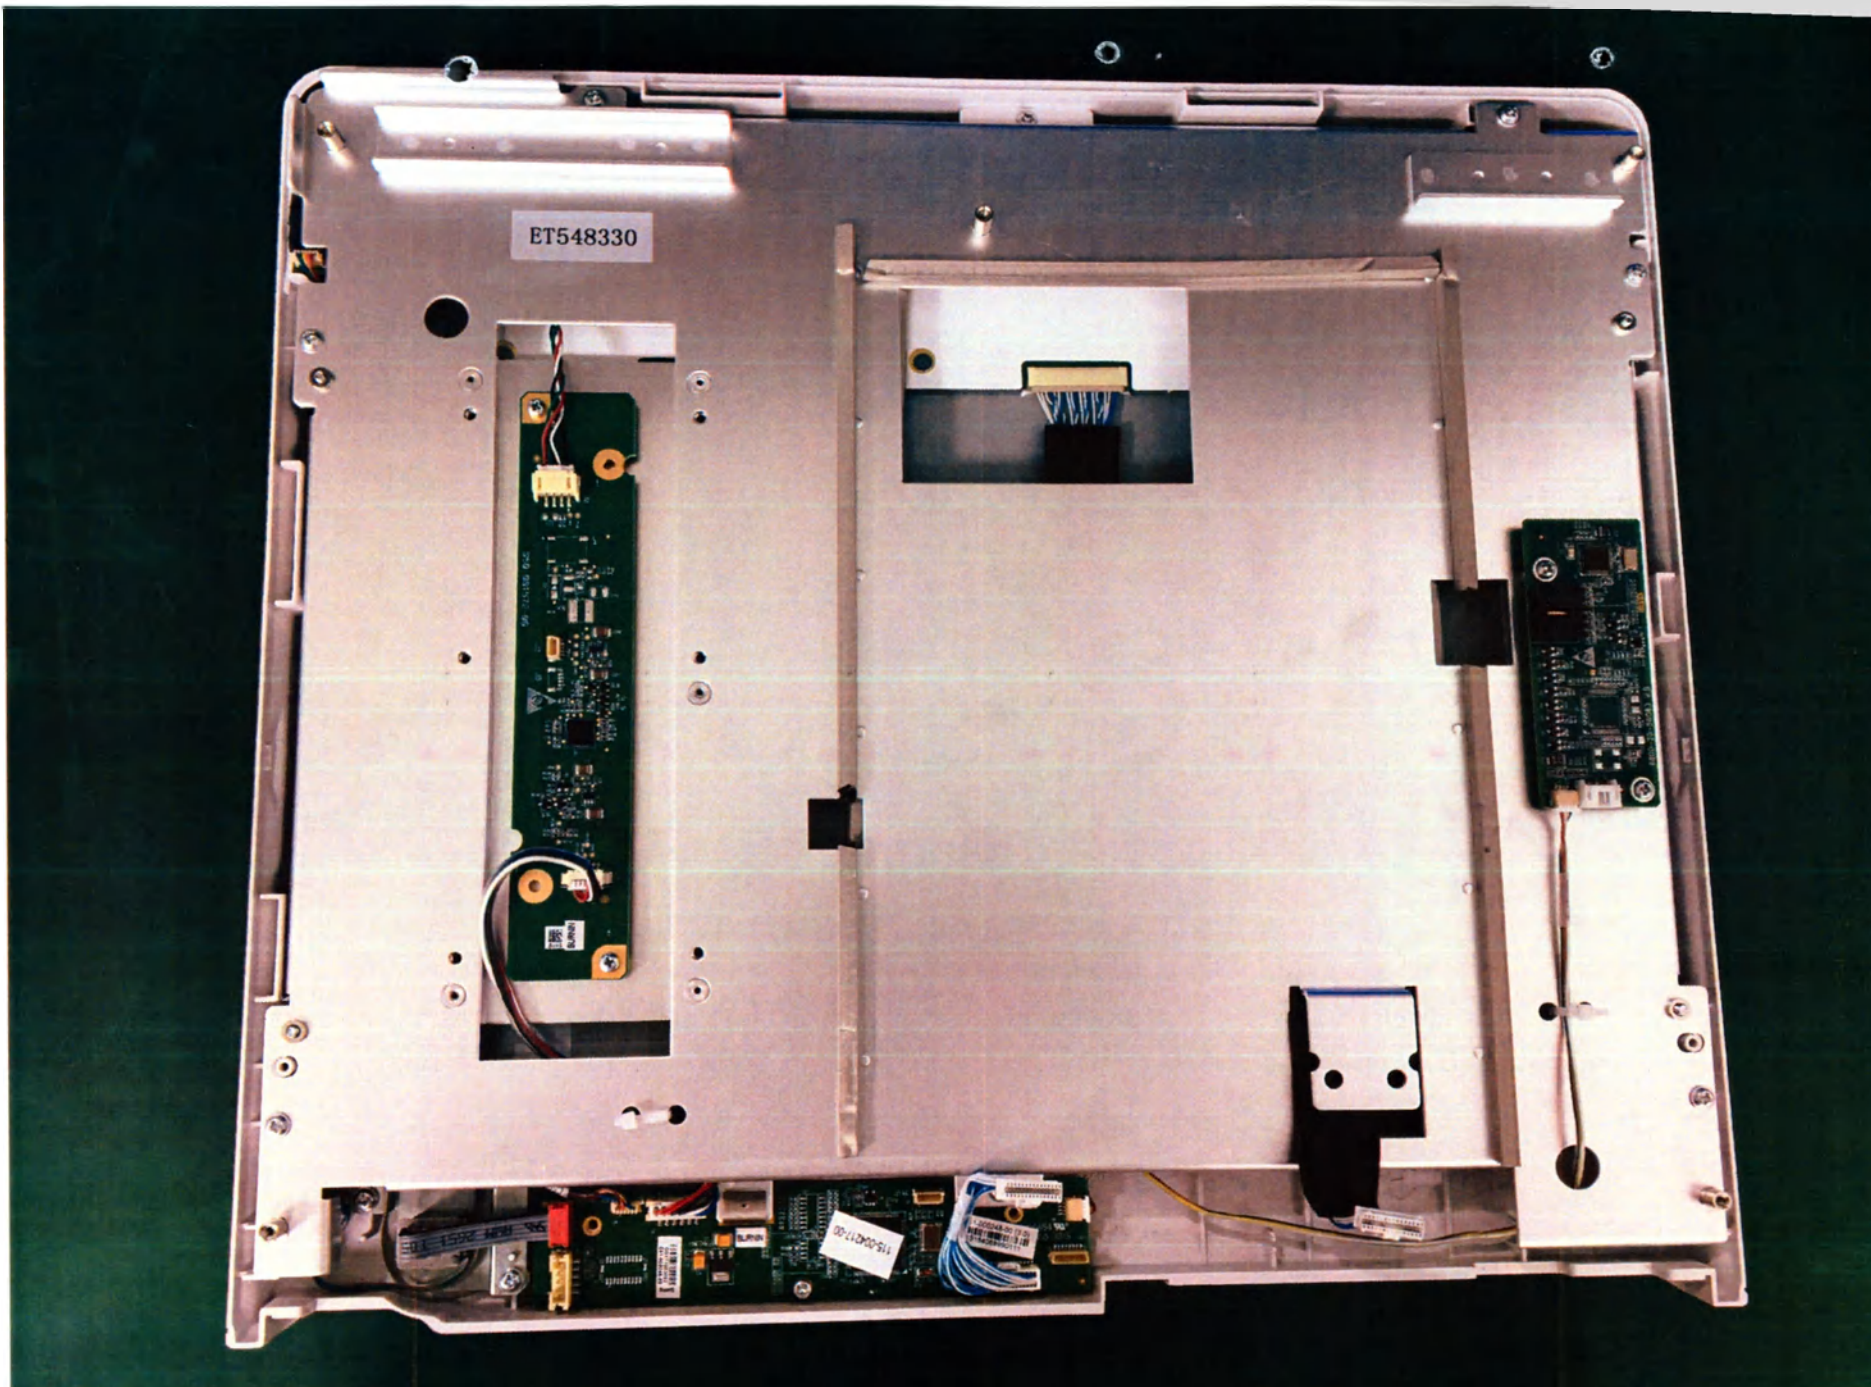


1.2. Дисплейный модуль Т6, ET548330

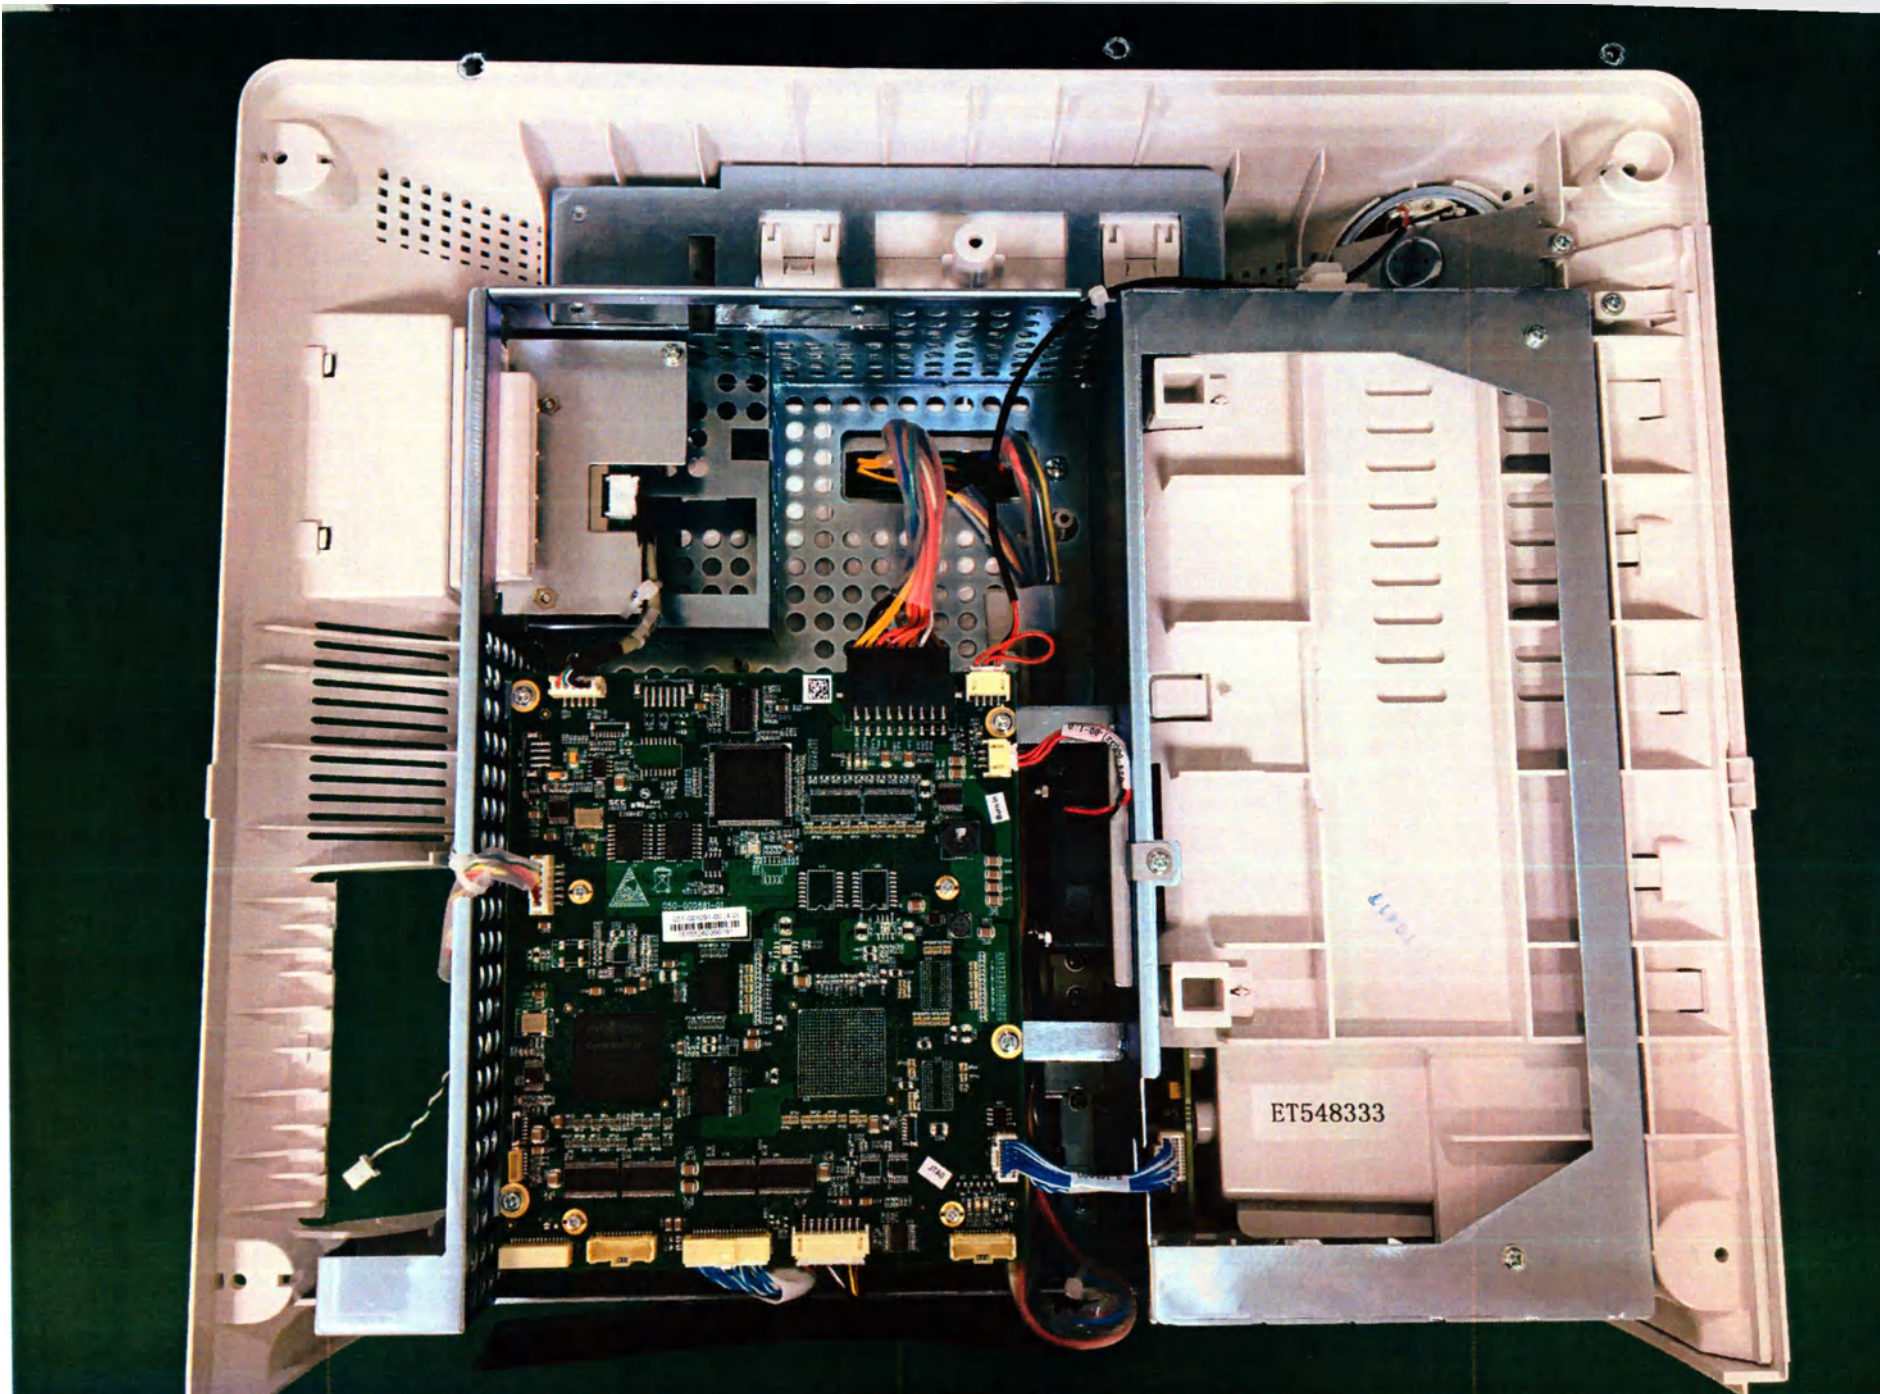


1.3. Электронно-коммуникационный модуль Т6, ET548333


ET548335

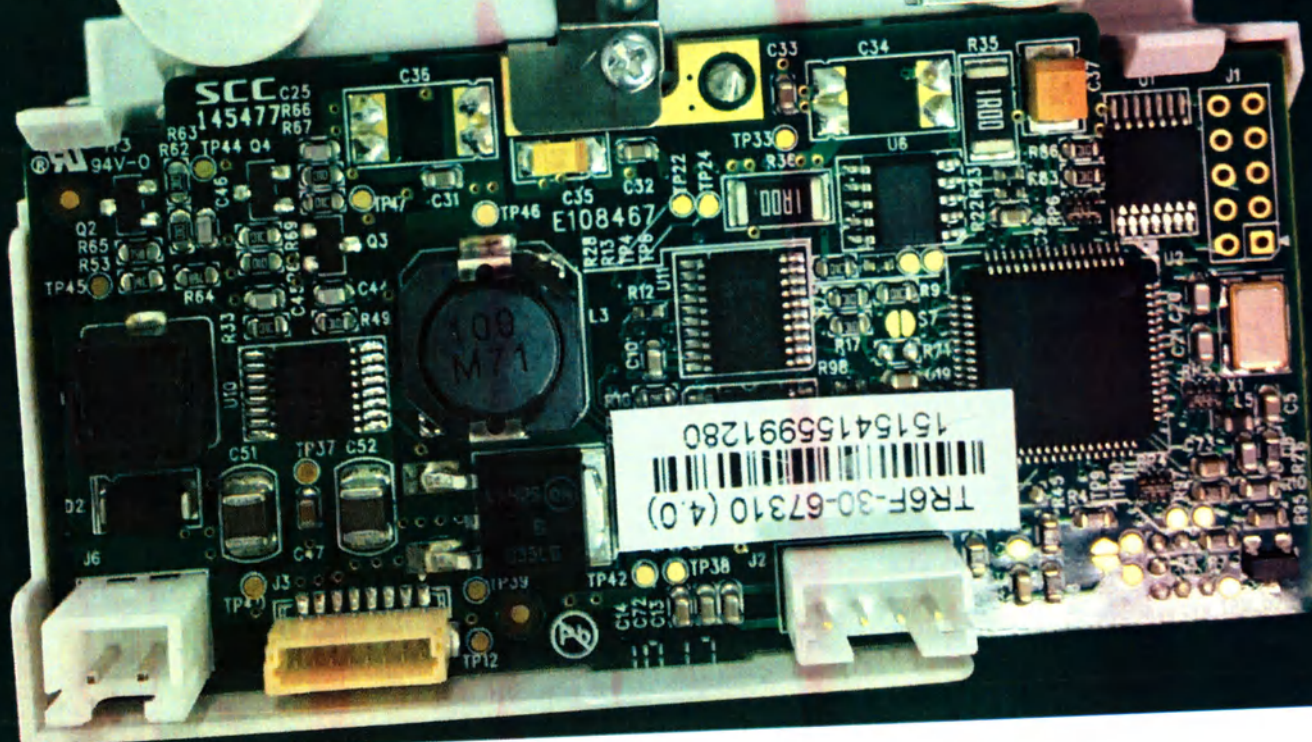


1.4. Термопринтер

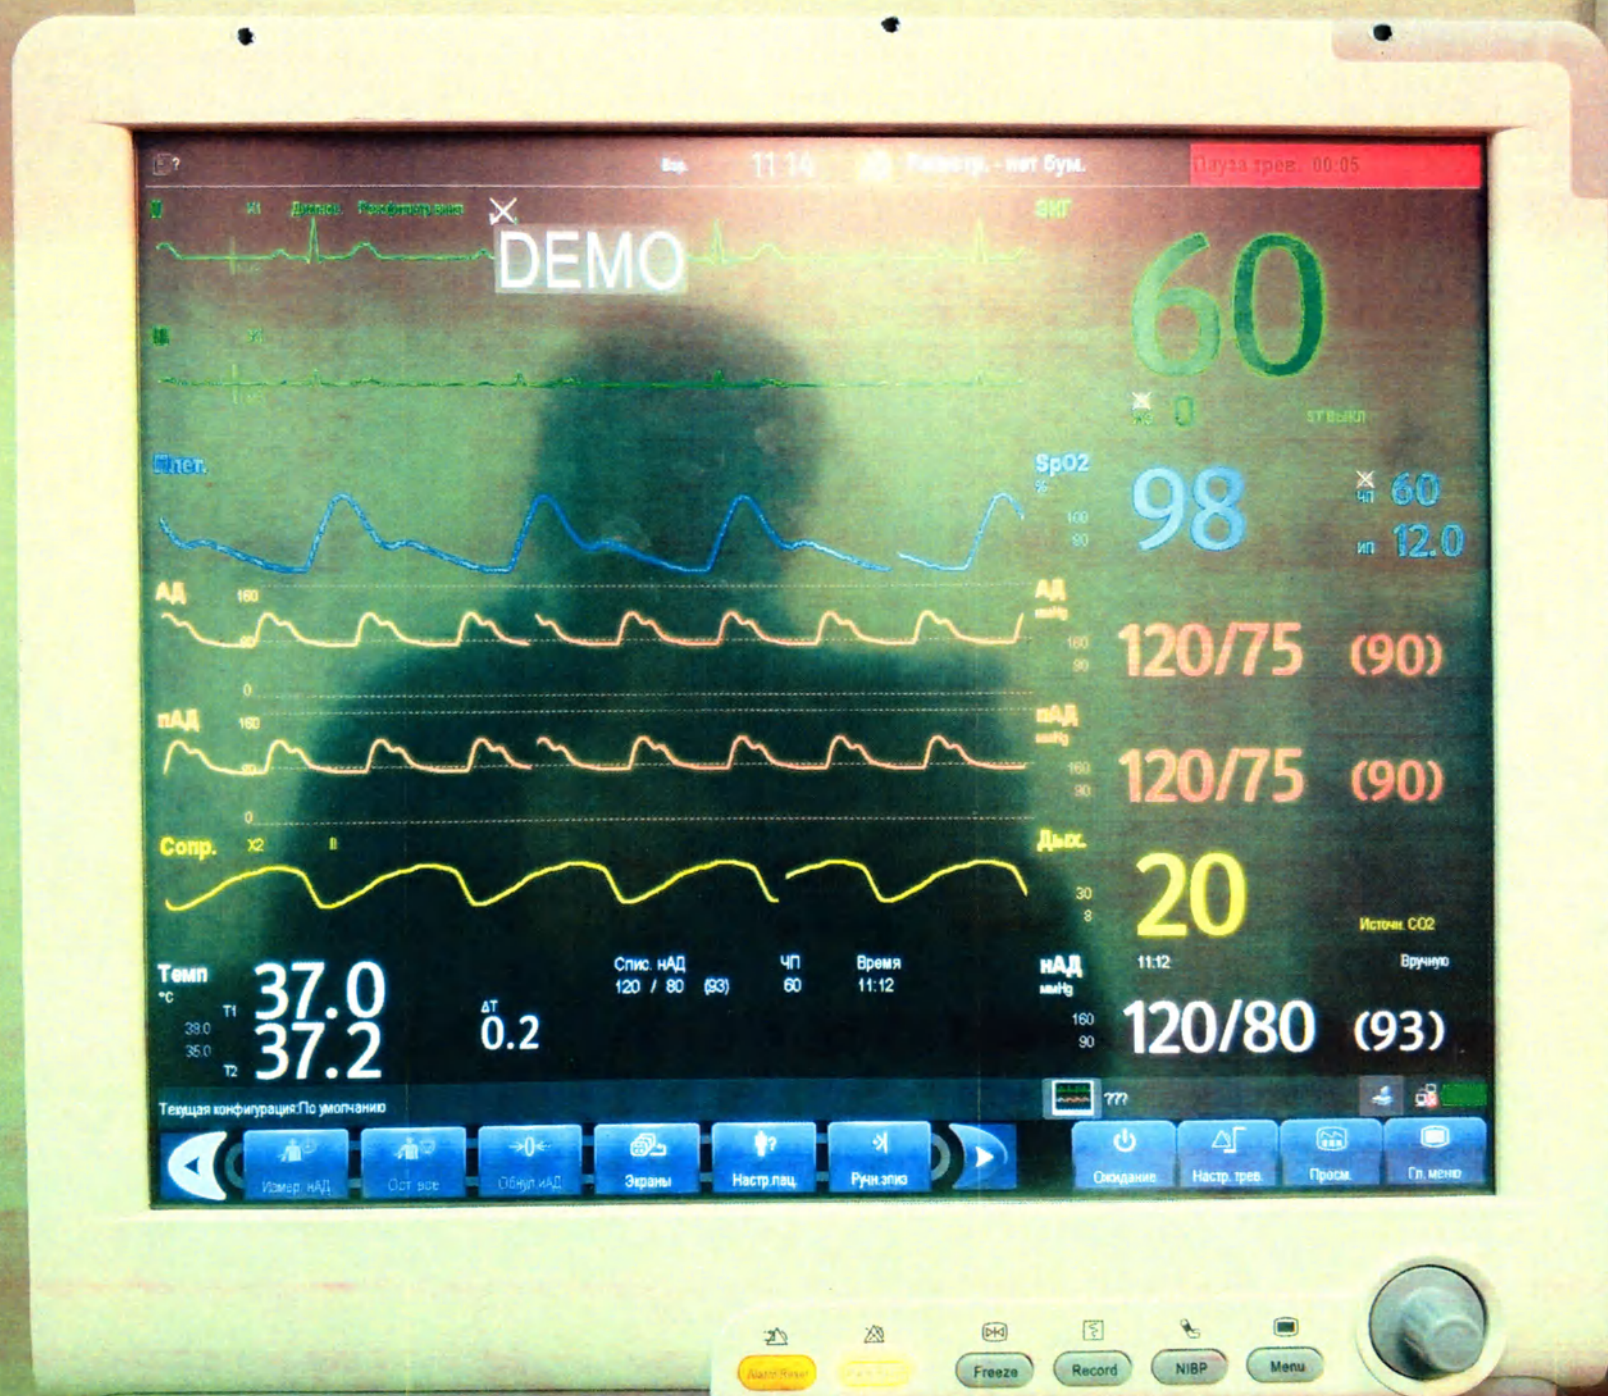


1. Блок основной T8 RUS, ТЭСМ.943119.011-03

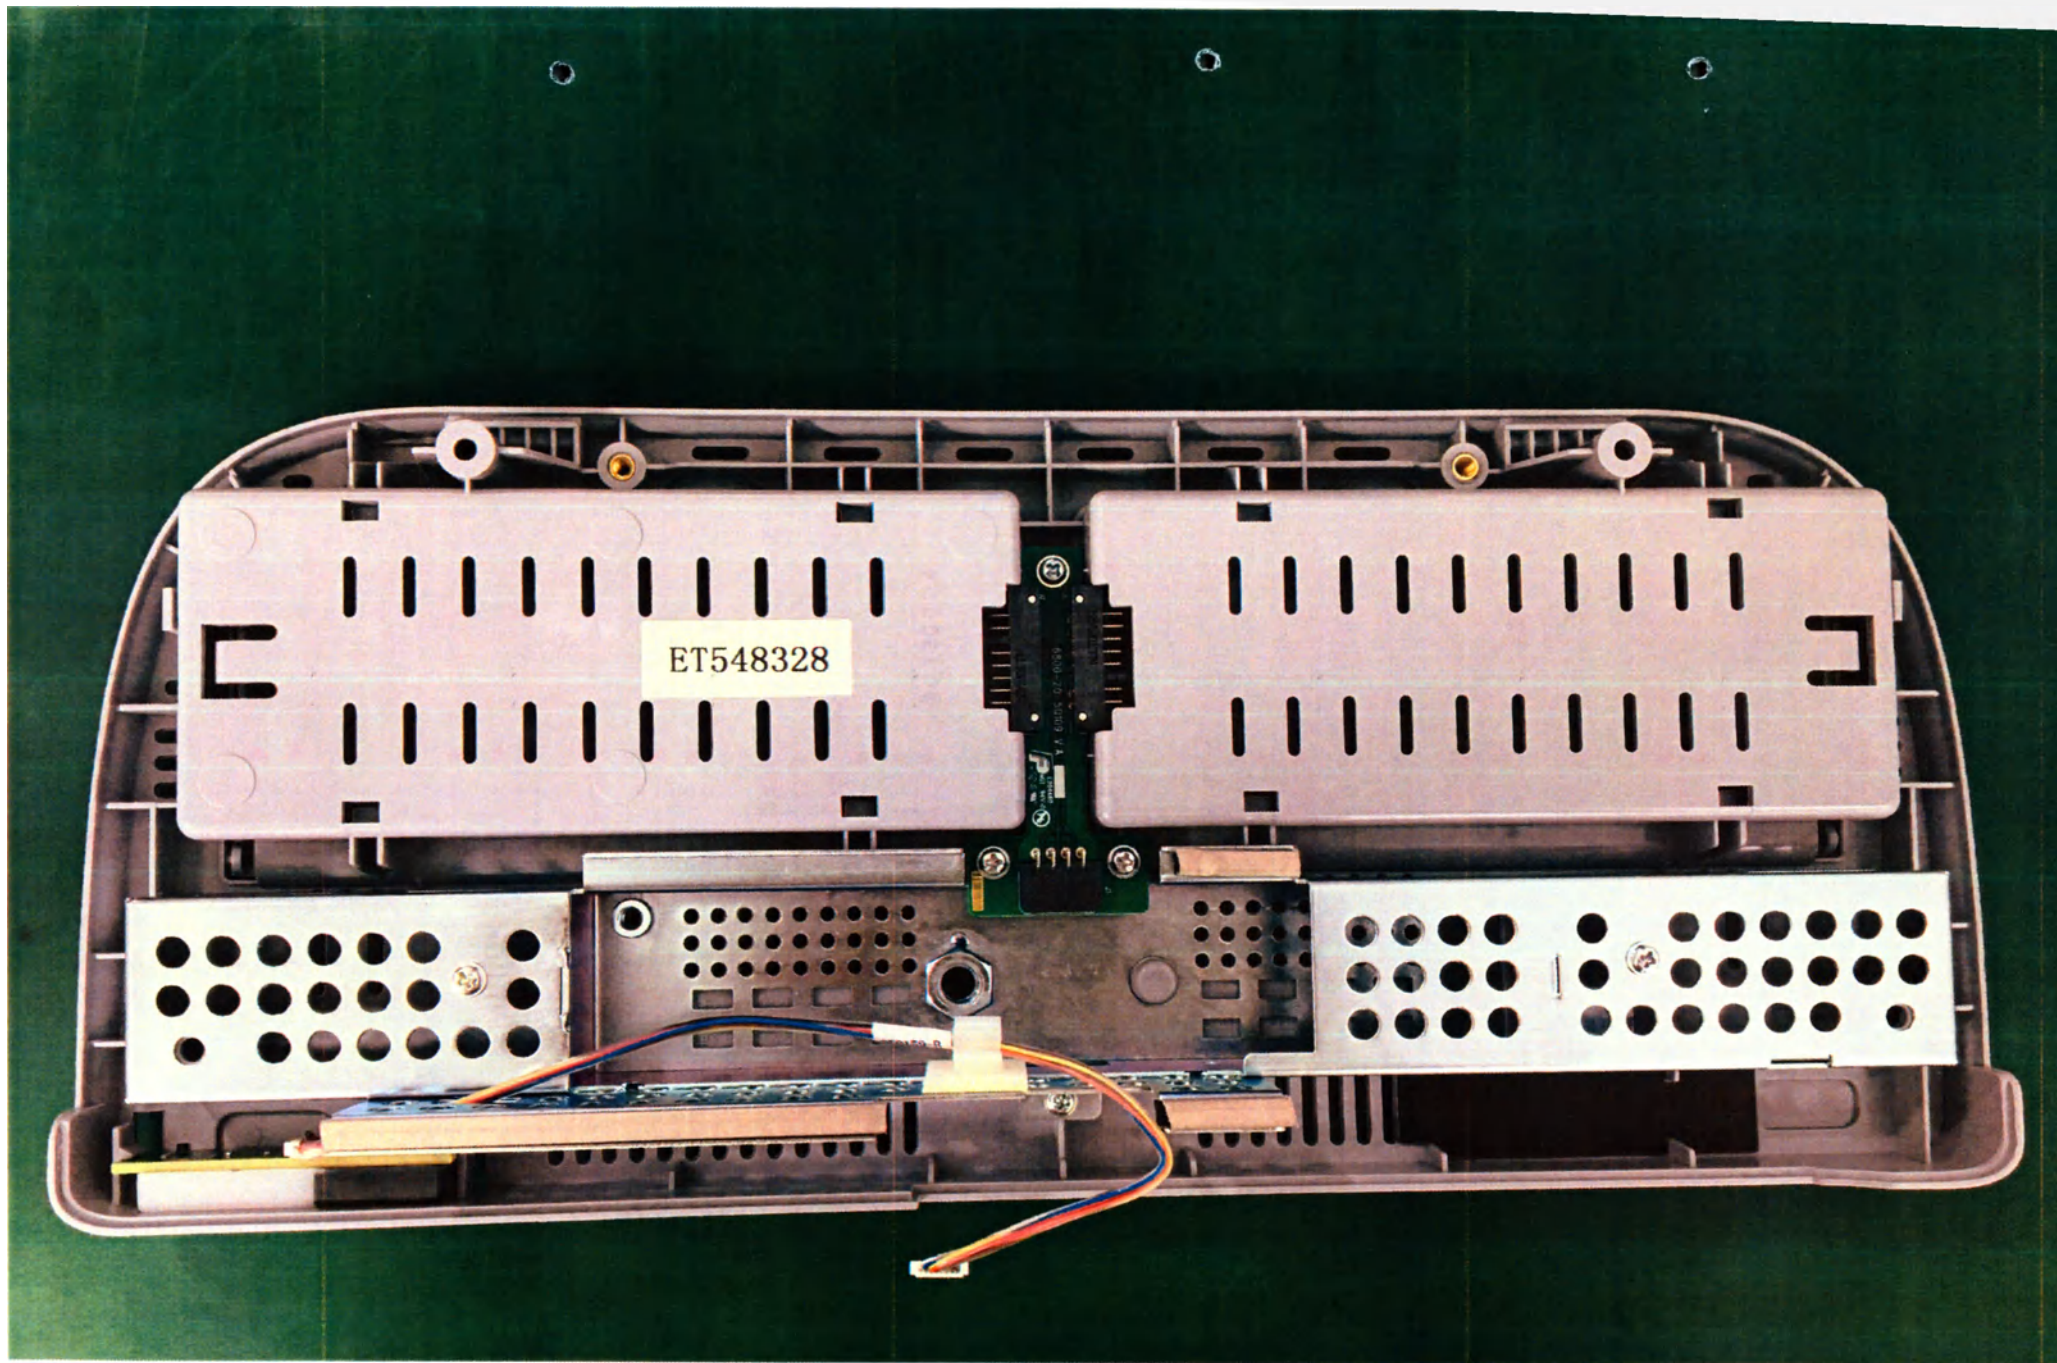


1.1. Модуль питания Т8, ET548328

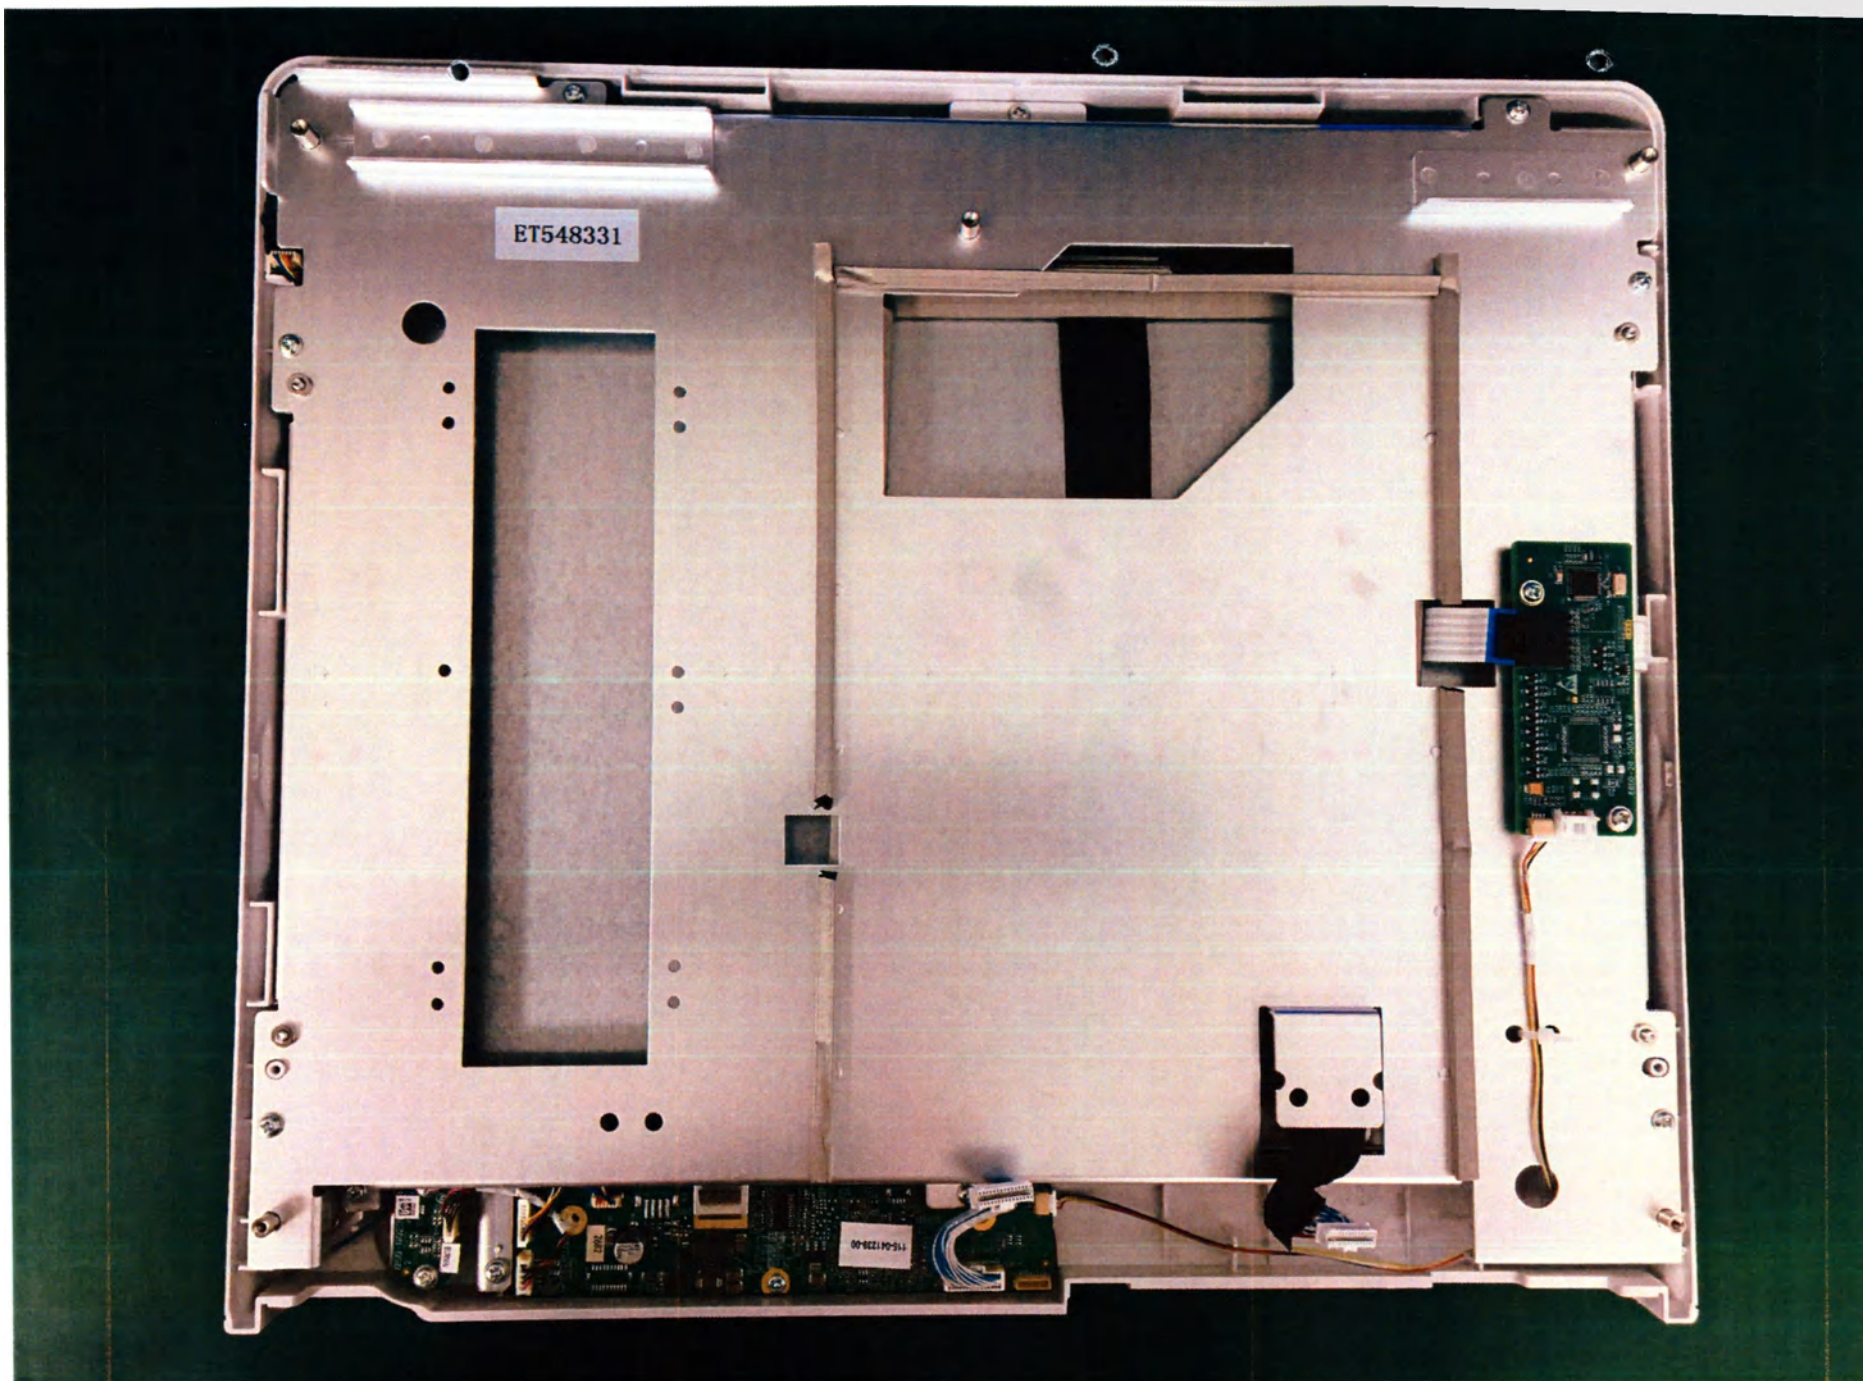

1.2. Дисплейный модуль Т8, ET548331

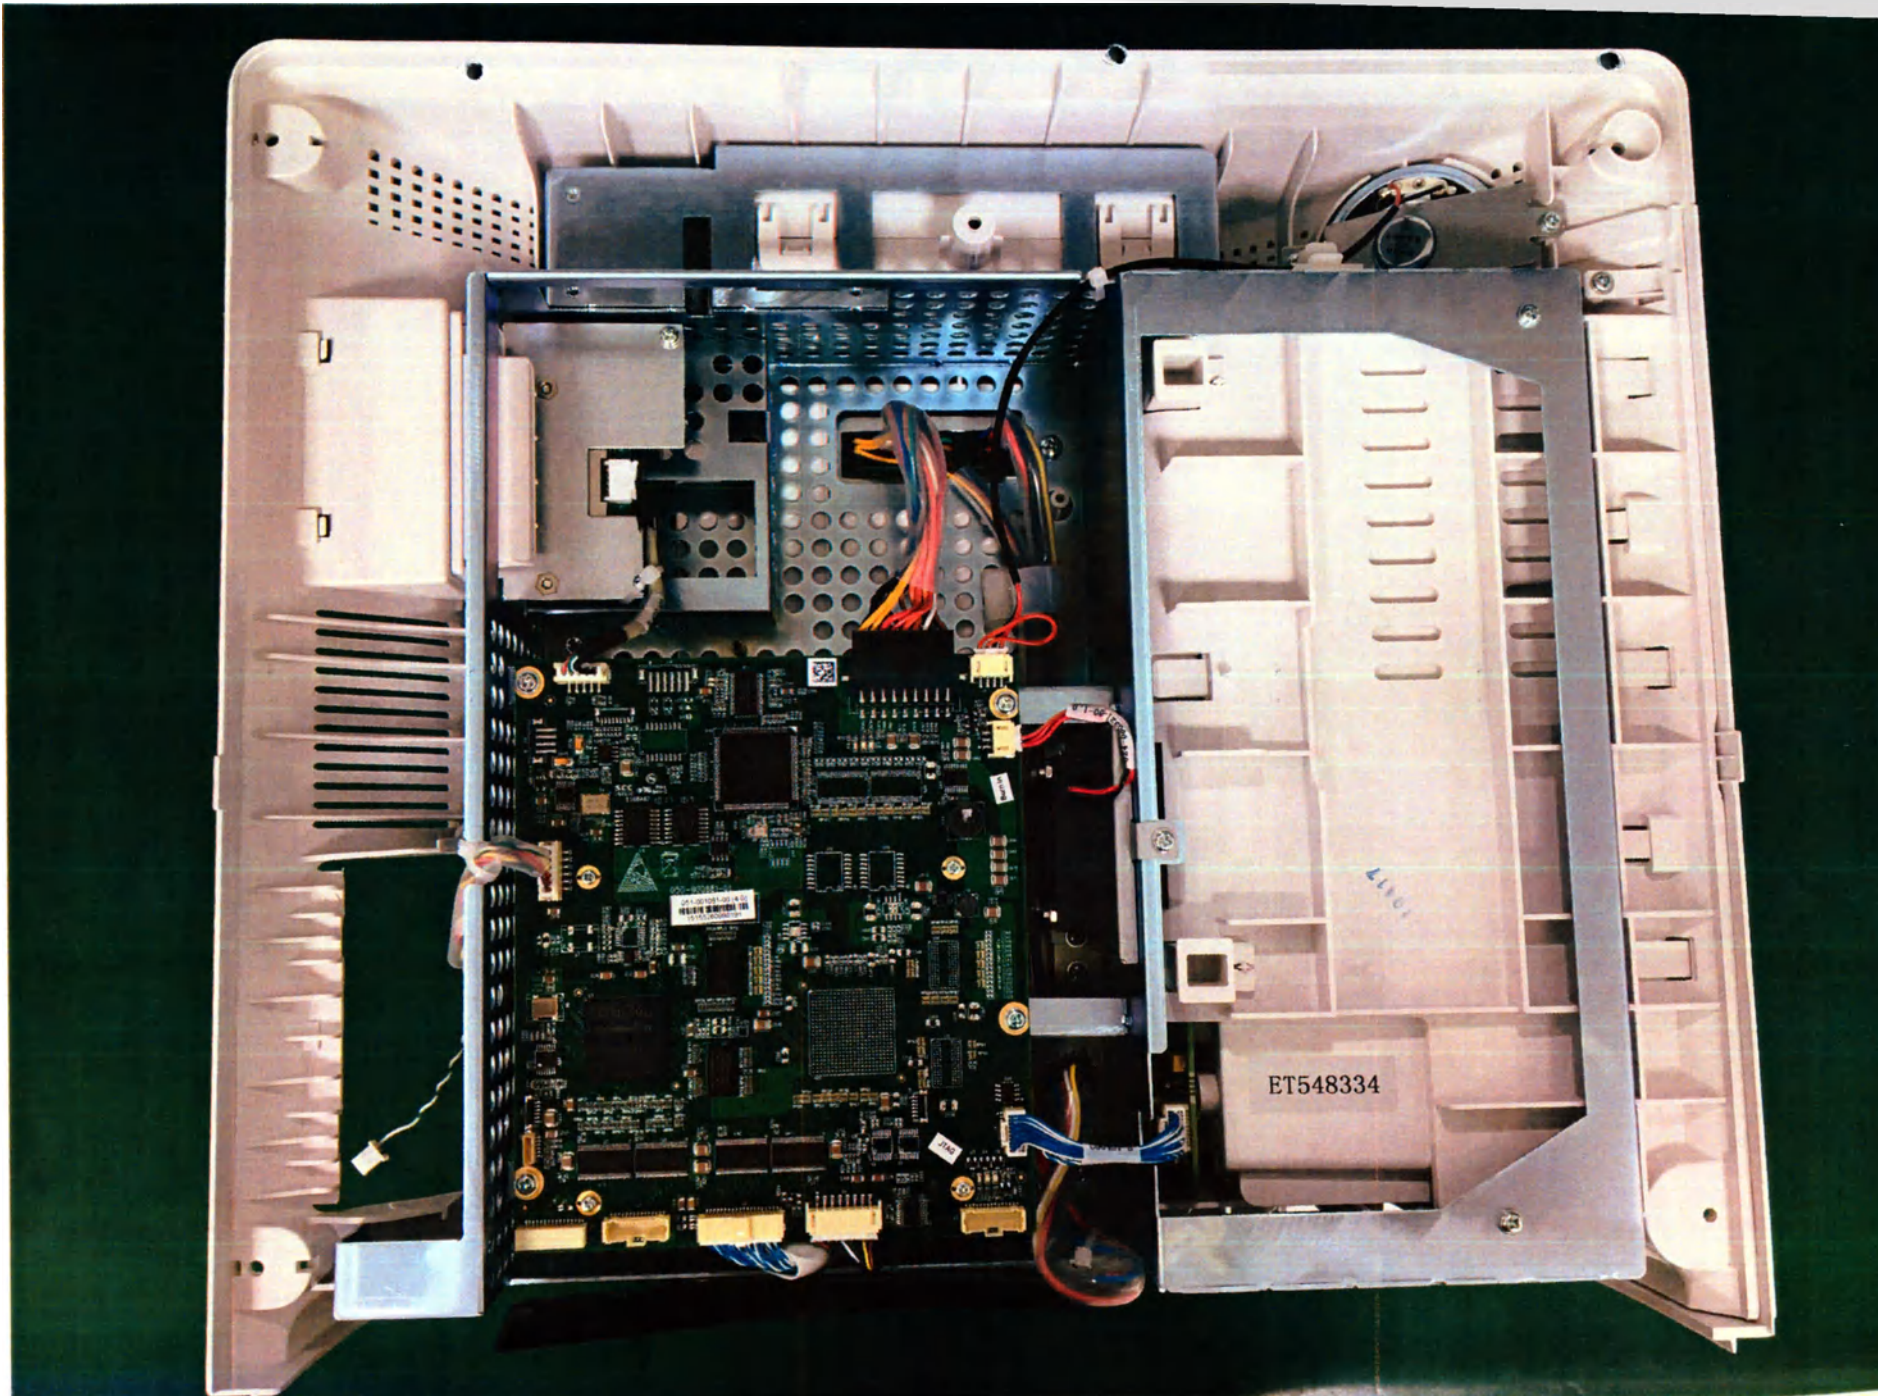

1.3. Электронно-коммуникационный модуль Т8, ET548334

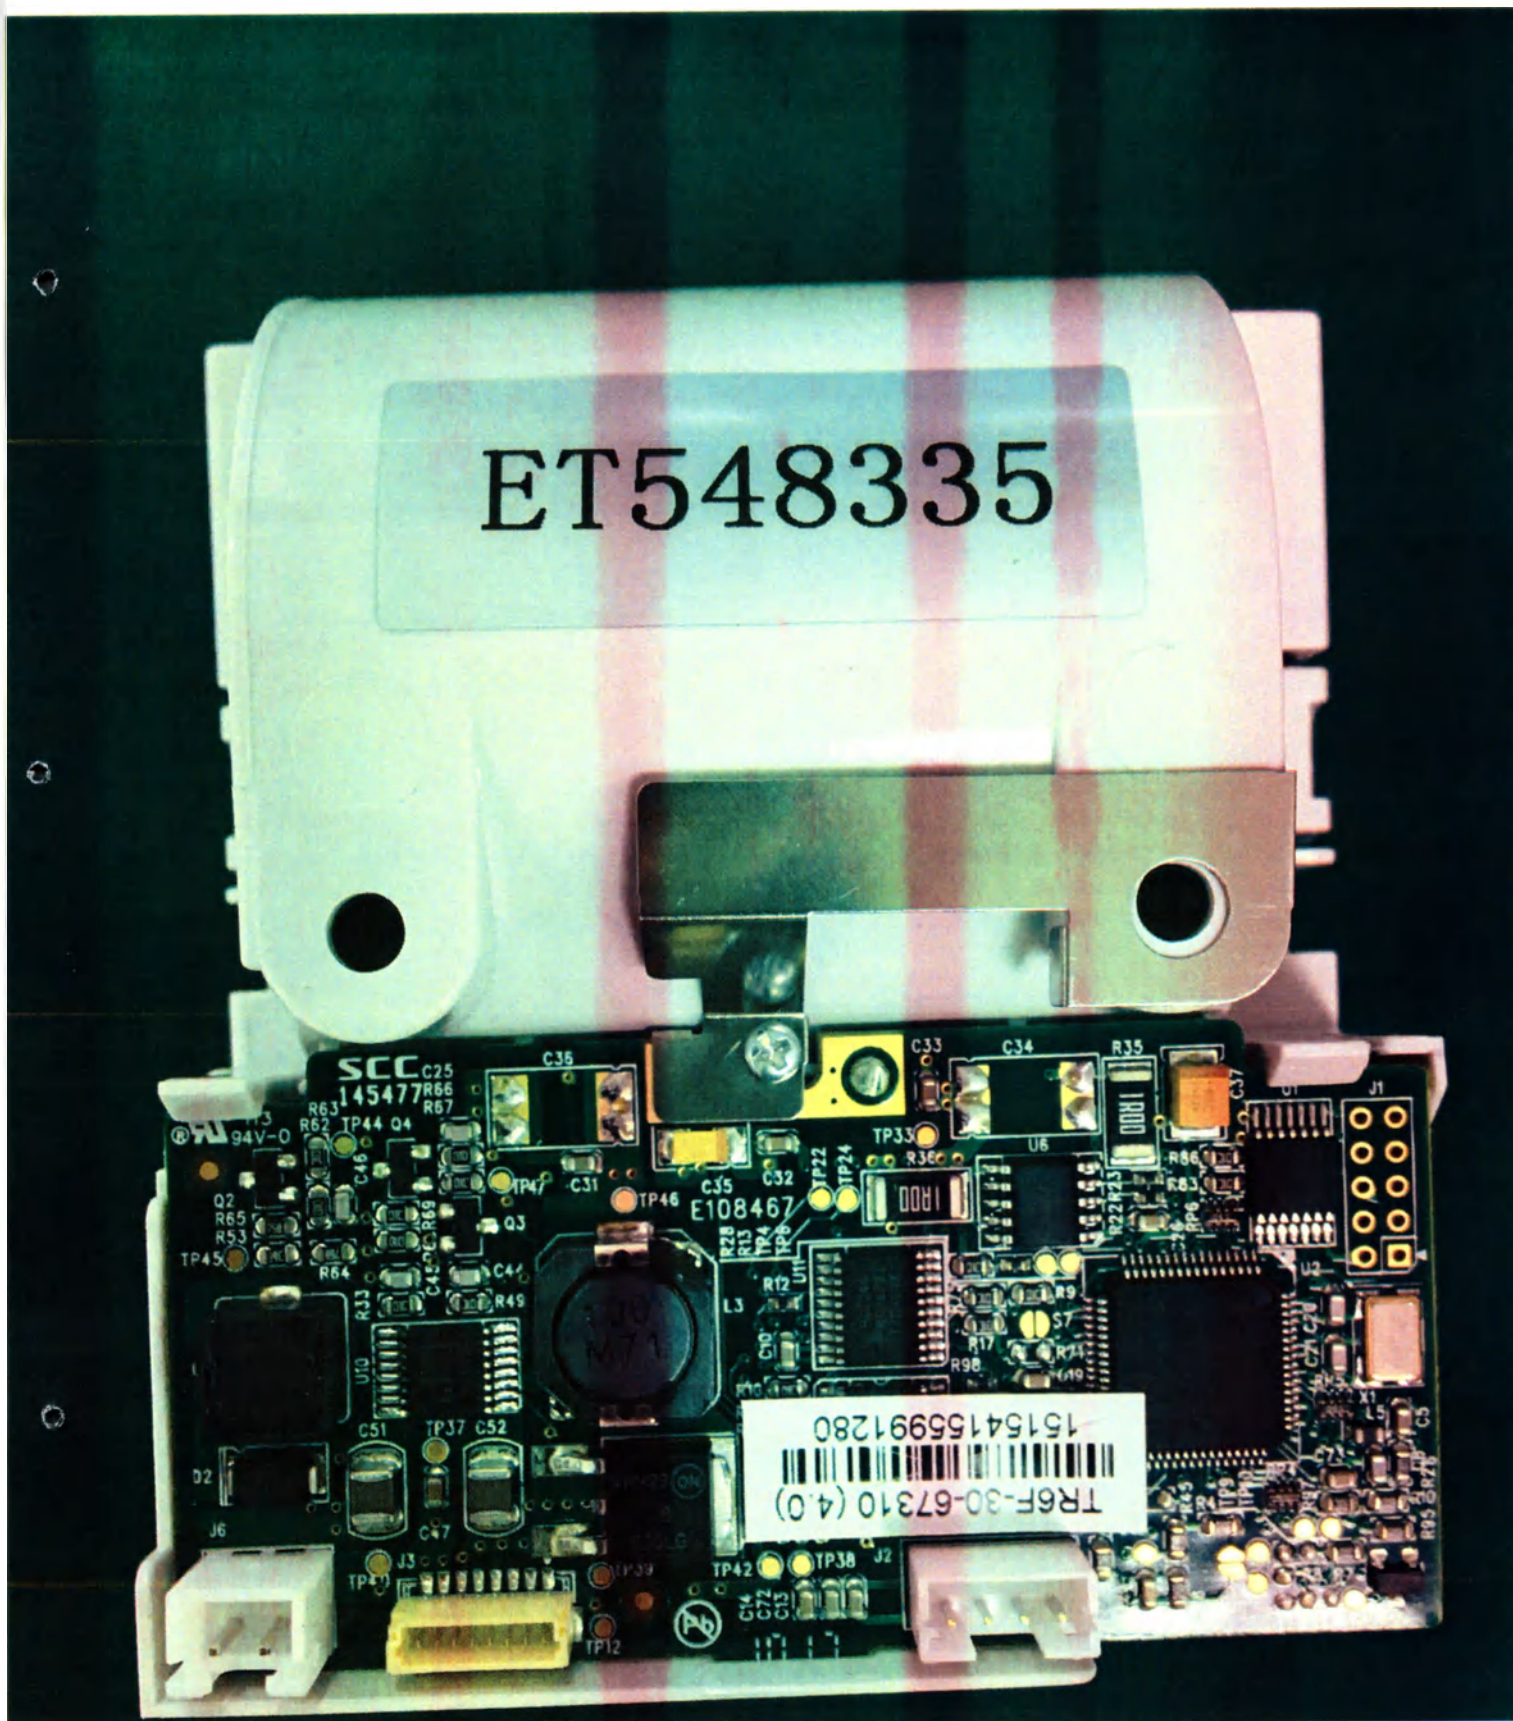

1.4. Термопринтер




2. Блок для дополнительных модулей SMR с кабелем



3. Модуль мультипараметрический, модели 3.1-3.8



3.9 Монитор пациента прикроватный BeneView T1

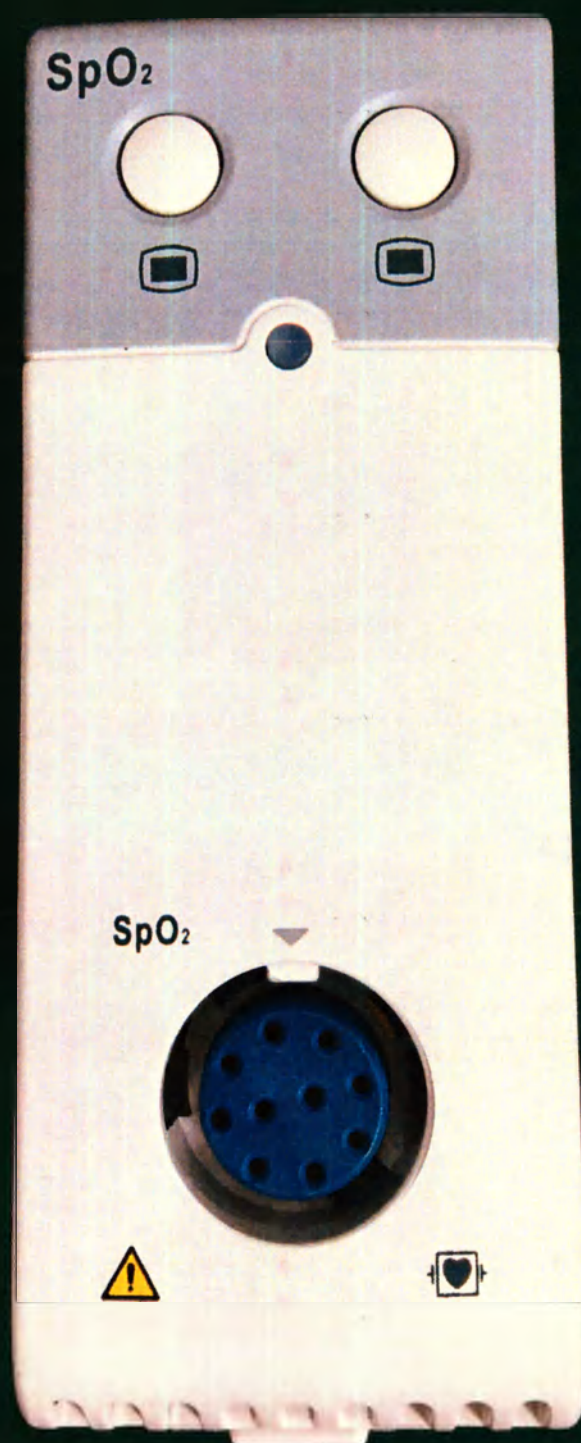


4. Модуль пульсоксиметрический



5. Модуль для измерения инвазивного артериального давления

6. Модуль термодилизионного сердечного выброса

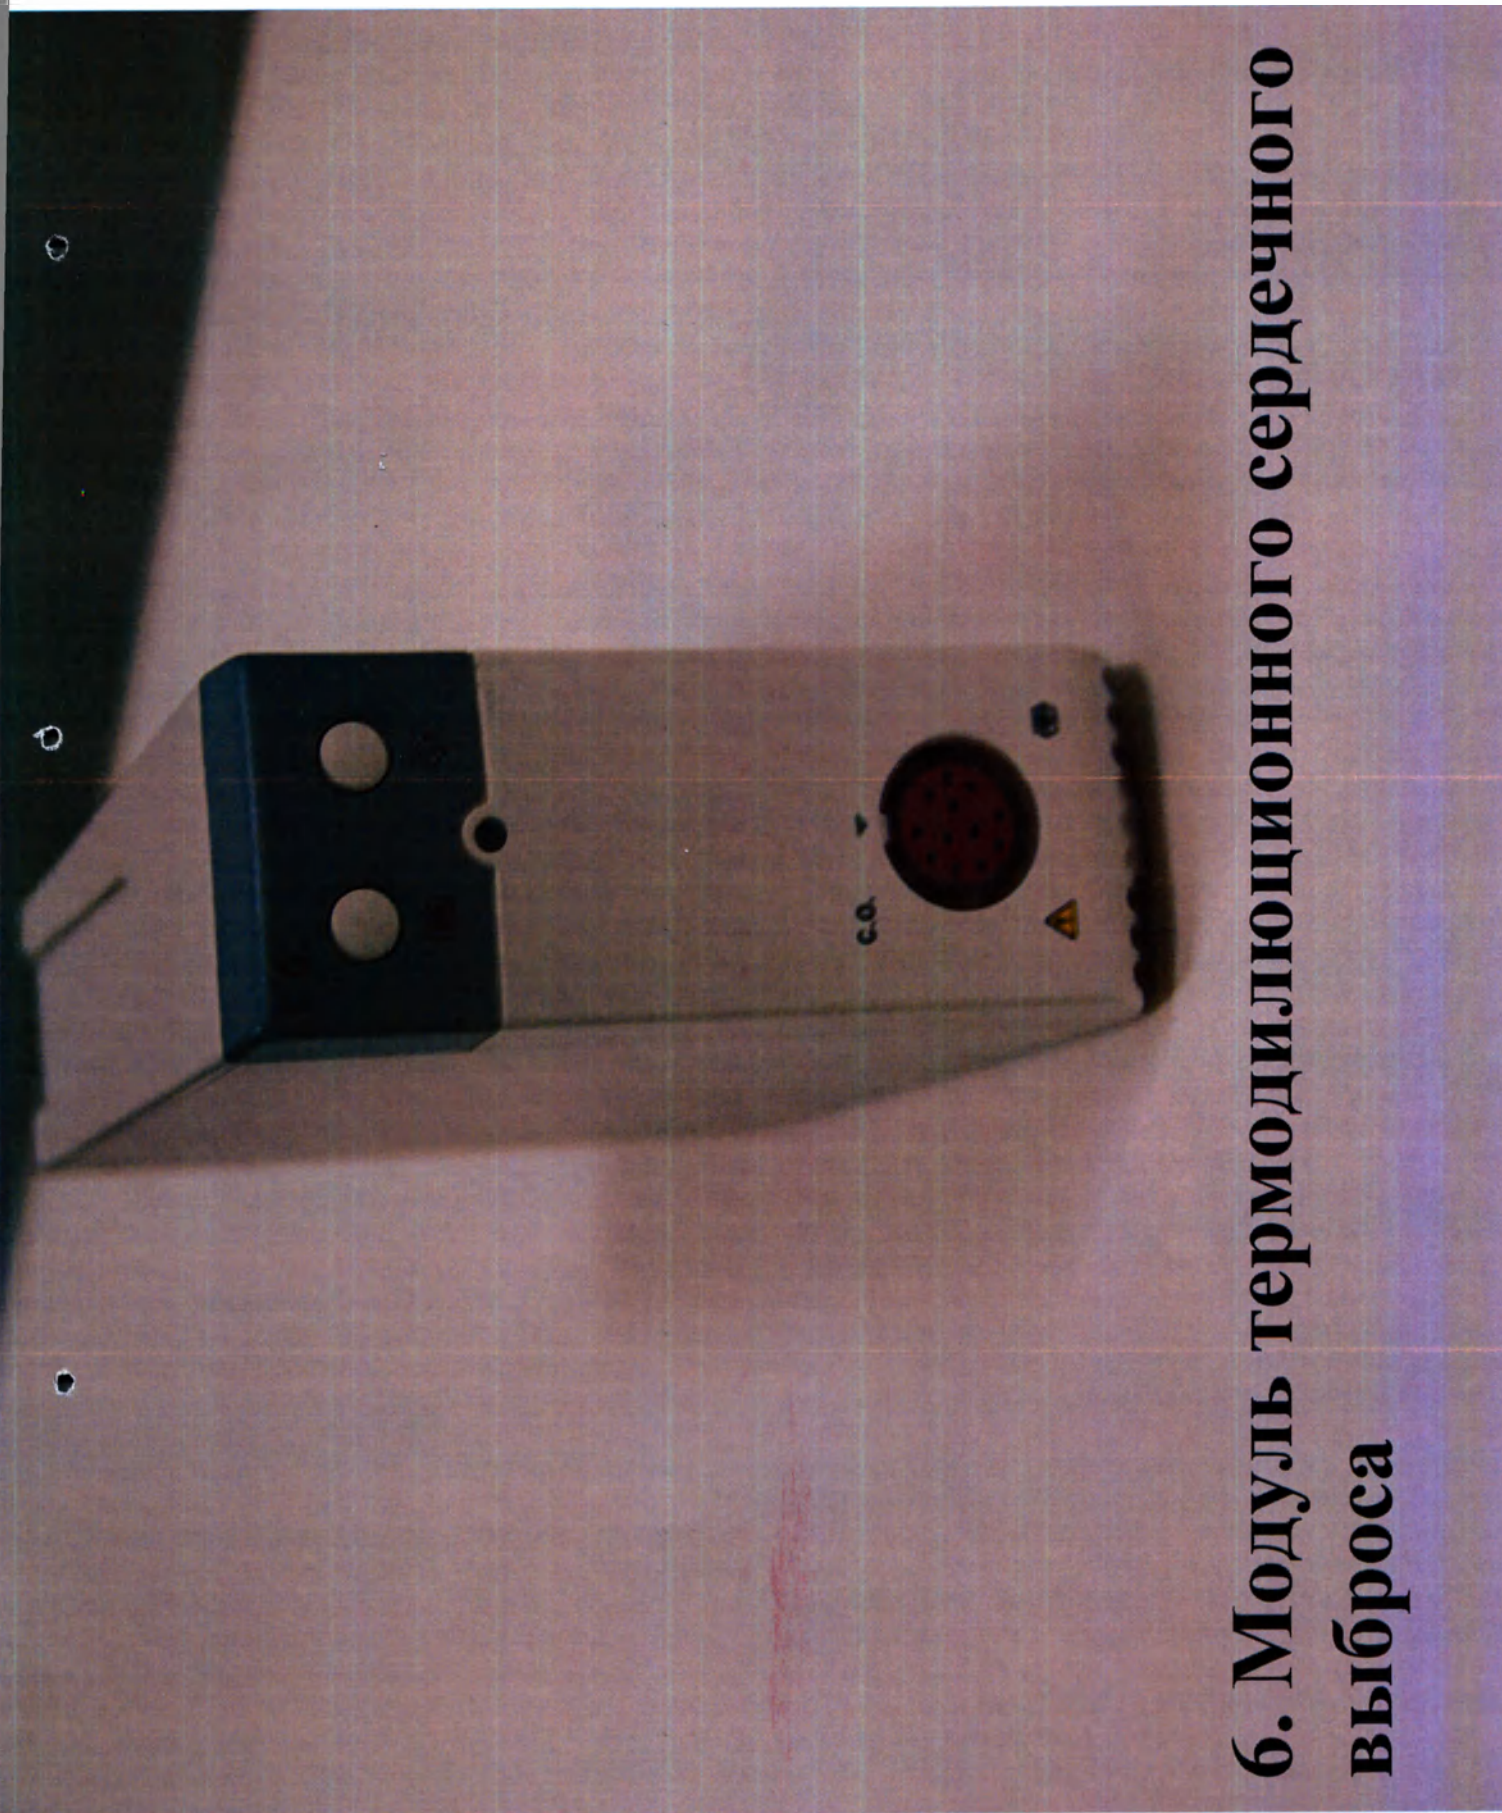

7. Модуль капнометрии бокового потока




8. Модуль капнометрии низкочастотной (microstream)






9. Модуль капнометрии прямого потока

10. Модуль газоанализа, модели 10.1 и 10.3

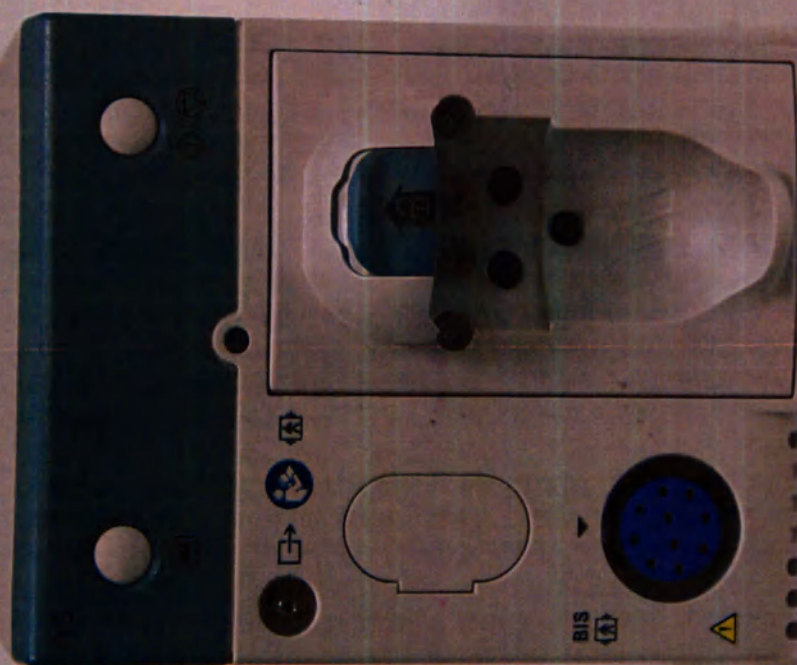

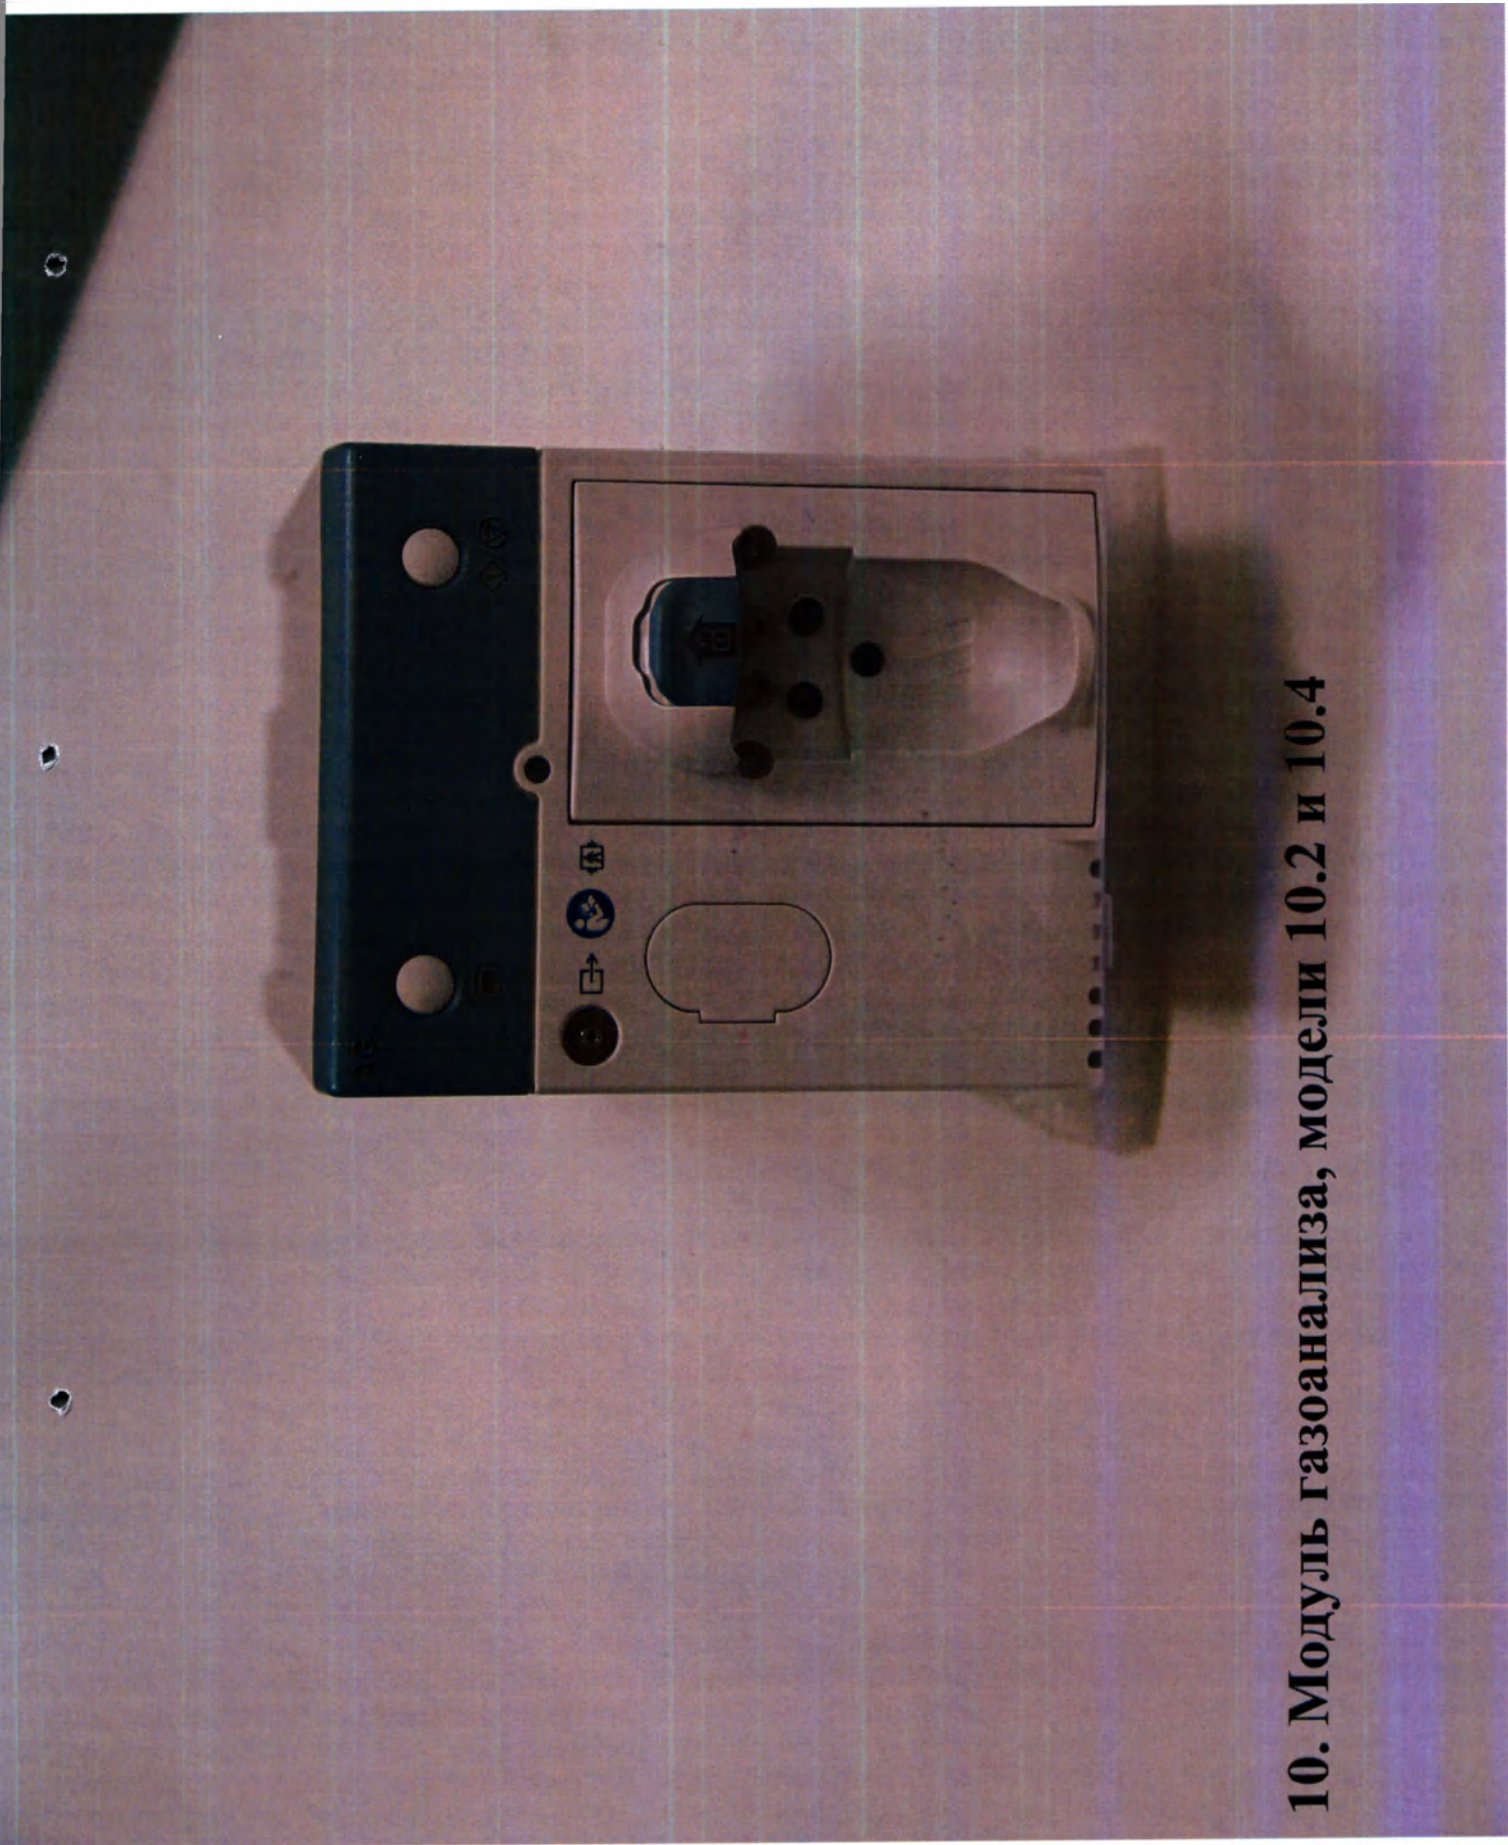


10. Модуль газоанализа, модели 10.2 и 10.4




11. Модуль мониторинга биспектрального индекса (BIS)

12. Модуль механики дыхания




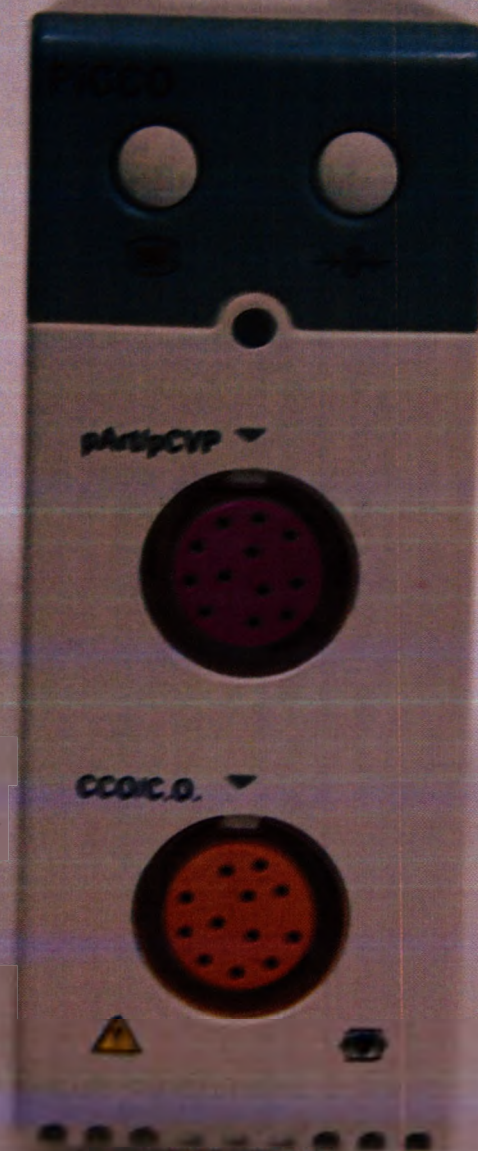

13. Модуль определения параметров центральной гемодинамики (PiCCO)

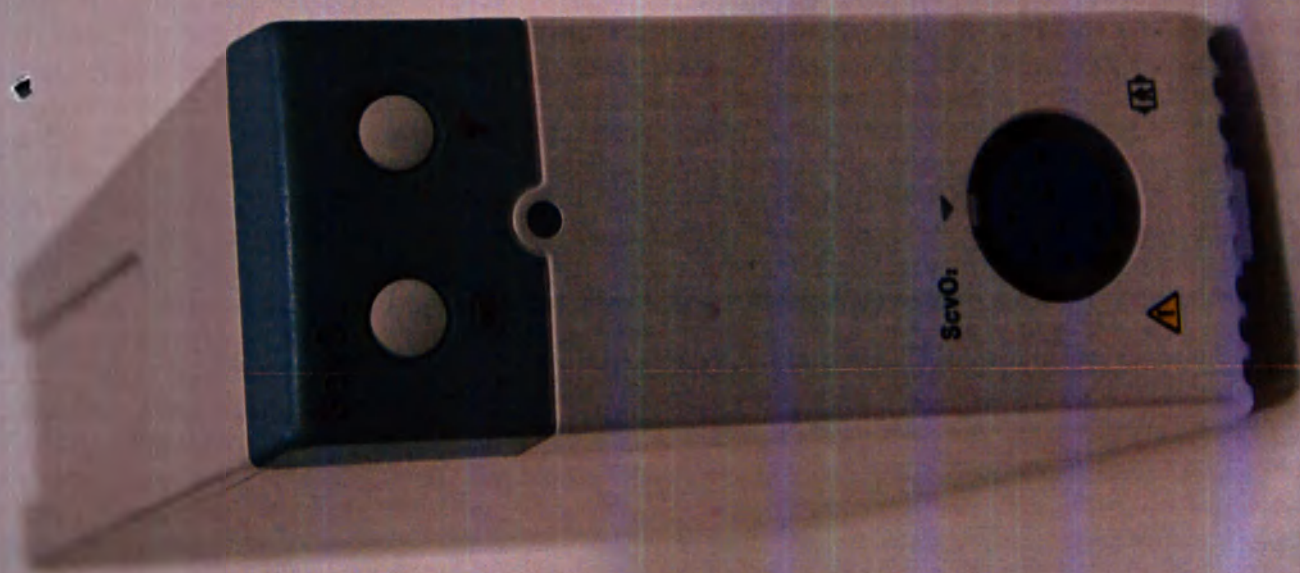

14. Модуль для измерения насыщения кислородом центральной венозной крови (ScvO2)

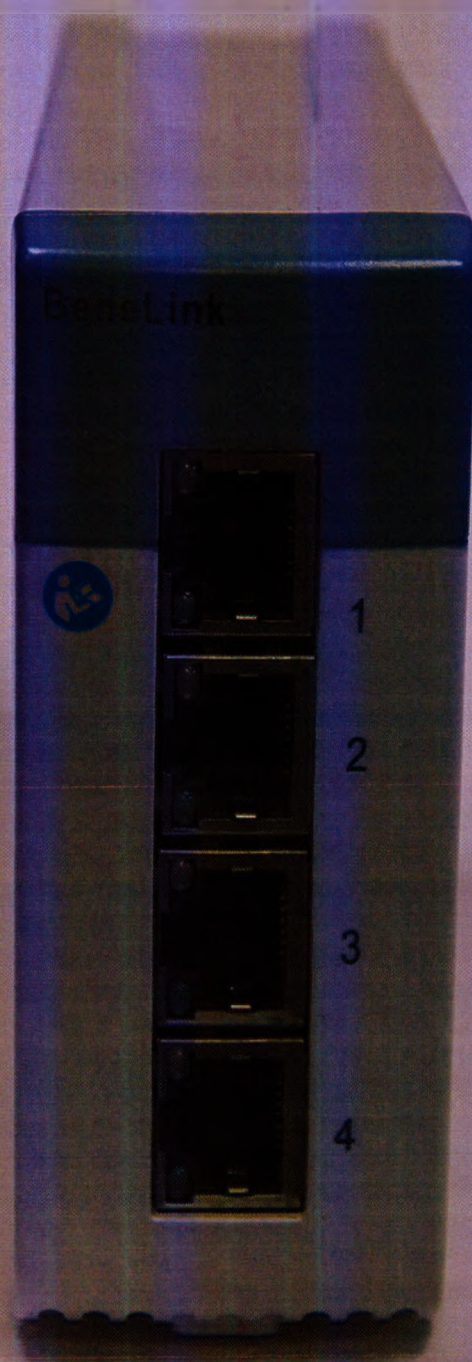

15. Модуль BeneLink



15.1 Соединительный кабель к модулю BeneLink




15.2 Адаптер к модулю BeneLink



16. Кабель ЭКГ




17. Провода ЭКГ на 3 отведения

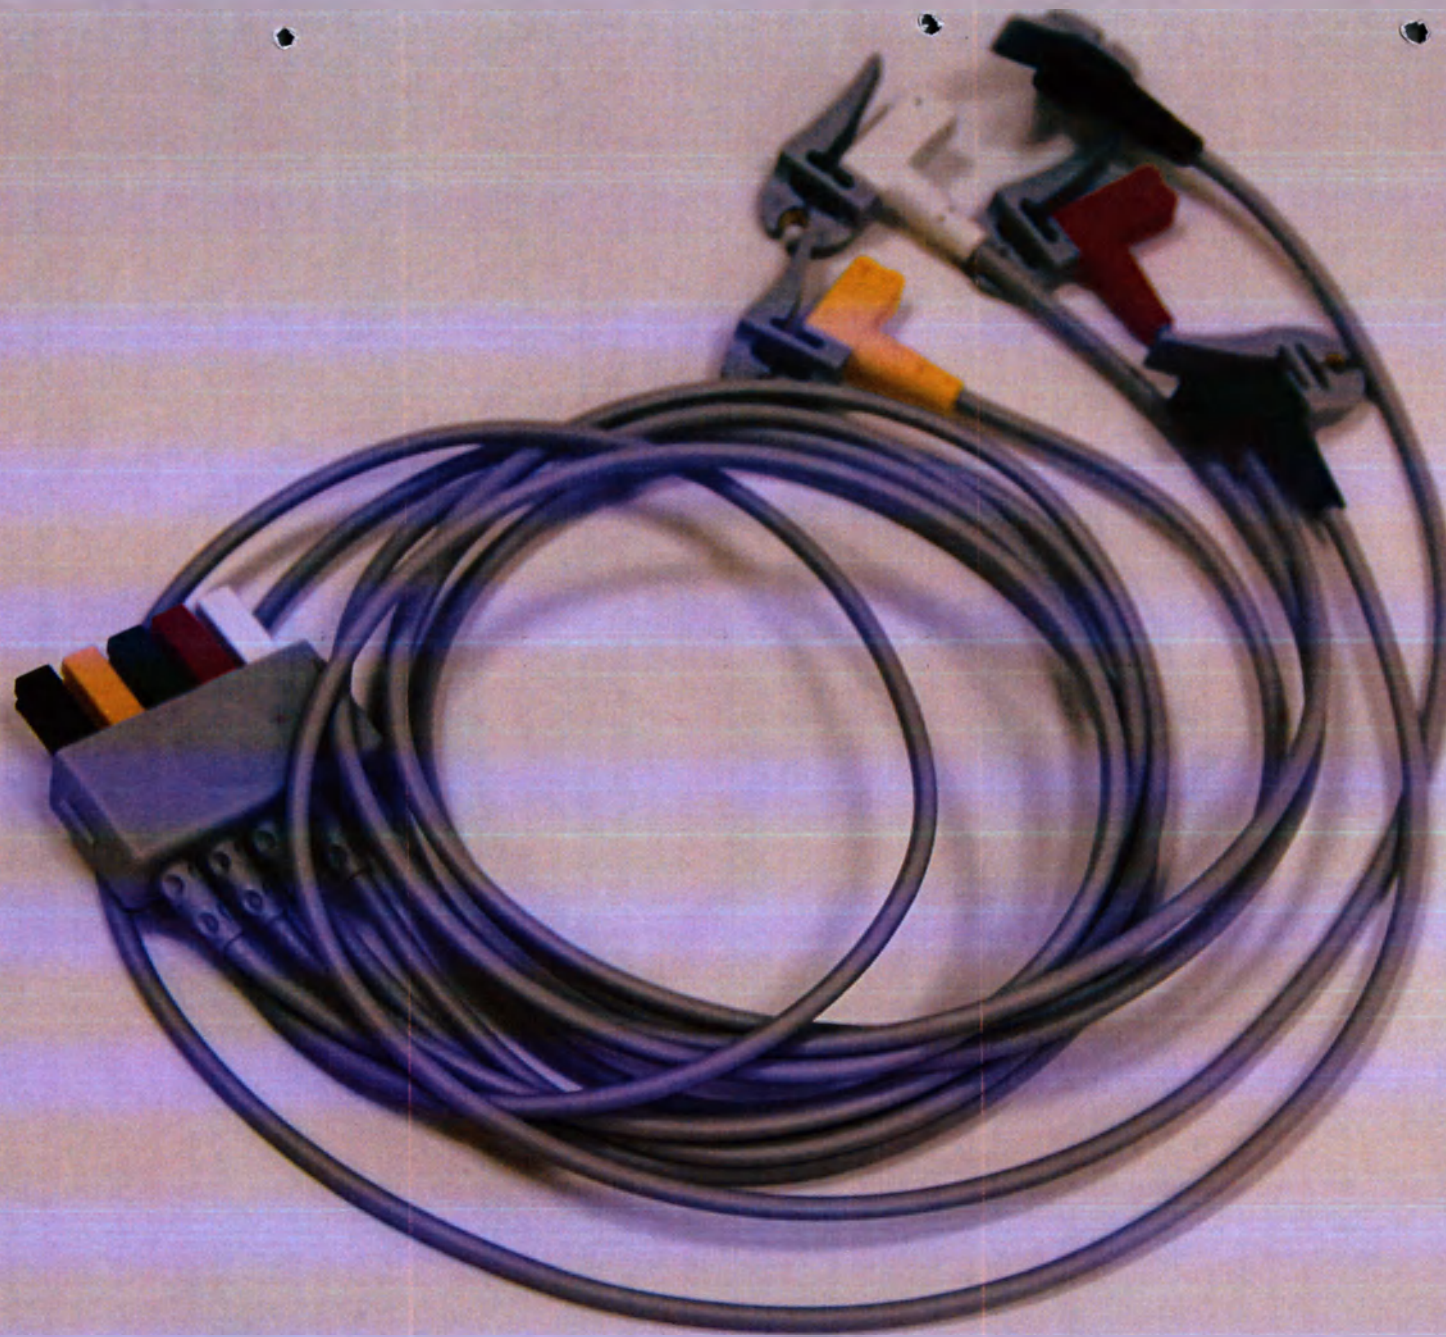

18. Провода ЭКГ на 5 отведений



19. Провода ЭКГ на 12 отведений

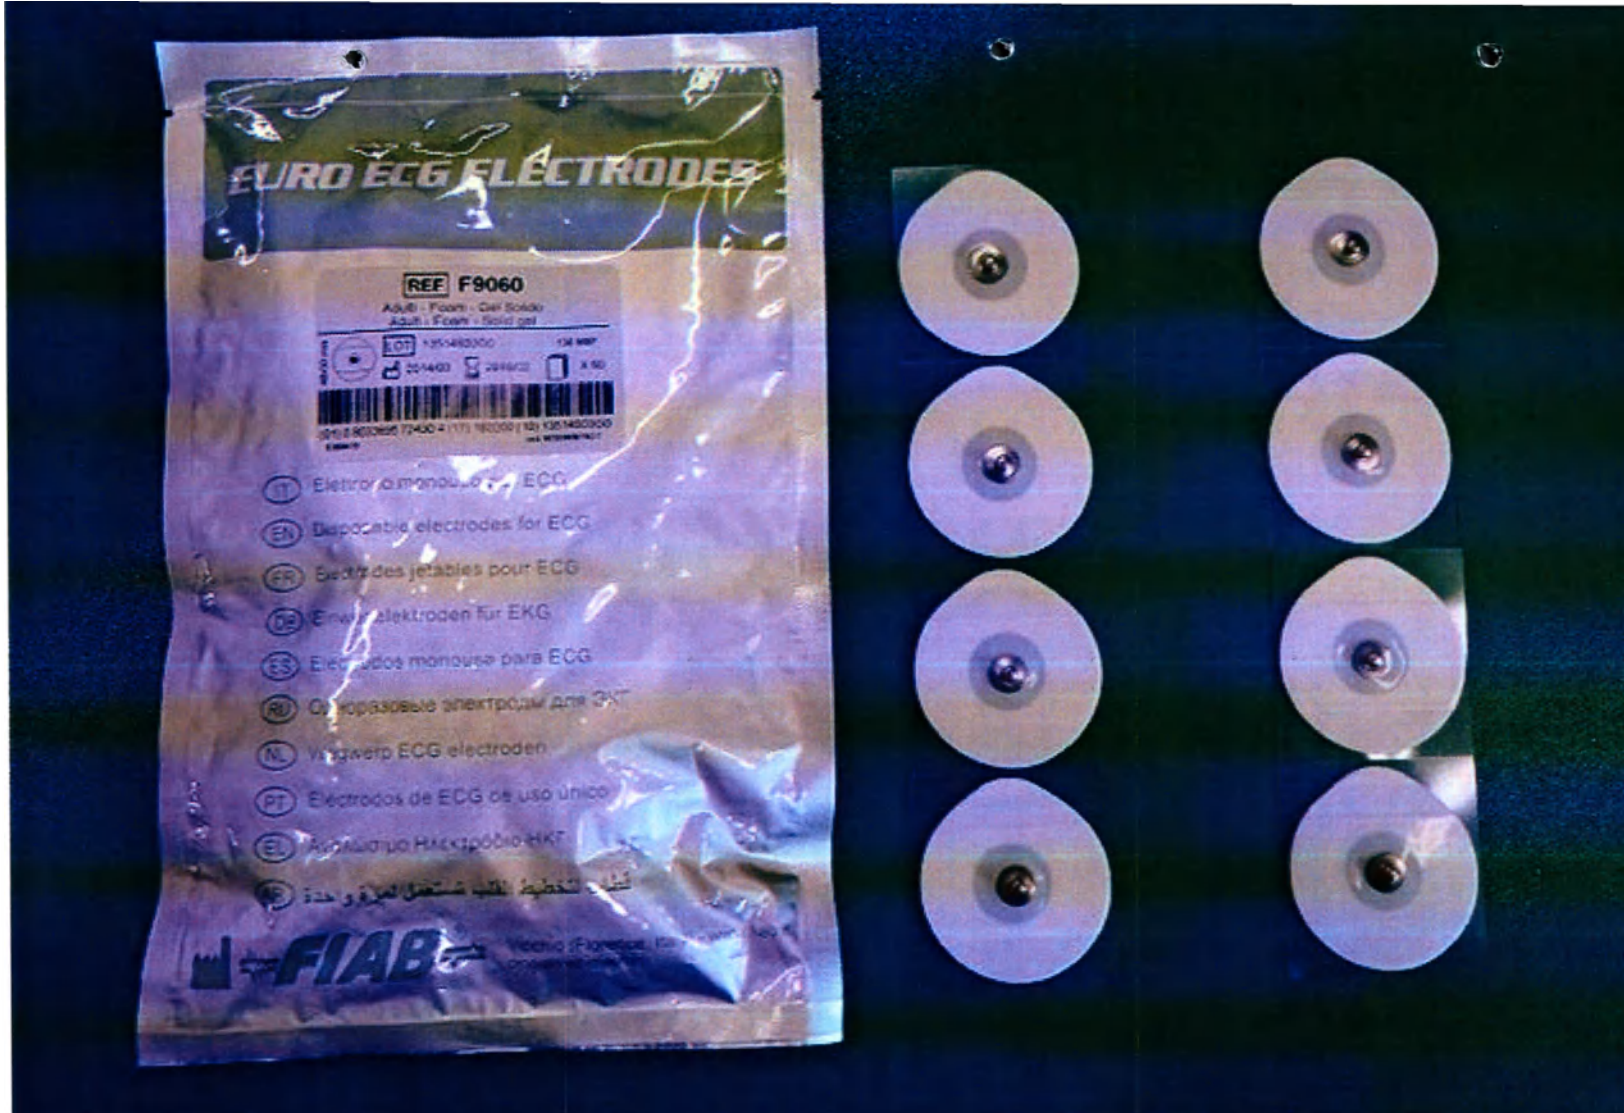

20. Электроды, кабели пациента и аксессуары (переходник-адаптер, коннектор, ремень, кнопка, фиксирующее кольцо-диск, фиксирующая подкладка, шлем) для ЭКГ, ЭЭГ, ЭМГ, производства «ФИАБ СпА», Италия



**20. Электроды медицинские с принадлежностями,
производства "Ковидиен Лс", США**



**20. ЭКГ-электроды одноразовые для диагностики
(с коннекторами и без коннекторов), производства
ЗАО "КонваТек", Россия**



**21. Трубки для неинвазивного измерения
давления взрослые, производства "Шэньчжэнь
Миндрэй Био-Медиал Электроникс Ко., Лтд.",
КНР**



**21. Шланг для манжеты, производства ООО
фирма "Тритон-ЭлектроникС", Россия**



22. Трубки для неинвазивного измерения давления неонатальные



23. Манжетки для неинвазивного измерения давления (взрослые/детские/неонатальные), производства "Шэньчжэнь Миндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.", КНР



23. Манжета для определения неинвазивного артериального давления, производства «Шеньжень ЕМС ЛАЙФ Текнолоджи Ко., Лтд.», КНР



24. Манжеты: Cuff-LDA, Cuff-LD8, производства "Литл Доктор Интернешнл (С) Пте. Лтд.", Сингапур



24. Манжеты НИАД, производства ООО фирма "Тритон-ЭлектроникС", Россия



25. Кабели для датчиков пульсоксиметрических (SpO₂), производства "Шэньчжэнь Миндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.", КНР



**25. Пульсоксиметрический кабель, производства Nellcor
Puritan Bennett Ireland Ltd.**



26. Датчики пульсоксиметрические (SpO₂) универсальные (взрослые/детские/неонатальные), производства "Шэньчжэнь Миндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.", КНР



**26. Пульсоксиметрические датчики MAXIPACK,
производства Nellcor Puritan Bennett Ireland Ltd**



26. Датчики пульсоксиметрические (SpO₂) взрослые, производства "Шэньчжэнь Миндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.", КНР



26. Пульсоксиметрический датчик Nellcor OXIMAX, производства Nellcor Puritan Bennett Ireland Ltd



27. Кабель удлинительный для одноразовых датчиков температуры, производства "Шэньчжэнь Миндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.", КНР



**28. Датчик температуры ректально/эзофагеальный,
производства "Шэньчжэнь Миндрэй Био-Медикал
Электроникс Ко., Лтд.", КНР**




**28. Датчик температуры внутриполостной, производства
ООО фирма "Тритон-ЭлектроникС", Россия**



**29. Датчик температуры накожный, производства
"Шэньчжэнь Миндрэй Био-Медикал Электроникс Ко.,
Лтд.", КНР**




29. Датчик температуры поверхностный, производства ООО фирма "Тритон-ЭлектроникС", Россия

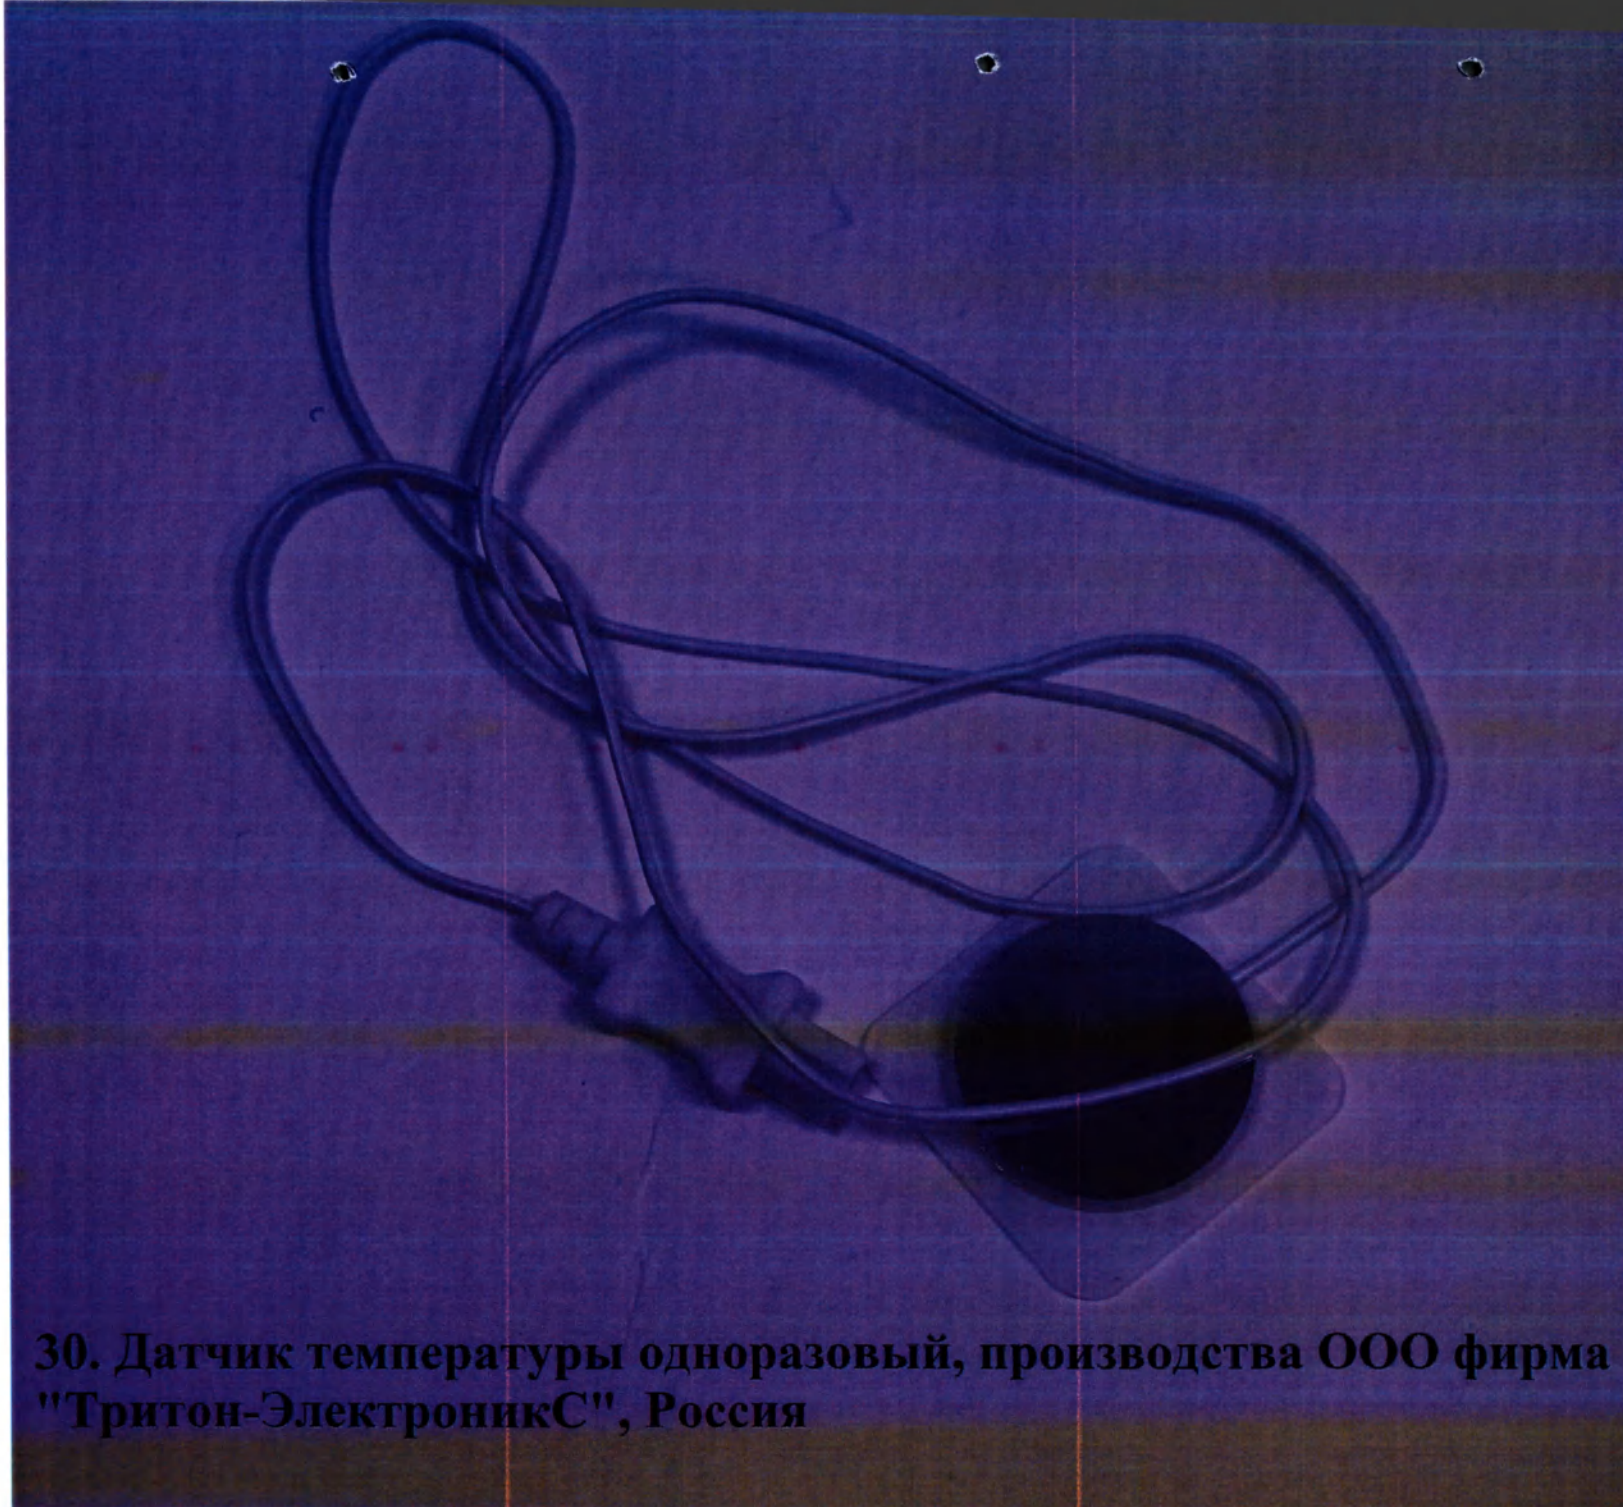

30. Датчик температуры одноразовый, производства ООО фирма "Тритон-ЭлектроникС", Россия



31. Наборы для измерения инвазивного давления (датчики, кабели, крепления датчиков, держатели)

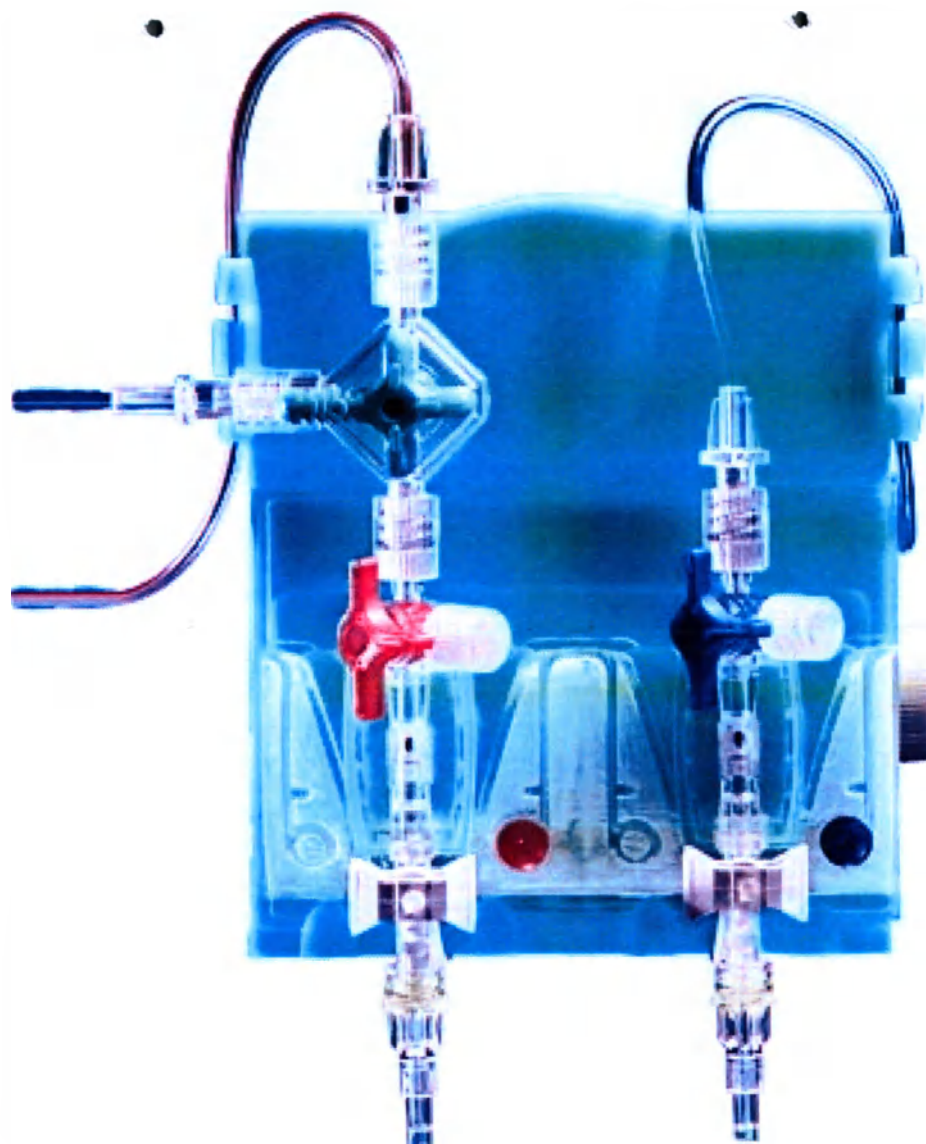

32. Наборы для контроля давления с преобразователем КОМБИТРАНС (Combitrans monitoring set)



33. Кабели соединительные КОМБИТРАНС (Combitrans monitoring cable)

34. Держатель Комби-холдер для преобразователей КОМБИТРАНС (Combiholder for Combitrans)






35. Датчики стерильные одноразовые для мониторинга кровяного давления, в наборах и отдельных упаковках



36. Набор для измерения сердечного выброса (С.О.) (кабели, термодатчики, инъекционные шприцы, переходники, краники), производства "Шэньчжэнь Миндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.", КНР




36. Набор для определения величины сердечного выброса BD Critikit, производства «Бектон Дикинсон Критикал Кэар Системс Пте Лтд.», Сингапур

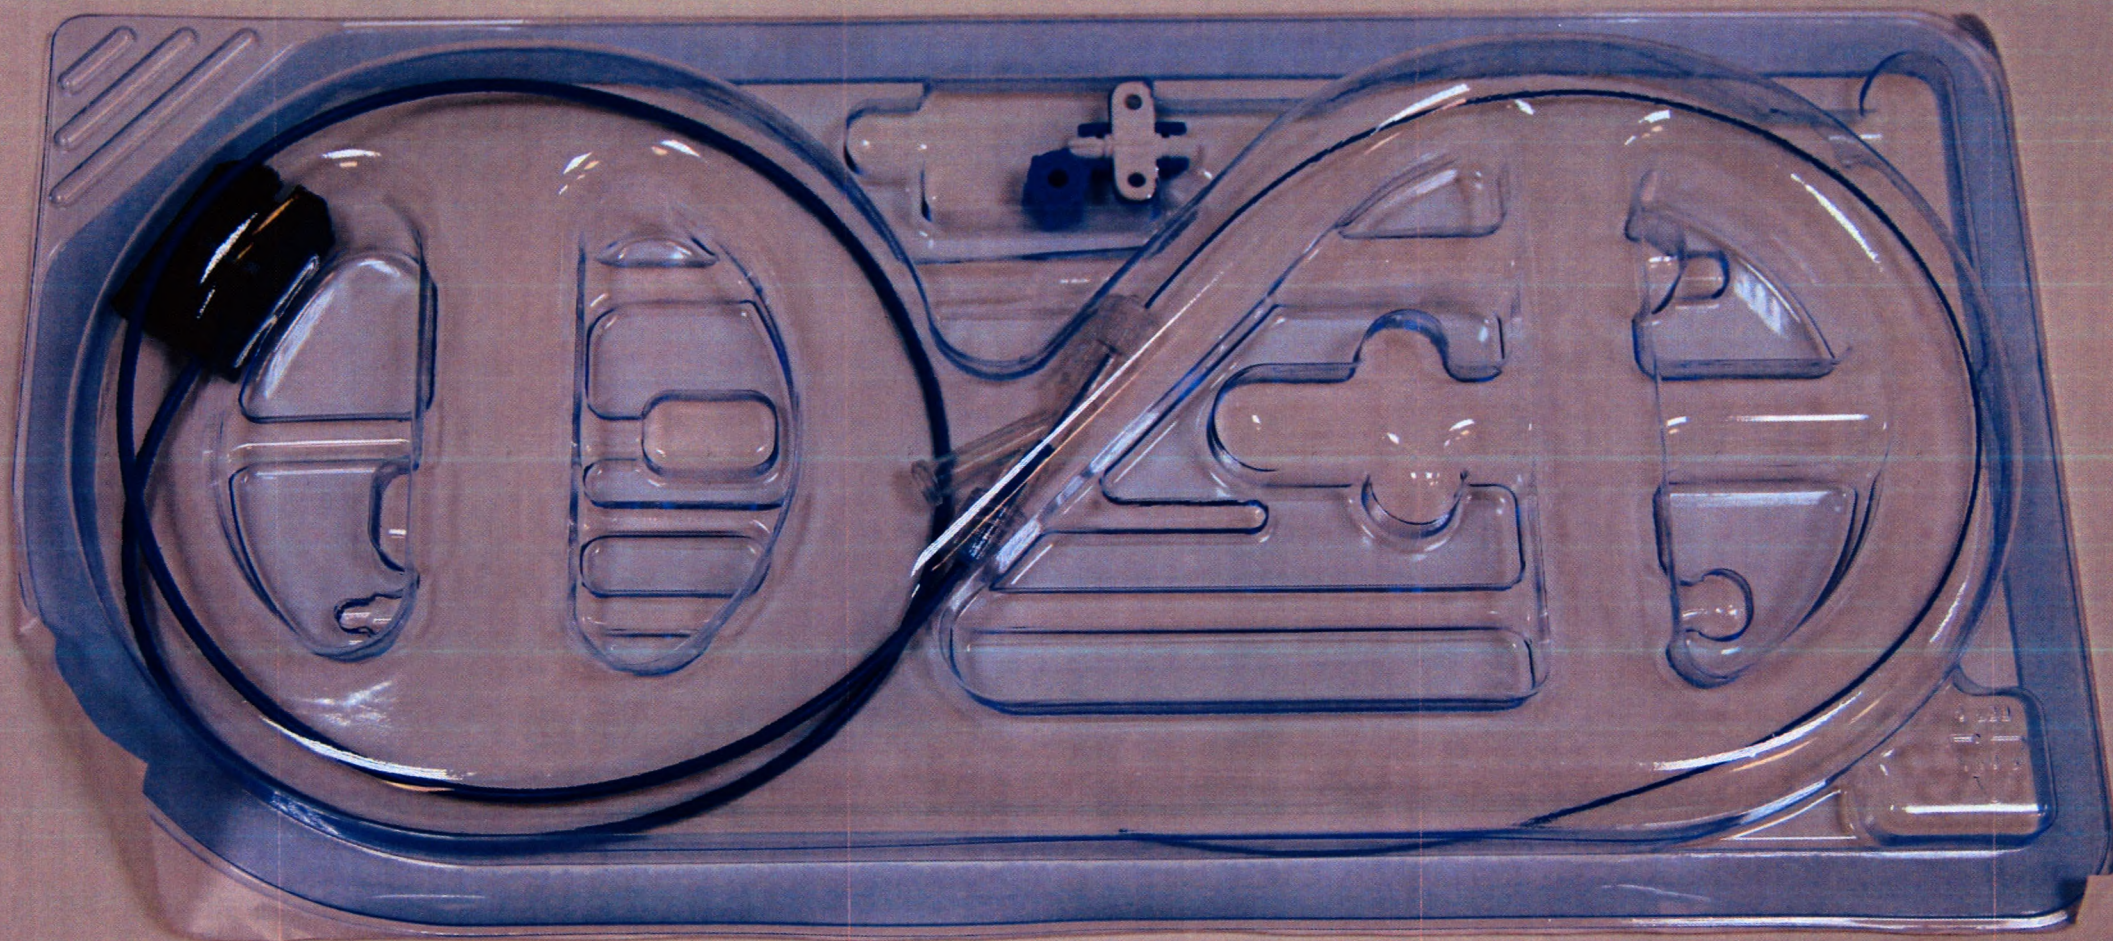

37. Одноразовый фиброоптический датчик CeVOX: PV2022-30, PV2022-31, PV2022-32, PV2022-33, PV2022-34, PV2022-35, PV2022-36, PV2022-37, PV2022-38, PV2022-46, PV2022-47, PV2022-48

38. Оптический модуль для PiCCO2: PC3015




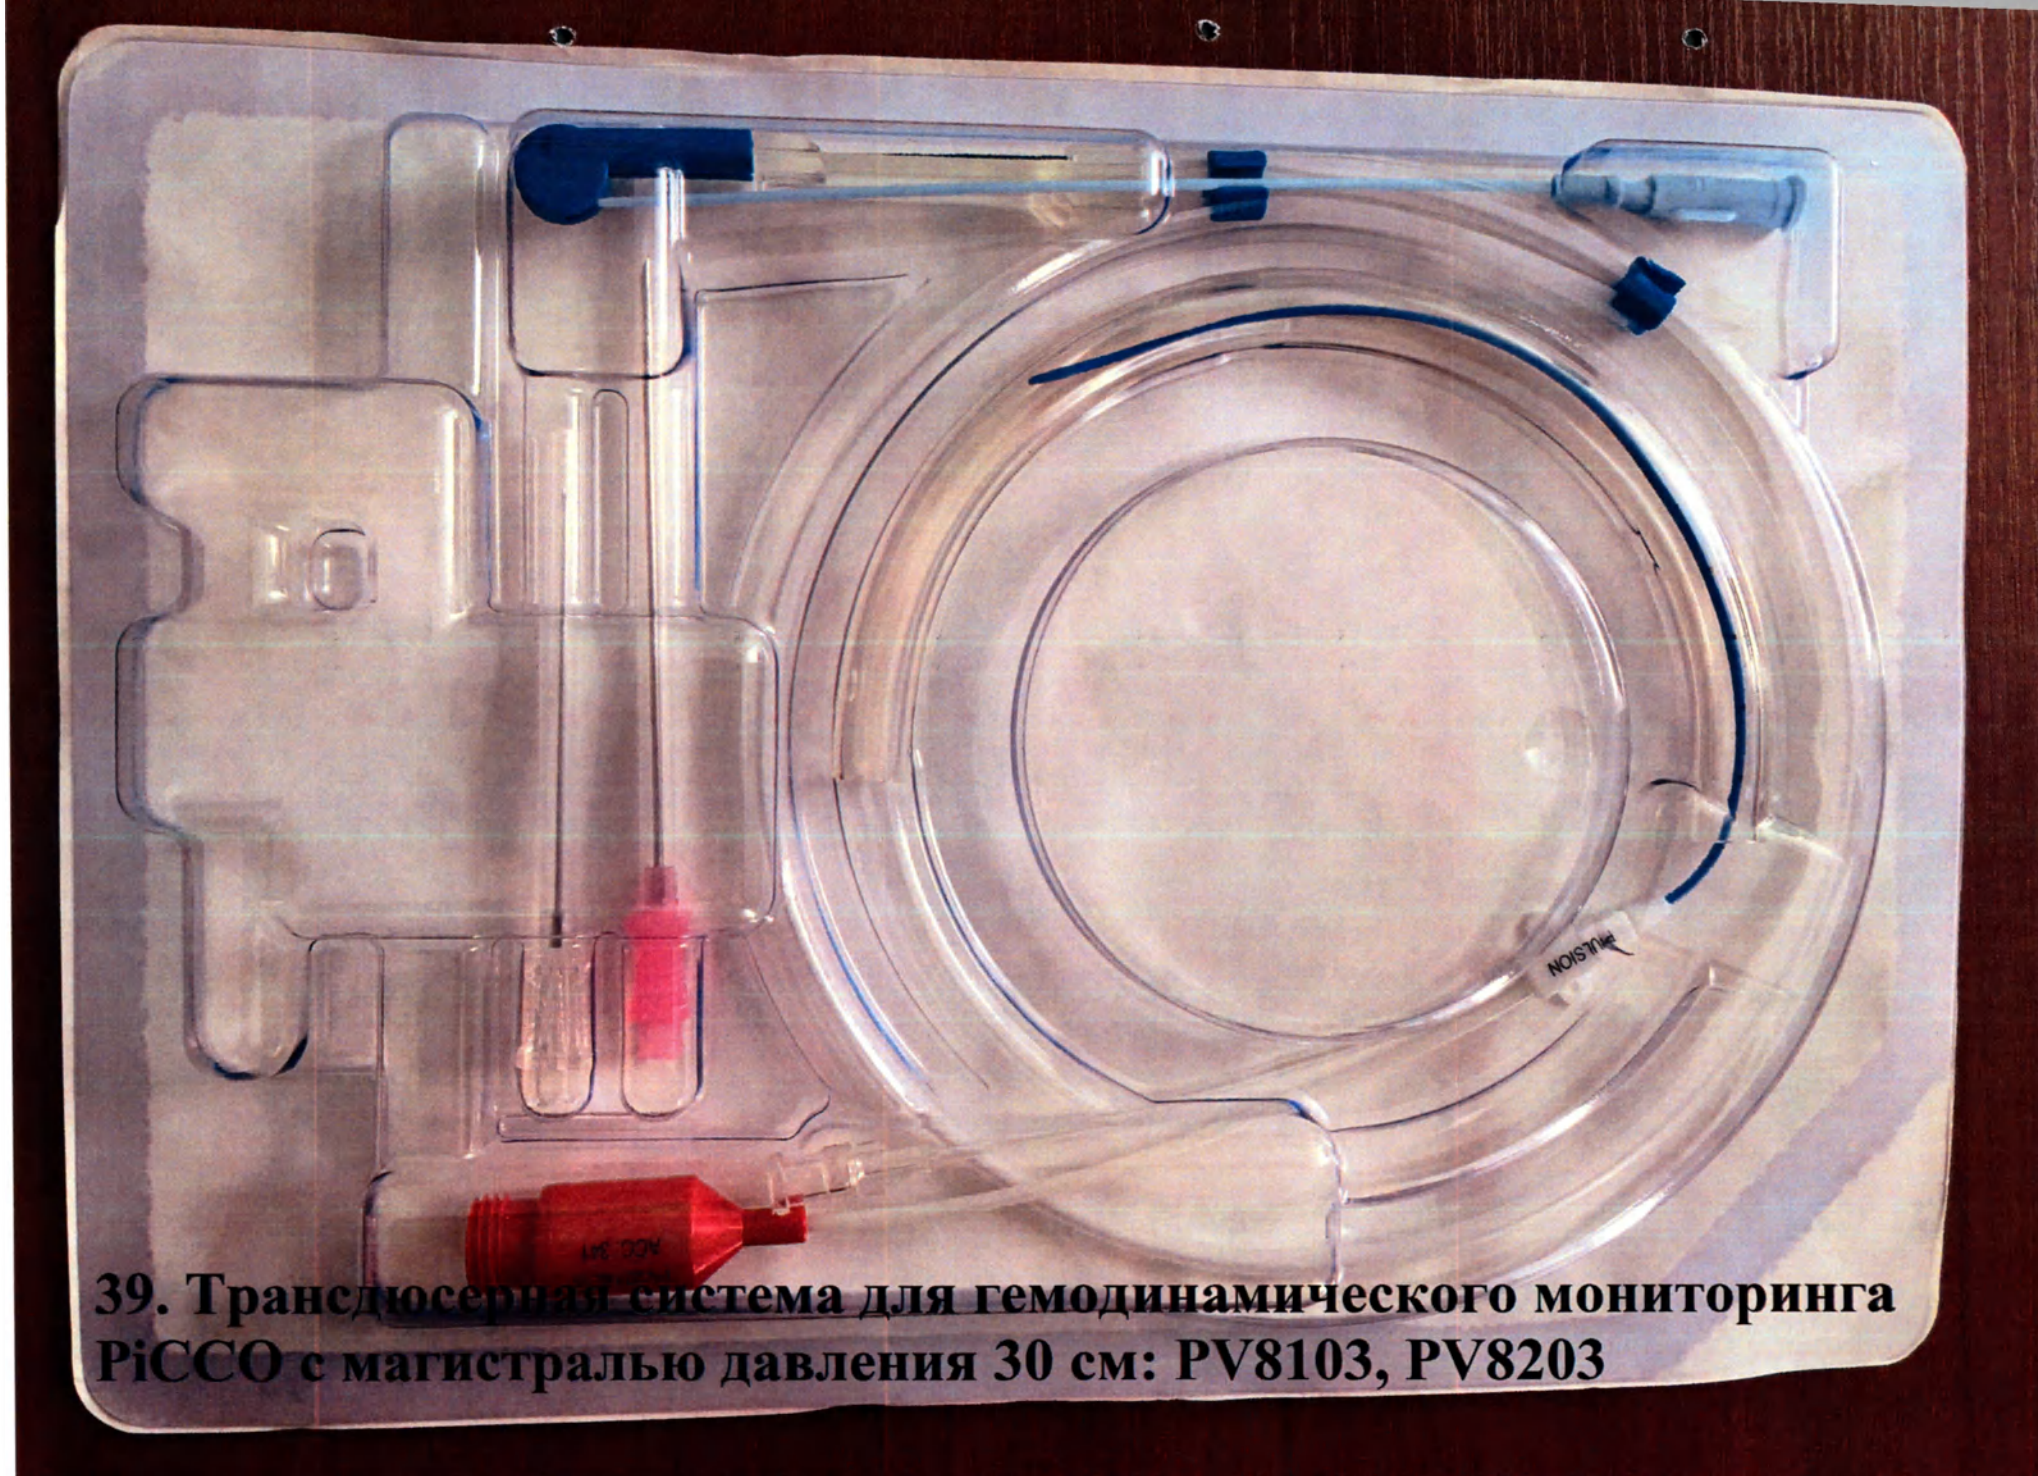


39. Трансдюсерная система для гемодинамического мониторинга PiCCO с магистралью давления 30 см: PV8103, PV8203




**40. Трансдюсерная система для гемодинамического мониторинга
PiCCO: PV8115, PV8215, PV8215-2, PV8115CVP, PV8215CVP**

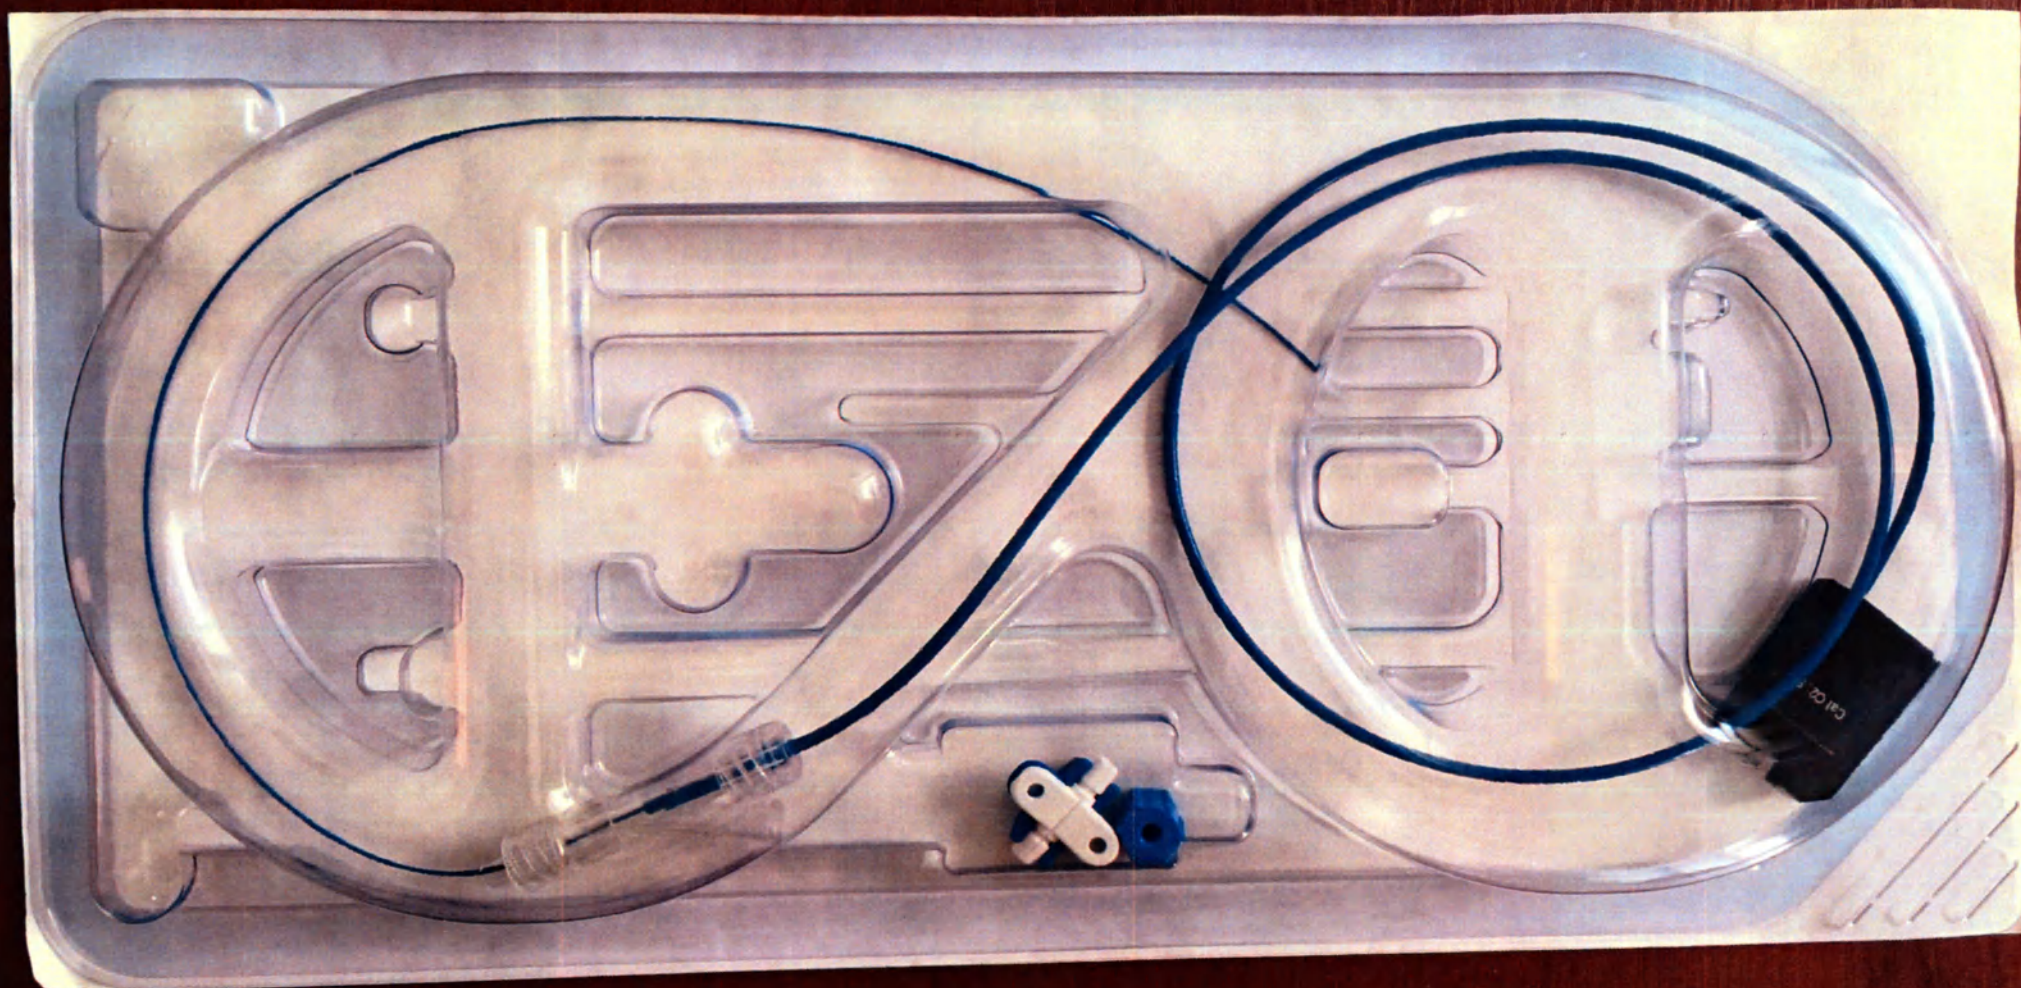


**41. Трансдюсерная система для гемодинамического мониторинга
VoLEF: PV8515, PV8615**

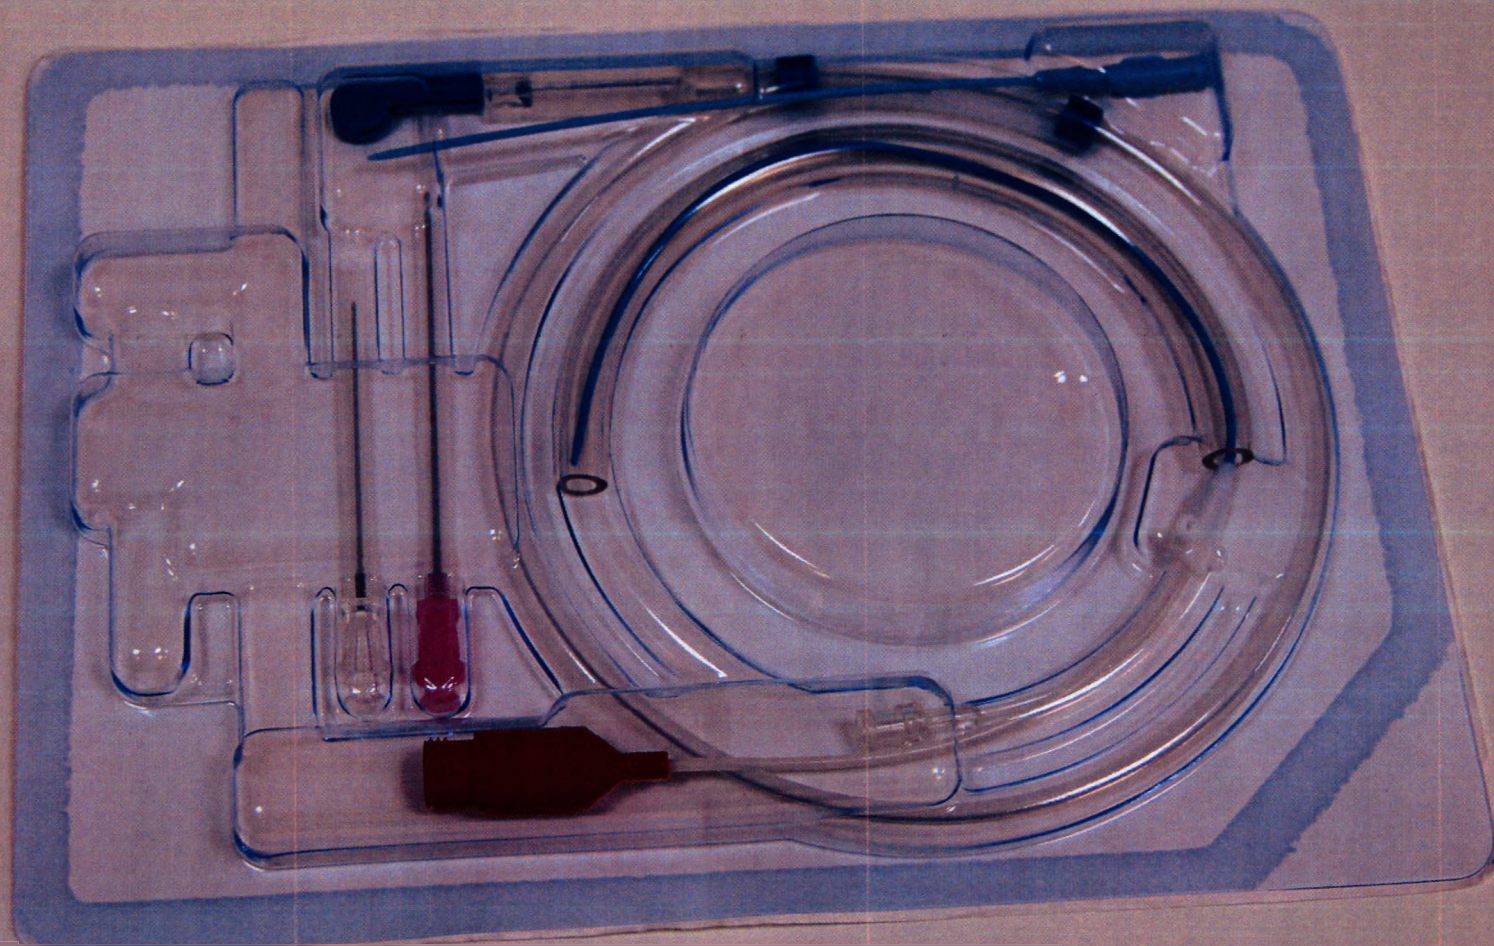

**42-46. PULSIOCATH 4F термодилуционный катетер длина 8 см: PV2014L08N,
PULSIOCATH 4F термодилуционный катетер длина 16 см: PV2014L16N,
PULSIOCATH 4F термодилуционный катетер длина 22 см: PV2014L22N,
PULSIOCATH 4F термодилуционный катетер длина 50 см: PV2014L50LGWN,
PULSIOCATH 5F термодилуционный катетер длина 20 см: PV2015L20N**

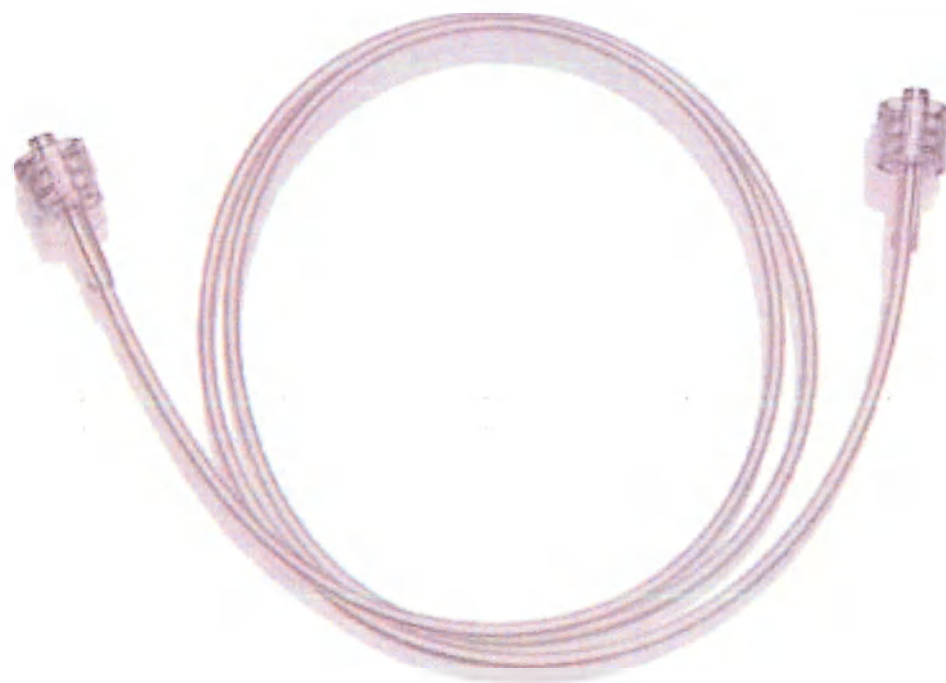



47. Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии, производства "Intersurgical Ltd", Великобритания

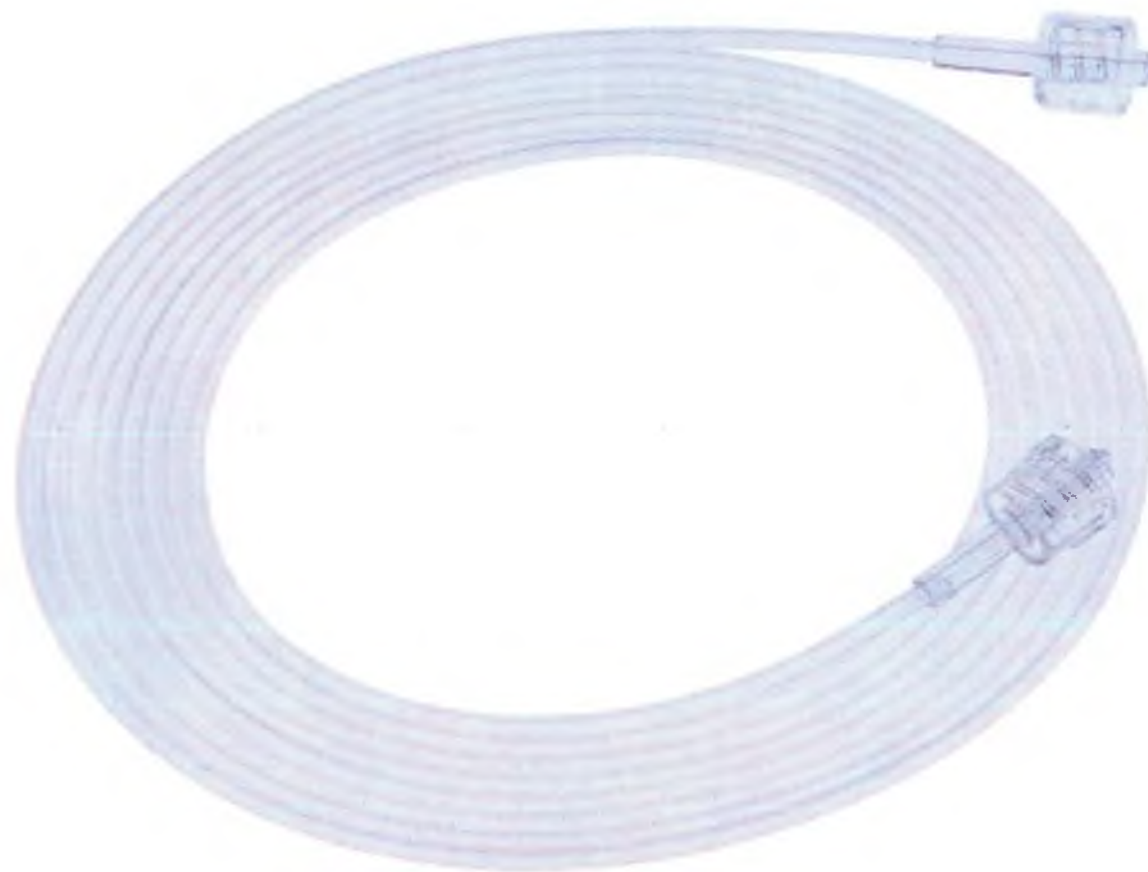

47. Контуры и трубки дыхательные, эндотрахеальные, трахеостомические (виды 275820; 185610; 185600; 136260; 136500), производства «Ковидиен Ллс» США



47. Трубки дыхательные, производства «Флексикэр Медикал Лимитед», Великобритания

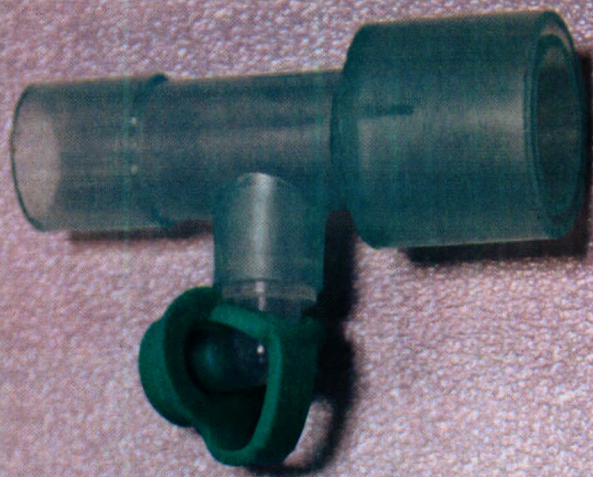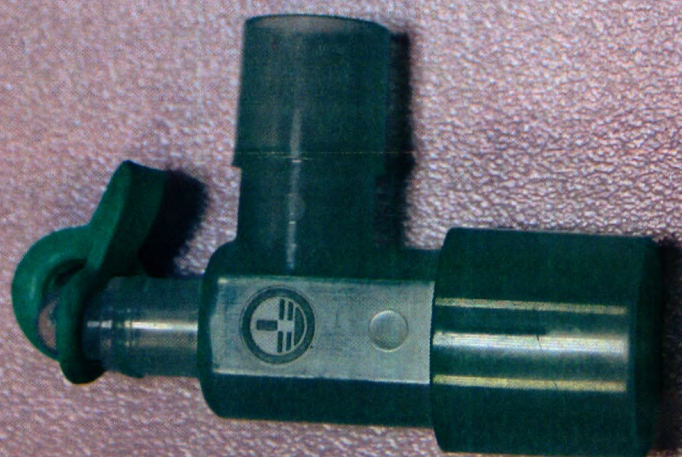

48. Соединители: жесткие, эластомерные, гибкие, шарнирные, прямые, угловые, Т-образные, Y-образные, адаптеры, производства «Intersurgical Ltd», Великобритания



48. Адаптеры (вид 151450), производства «Ковидиен Ллс» США



48. Переходники, производства «Флексикэр Медикал Лимитед», Великобритания



**49. Влагосборники для дыхательных контуров
для взрослых, для детей и для новорожденных,
производства «Intersurgical Ltd»,
Великобритания**



**49. Влагосборник многократного
использования (вид 260480),
производство "Ковидиен Лтс", США**



**49. Влагосборник, производства
«Флексикэр Медикал Лимитед»,
Великобритания**




50. Набор для капнометрии (ETCO₂) с технологией microstream для взрослых (линии забора проб газа, фильтры), производства "Шэньчжэнь Миндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.", КНР



50. Комплекты Filter Line (гидрофобный фильтр, носовые канюли, пробозаборный канал, опознавательный ключ, соединительные линии, байтблок, воздухозаборный адаптер), производства "Оридион Медикал 1987 Лтд.", Израиль



51. Набор для капнометрии (ETCO₂) с технологией microstream для детей (линии забора проб газа, фильтры)

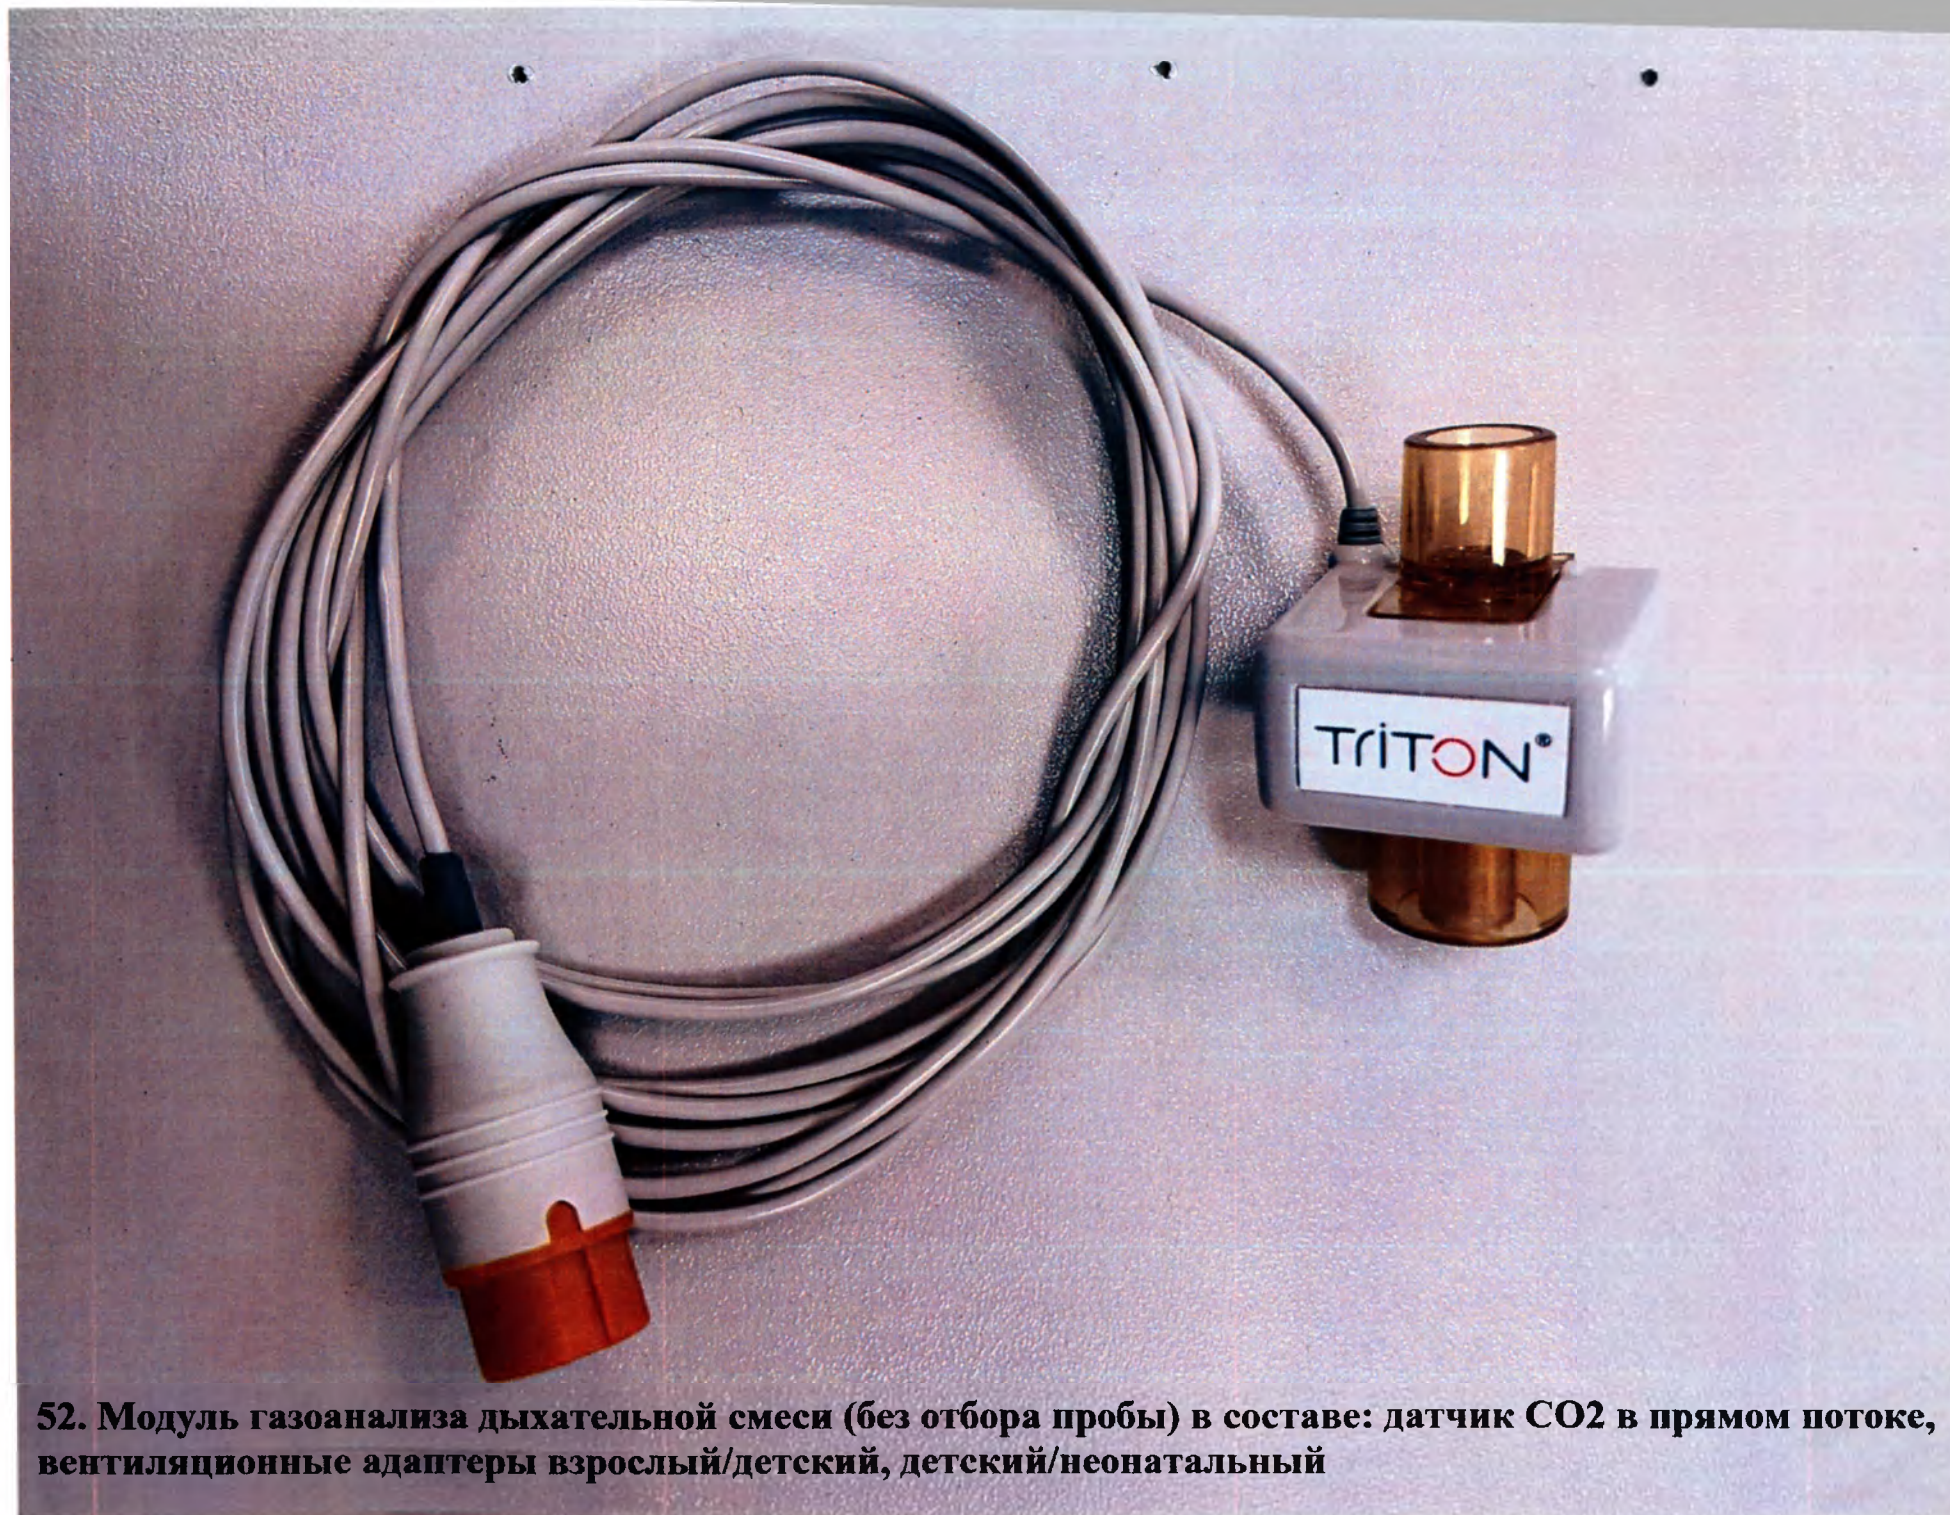

52. Модуль газоанализа дыхательной смеси (без отбора пробы) в составе: датчик CO₂ в прямом потоке, вентиляционные адаптеры взрослый/детский, детский/неонатальный



53. Набор для капнометрии (ЕТСО₂) в боковом потоке для взрослых (воздушные адаптеры, влагоуловители, линии отбора проб газа, носовые канюли)



54. Набор для капнометрии (ЕТСО₂) в боковом потоке для детей (воздушные адаптеры, влагоуловители, линии отбора проб газа, носовые канюли)



55. Набор для измерения концентрации CO₂ в микропотоке, для новорожденных



56. Набор для измерения внутричерепного давления (кабели, датчики)



57. Цифровой преобразователь сигнала с кабелем для соединения с основным блоком или цифровой билатеральный преобразователь сигнала с кабелем для соединения с основным блоком



57.1 Сенсоры Одноразовые для



57.2. Сенсоры Одноразовые для детей, производства "Ковидиен ЛлС"




57.3. Сенсоры одноразовые билатеральные для взрослых, производства "Ковидиен Ллс"



57.4. Сенсоры Одноразовые билатеральные для детей, производства "Ковидиен Ллс"



58. Монитор оценки глубины анестезии МГА-06 по ТУ 9441-013-32119398-2012

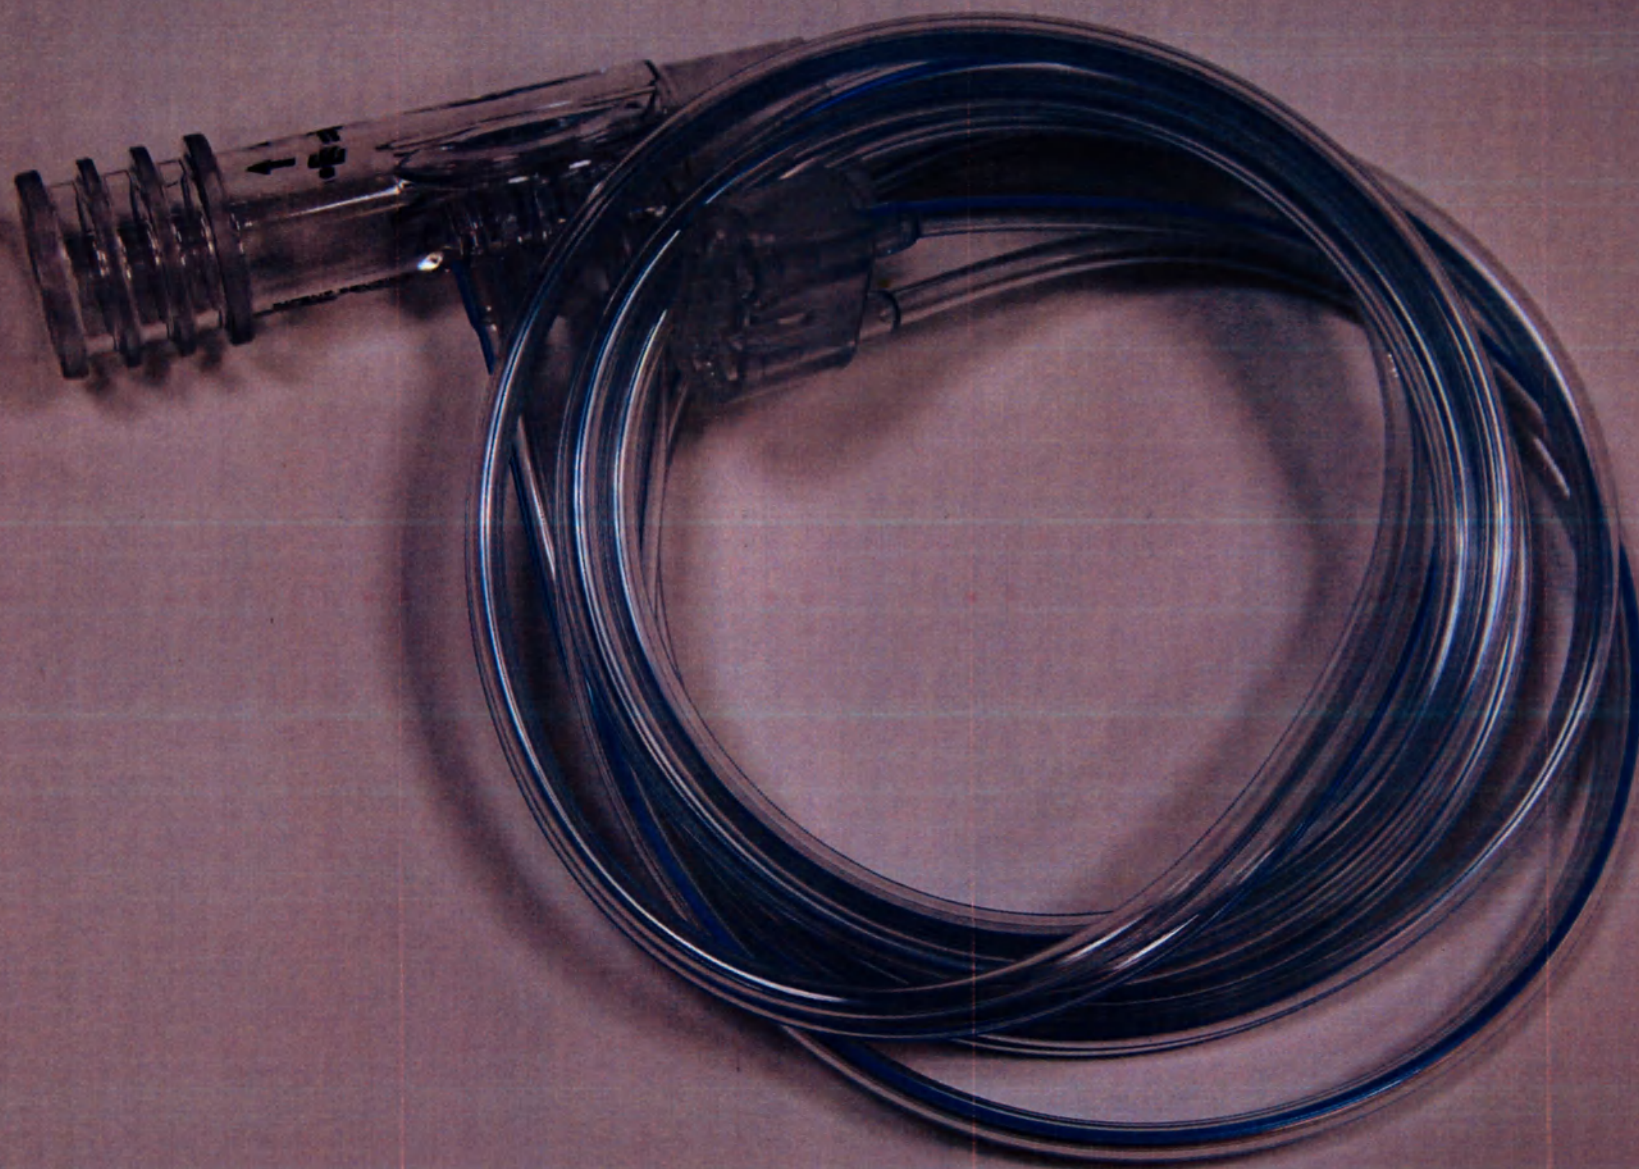


59. Набор для мониторинга дыхания (RM) для детей (датчики потока, удлинители)




60. Набор для мониторинга дыхания (RM) для взрослых (датчики потока, удлинители)




**61. Стойка передвижная для крепления монитора,
производства "Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.,
Ltd., Китай"**

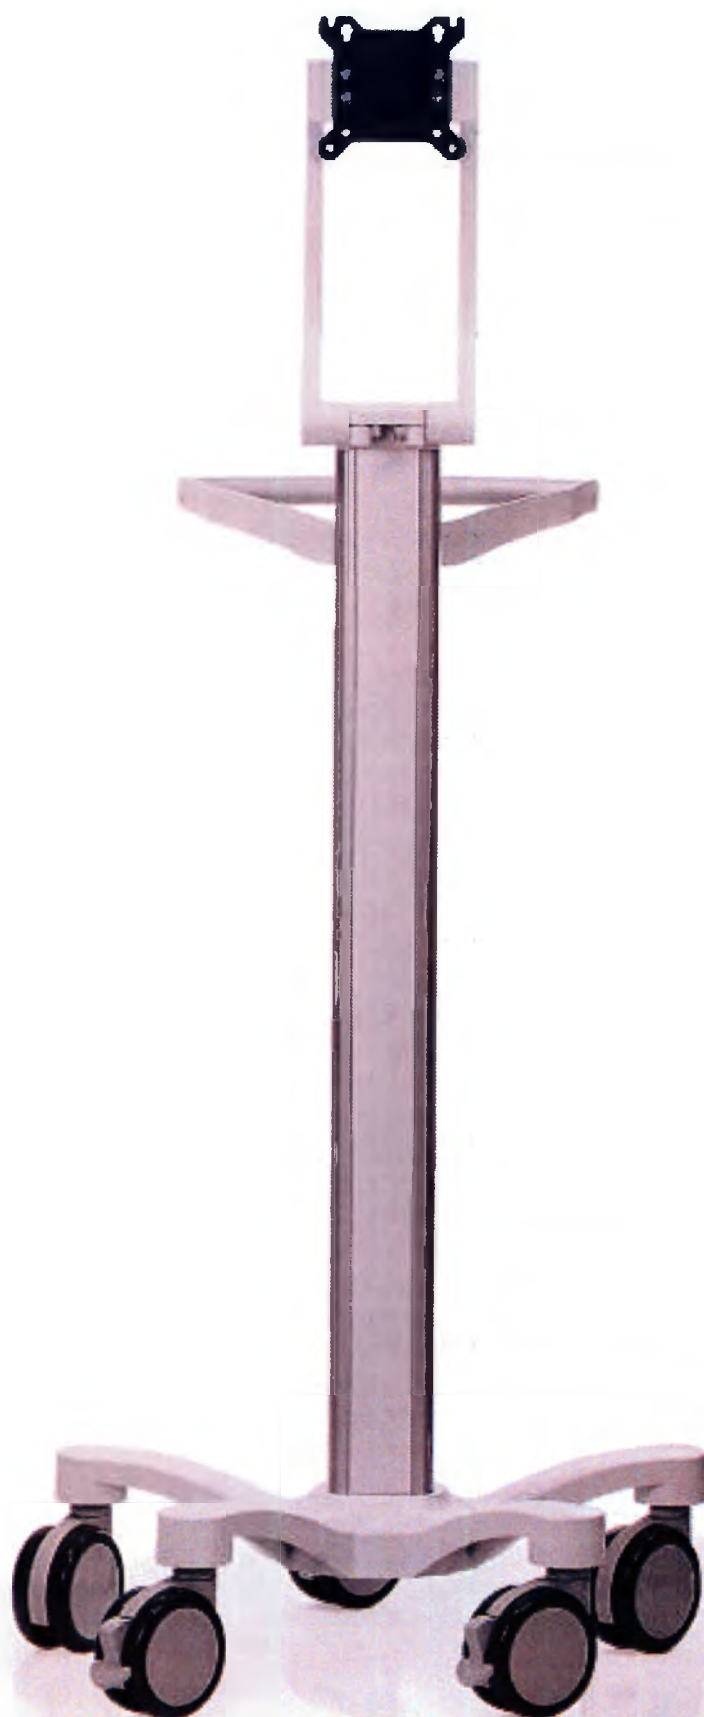

**61. Установочное оборудование,
производства ООО фирма "Тритон-
ЭлектроникС", Россия**

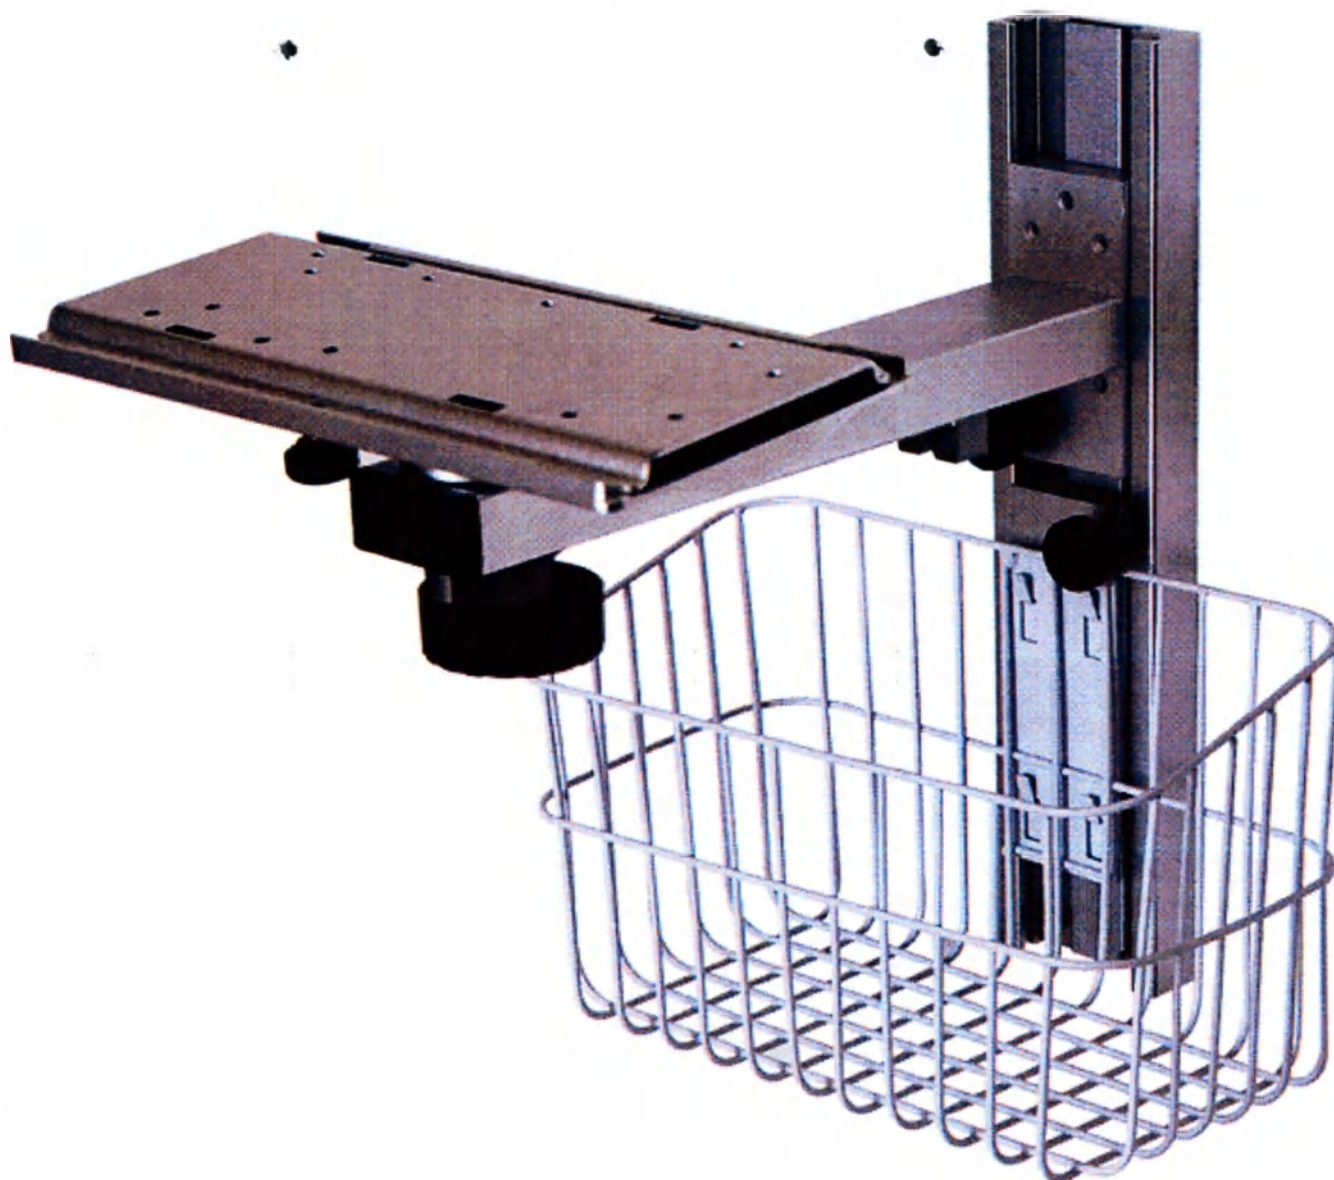

62. Настенный монтажный кронштейн для основного блока

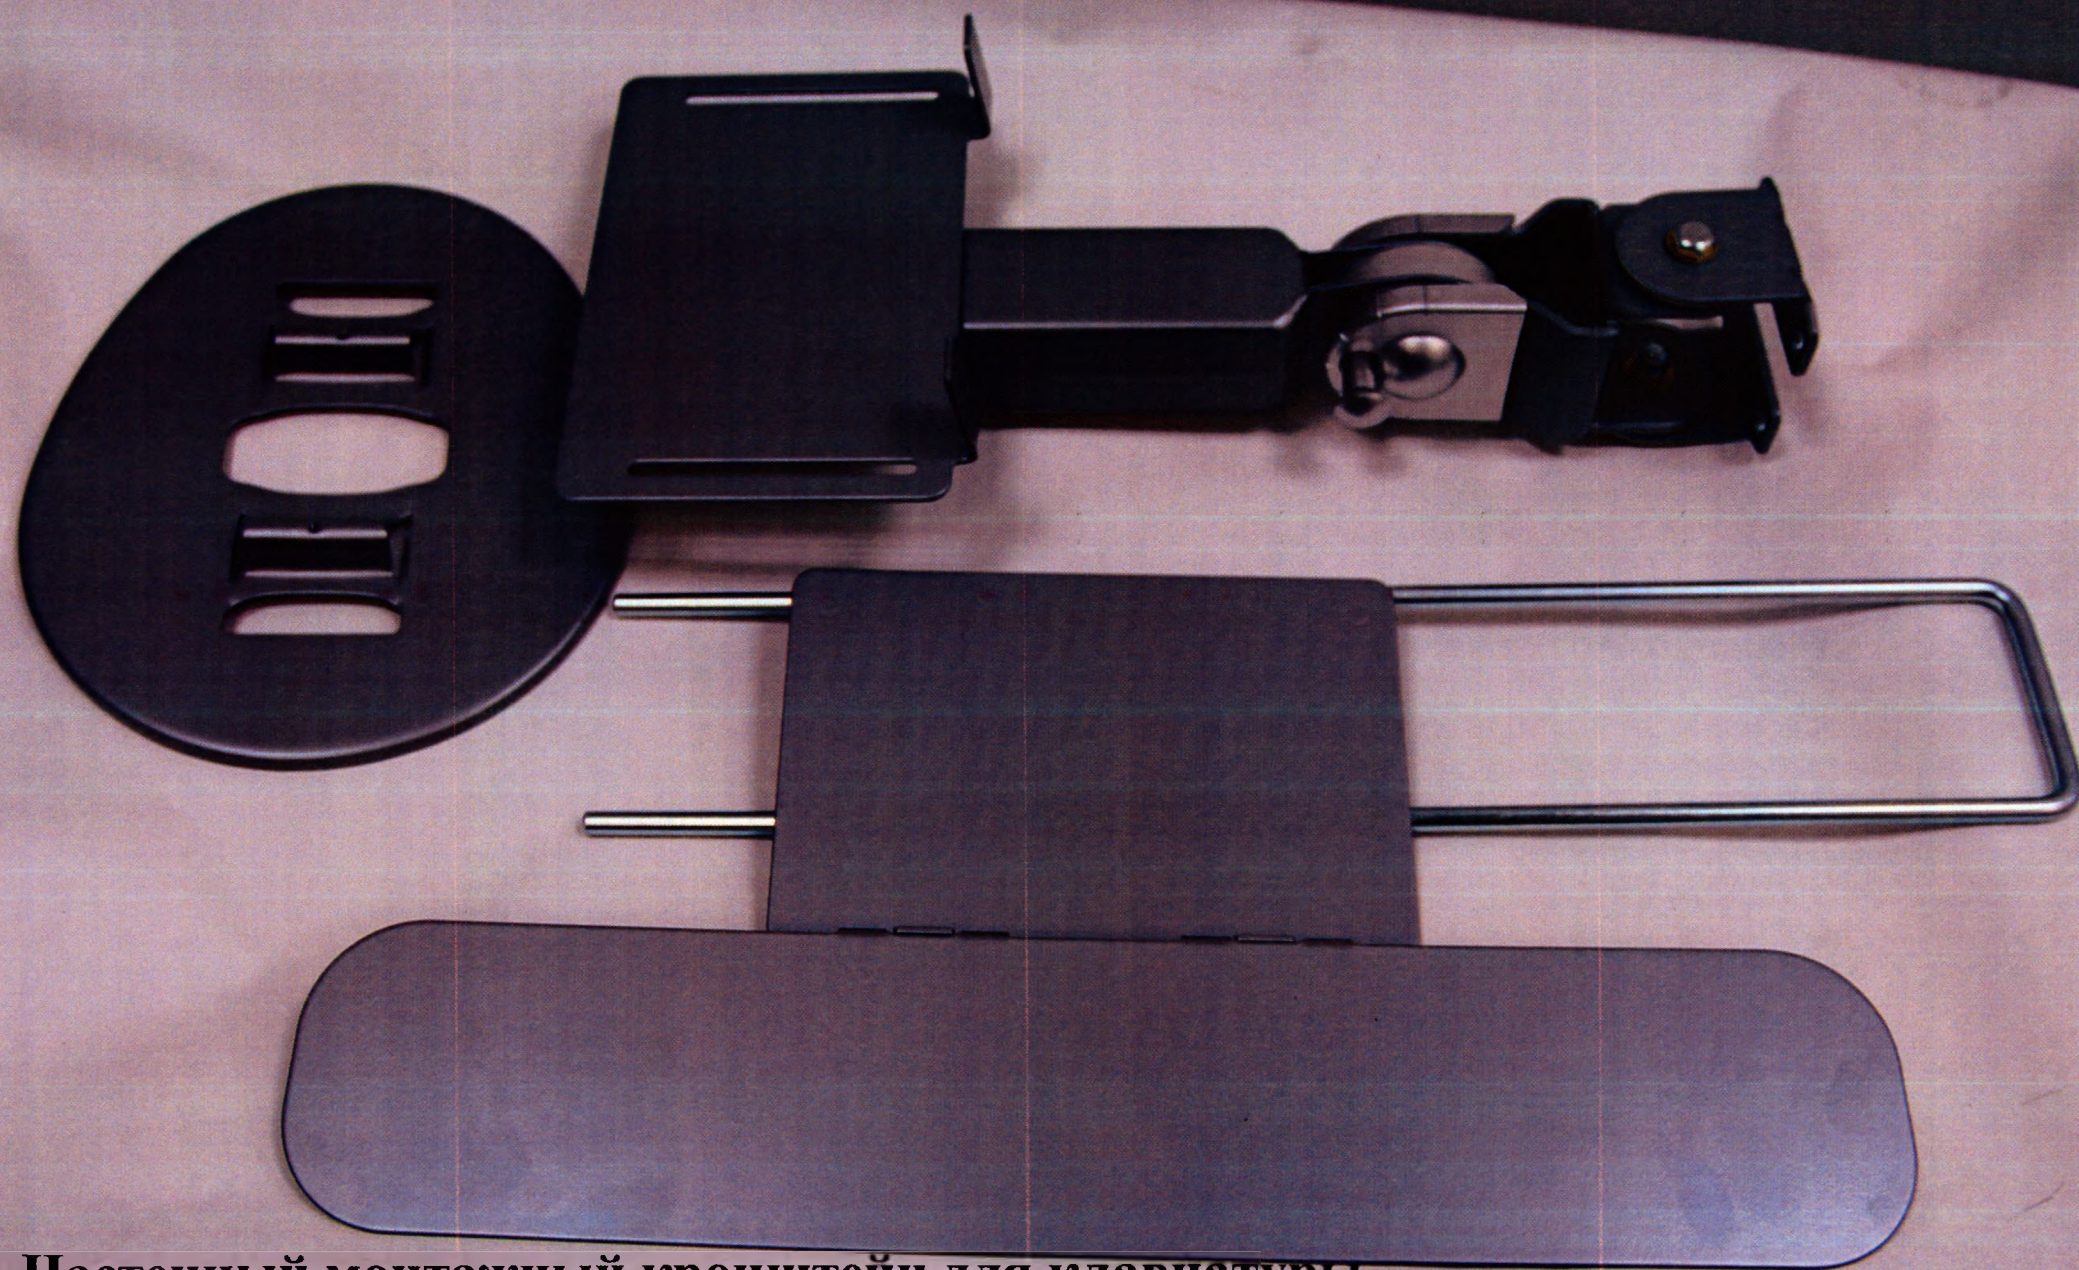

63. Настенный монтажный кронштейн для клавиатуры



64. Кабель сетевой, производства "Шэньчжэнь Миндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.", КНР



64. Кабель питания, производства "Электрическая мануфактура", Россия




65. Кабель для вызова медсестры



66. Кабель синхронизации с дефибриллятором



67. Аккумулятор литий-ионный

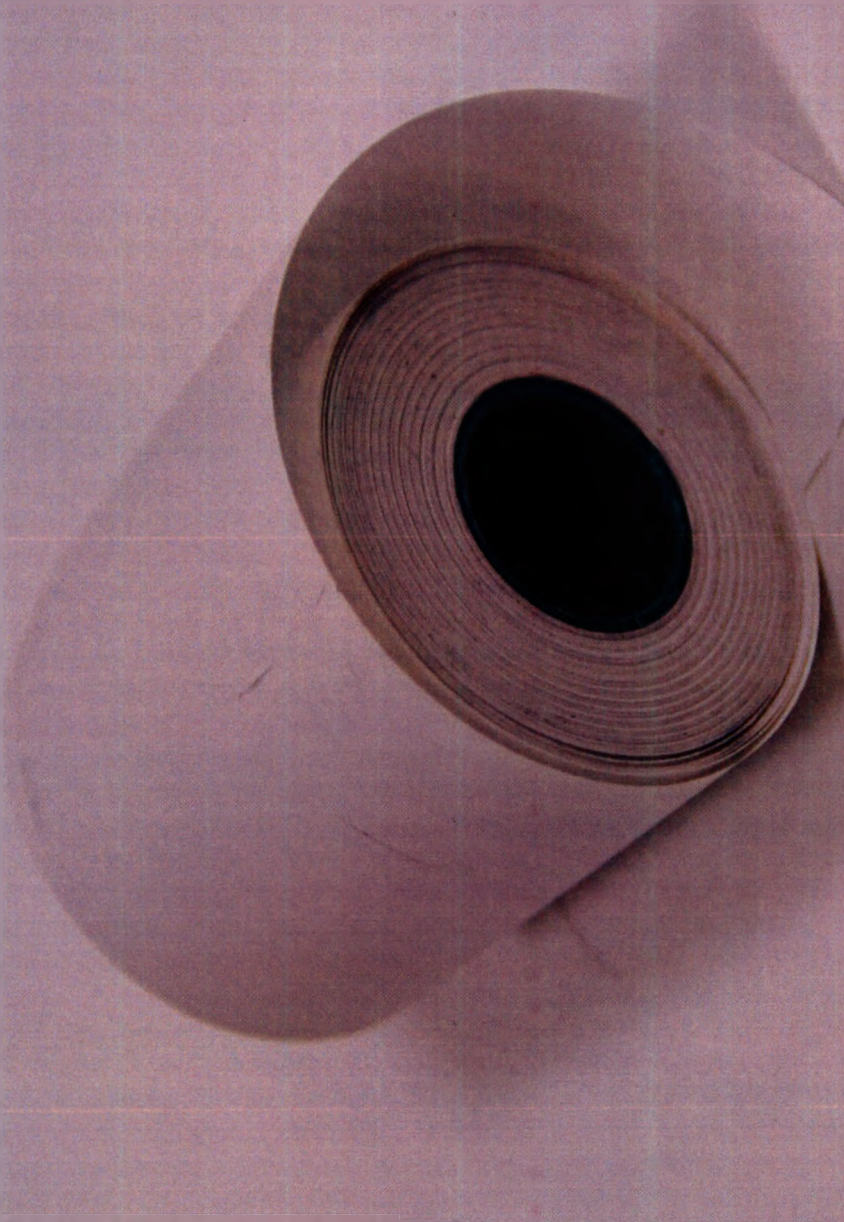

68. Термобумага



69.1 Программное обеспечение HYPERVISOR VI



1. Industrial Compact Flash




2. Защитная USB-заглушка



3.1. Хост-компьютер



3.2. Дисплей

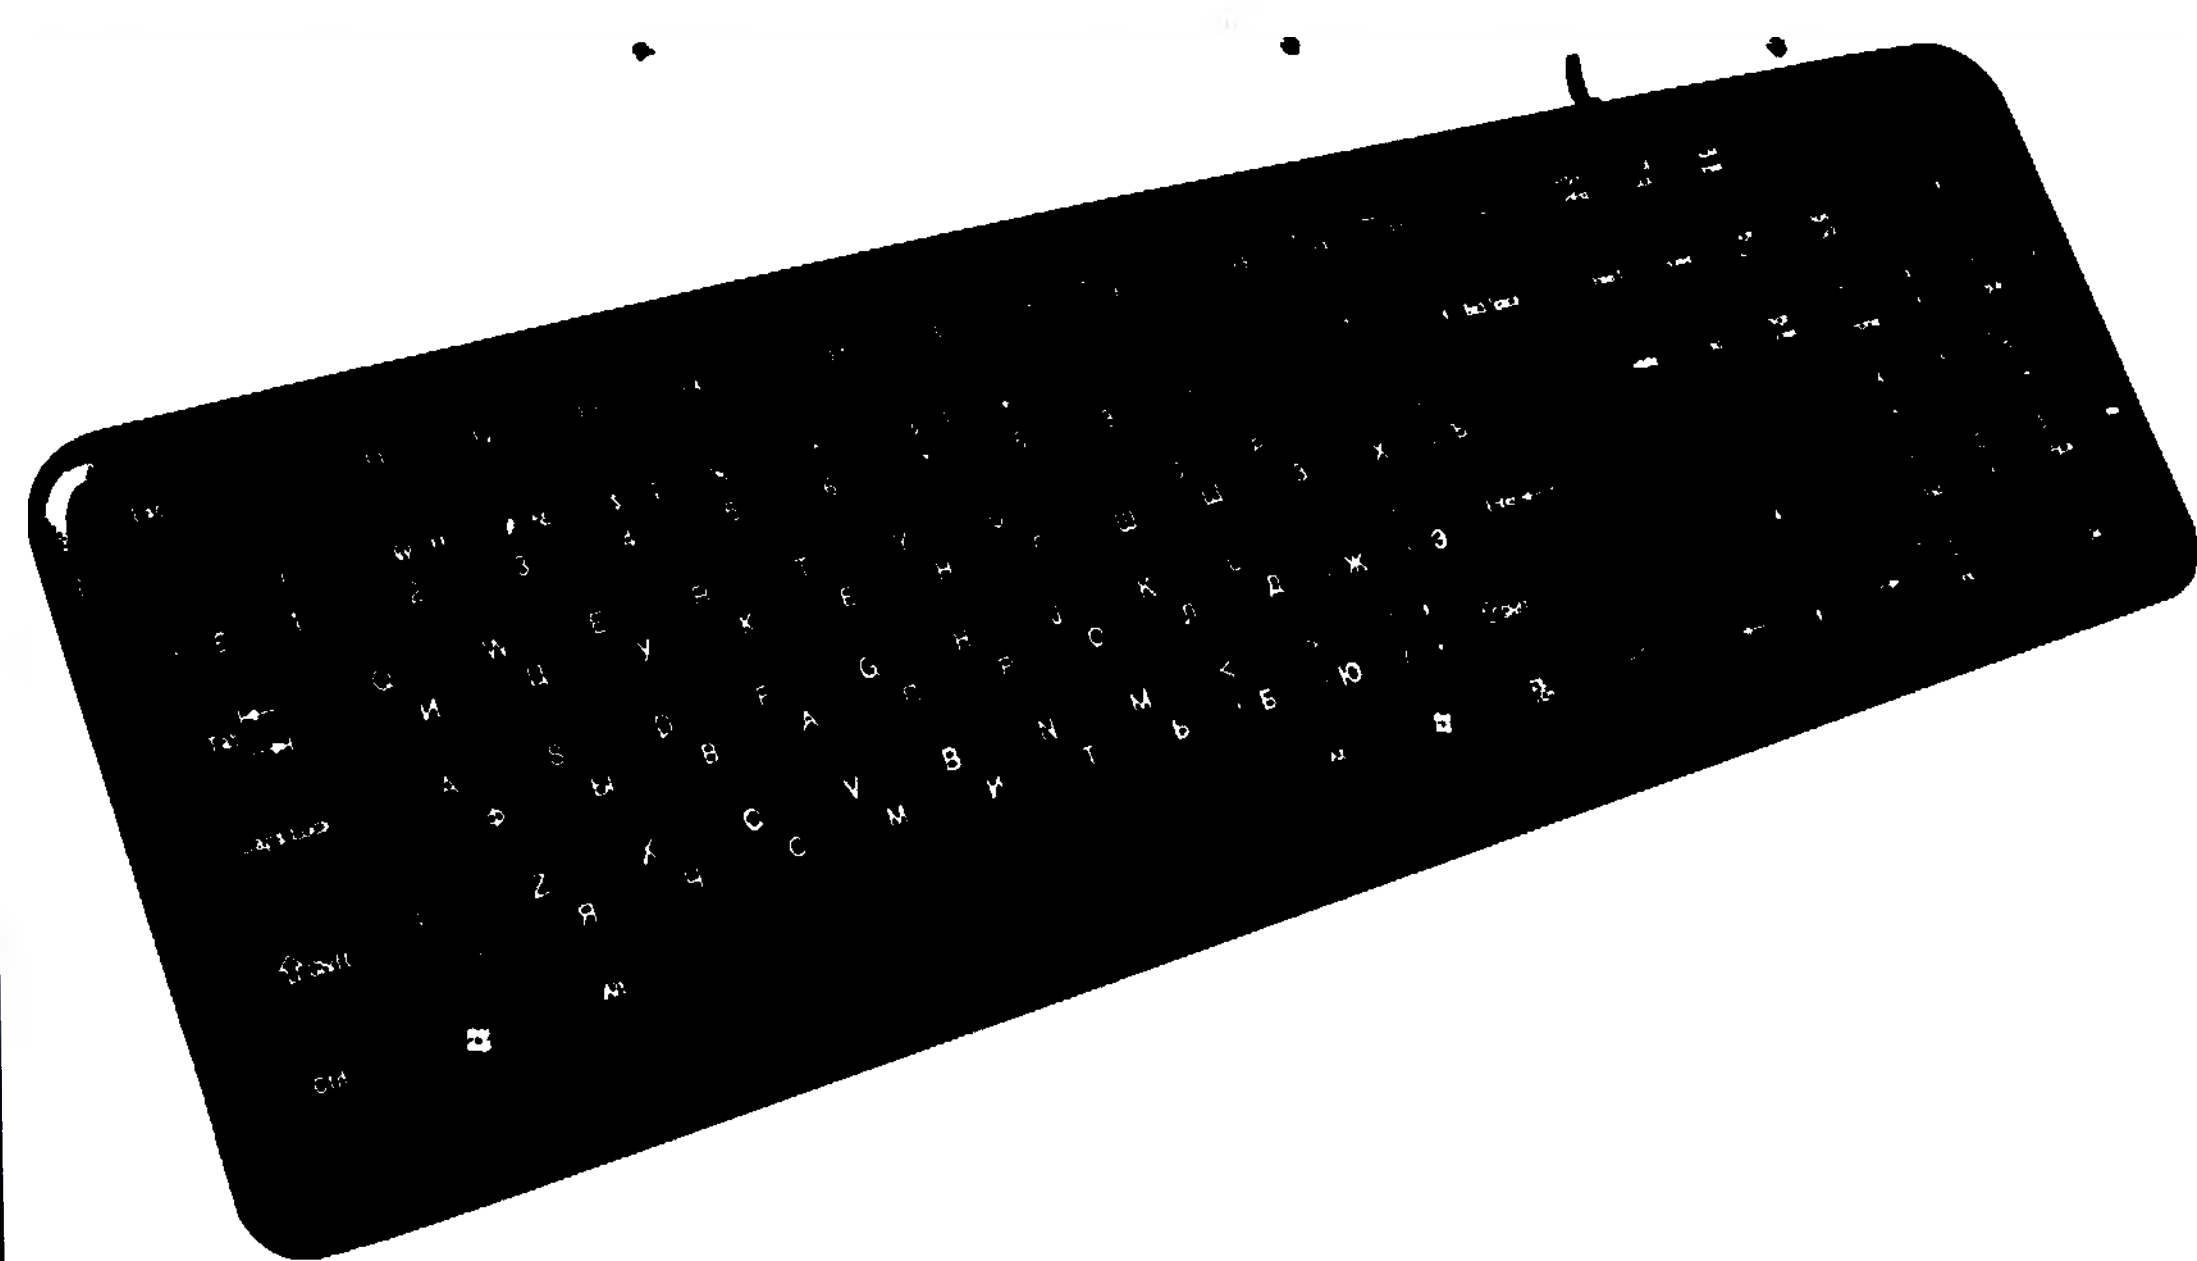

3.3. Клавиатура



3.4. Мышь



3.5. Принтер лазерный



3.6. Адаптер USB-VGA



3.7. Адаптер VGA



3.8. Беспроводная точка доступа

прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 116 листов

Директор по качеству
ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»

А.Р. Овчинников



2017г.