

Утверждаю

Директор

ООО «Бизнес технология»

Назарова Н.К



Файл фото медицинского изделия
«Анализатор электролитов крови E-Lyte Plus
с принадлежностями»



Фото 1. Анализатор электролитов крови E-Lyte Plus. Вид спереди.

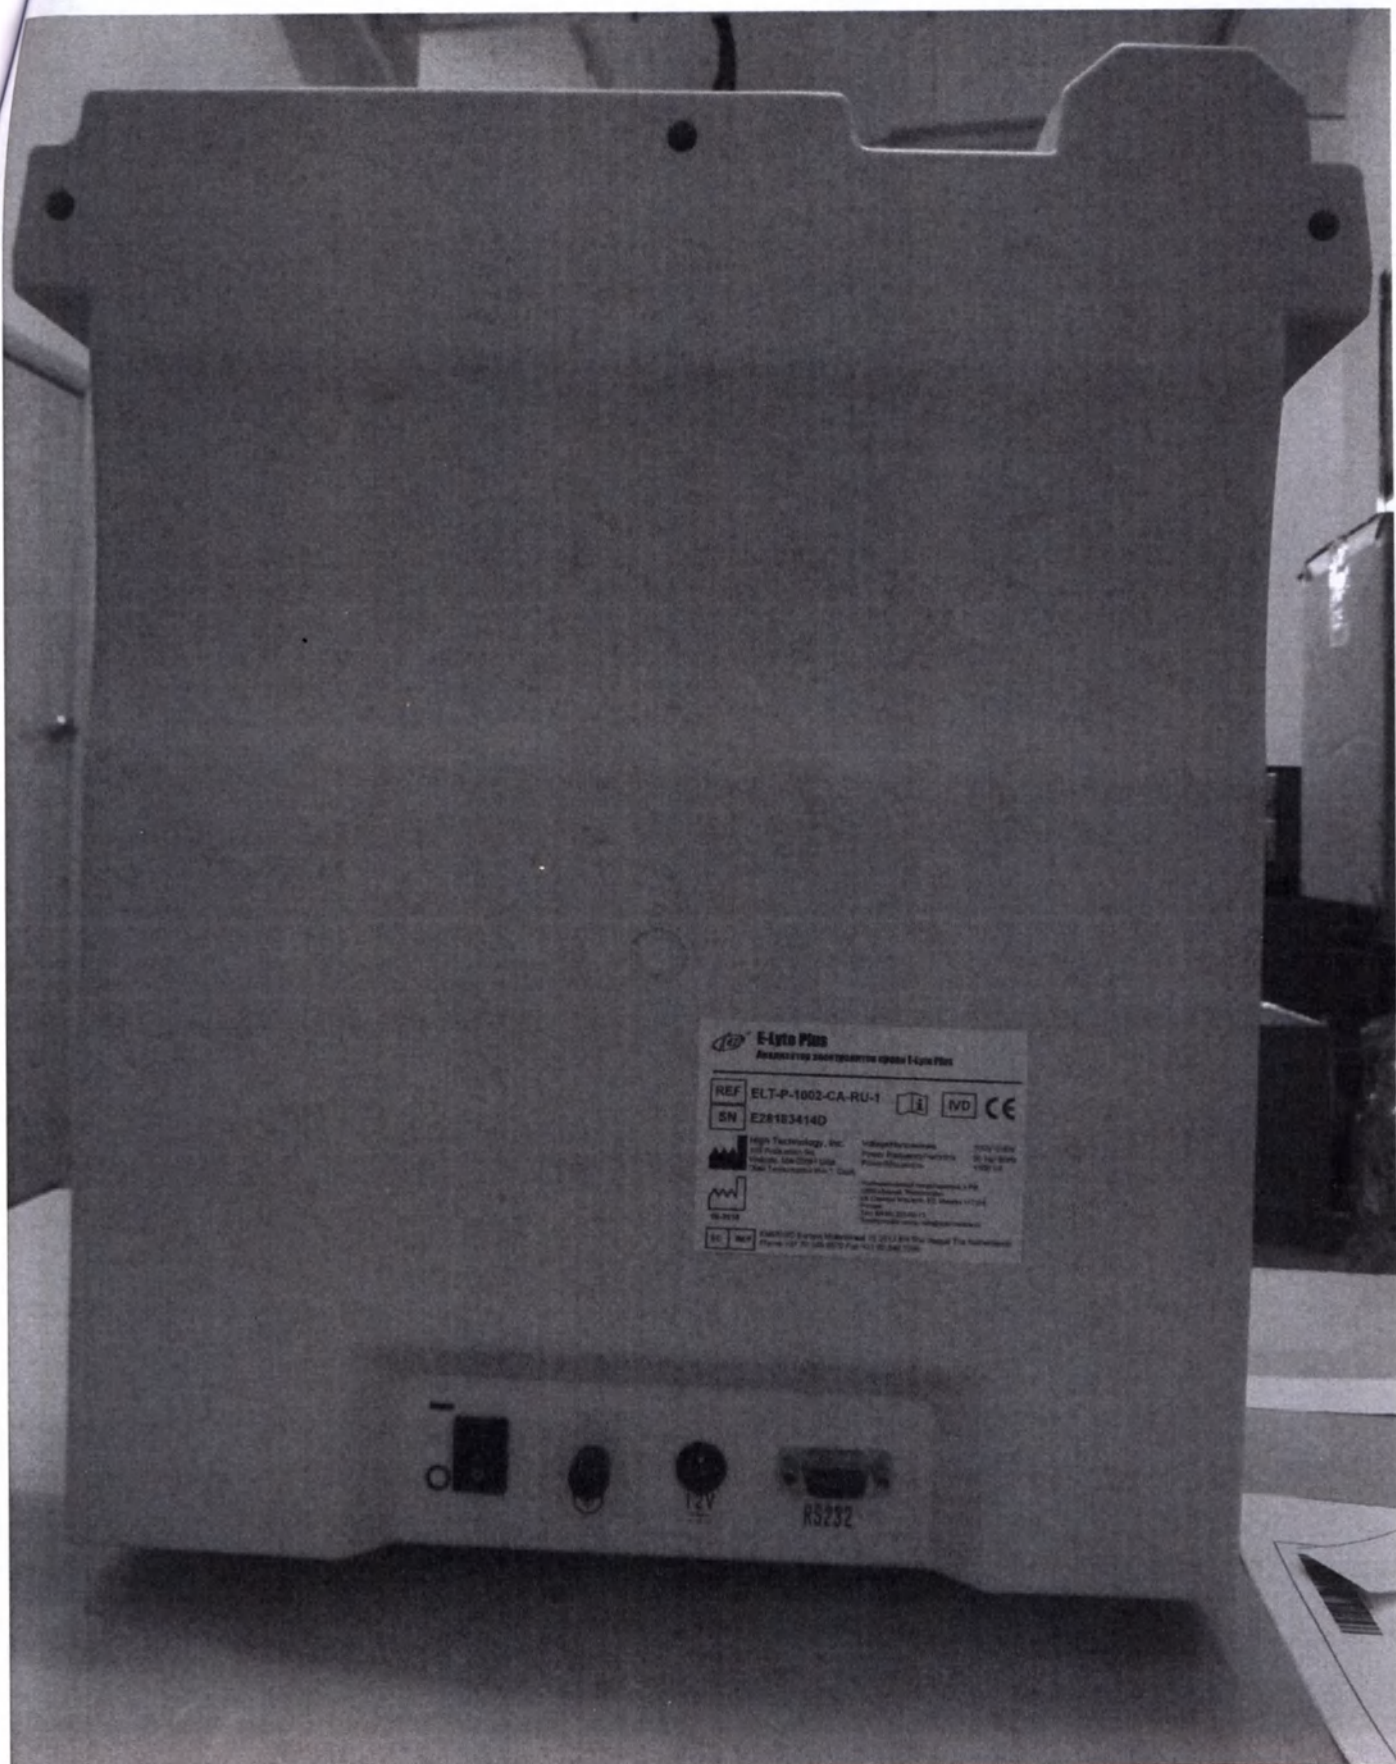


Фото 2. Анализатор электролитов крови E-Lyte Plus. Вид сзади.



E-Lyte Plus

Анализатор электролитов крови E-Lyte Plus

REF

ELT-P-1002-CA-RU-1



IVD



SN

E28183414D



High Technology, Inc.

109 Production Rd,

Walpole, MA 02081 USA

"Хай Текнолоджи Инк.", США

Voltage/Напряжение


100V~240V

Power Frequency/Частота

50 Hz/ 60Hz

Power/Мощность

<100 VA



08-2015

Уполномоченный представитель в РФ:

ООО «Бизнес Технологии»

ул. Саморы Машеля, 8/2, Москва 117198,

Россия

Тел: 8(495) 232-02-13

Электронная почта: info@intermedica.ru

EC

REP

EMERGO Europe Molenstraat 15 2513 BH The Hague The Netherlands
Phone +31 70 345 8570 Fax +31 70 346 7299



12V



RS232

Фото 3. Анализатор электролитов крови E-Lyte Plus. Маркировочная таблица.



Фото 4. Реагент-пак

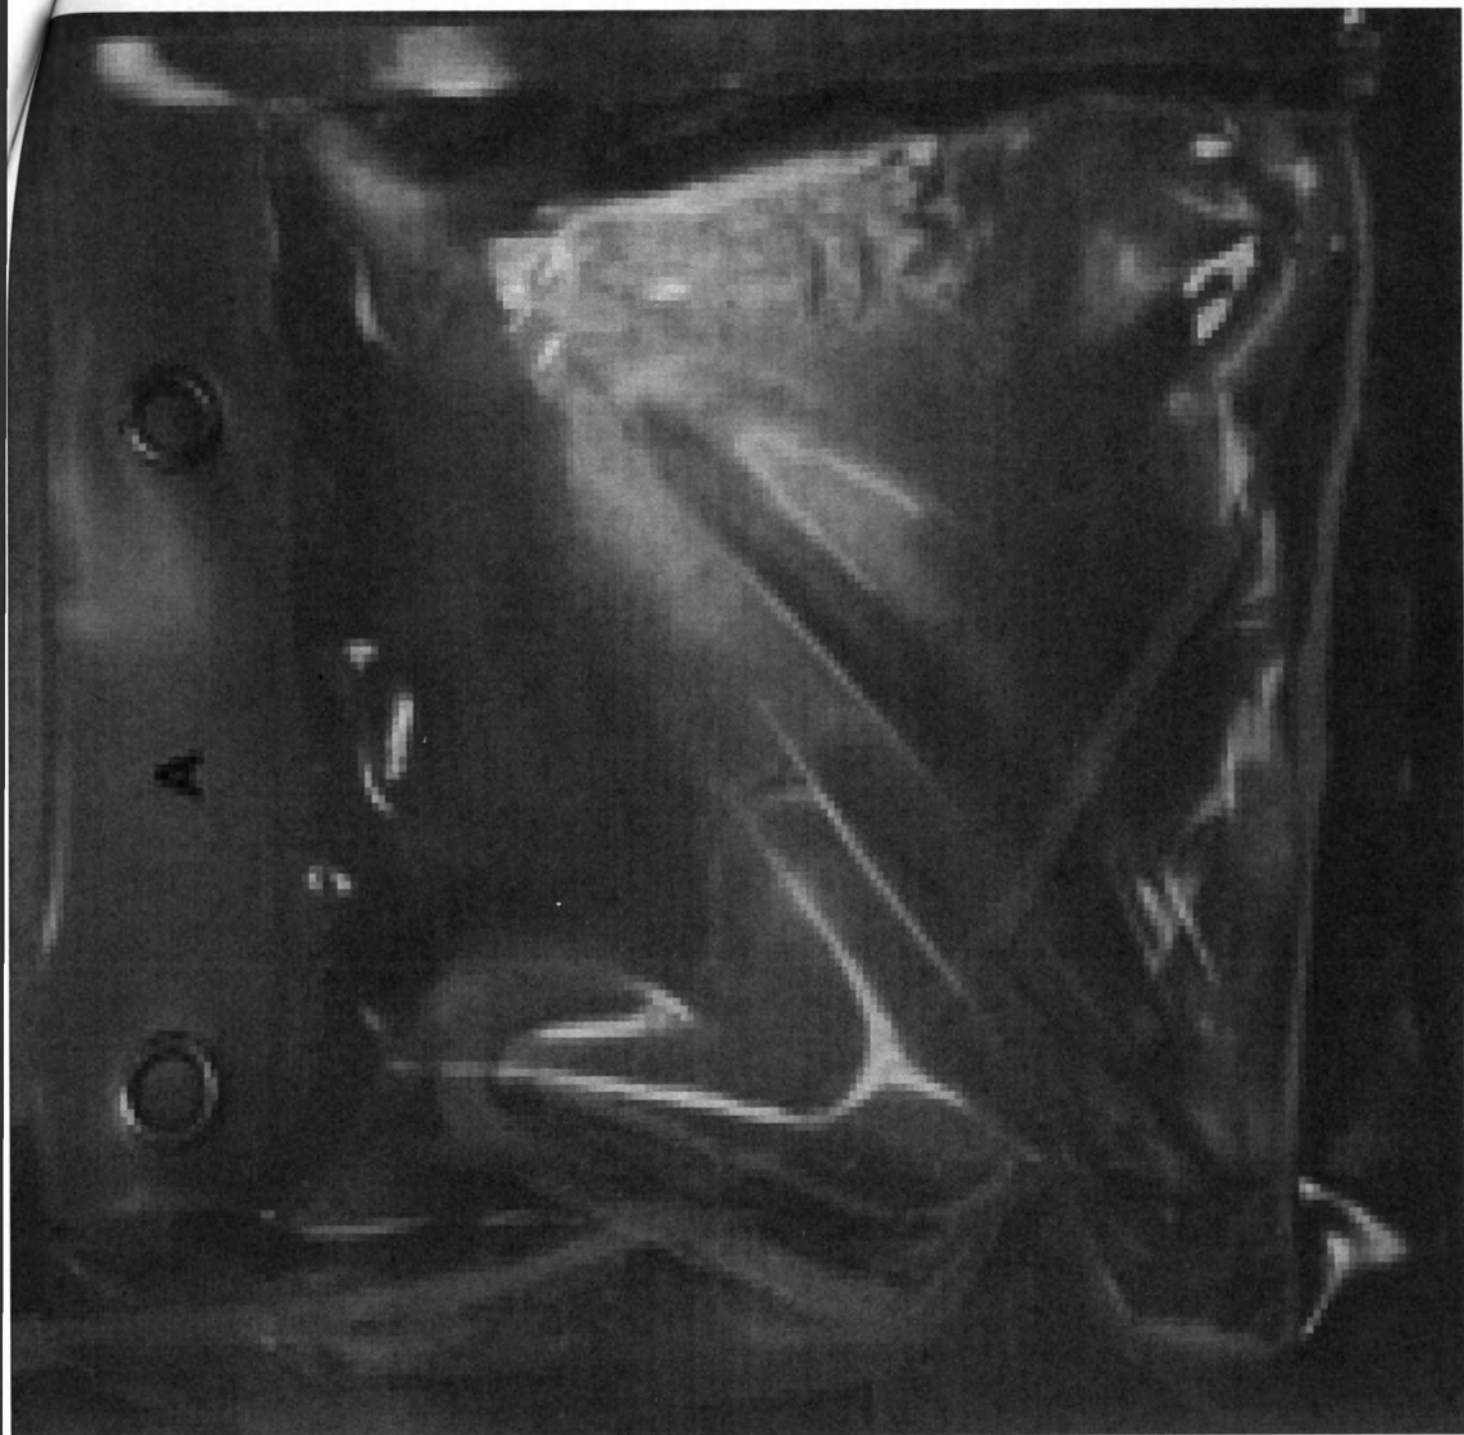


Фото 5.

Раствор стандарт А



Фото 6. Раствор стандарт В



Фото 7. Сетевой кабель

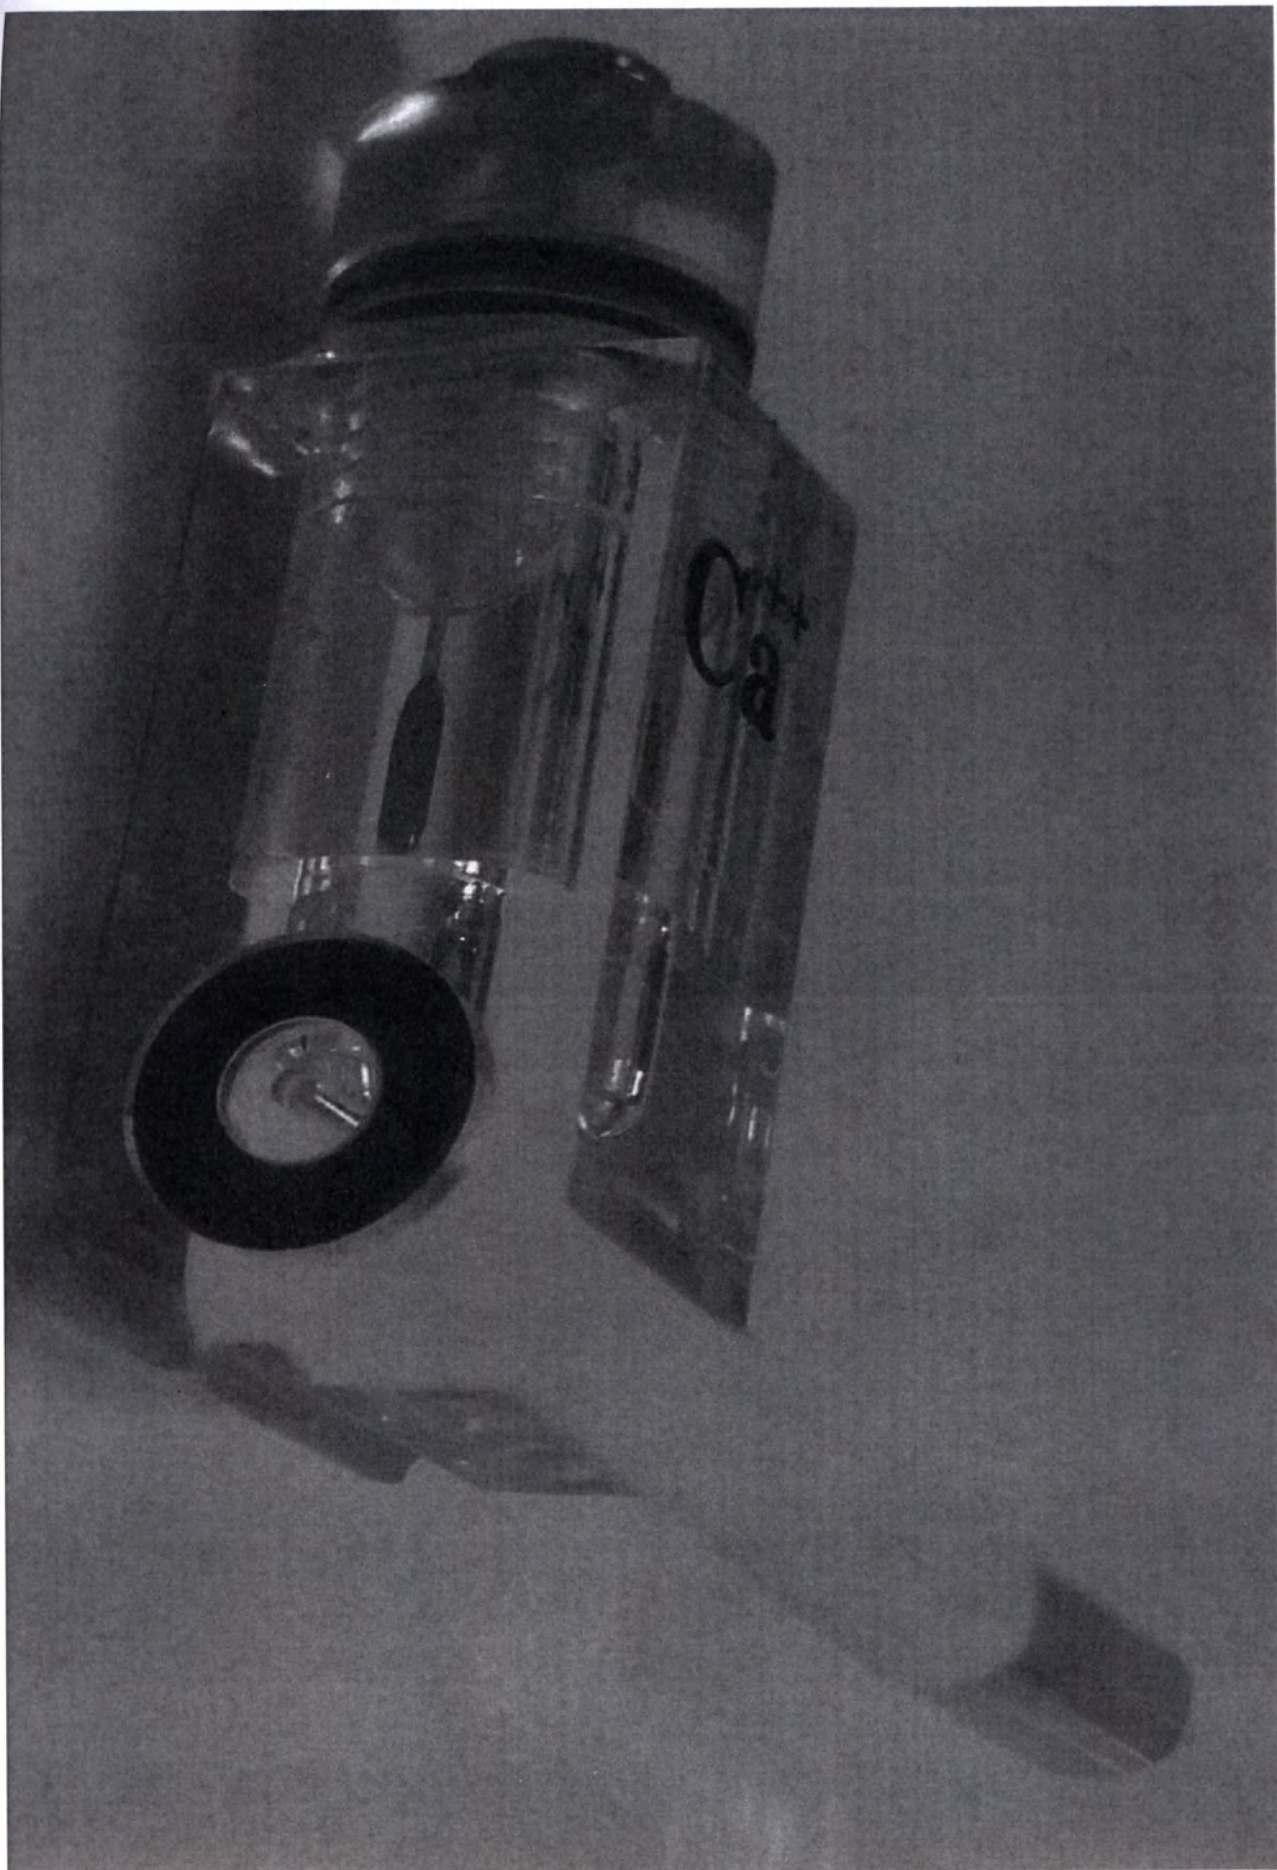


Фото 8. Электрод, Са

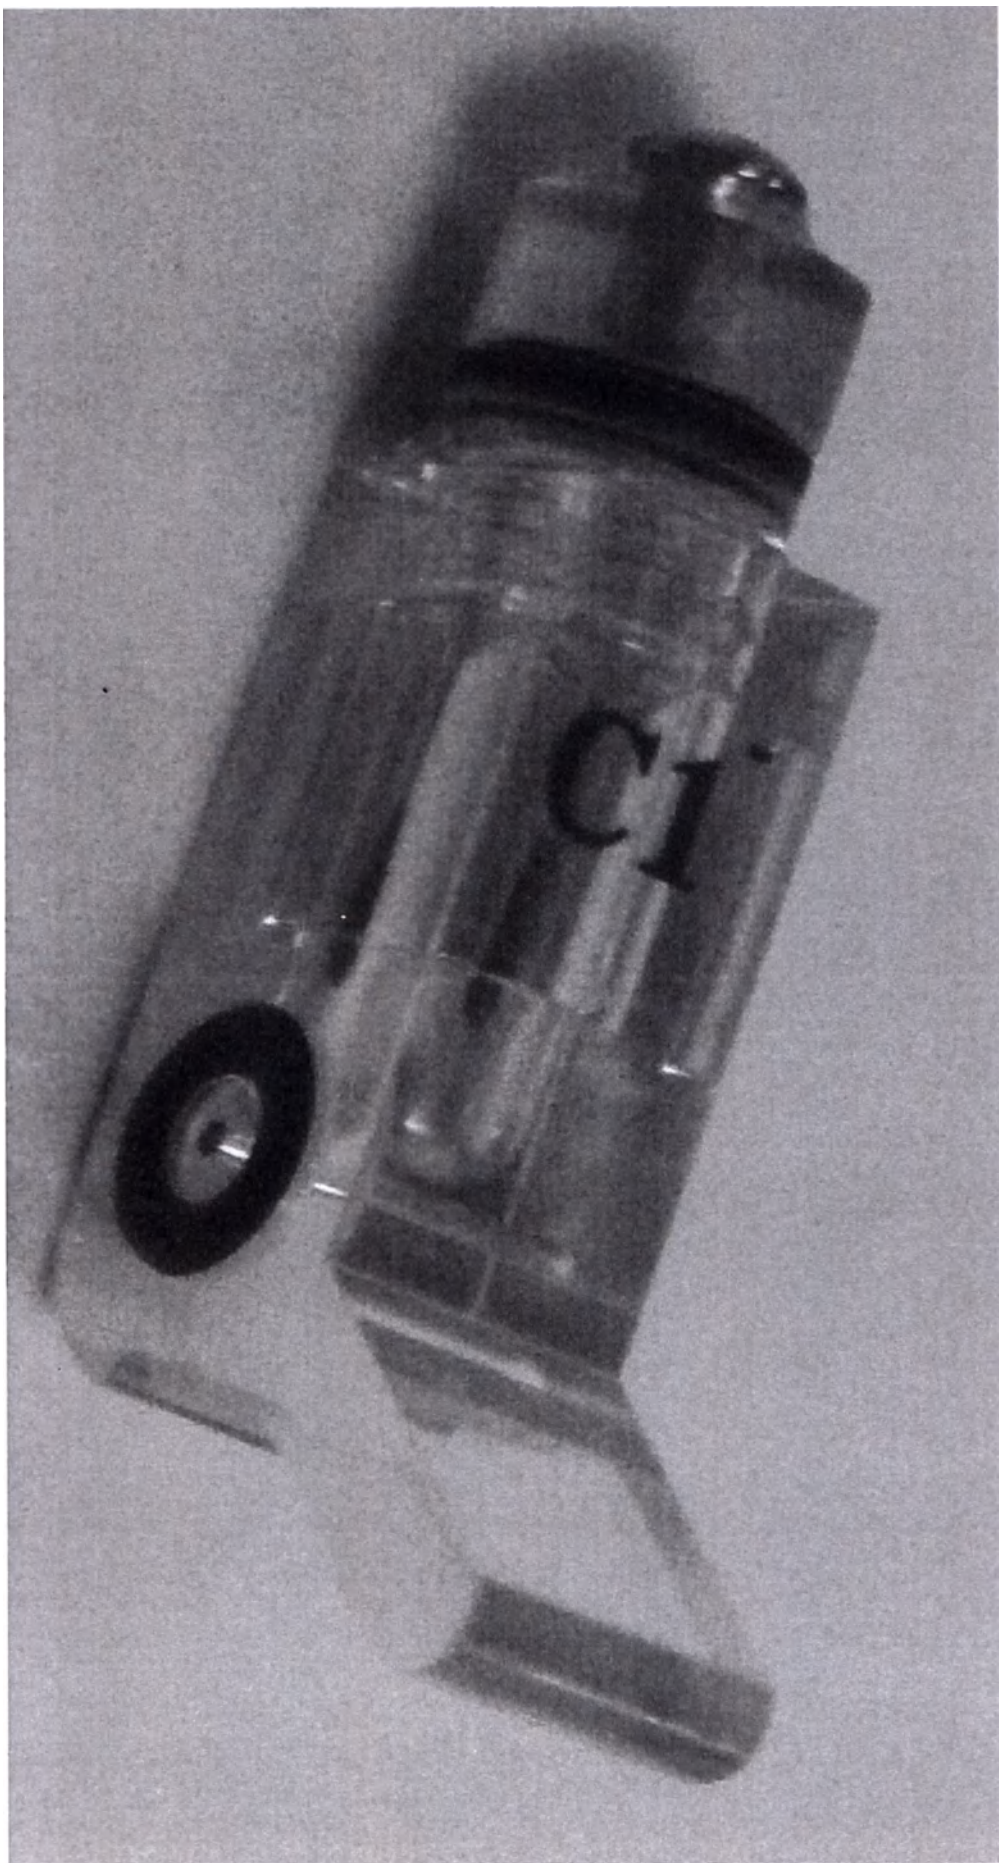


Фото 9. Электрод, Cl

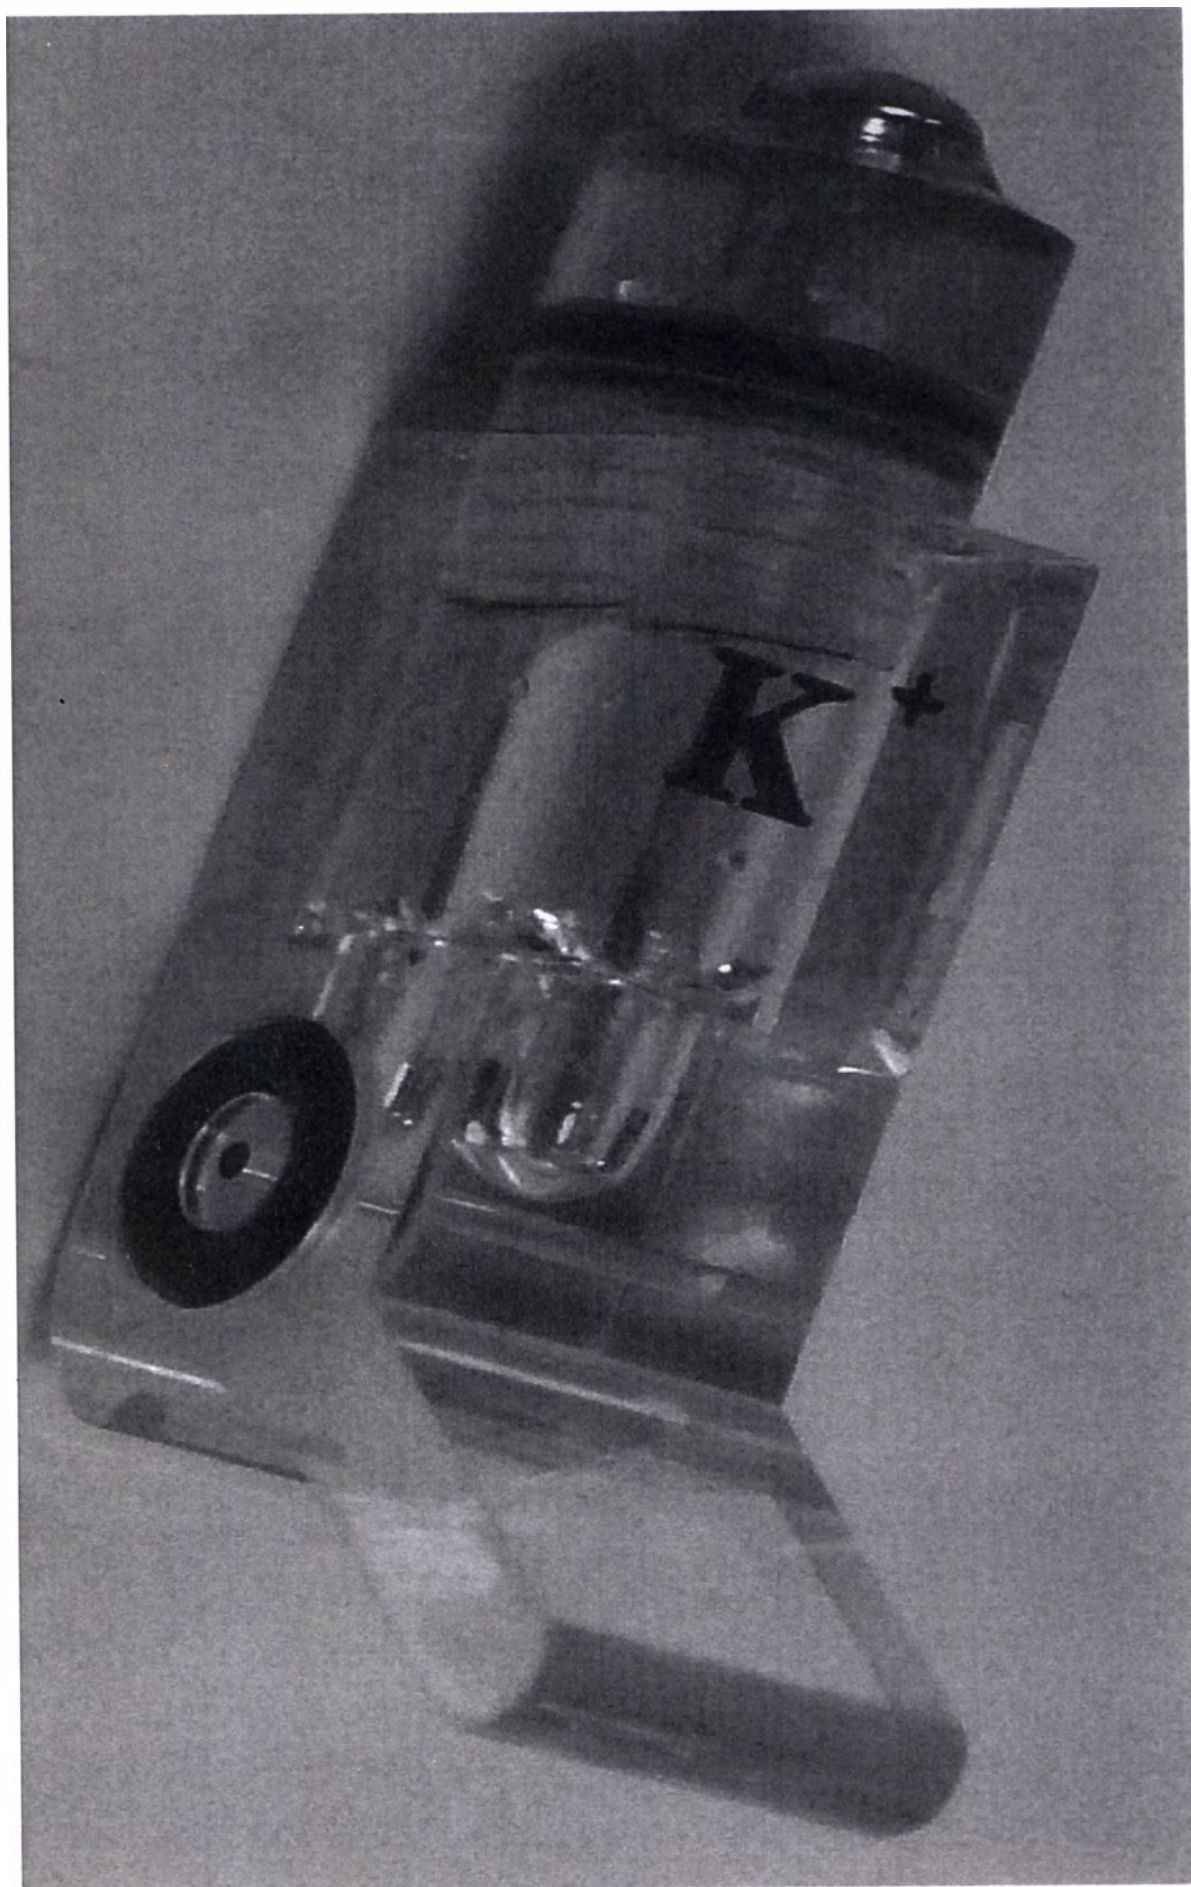


Фото 10. Электрод, К



Фото 11 Электрод, Na

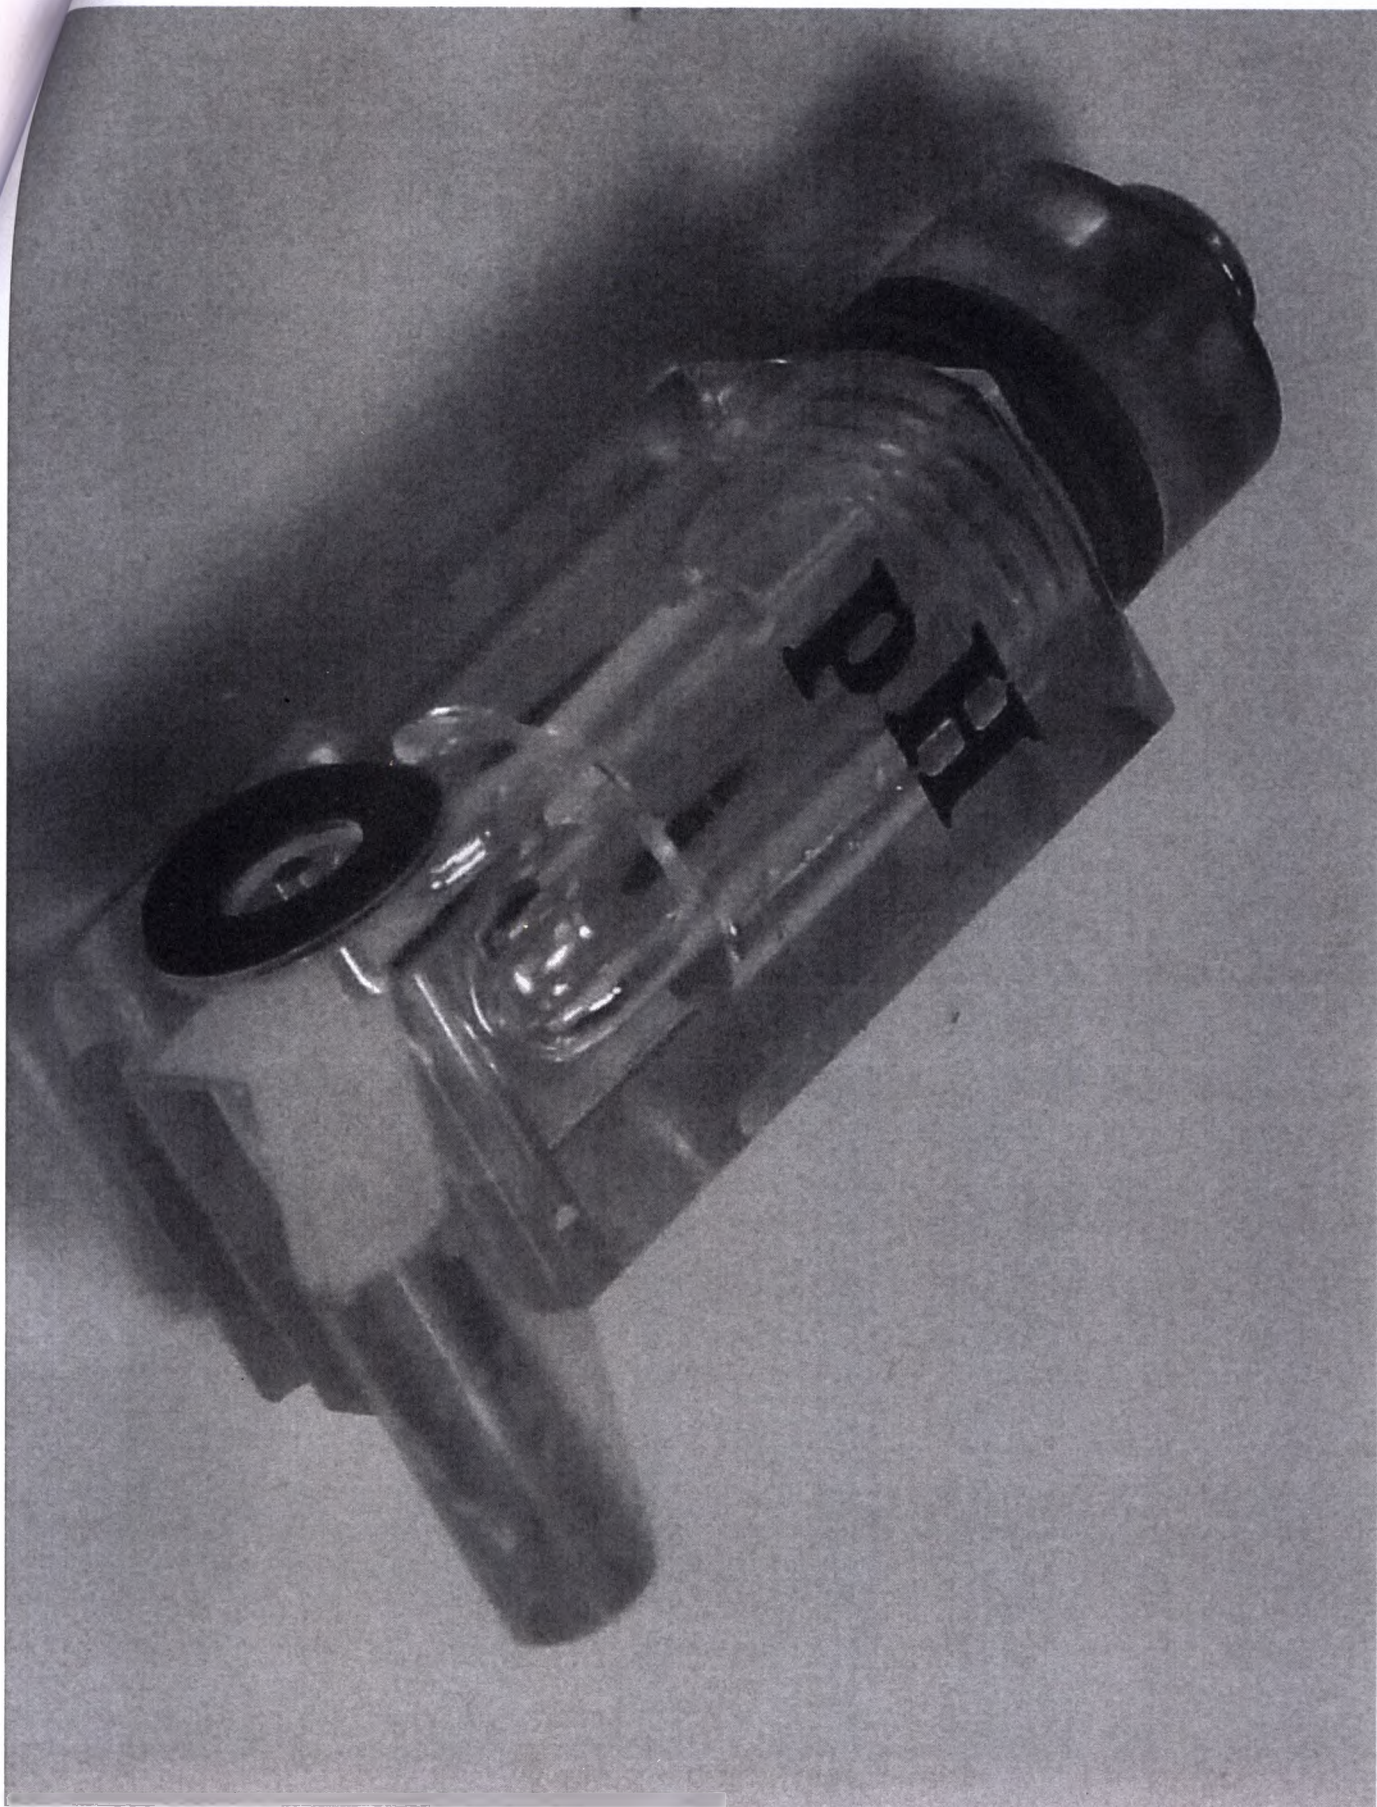


Фото 12. Электрод, pH

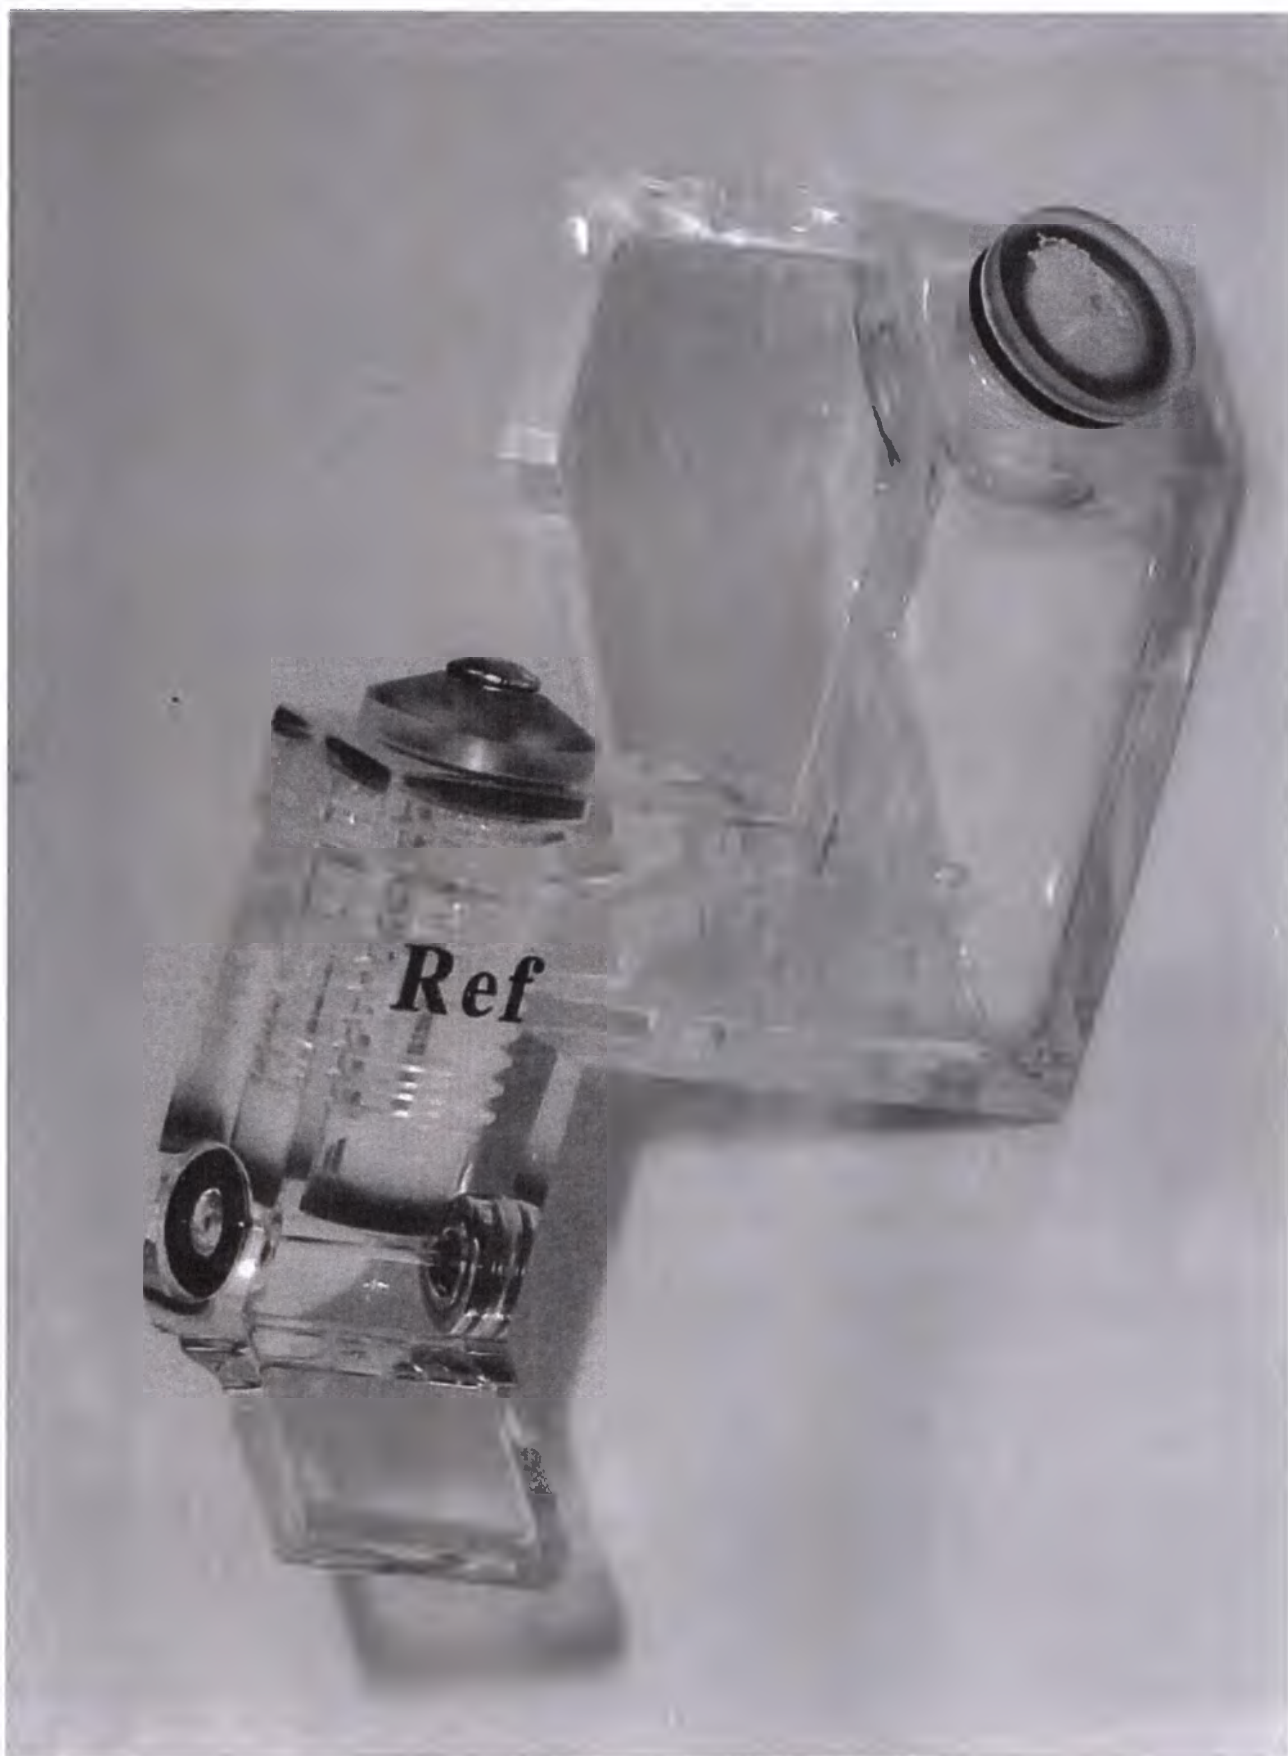


Фото 13. Электрод, референсный

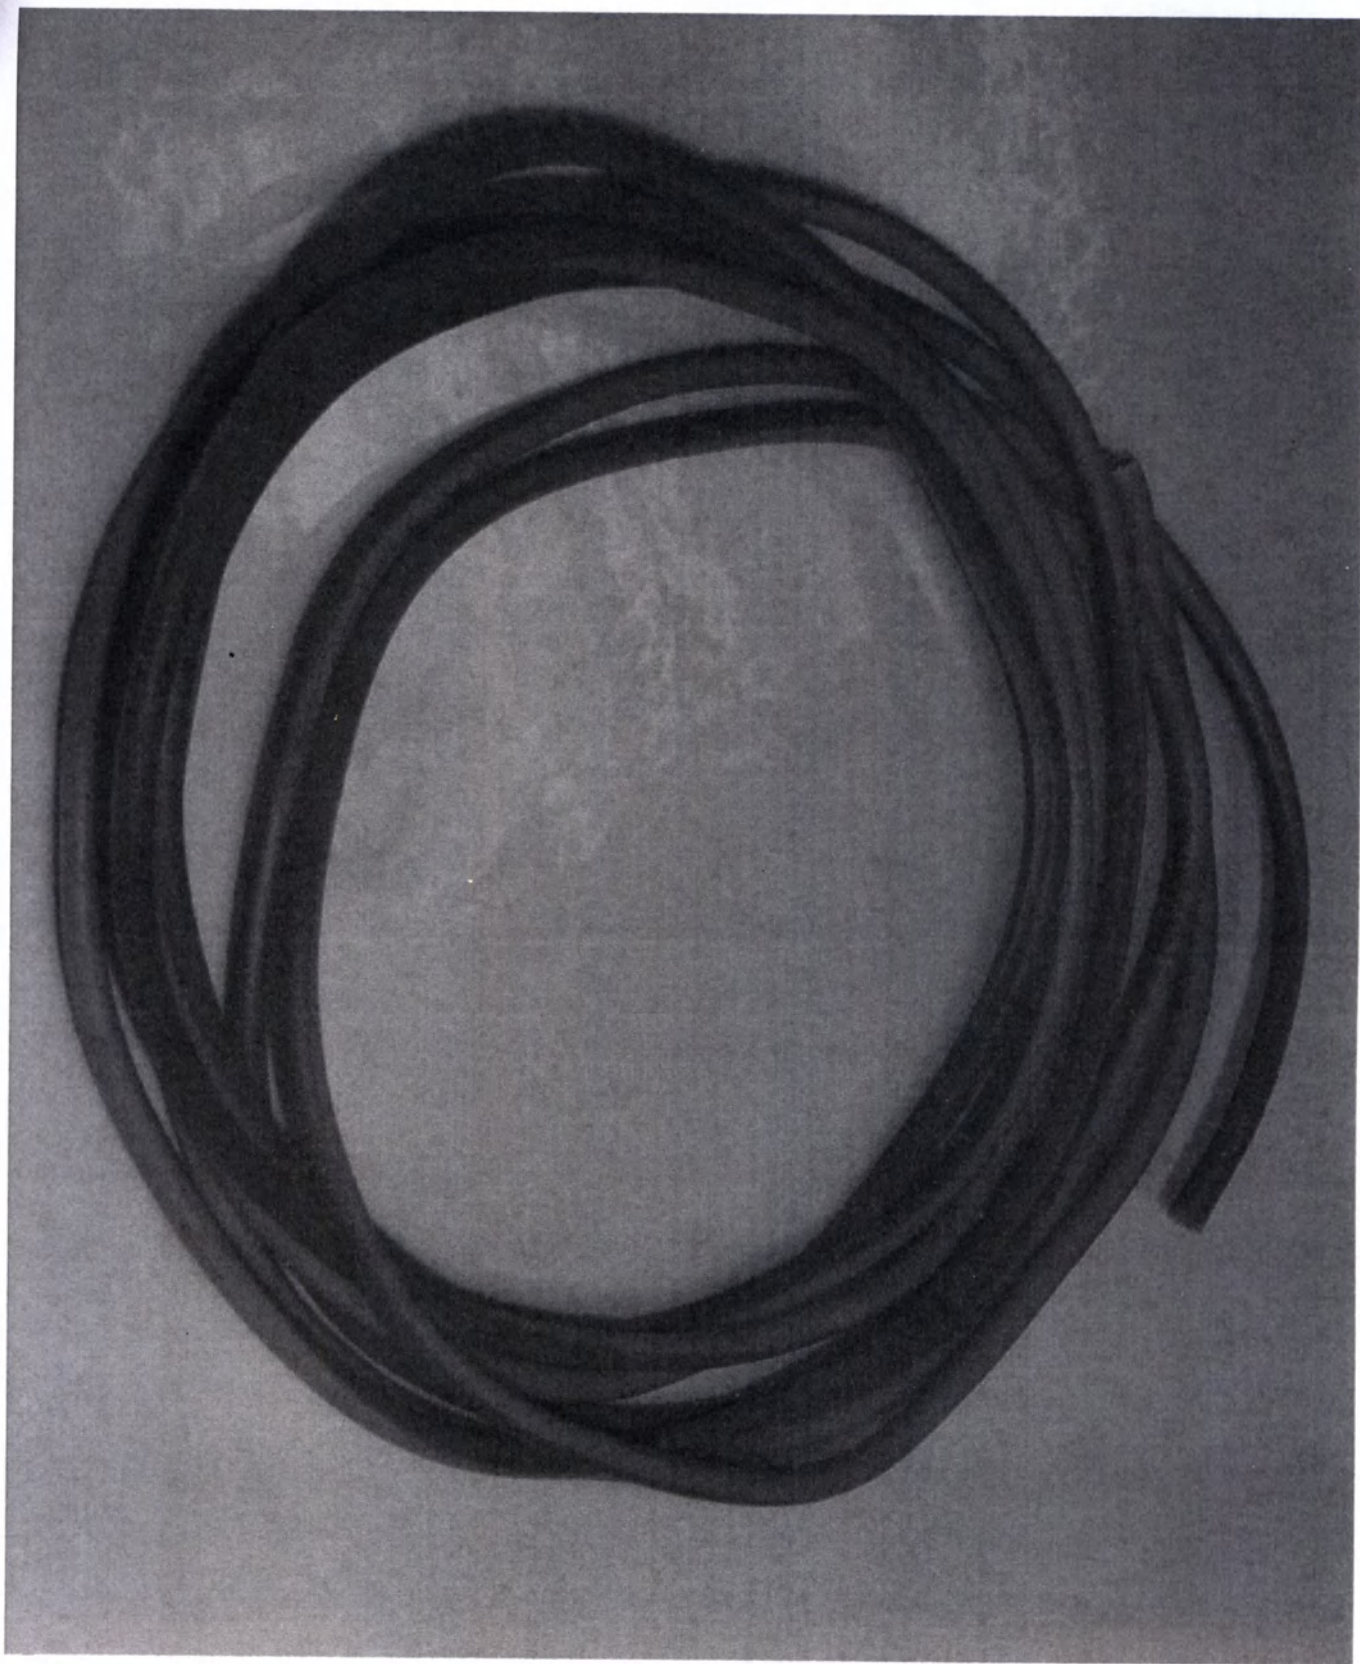


Фото 14. Кабель заземления

Фото 15. Предохранитель.



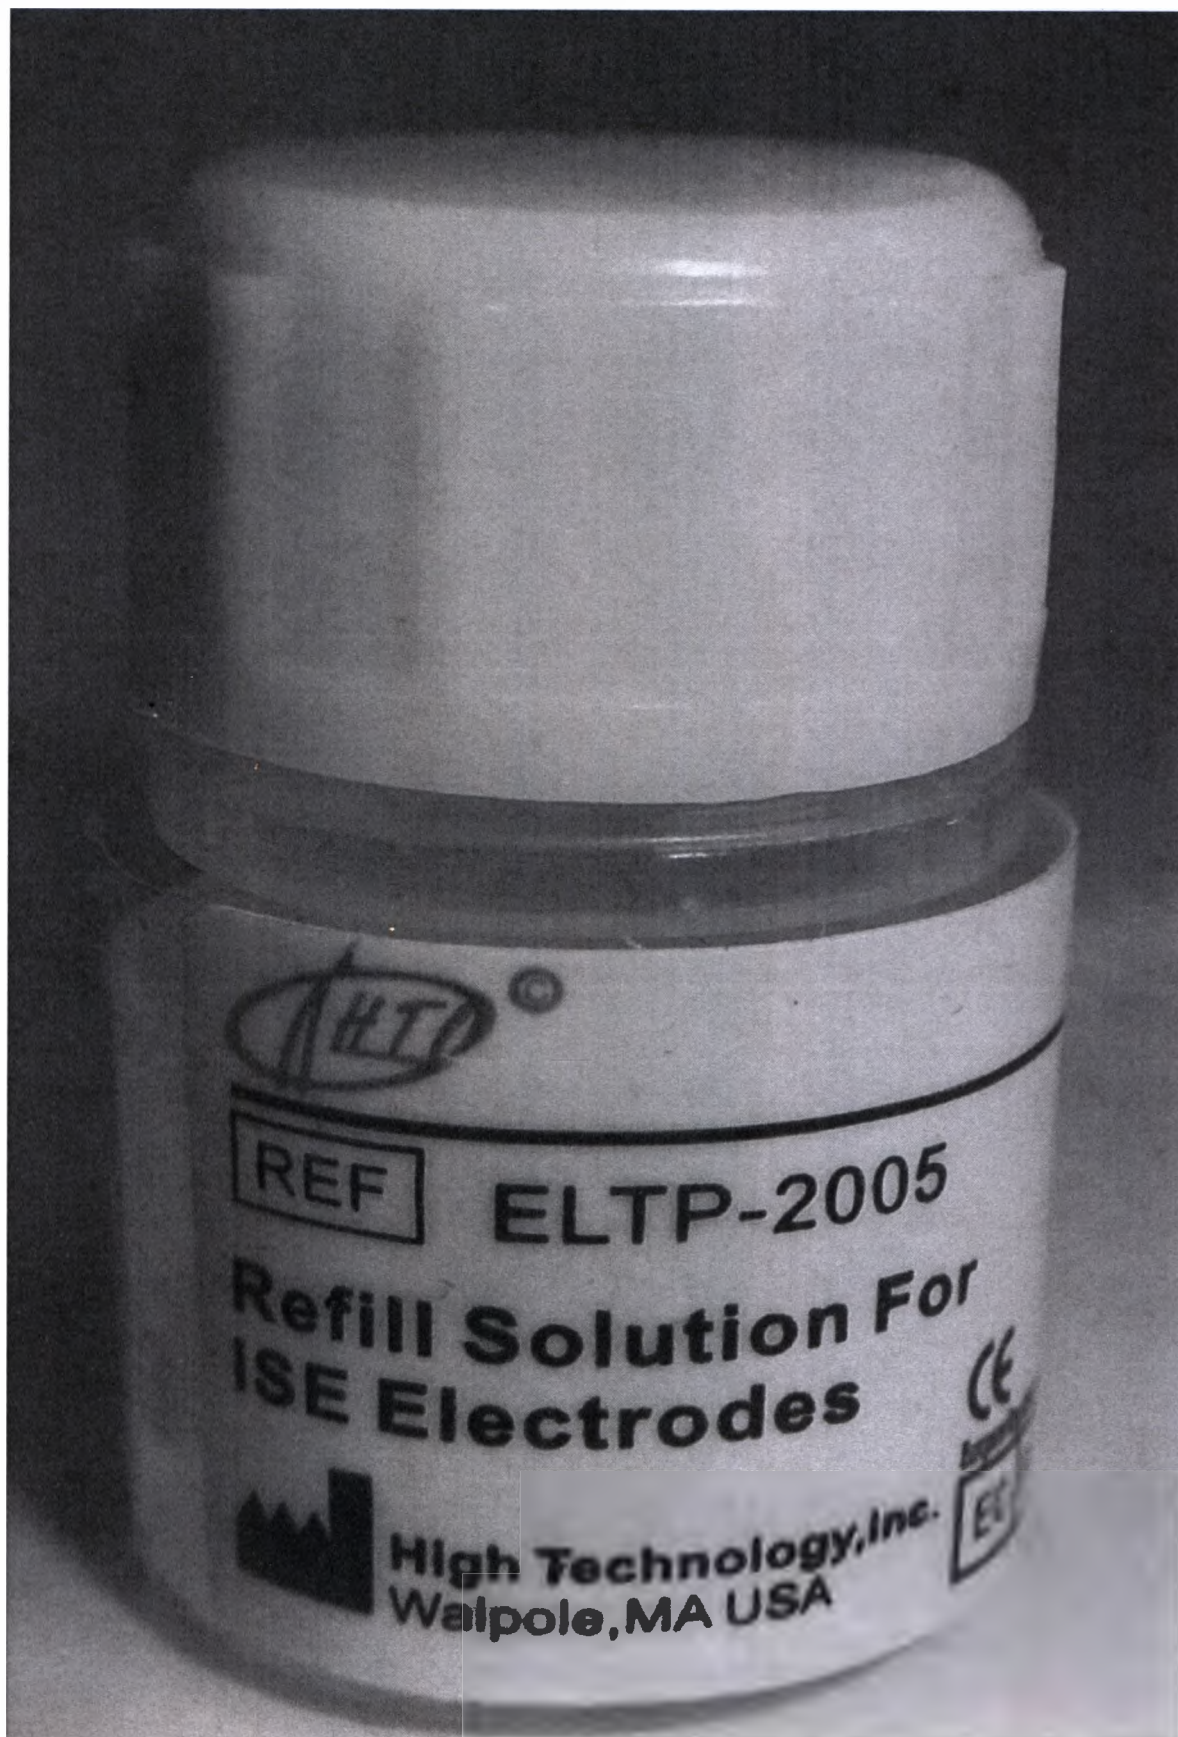


Фото 16. Раствор для заполнения электродов



Фото 17. Раствор для референсного электрода

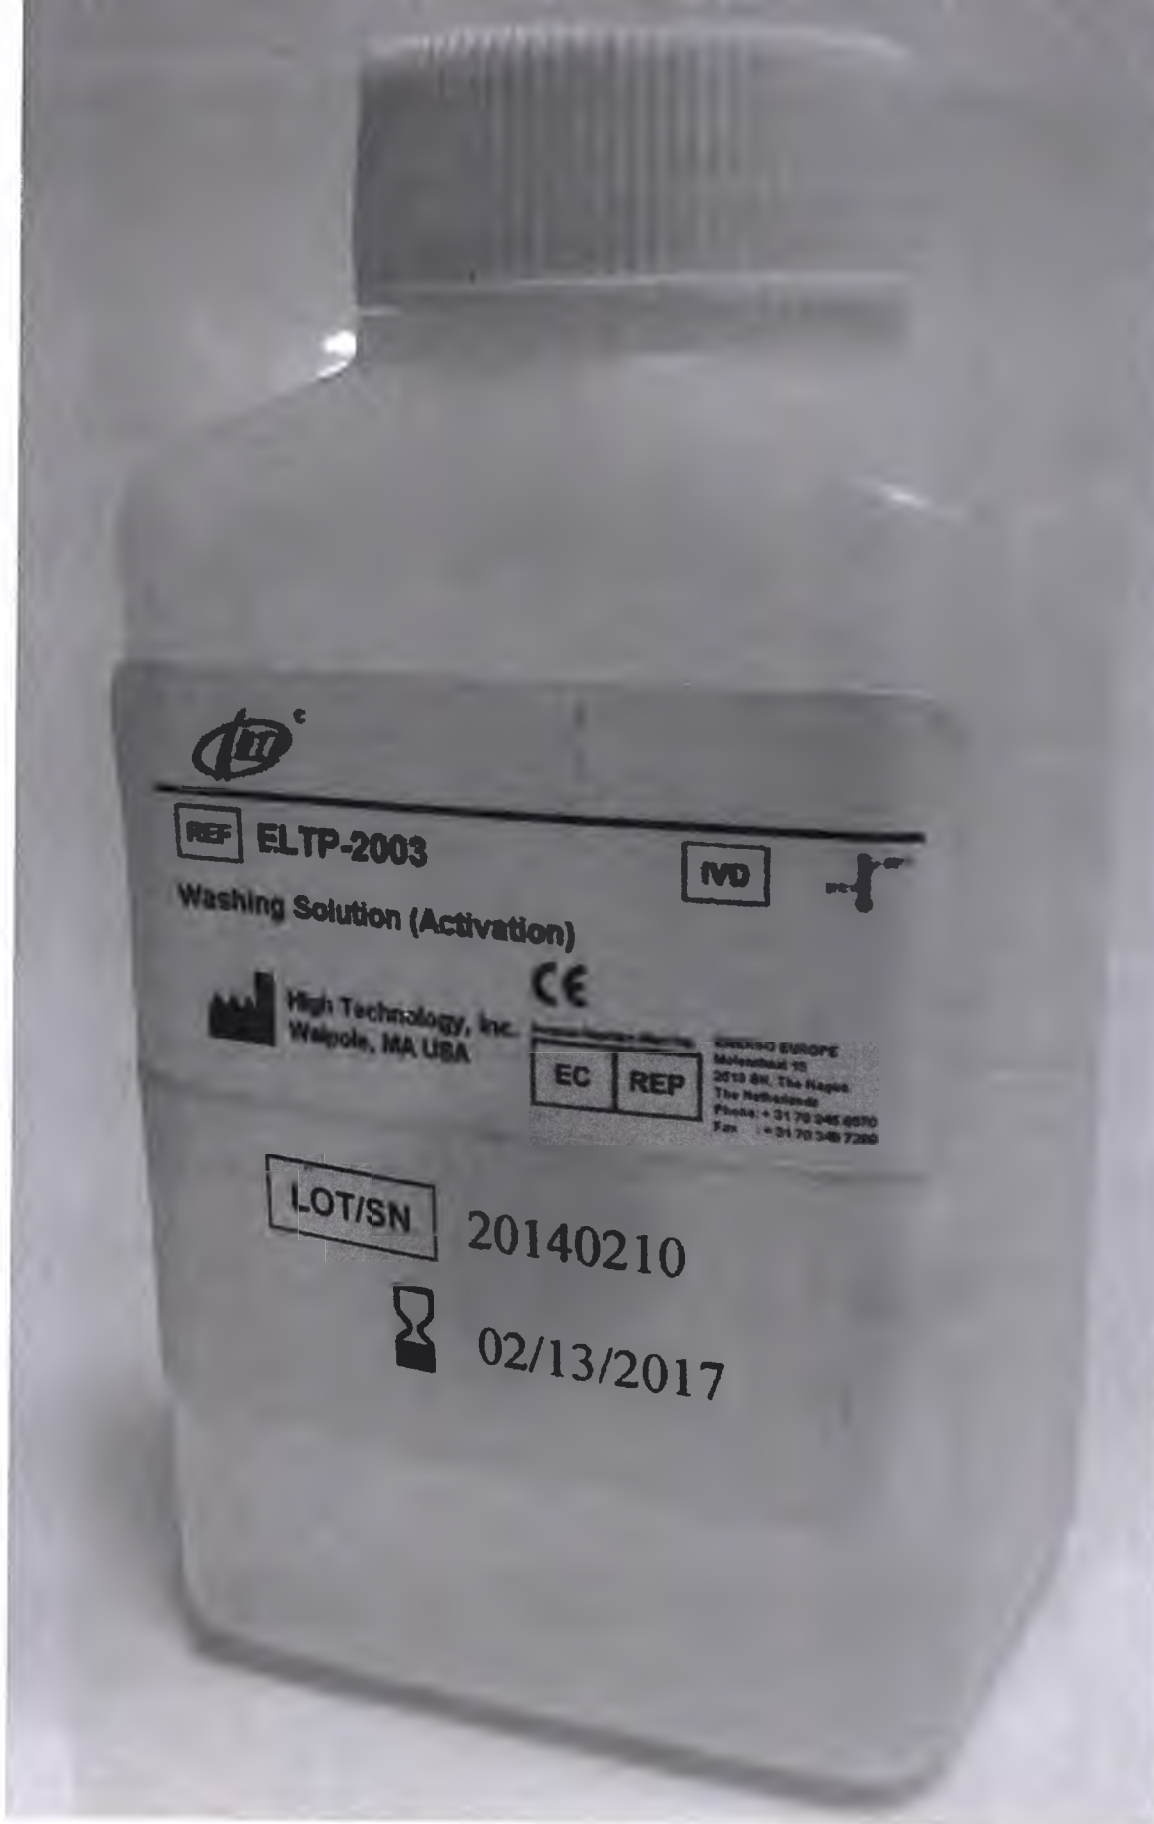


Фото 18. Промывочный раствор (кондиционирующий)

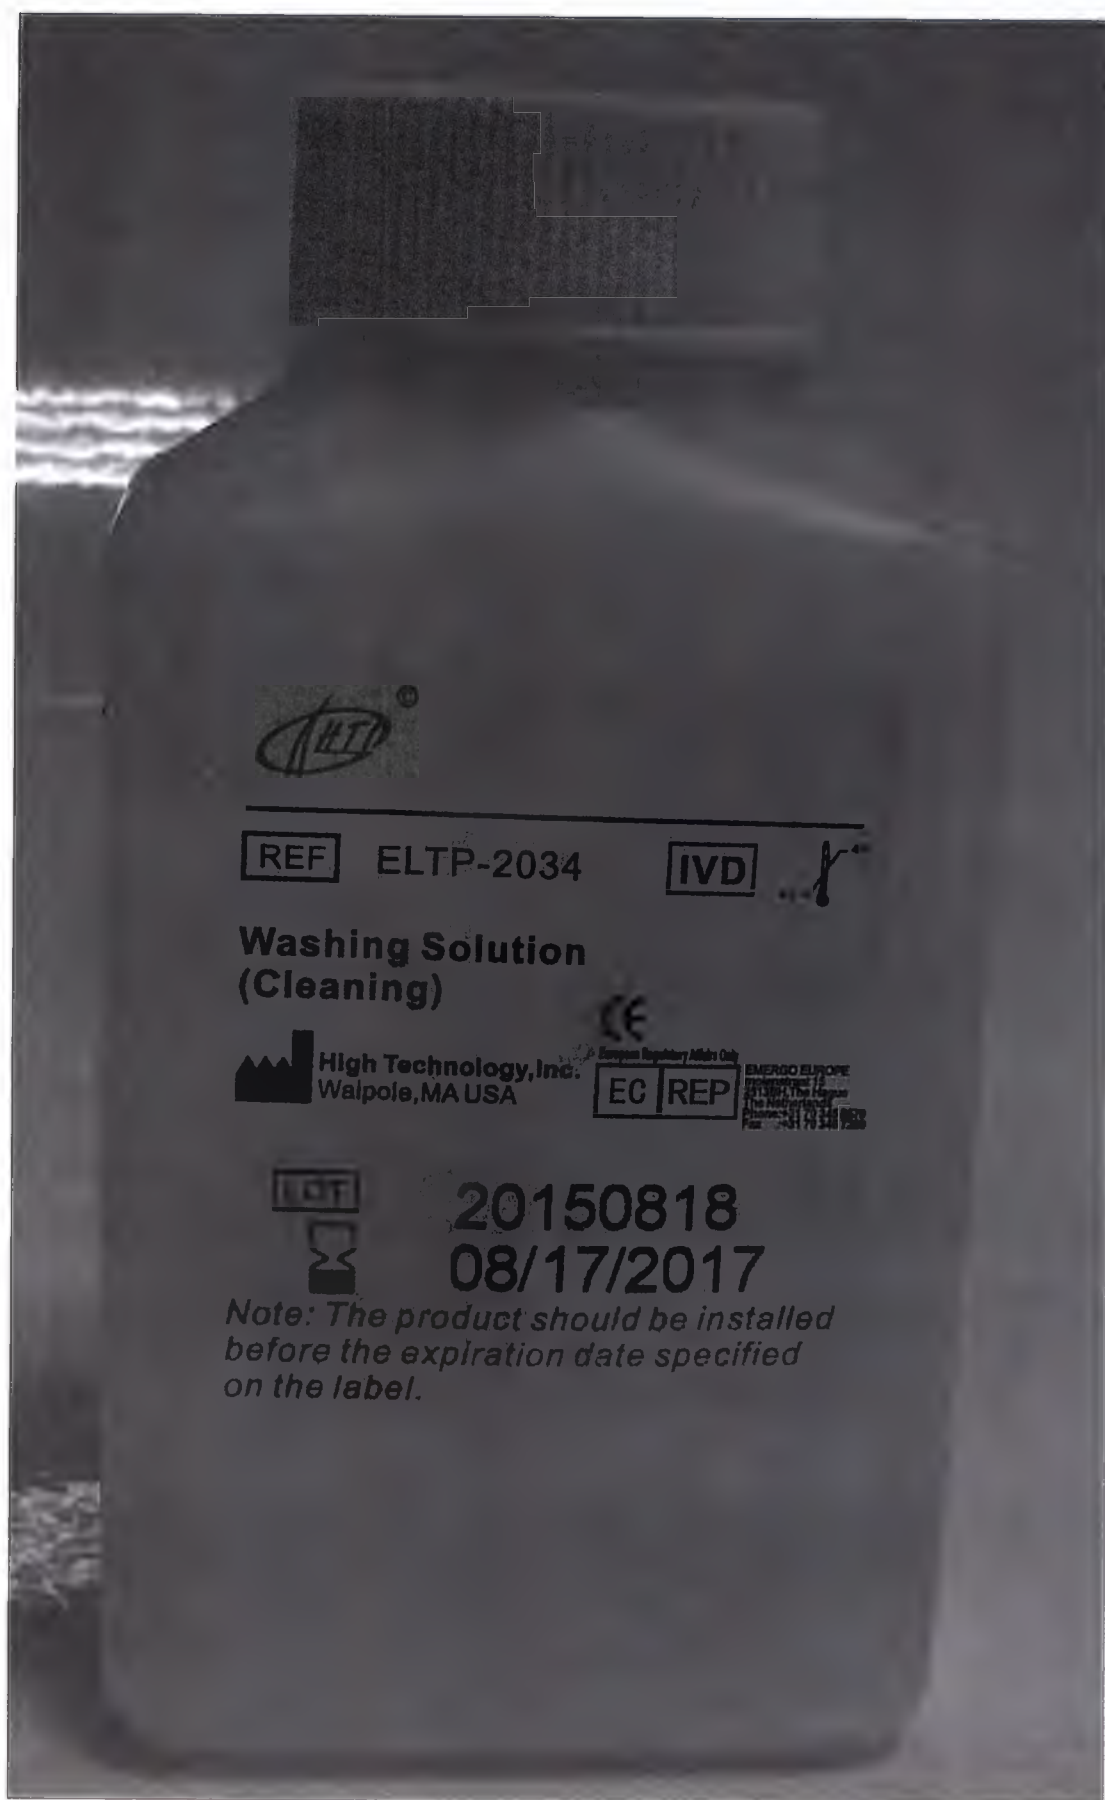


Фото 19. Промывочный раствор (очищающий)



Фото 20 а. Промывочный раствор (депротеинизирующий)

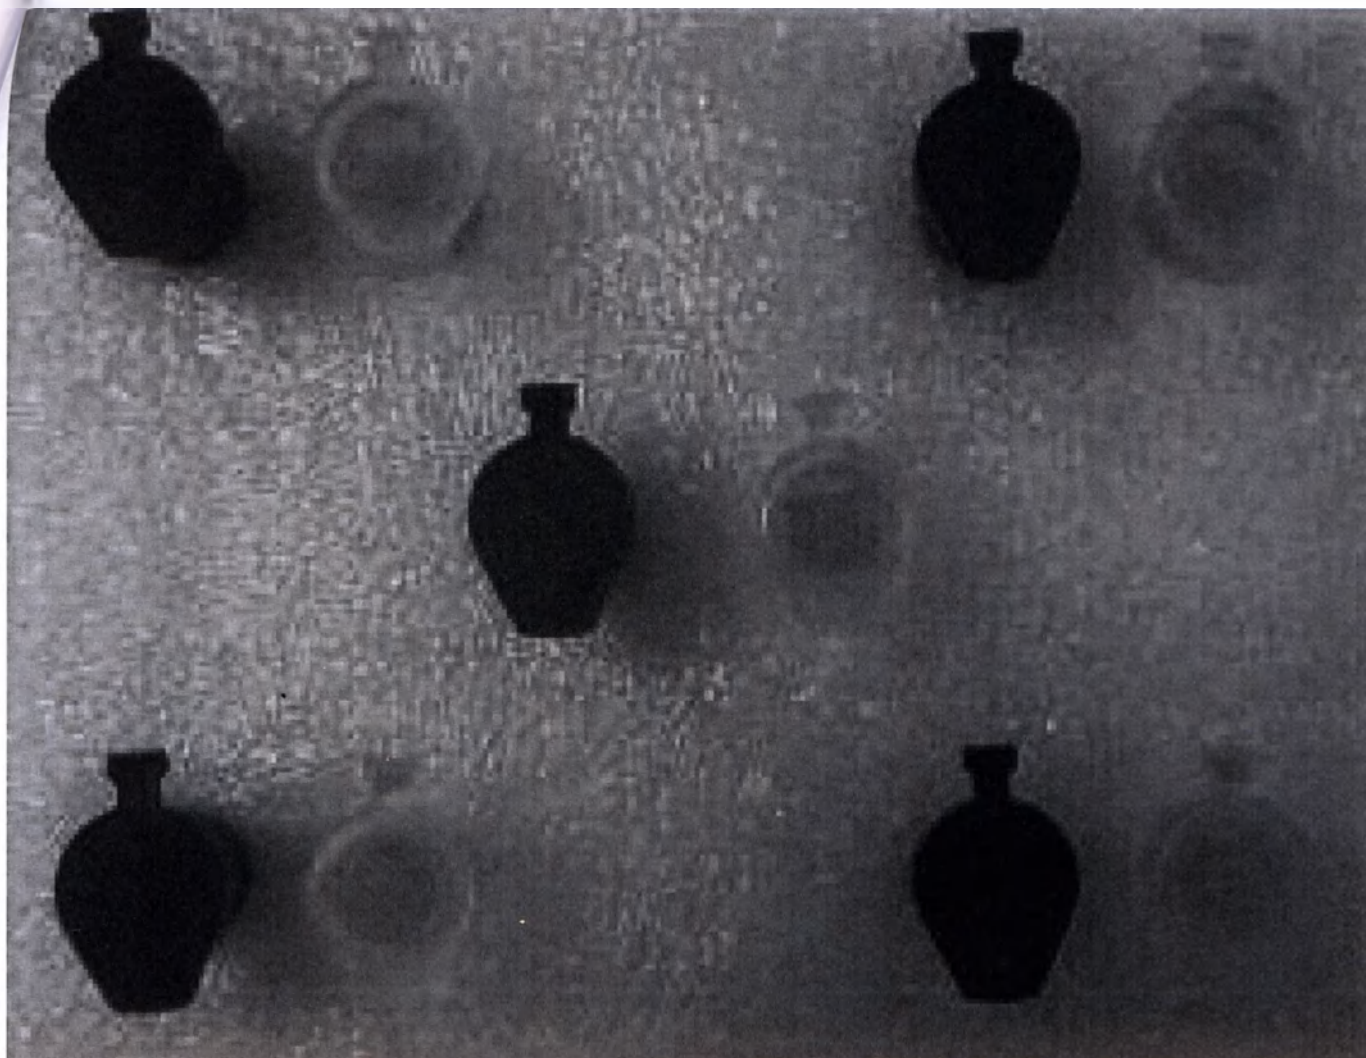


Фото 20 б. Промывочный раствор (депротеинизирующий) (в упаковке)

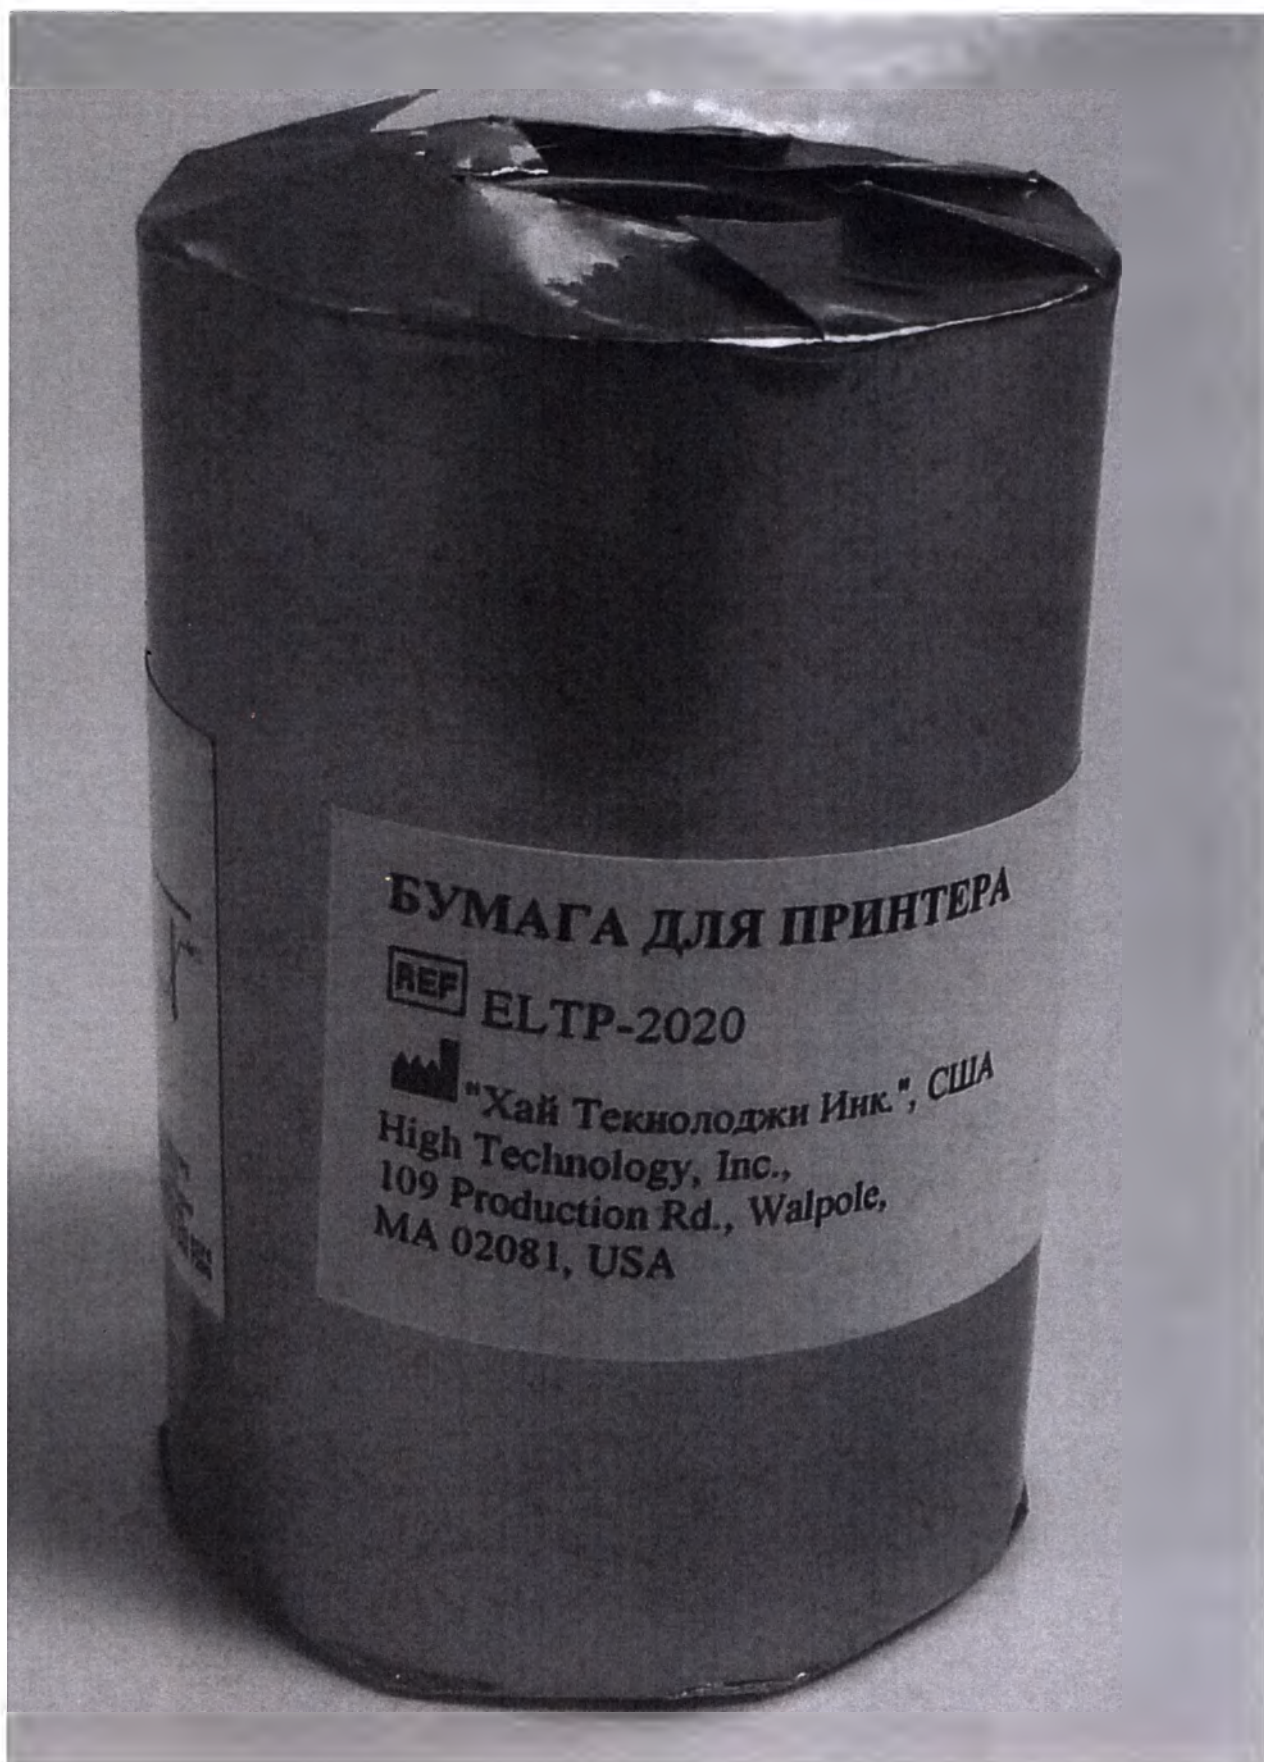



Фото 21. Бумага для принтера



Фото 22. Комплект трубок перистальтического насоса



High Technology, Inc.
109 Production Road, Walpole MA 02081



E-Lyte Plus

Анализатор электролитов крови




Руководство пользователя

Номер документа	:	OM-R-ELT-P-10-1
Уровень ревизии	:	Рев. 1
Дата выпуска	:	22/9/2016

ХАЙ ТЕКНОЛОДЖИ, ИНК. ЯВЛЯЕТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИИ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Фото 23. Руководство пользователя

 **High Technology, Inc.**
109 Production Road, Walpole MA 02081

**Electrolyte Analyzer
HTI E-Lyte Plus**

**Service Manual
Сервисное руководство**

Document Number	:	SM-E-ELYTEP
Revision Level	:	Rev A
Effective Date	:	6/23/2014

HIGH TECHNOLOGY, INC. PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL

Фото 24 Сервисное руководство.

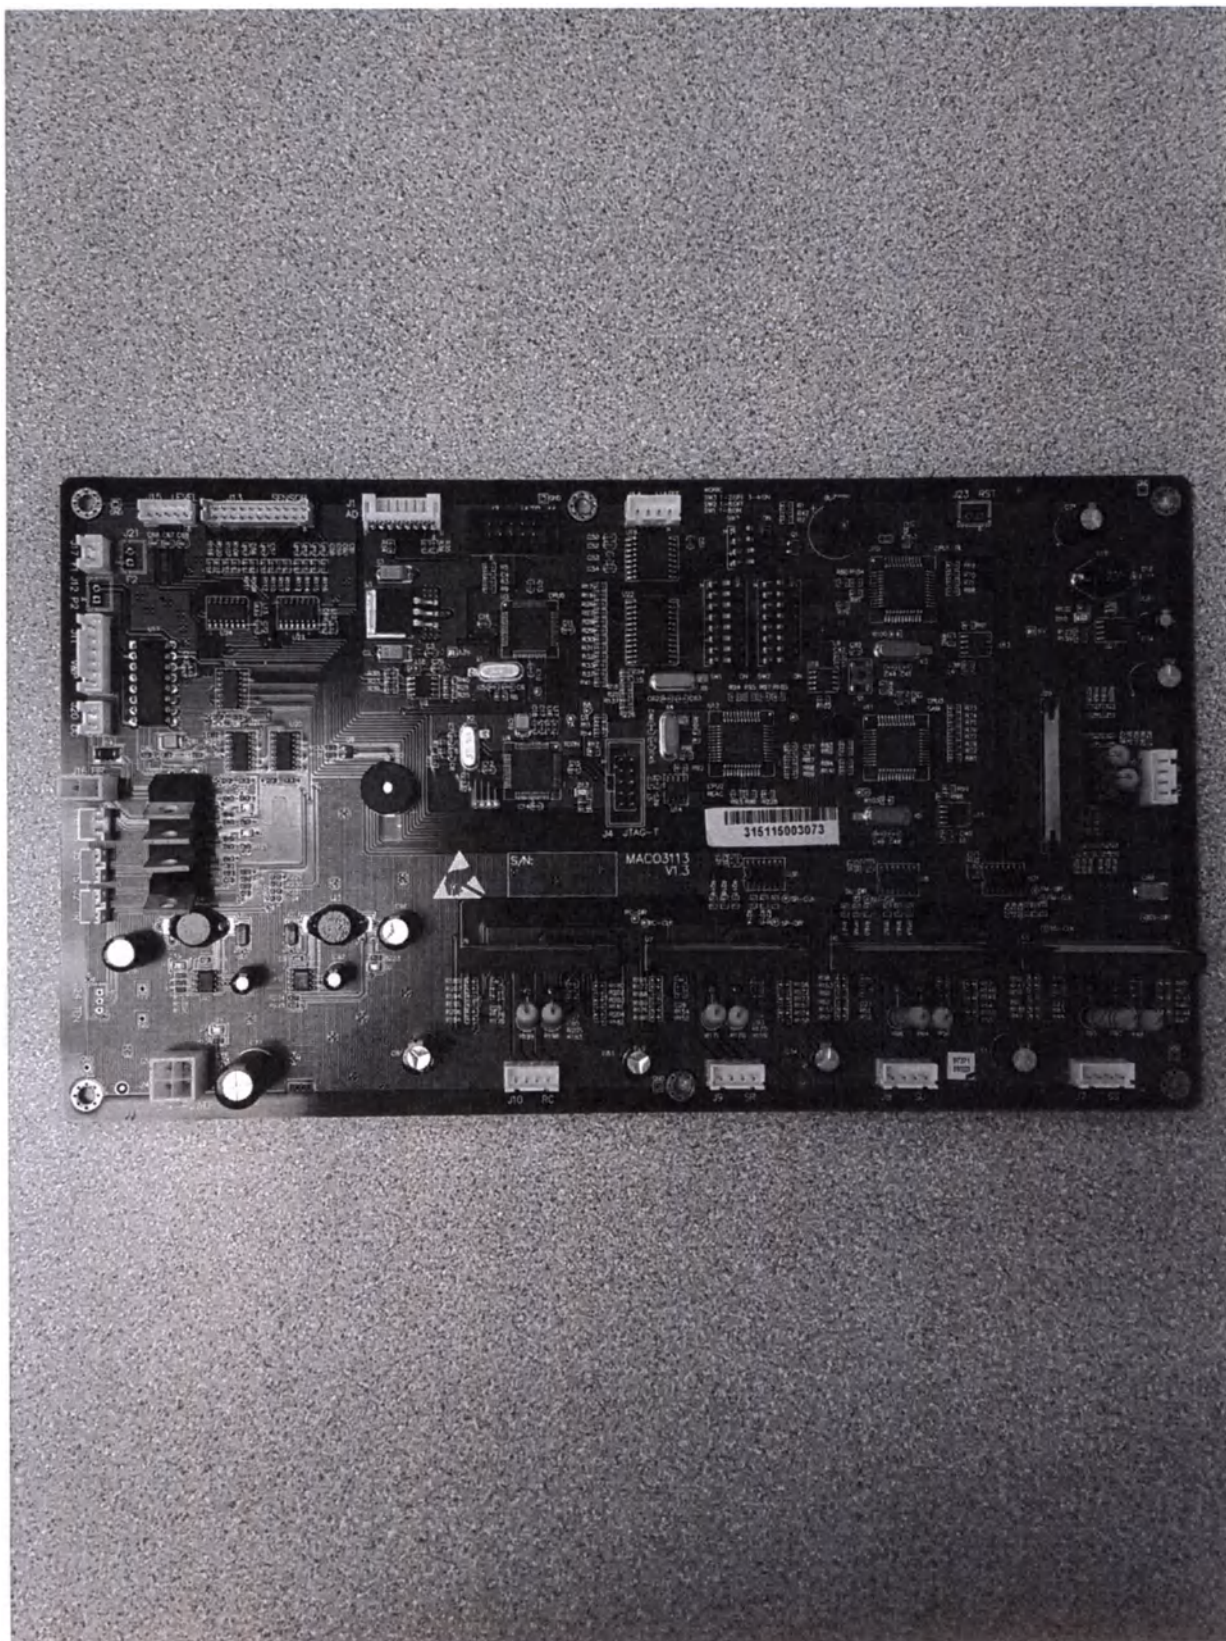


Фото 25. Электронные платы

1.

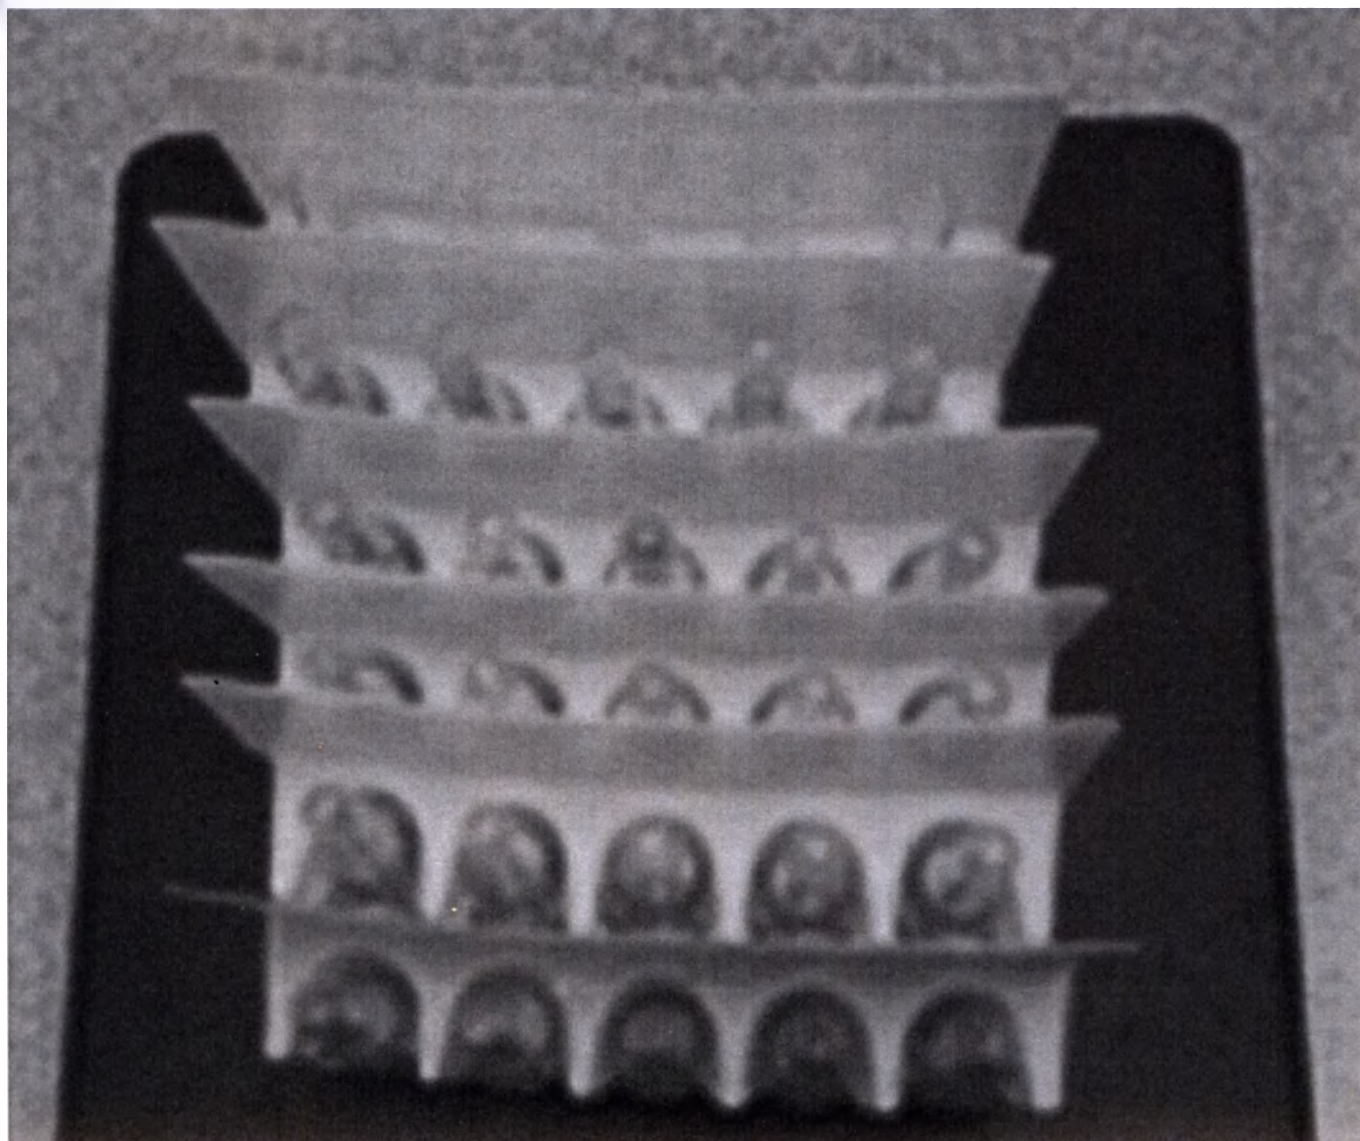


Фото 26. Контрольные материалы

19. Информация об изготовителе

Наименование : High Technology, Inc. (Хай Текнолоджи, Инк.)
Адрес : 109 Production Rd., Walpole, MA USA 02081
(109 Продакшн Роад, Уолпол, штат Массачусетс 02081, США)
Телефон : +1 508-660-2221
Факс : +1 508-660-2224

20. КОНТАКТЫ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ООО «Бизнес Технологии»

Адрес: ул. Саморы Машела, 8/2, Москва 117198, Россия

Телефон: 8 (495) 232-02-13

E-mail: info@intermedica.ru

.

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью на 29
листах

Директор
Назарова Н.К.

