




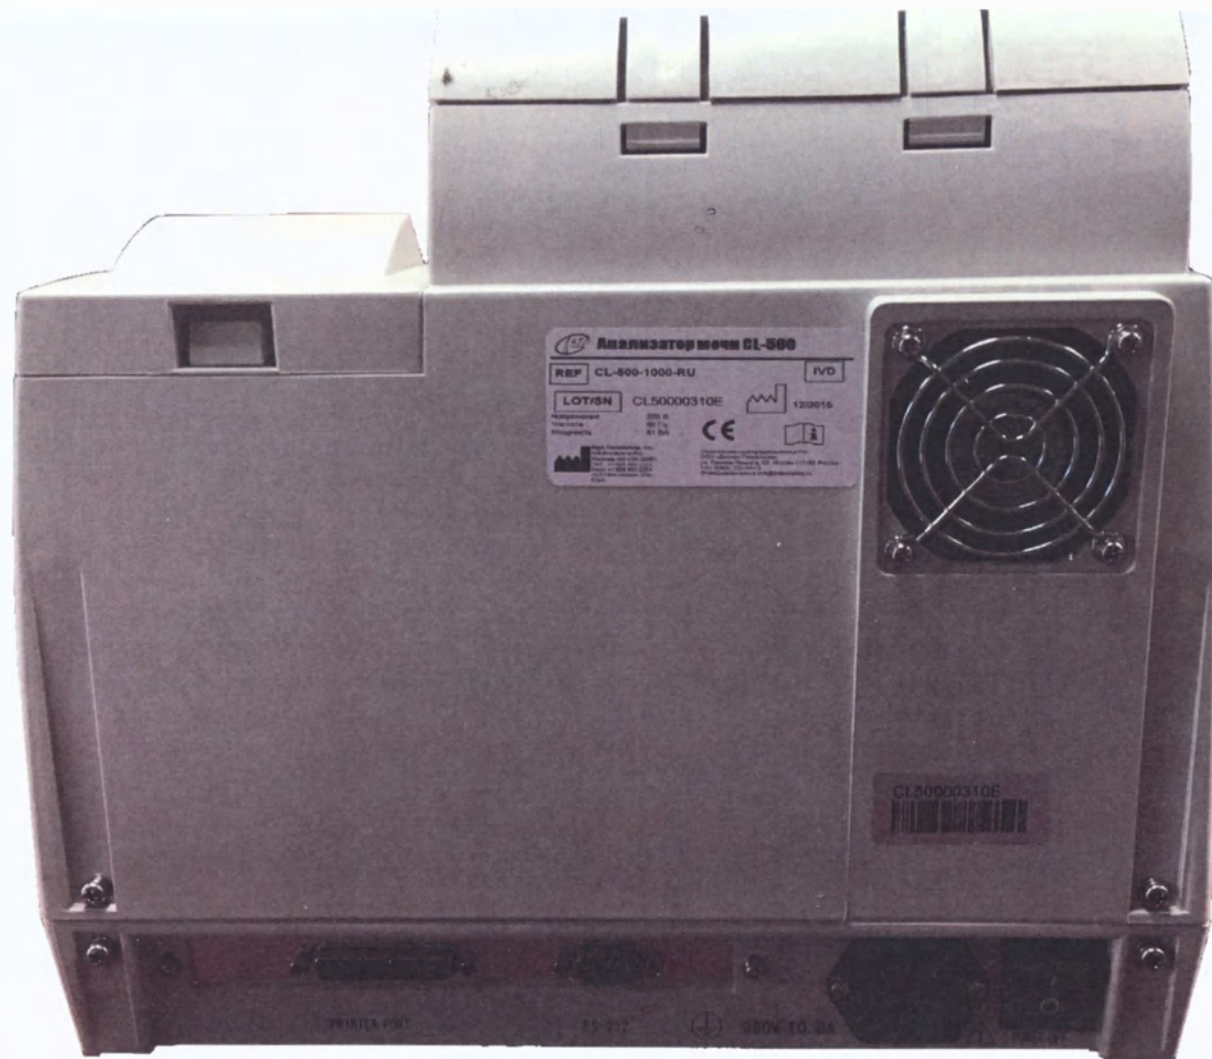

Анализатор мочи CL-500 (вид сзади)

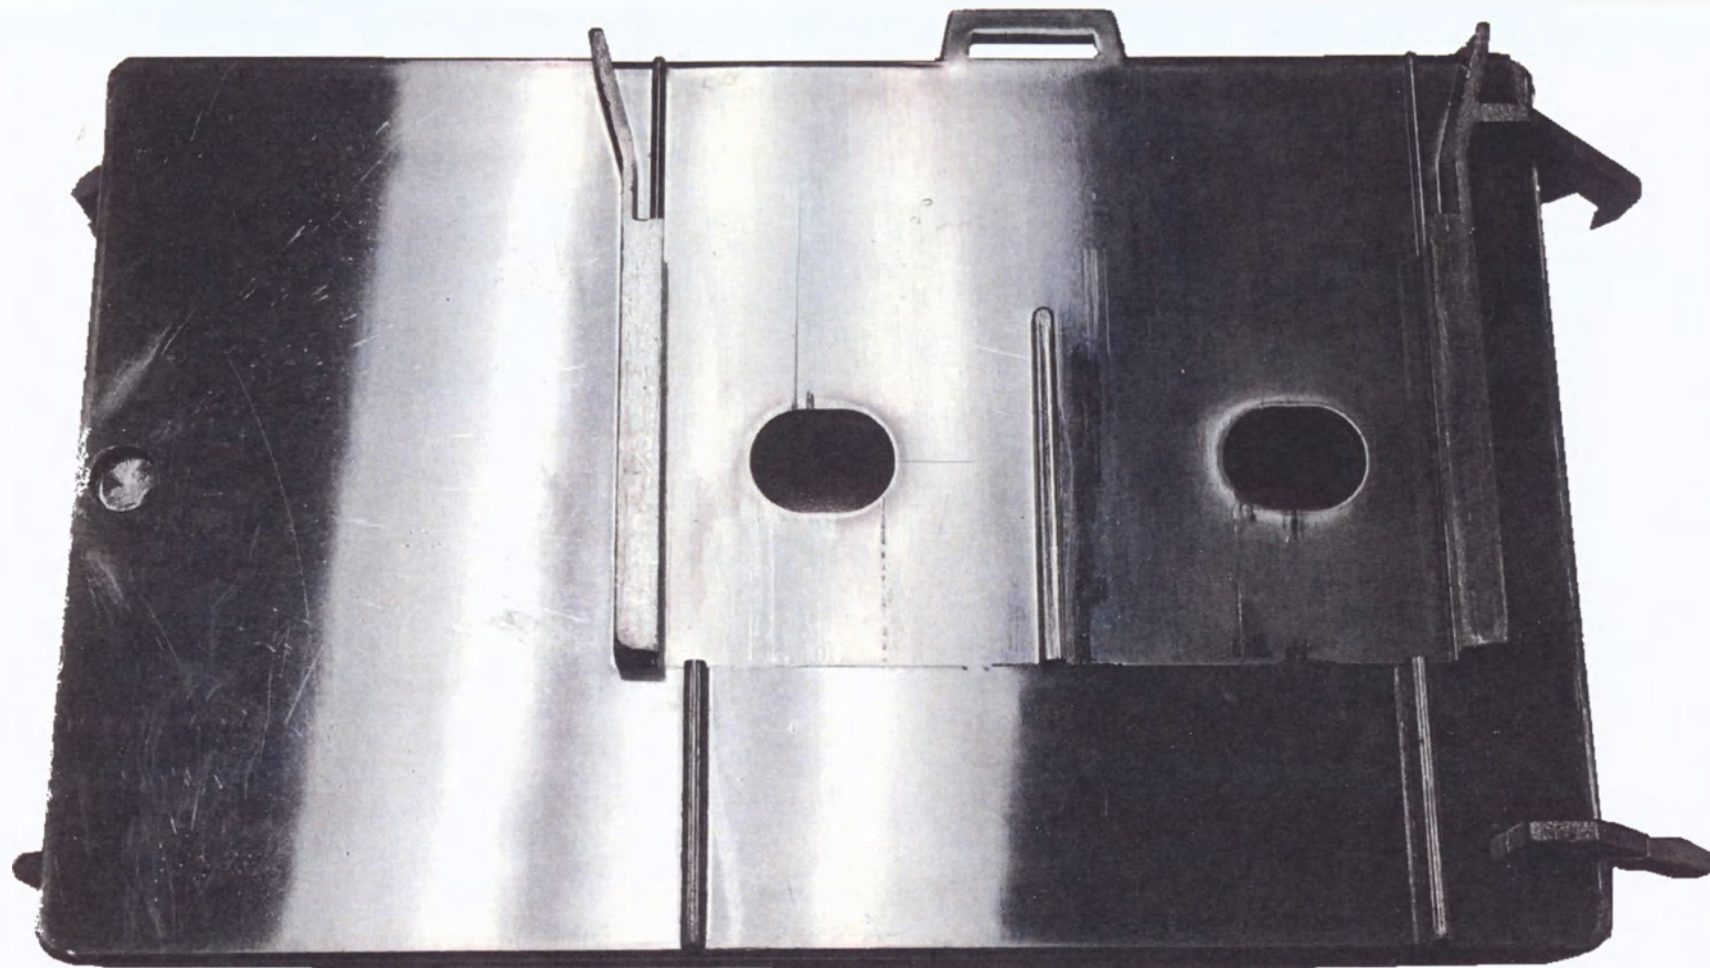


Стол конвейера

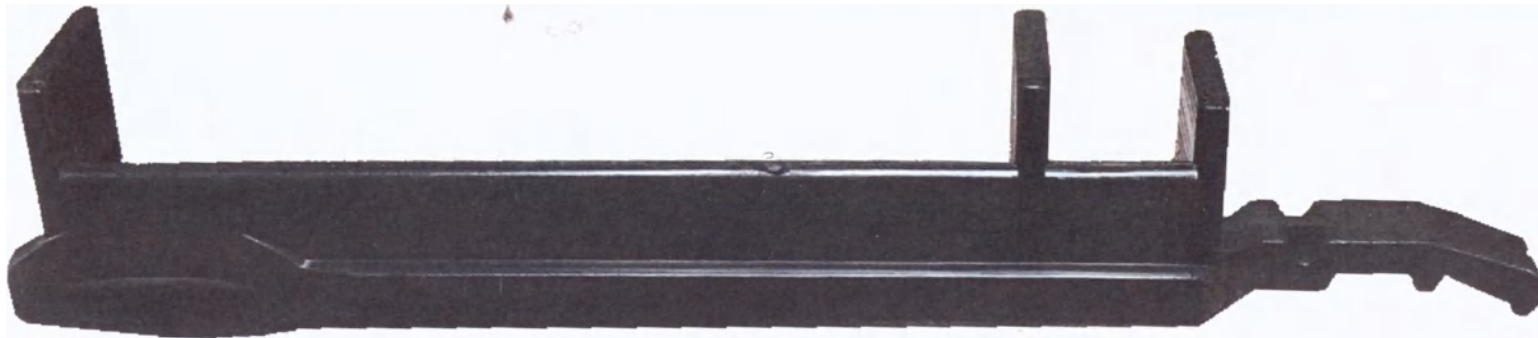

Толкатель


Калибровочные тест-полоски




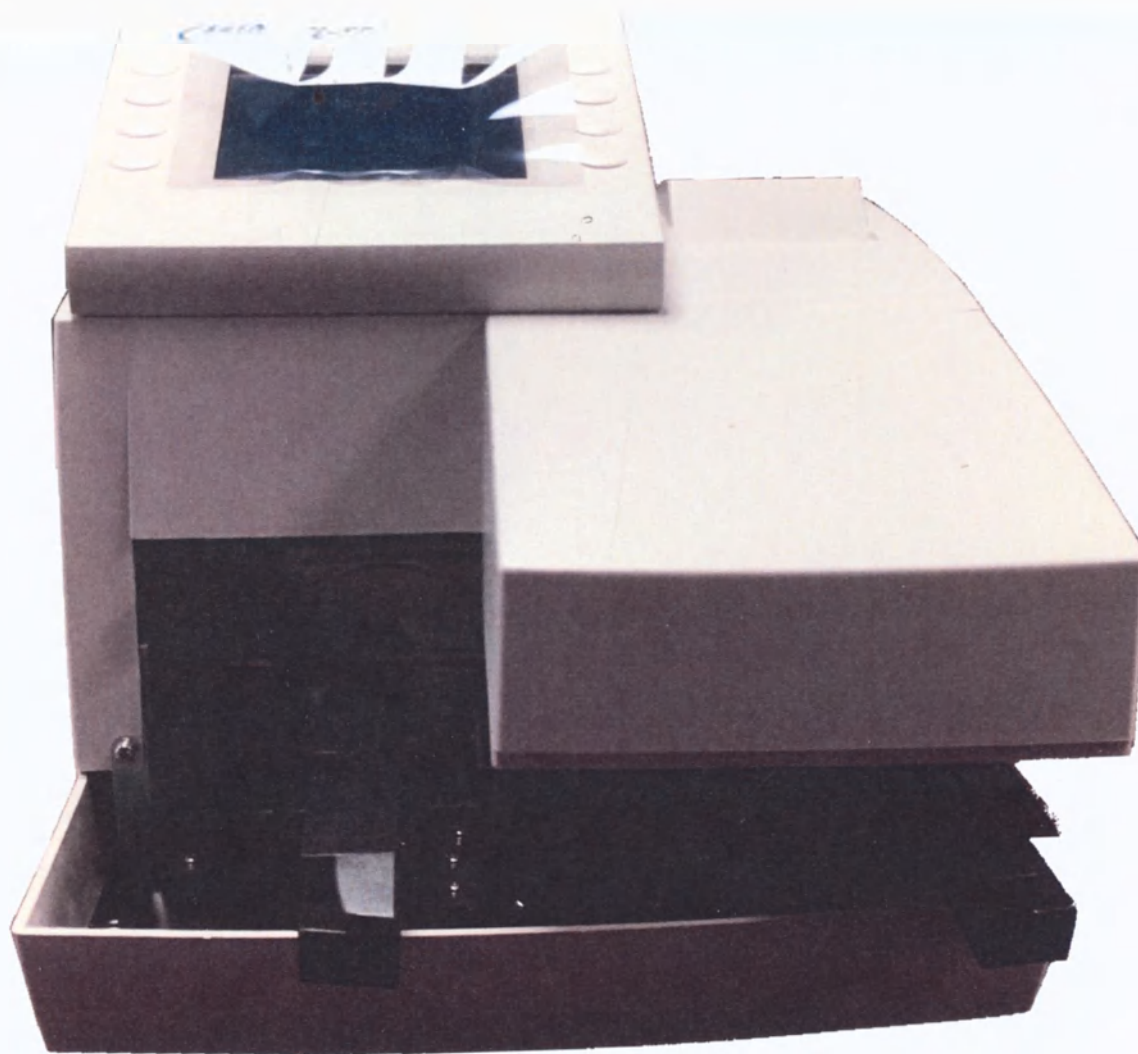

Анализатор мочи CL-500

Предметный стол для тест-полосок

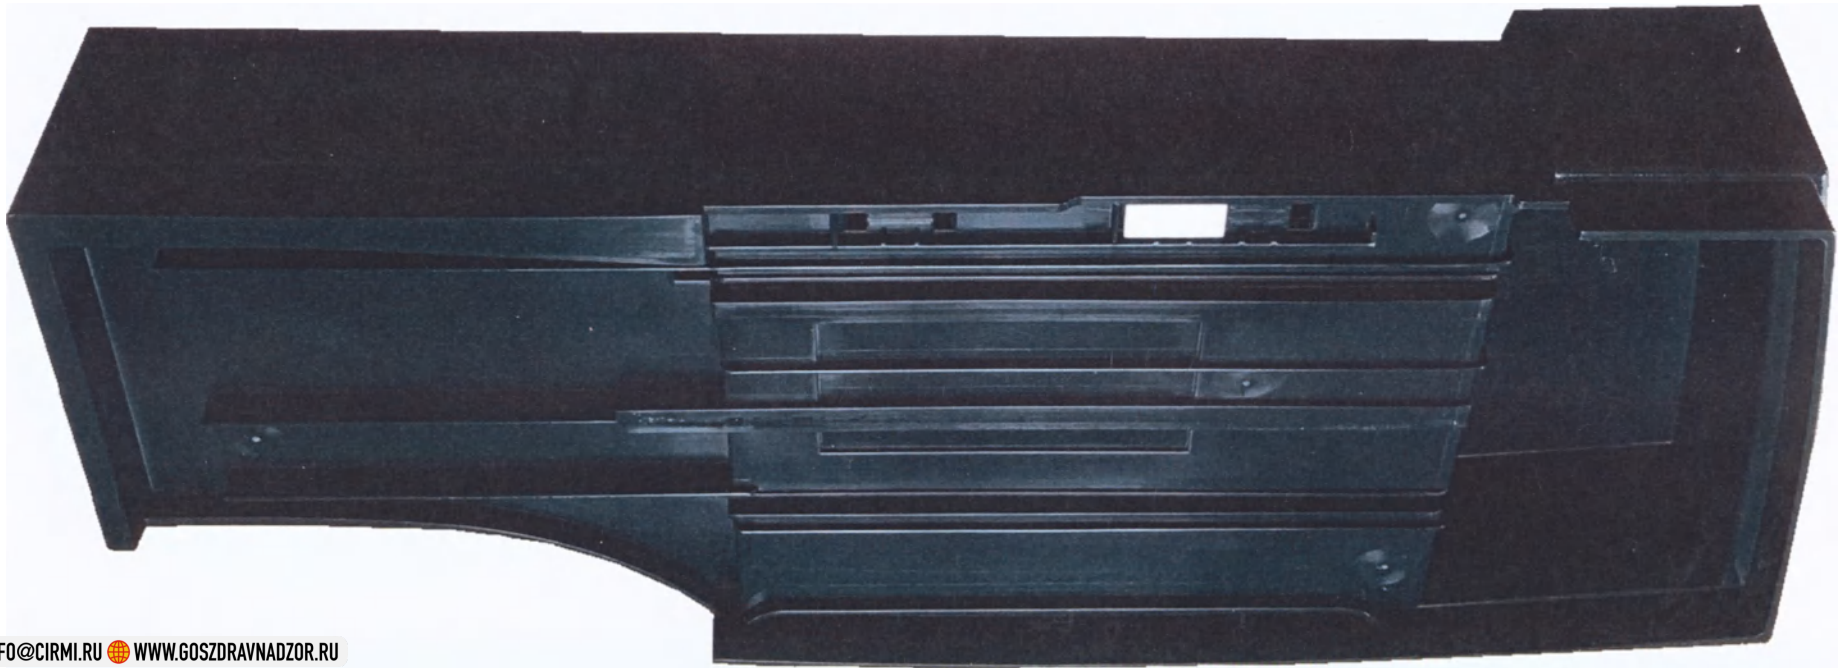


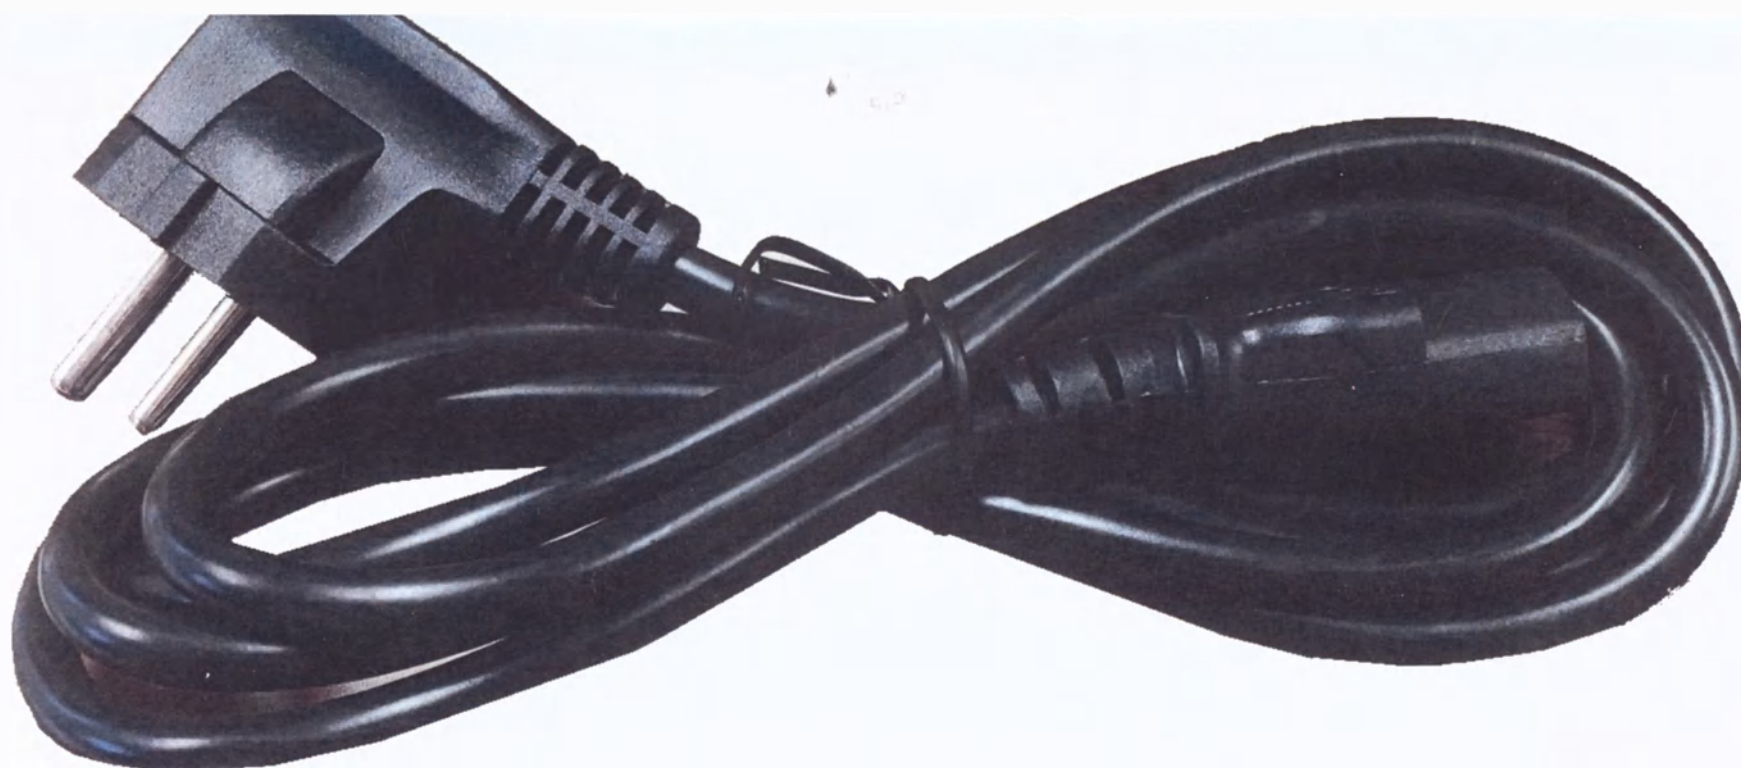


Кабель питания

MC

 **High Technology, Inc.**
109 Production Road, Walpole MA 02081 USA



Анализатор мочи CL-500

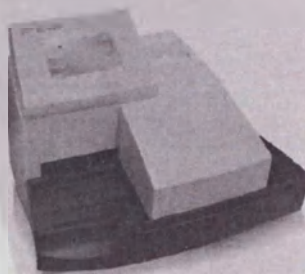


Руководство пользователя

Document Number	: CL-R-CL500
Revision Level	: Rev.B
Effective Date	: 7/7/2015


HIGH TECHNOLOGY, INC. PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL

Инструкция пользователя

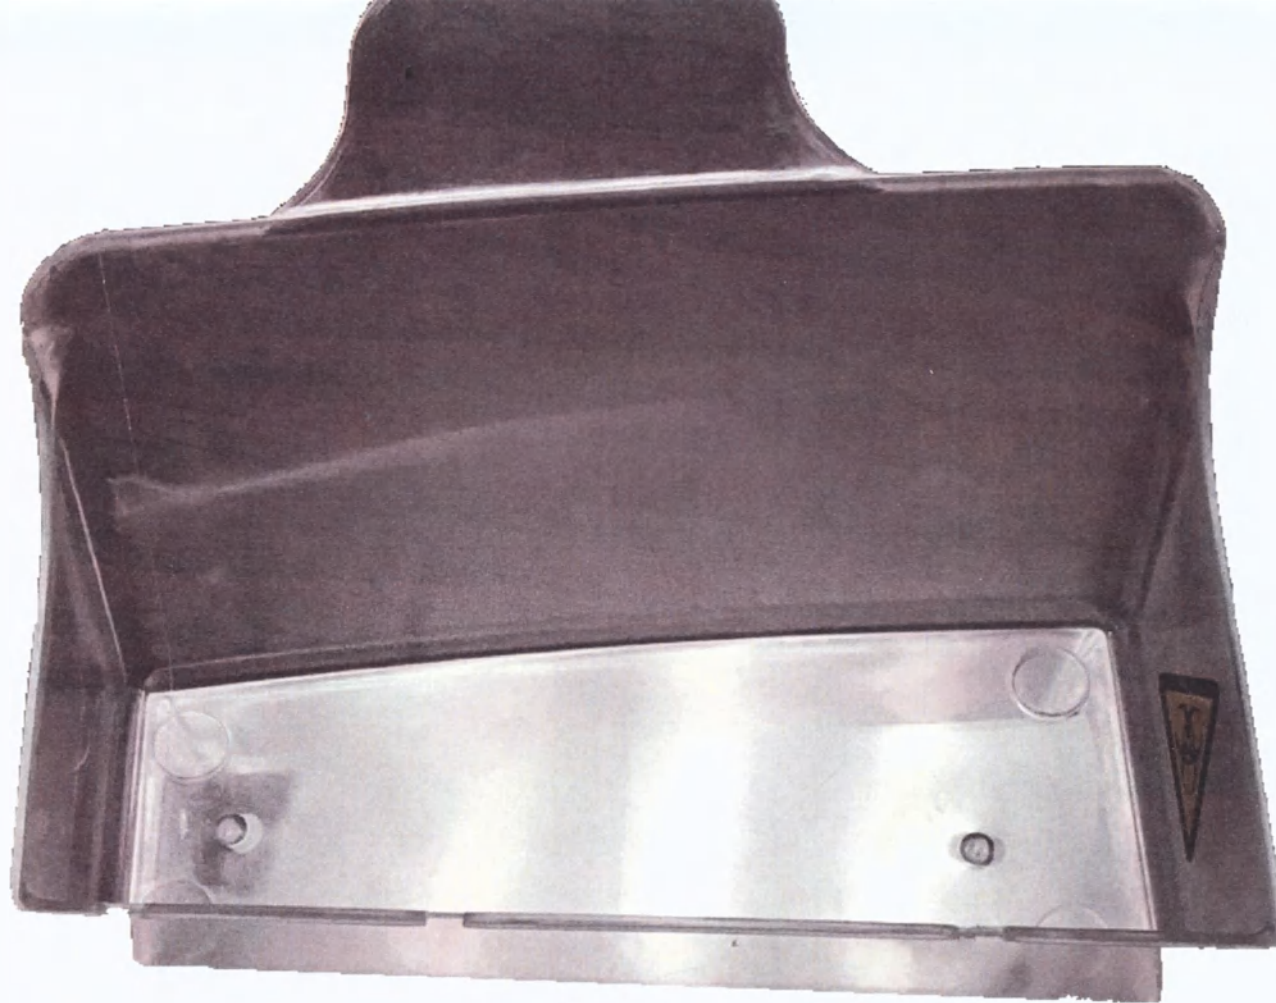

Емкость для использованных тест-полосок

Стартовый набор:

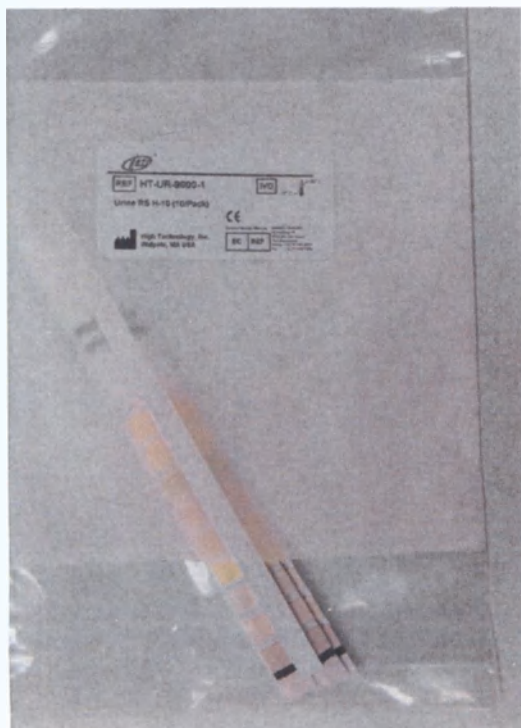


Тест-полоски UrineRS H-10


Тест-полоски UrineRS H-11




Термобумага

Анализатор мочи CL-50 Plus

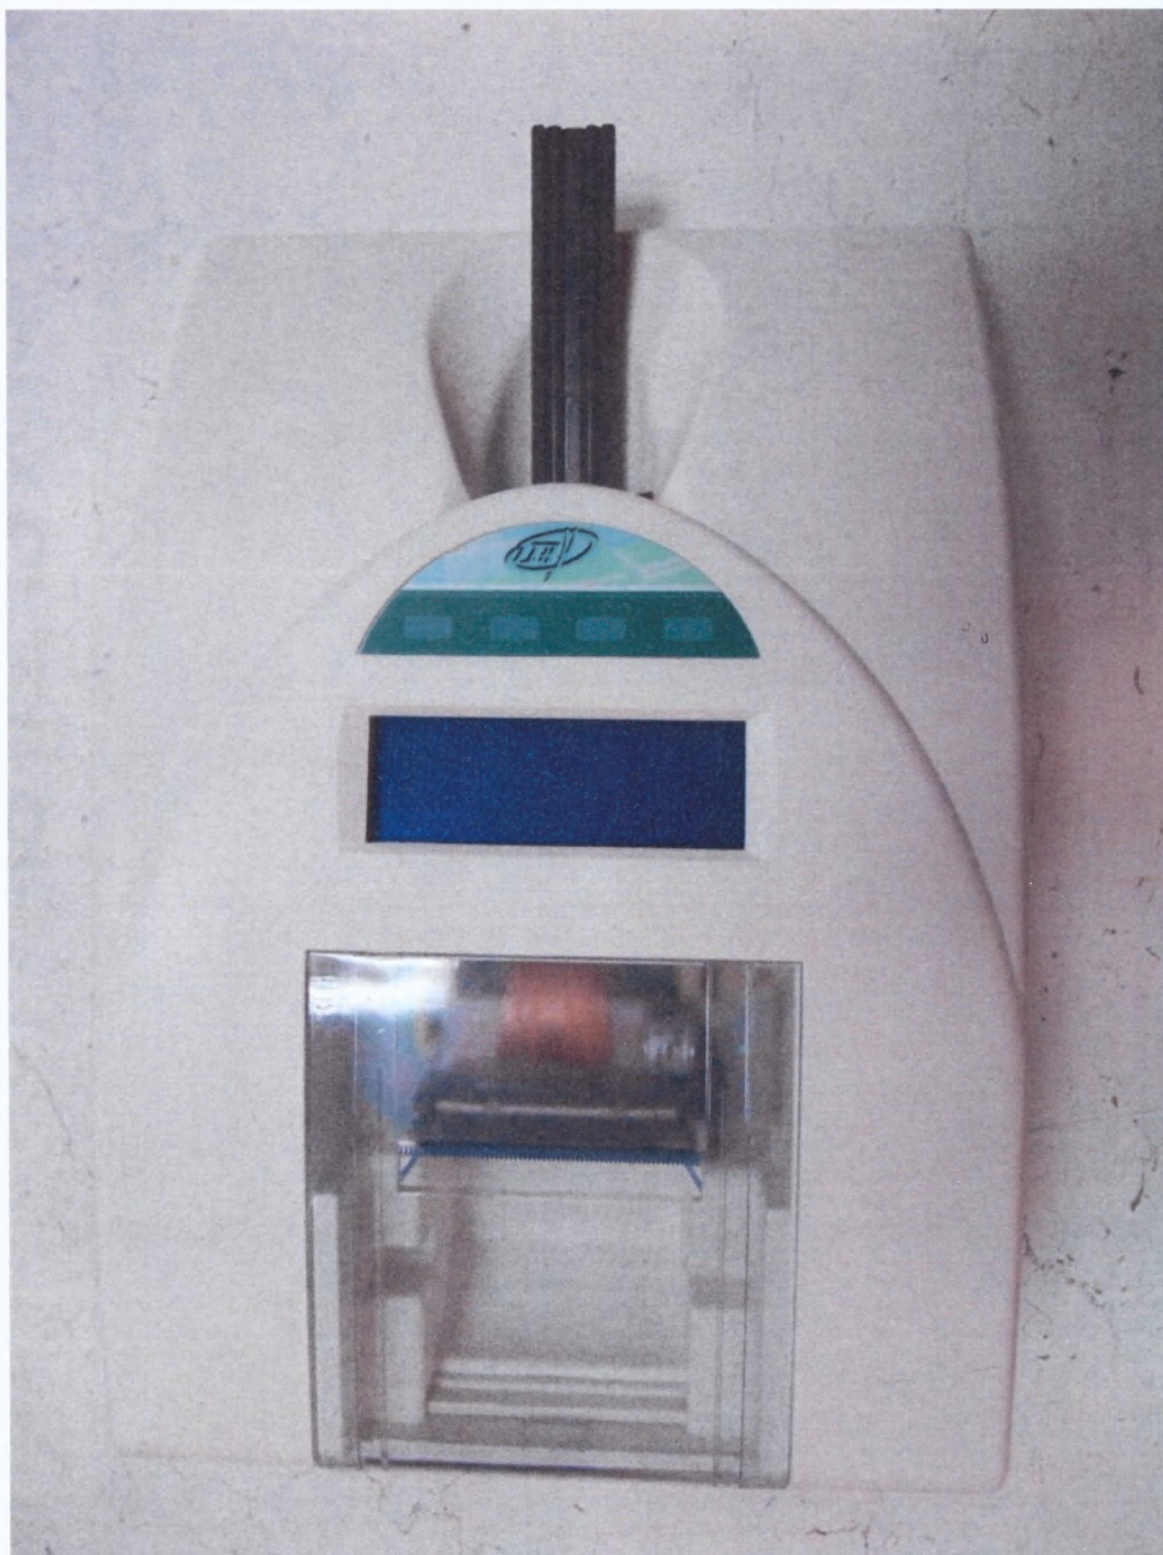


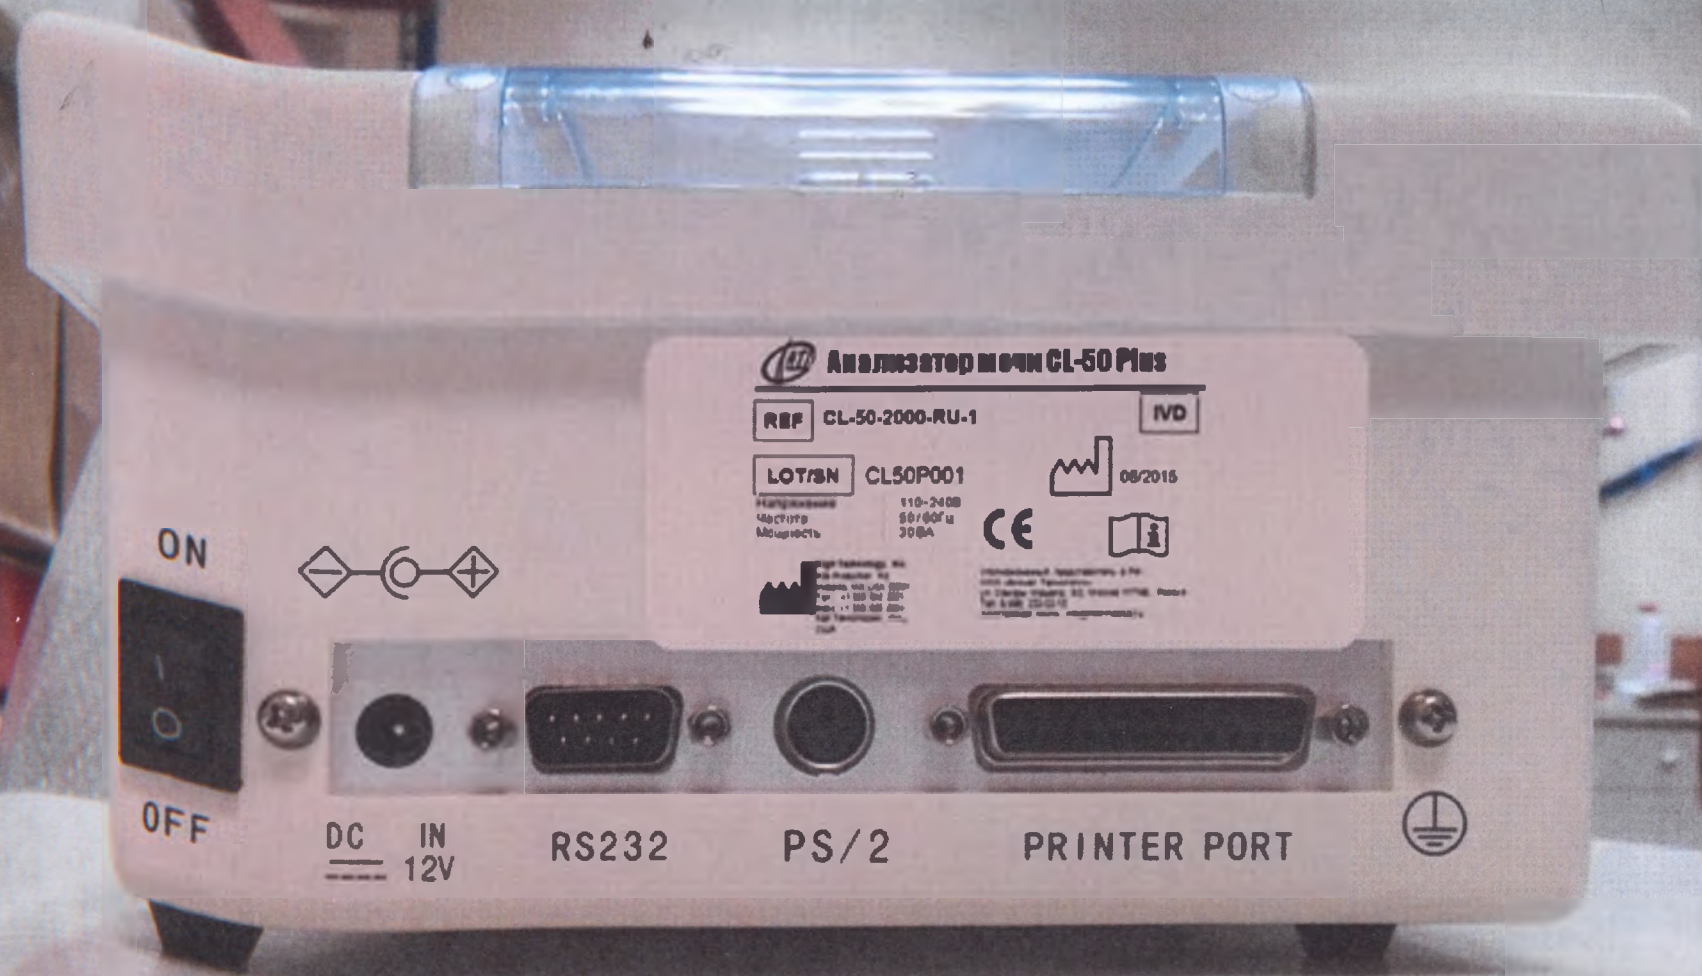


Анализатор мочи CL-50 Plus (вид сзади)

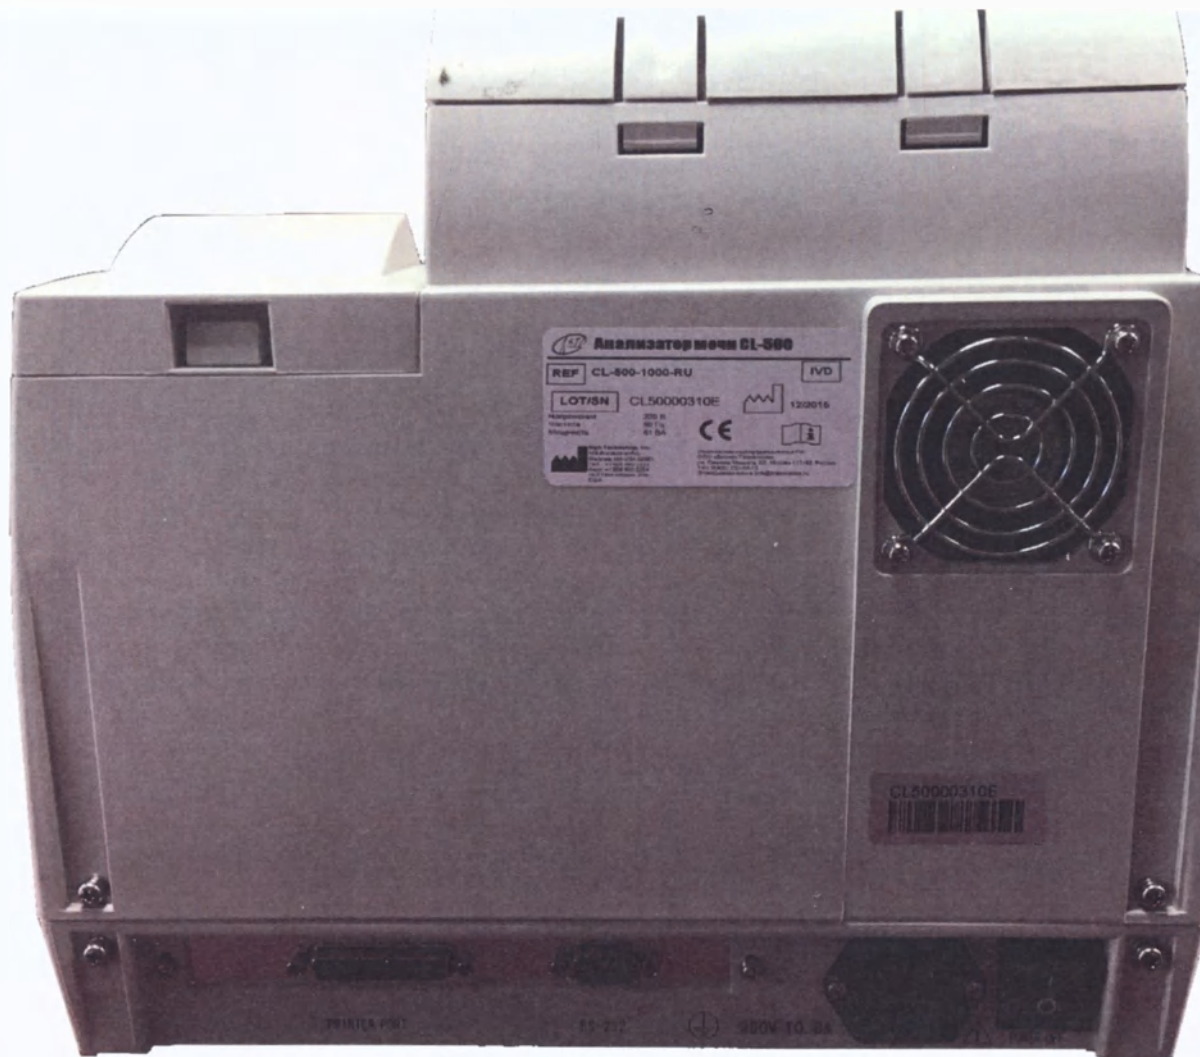

Анализатор мочи CL-500 (вид сзади)

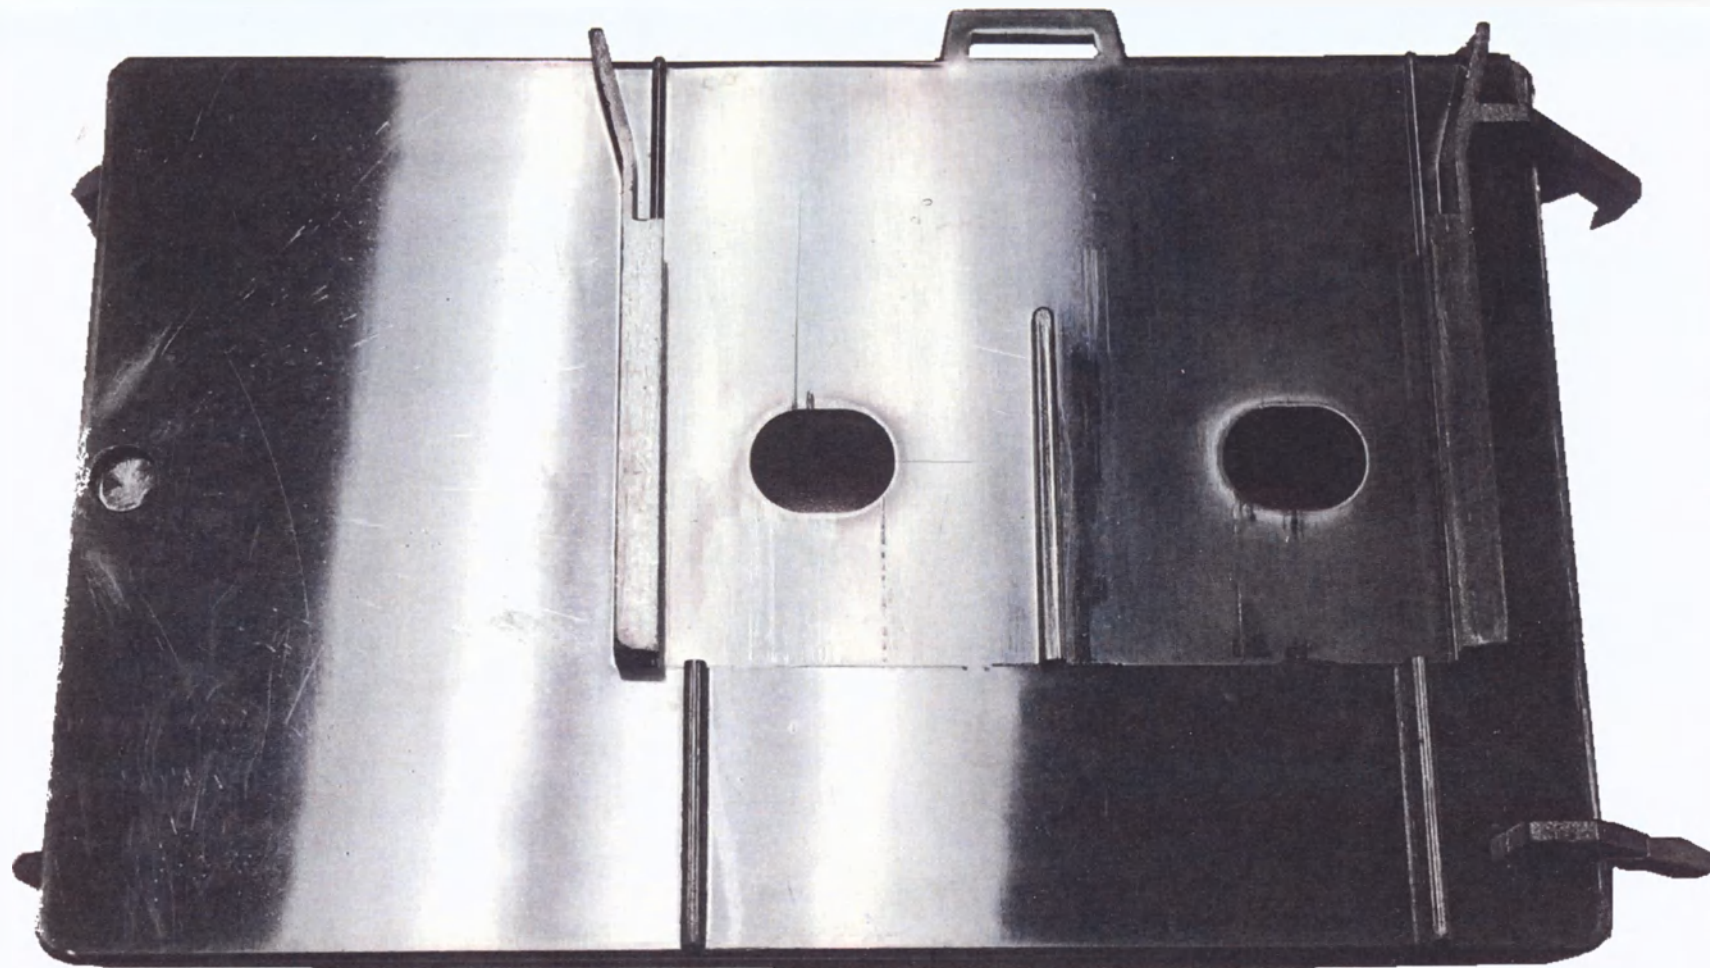

Стол конвейера

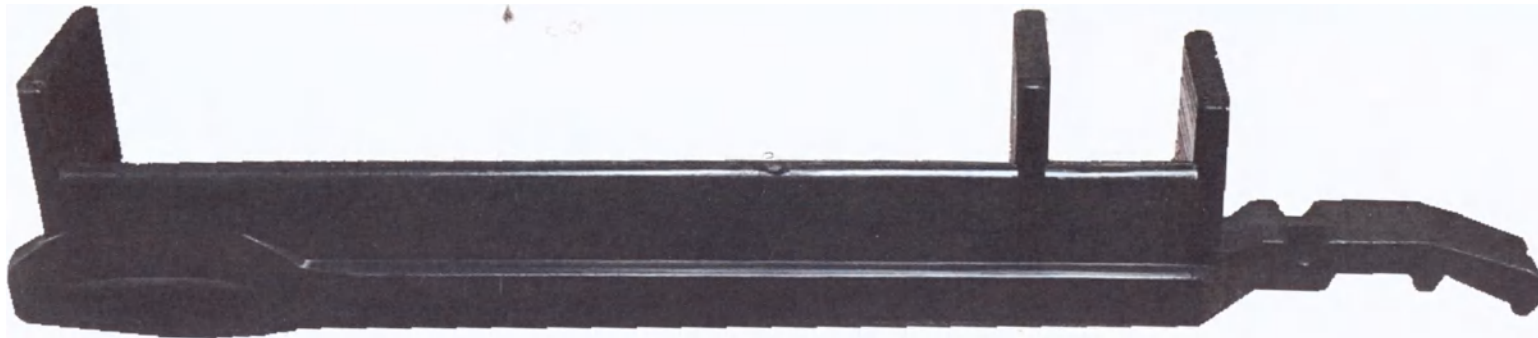


Толкатель

Калибровочные тест-полоски



 **High Technology, Inc.**
109 Production Road, Walpole MA 02081 USA




Анализатор мочи CL-50 PLUS

Руководство пользователя

Number	:	OM-R-CL-50-20-1
Revision Level	:	Rev.A
Effective Date	:	9/23/2015


HIGH TECHNOLOGY, INC. PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL

Инструкция пользователя

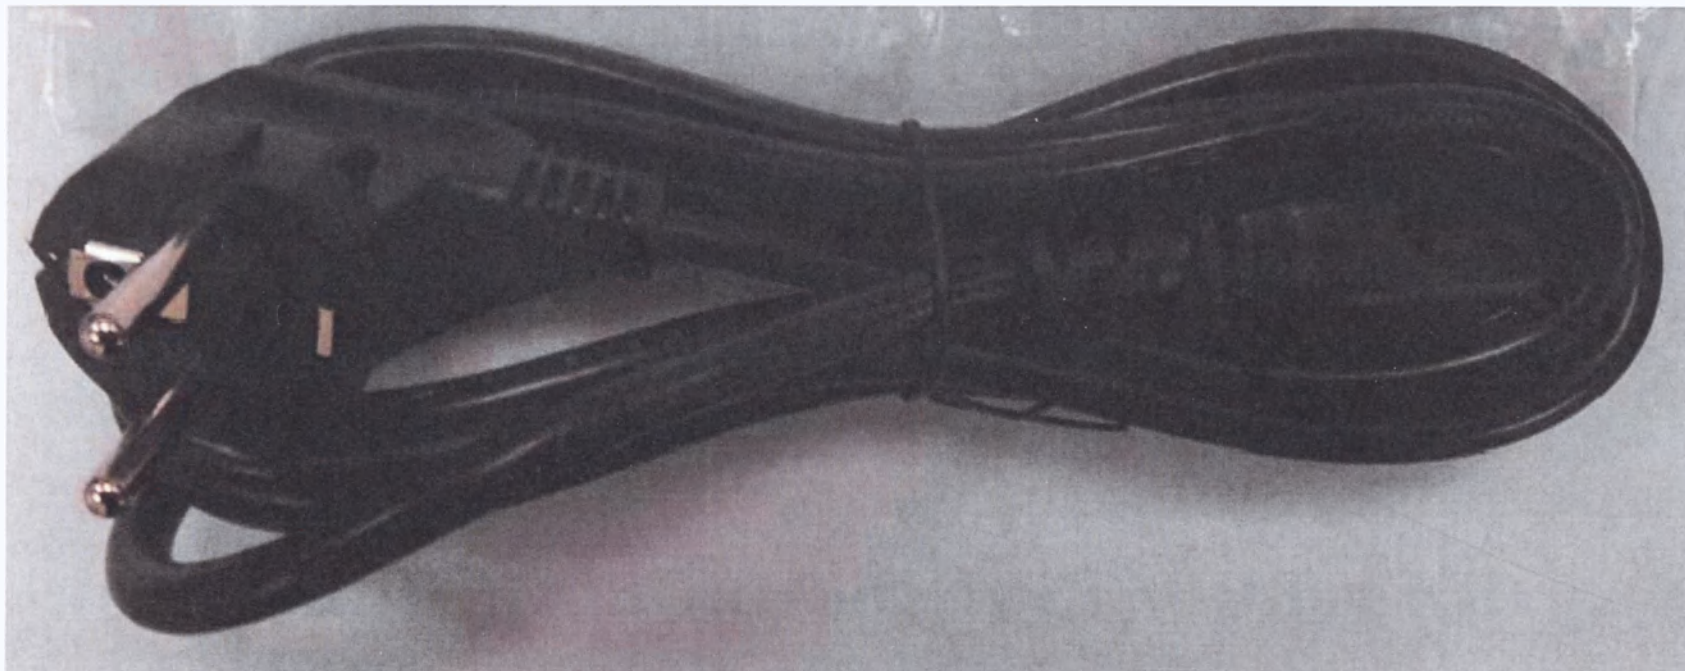


Кабель питания


Кати́оновые тест-полоски

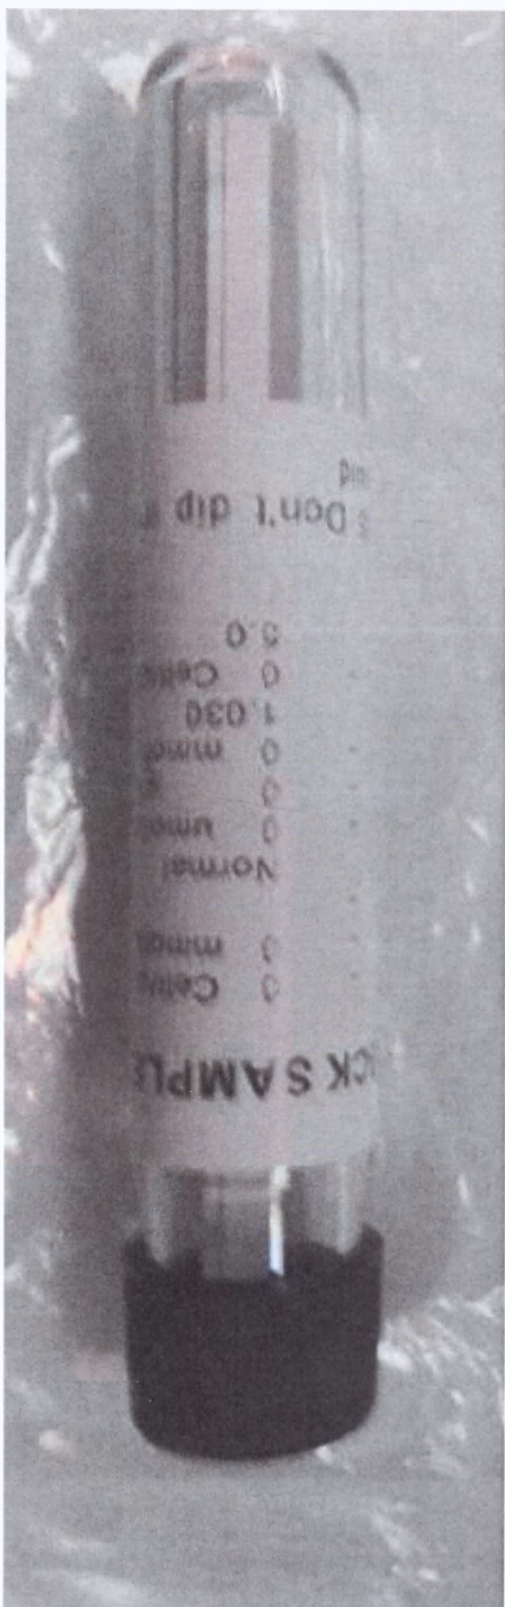

Термометра

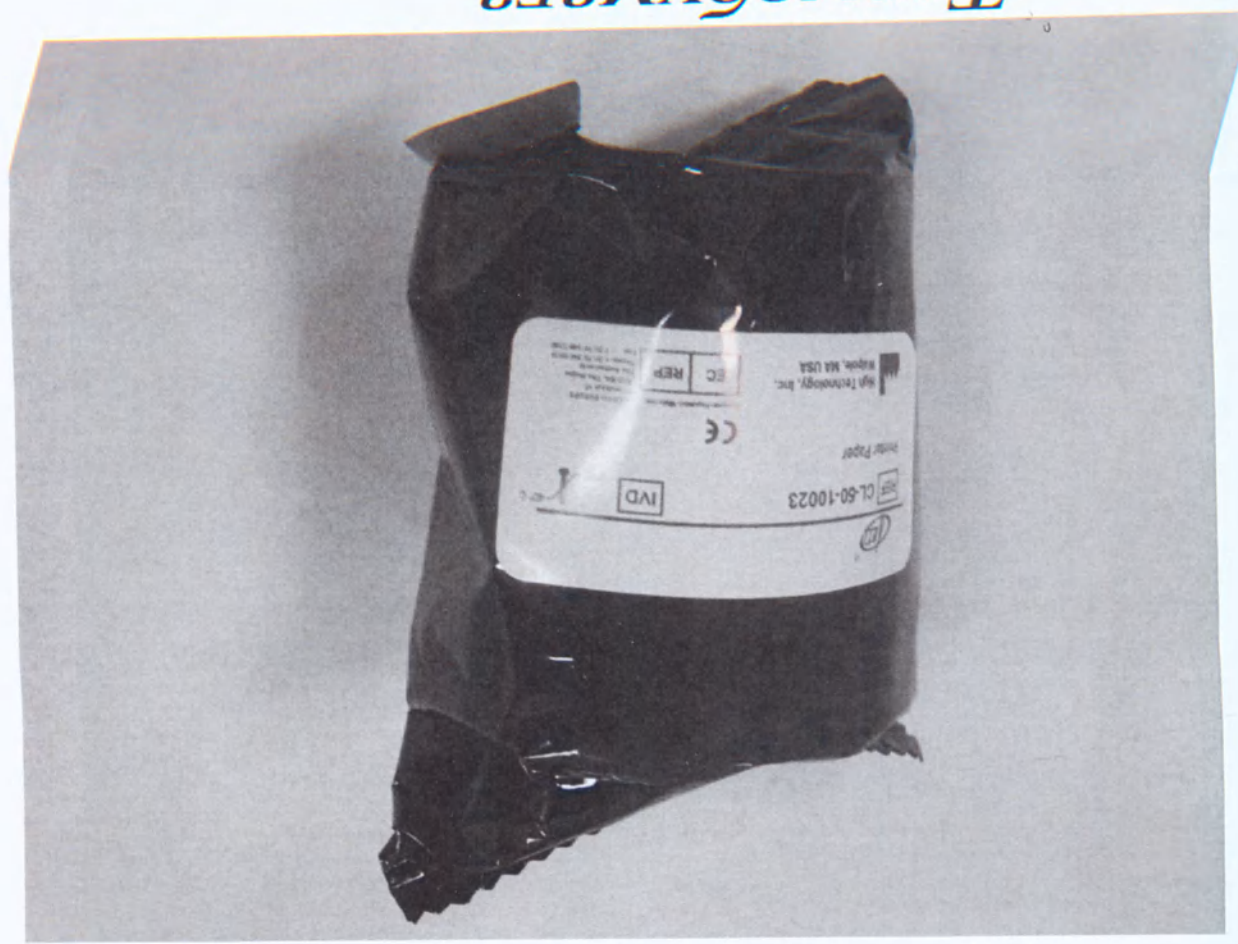

Тест-полоски UrineRS H-10

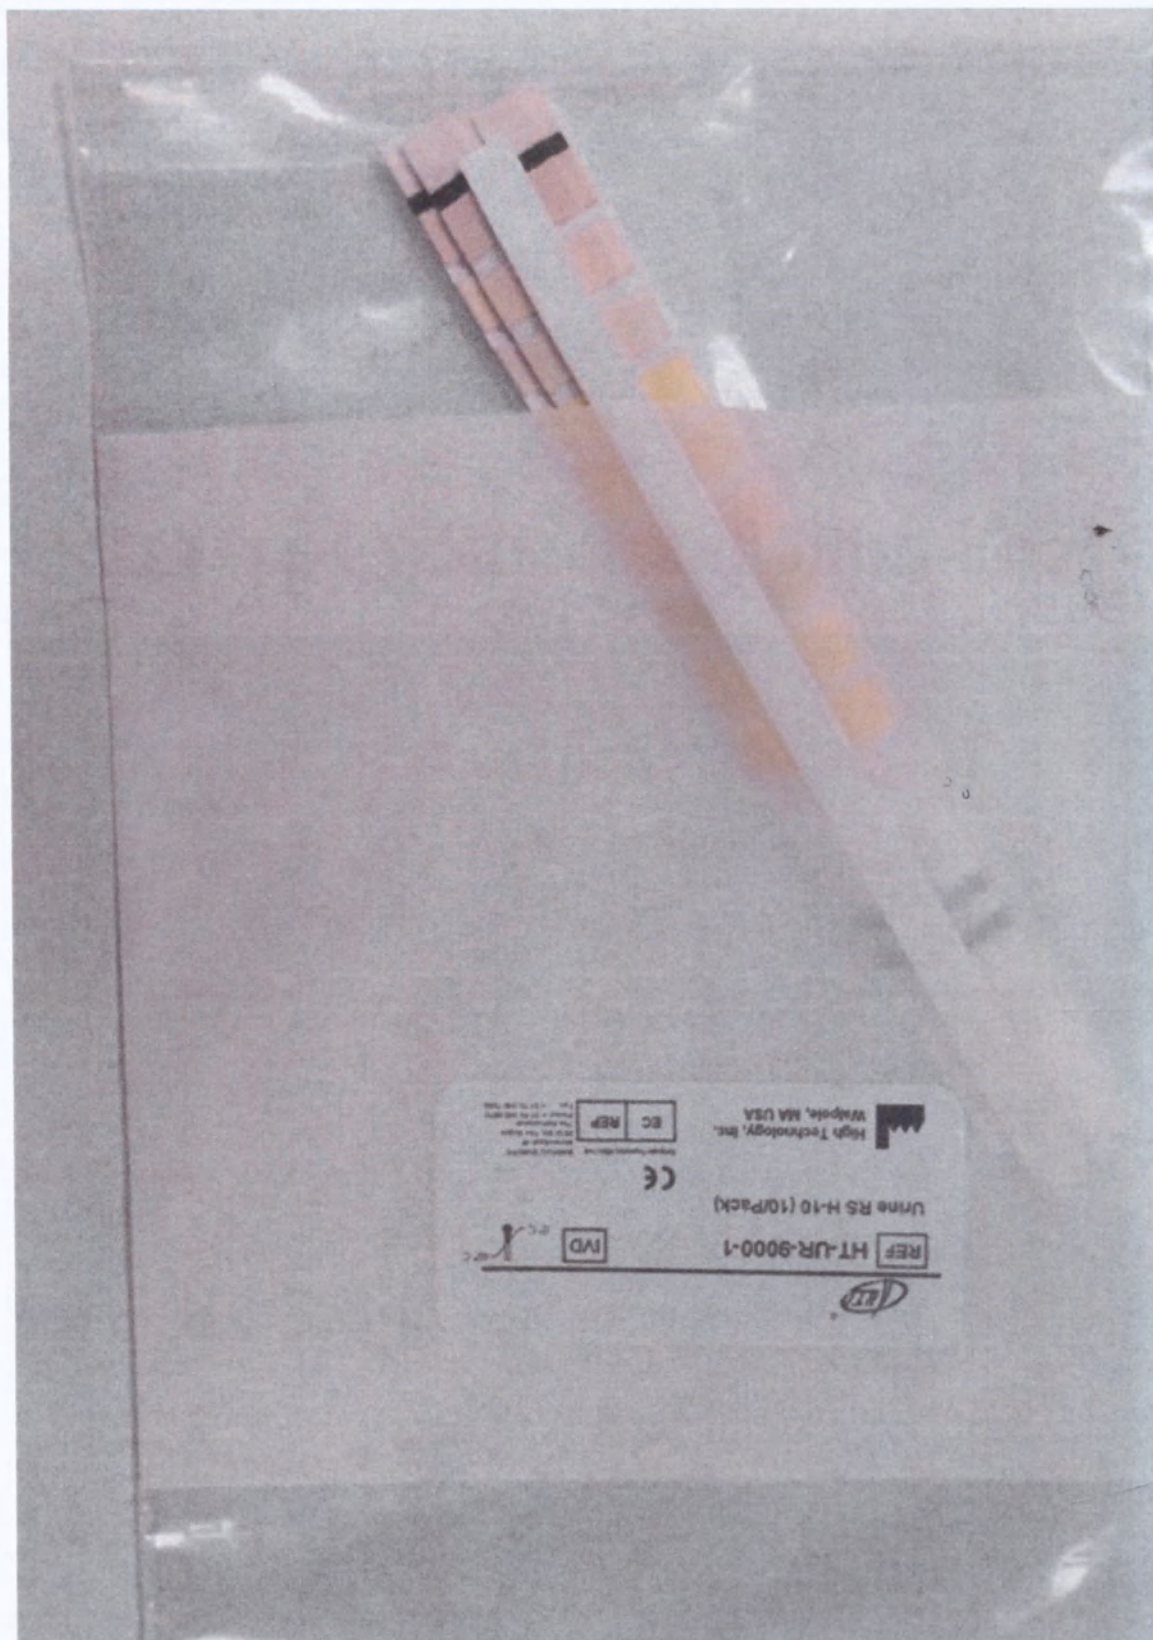



Тест-полоски UrineRS H-11