

Фотографии медицинского изделия

**«Инструменты к Морцеллятору TCM 3000 BL для хирургических операций»,
производства «Ноувэг АГ» / Nouvag AG, St.Gallerstrasse, 23-25, CH 9403 Goldach,
Switzerland / Швейцария.**

Список фотографий:

Рис. 1. 5139пou Трубкa защитная, Ø 20 мм.

Рис. 2. 5138пou Трубкa защитная, Ø 15 мм.

Рис. 3. 5137пou Трубкa защитная, Ø 12 мм.

Рис. 4. 5153пou Обтуратор Ø 20 мм.

Рис. 5. 5152пou Обтуратор Ø 15 мм.

Рис. 6. 5151пou Обтуратор Ø 12 мм.

Рис. 7. 5156пou Нож-губус, Ø 20 мм.

Рис. 8. 5155пou Нож-губус, Ø 15 мм.

Рис. 9. 5154пou Нож-губус, Ø 12 мм.

Рис. 10. 5142пou Трубкa троакара для инструментов Ø 15 мм.

Рис. 11. 5141пou Трубкa троакара для инструментов Ø 12 мм.

Рис. 12. 5193 Сверло для миомы, Ø 10 мм.

Рис. 13. 5195 Щипцы когтевидные, Ø 10 мм.

Рис. 14. 5196 Щипцы зубчато-лапчатые, Ø 10 мм.

Рис. 15. 5194 Щипцы зубчато-лапчатые, Ø 5 мм.

Рис. 16. 5192 Щипцы зубчато-лапчатые, Ø 13.5/ 15.0 мм.

Генеральный директор

ООО «МедТестКонсалтинг»



Бунзя В.К.



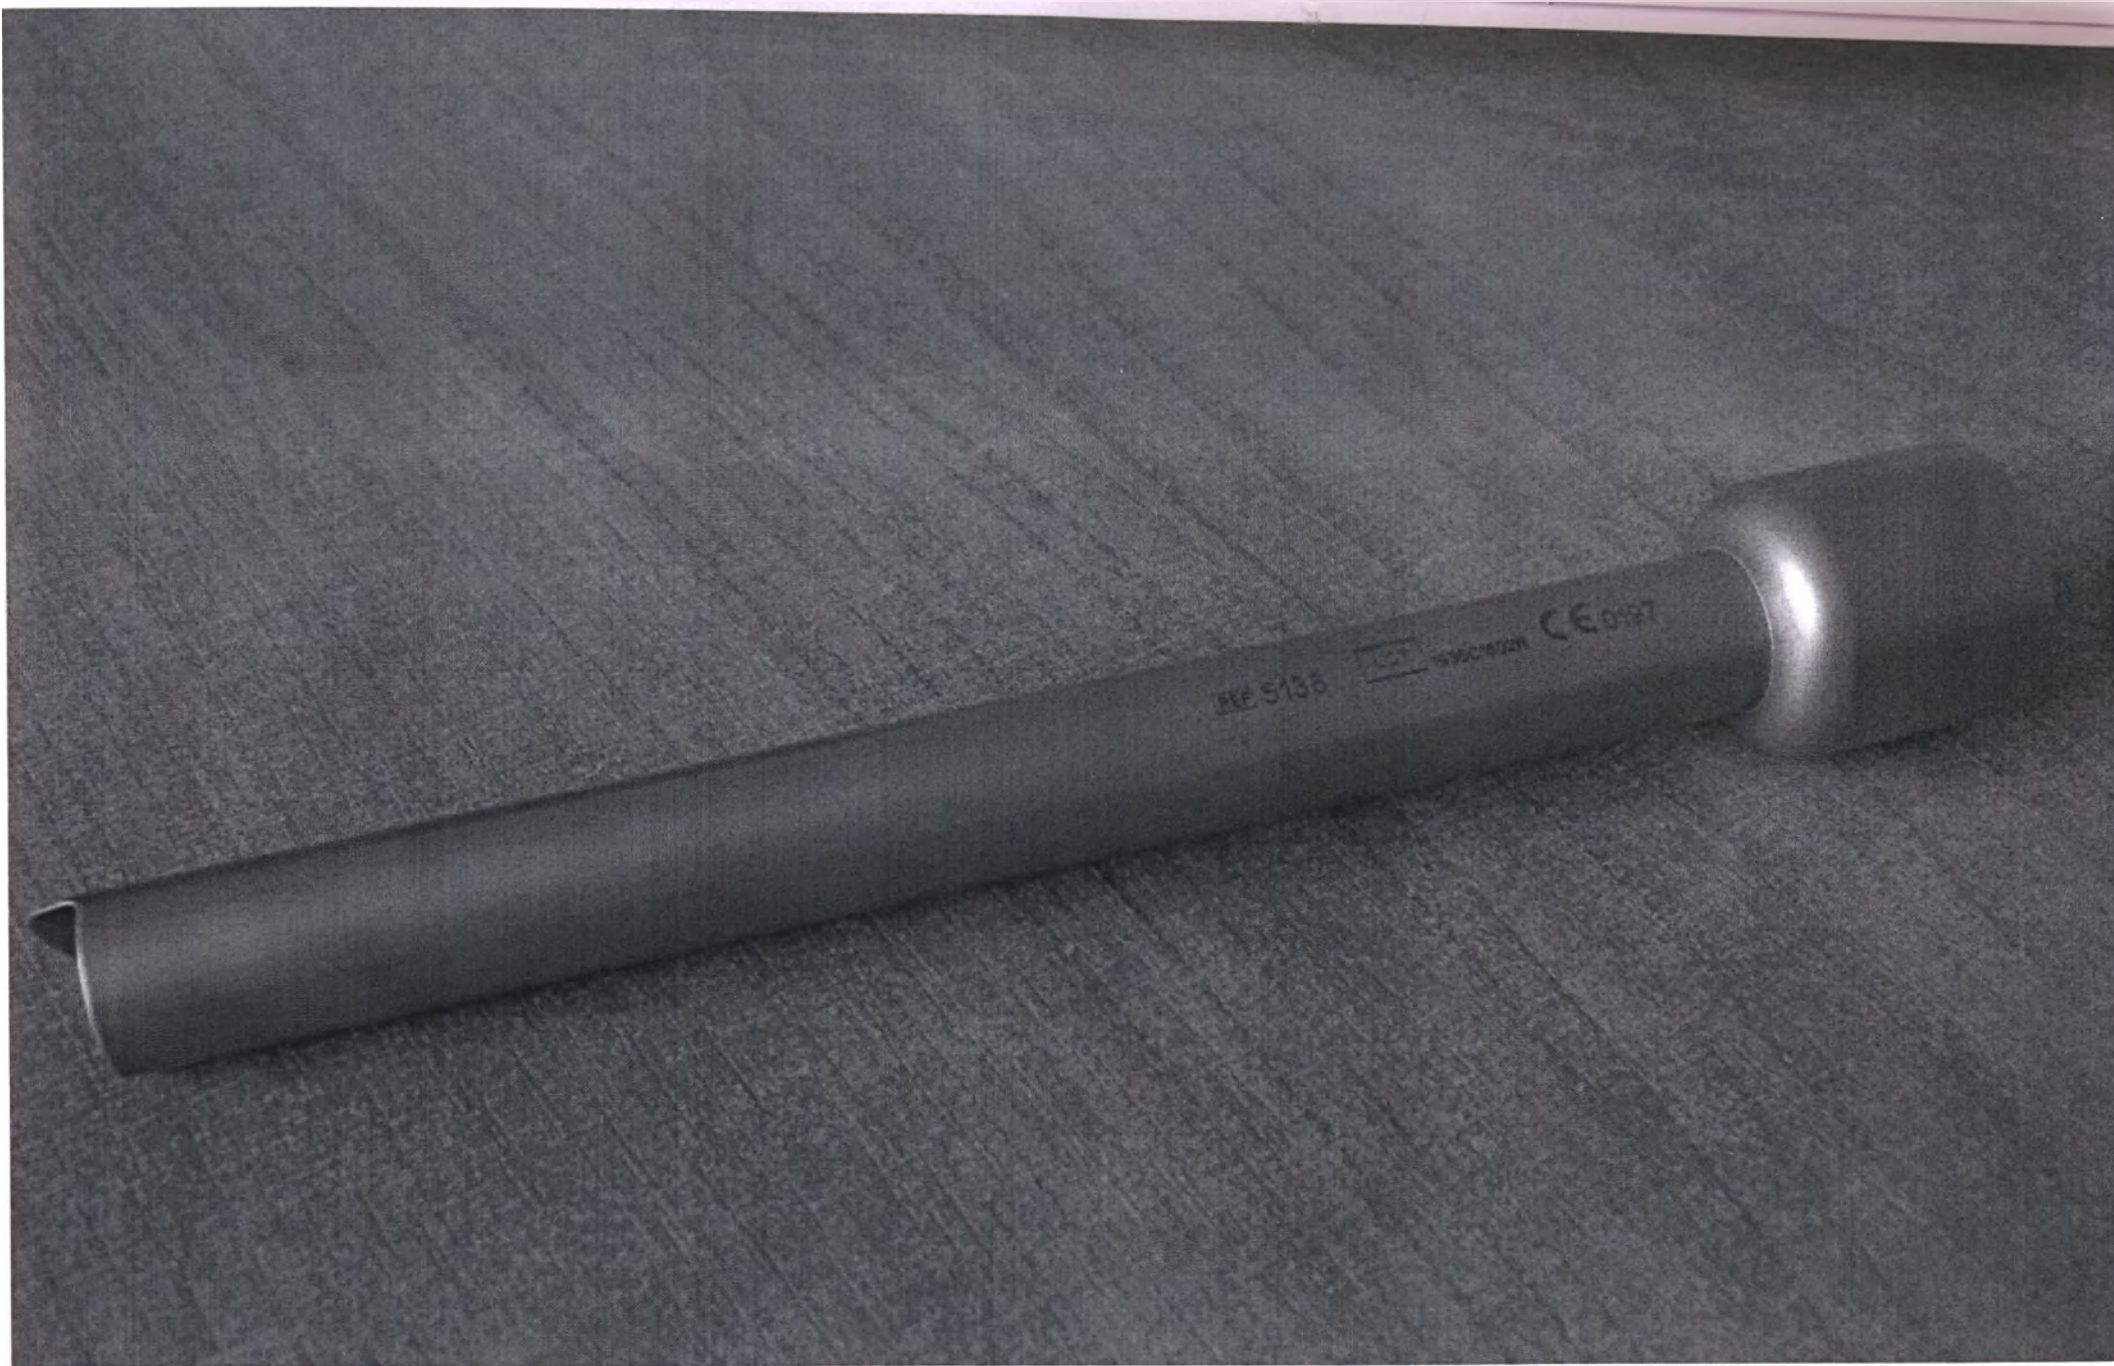


Рис. 2. 5138пou Трубка защитная, Ø 15 мм.

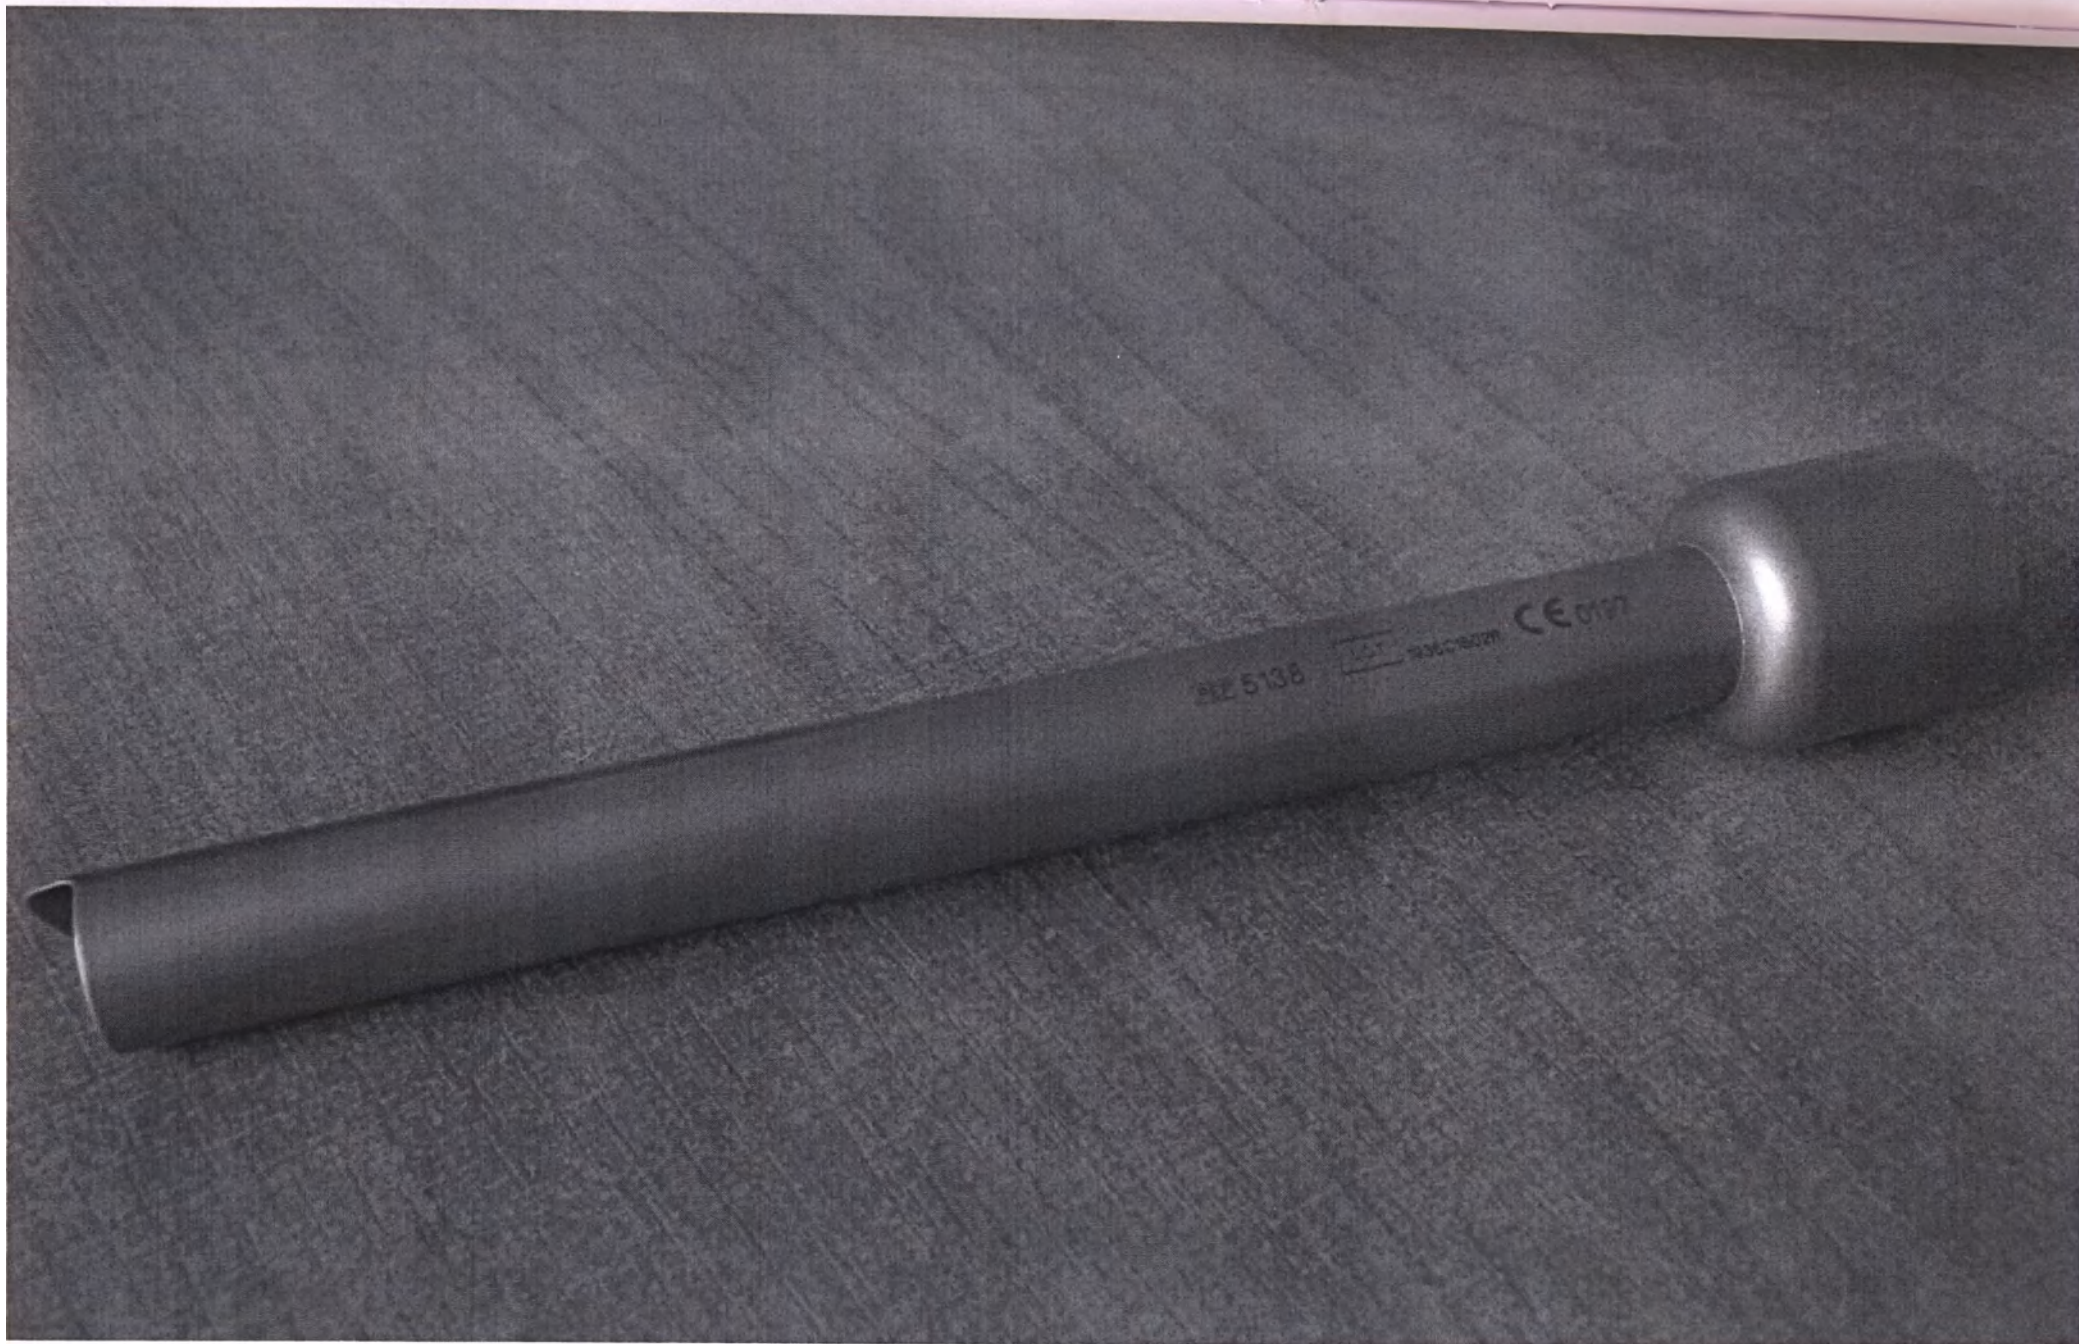
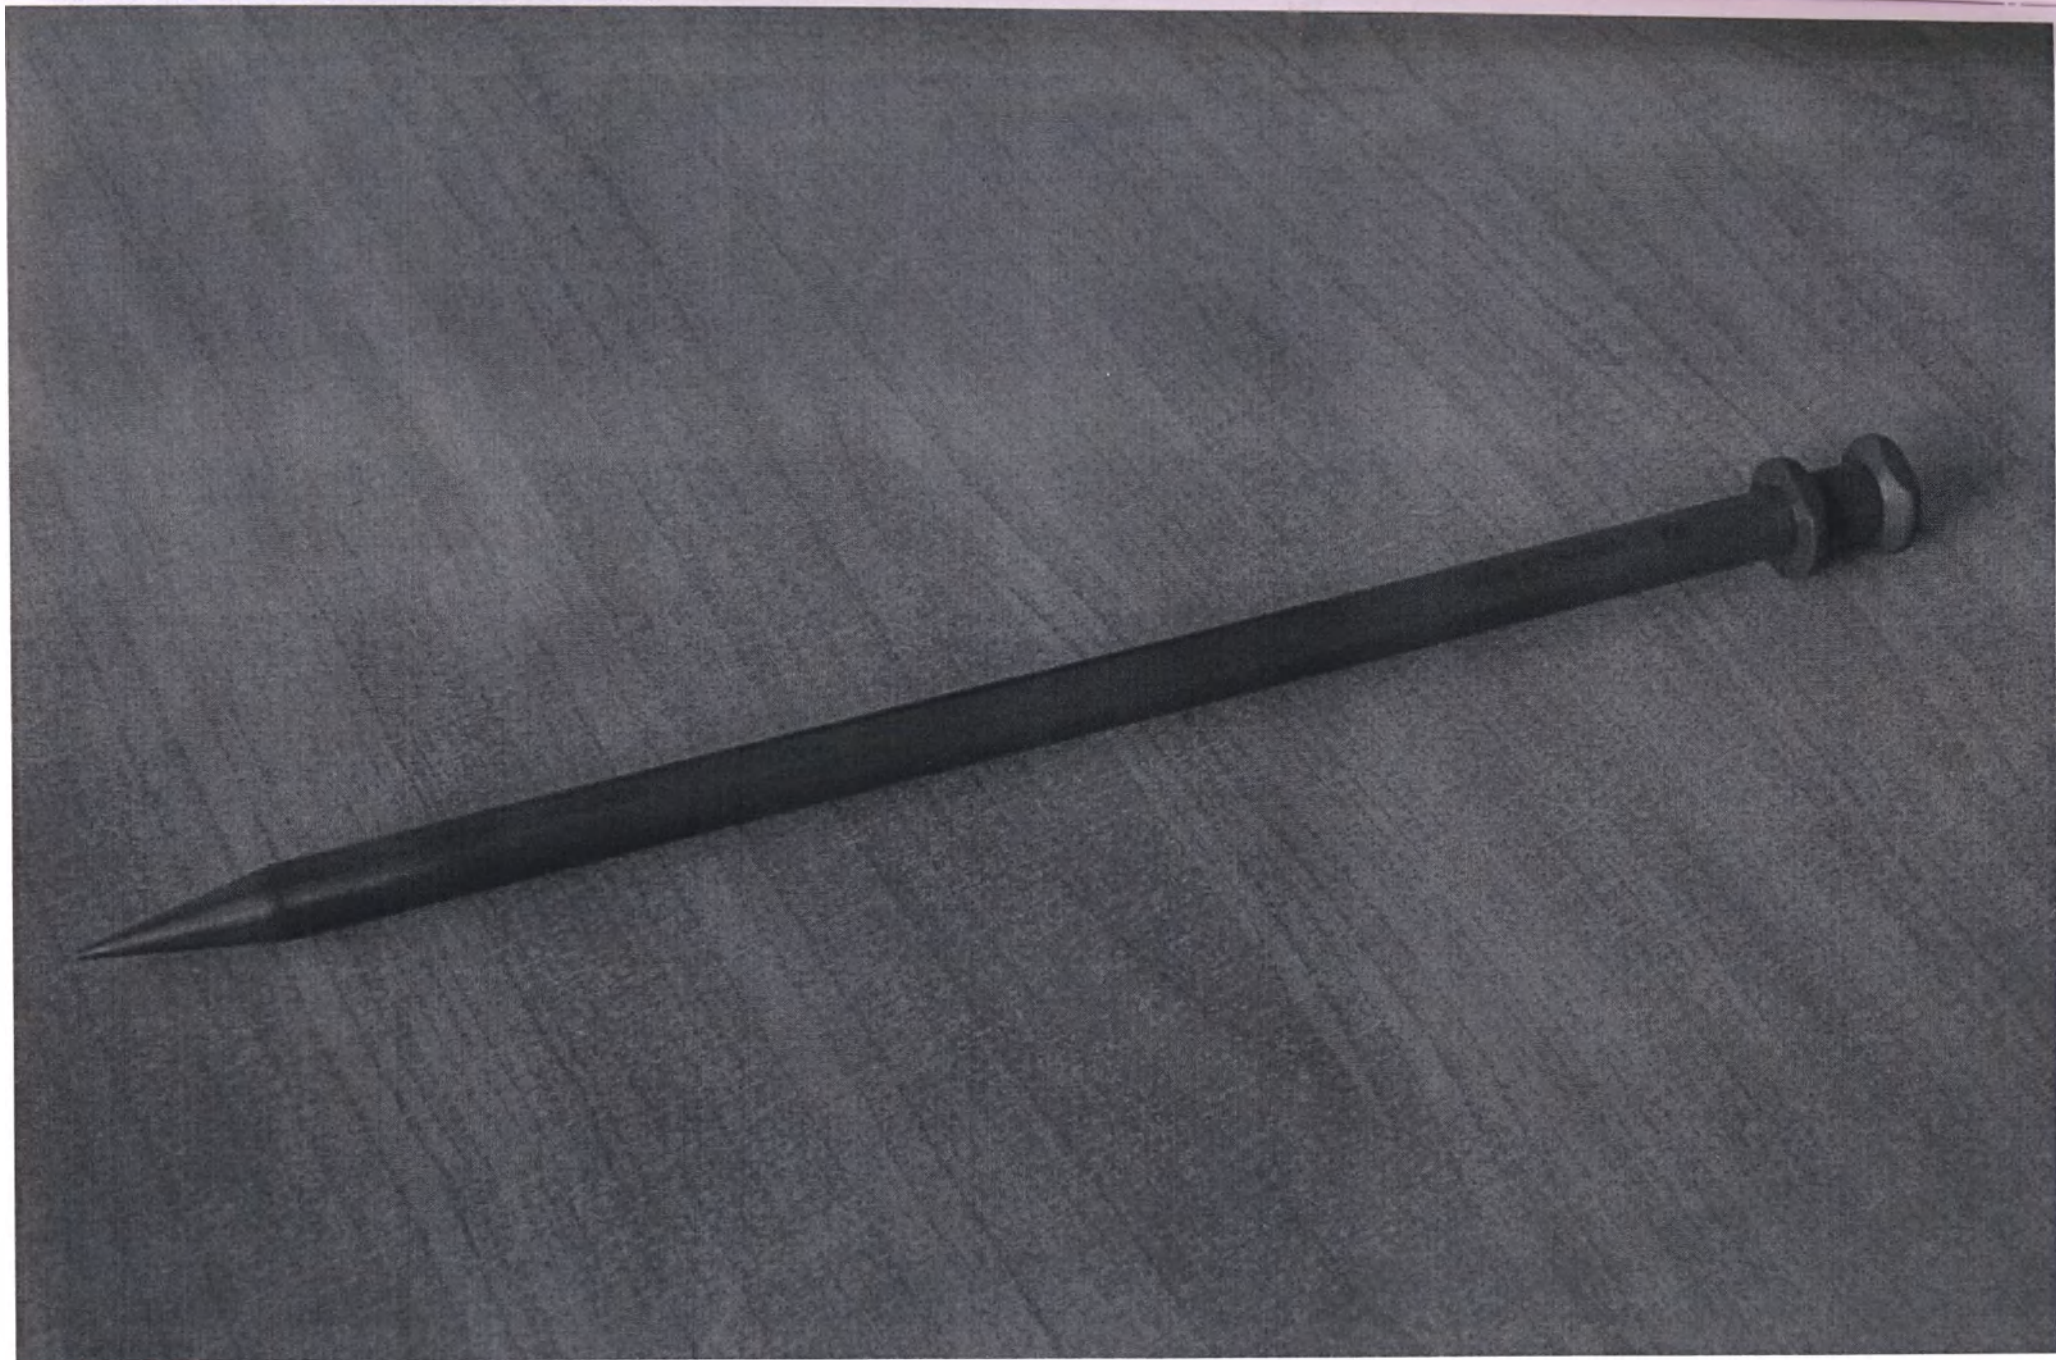


Рис. 3. 5137пou Трубка защитная, Ø 12 мм.



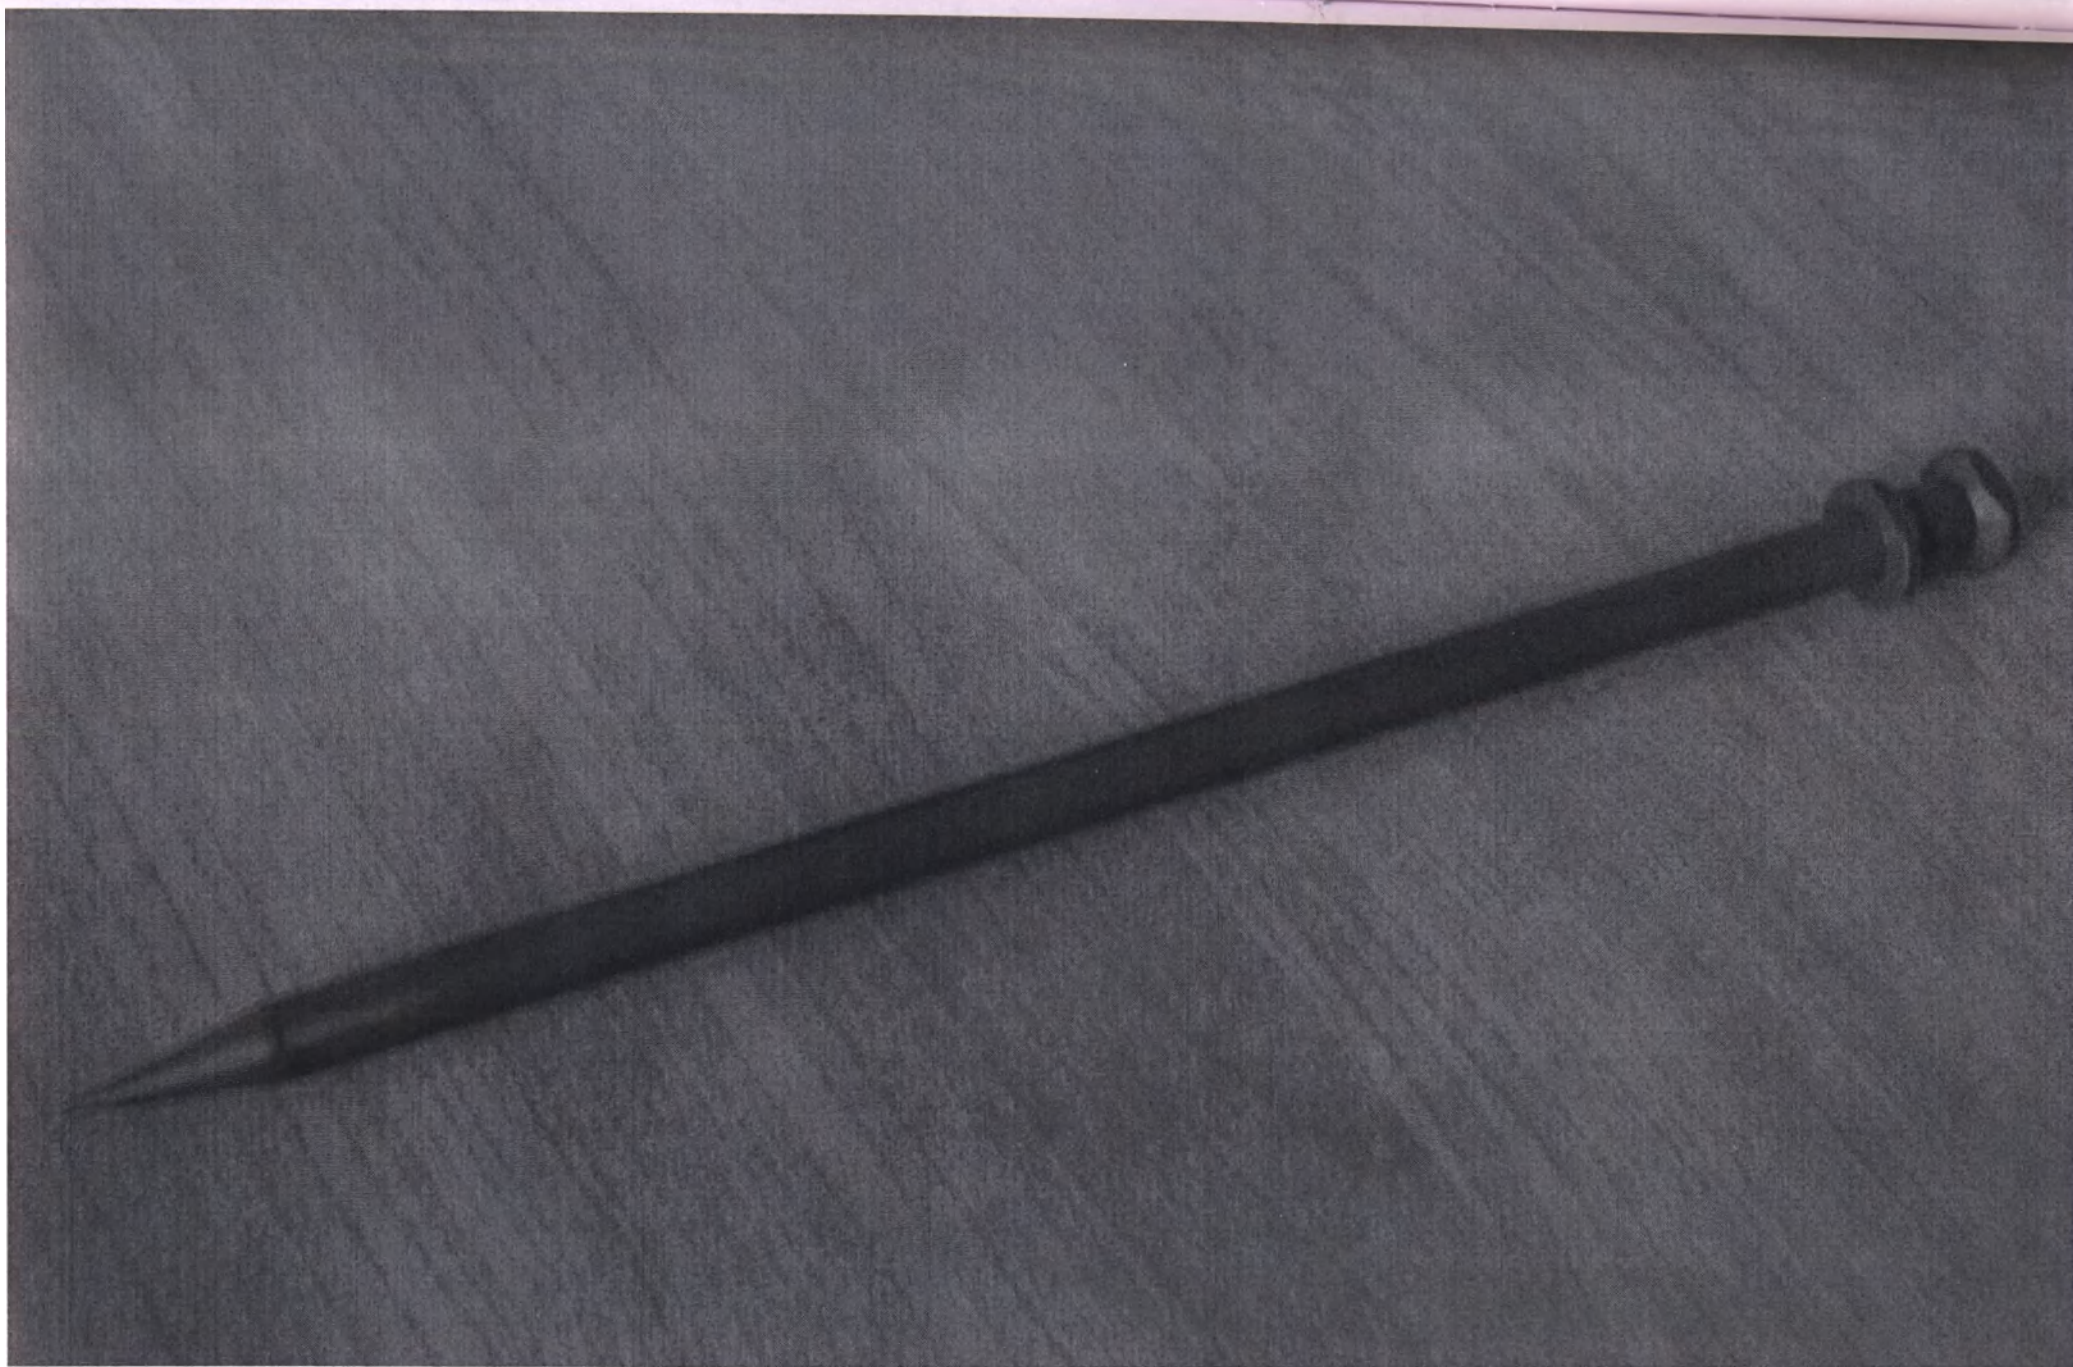


Рис. 5. 5152пou Обтуратор Ø 15 мм.

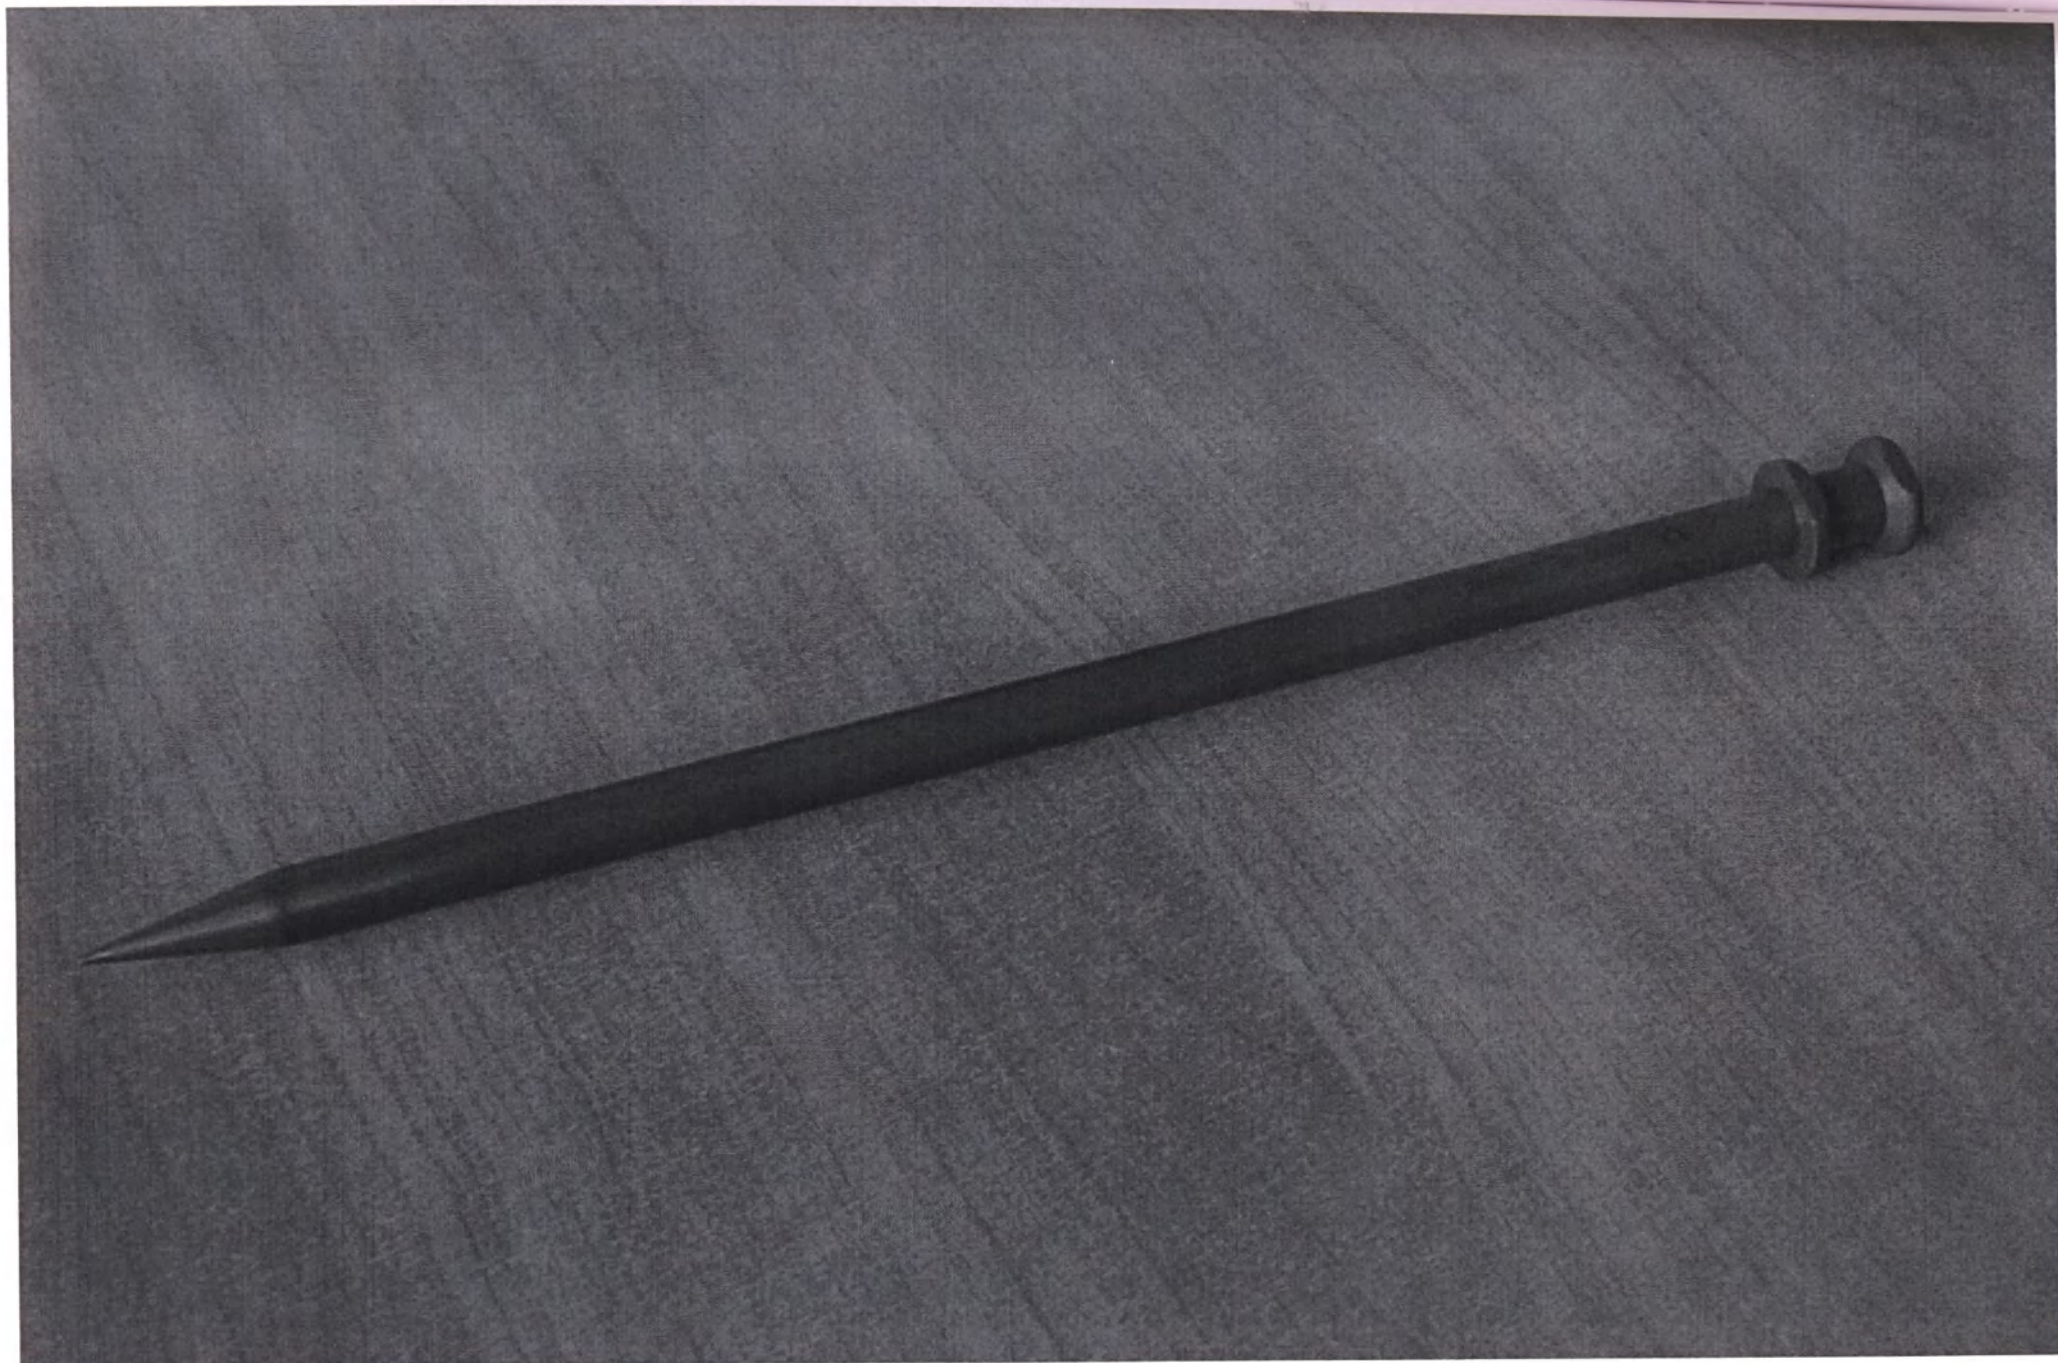


Рис. 6. 5151пou Обтуратор Ø 12 мм.



Рис. 7. 5156пou Нож-тубус, Ø 20 мм.

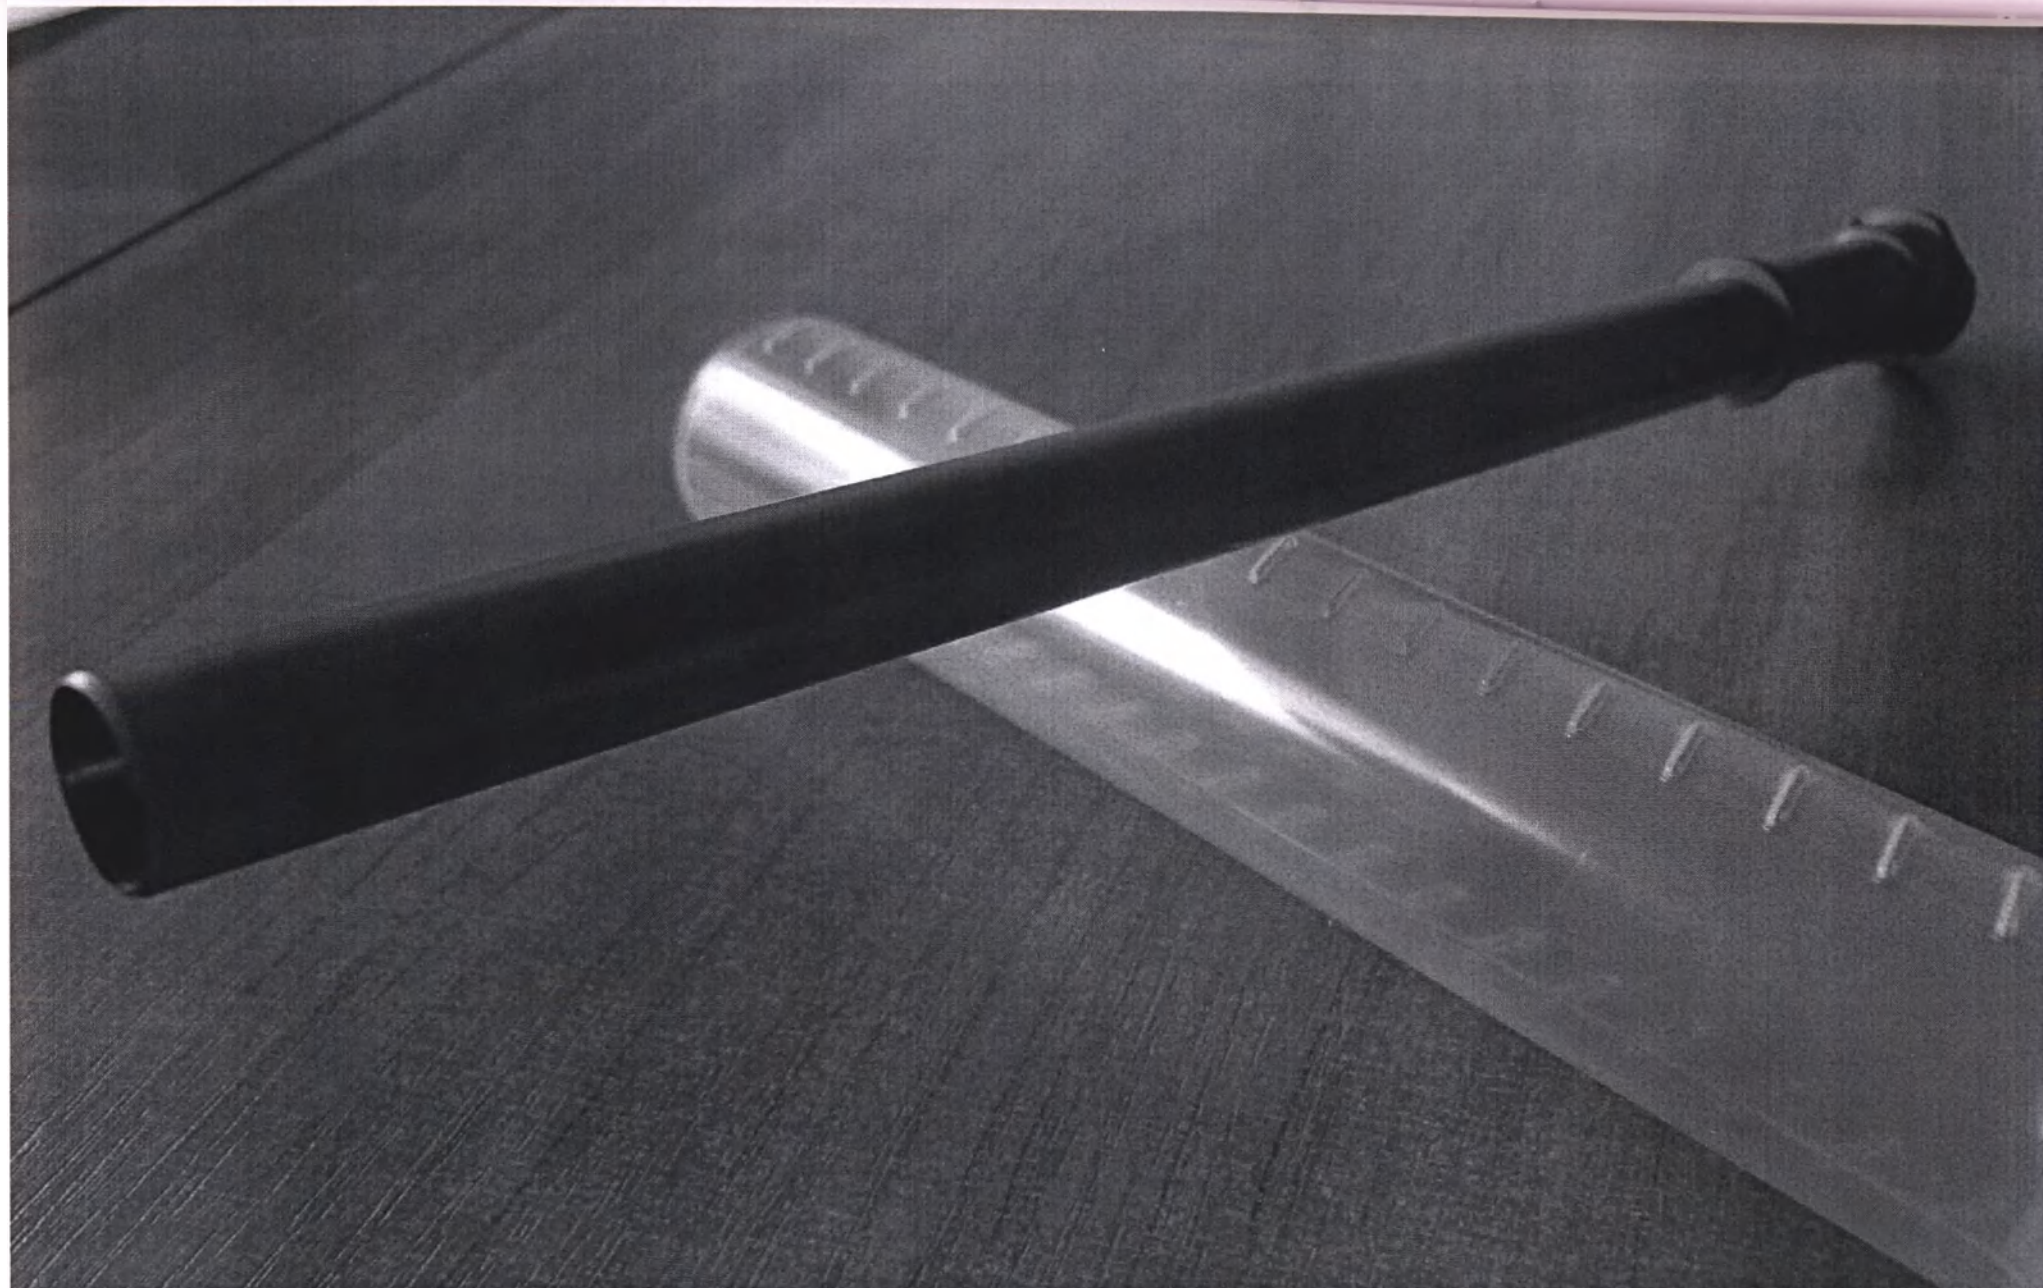


Рис. 8. 5155пou Нож-тубус, Ø 15 мм.



Рис. 9. 5154пou Нож-тубус, Ø 12 мм.



Рис. 10. 5142пou Трубка троакара для инструментов $\varnothing$ 15 мм.

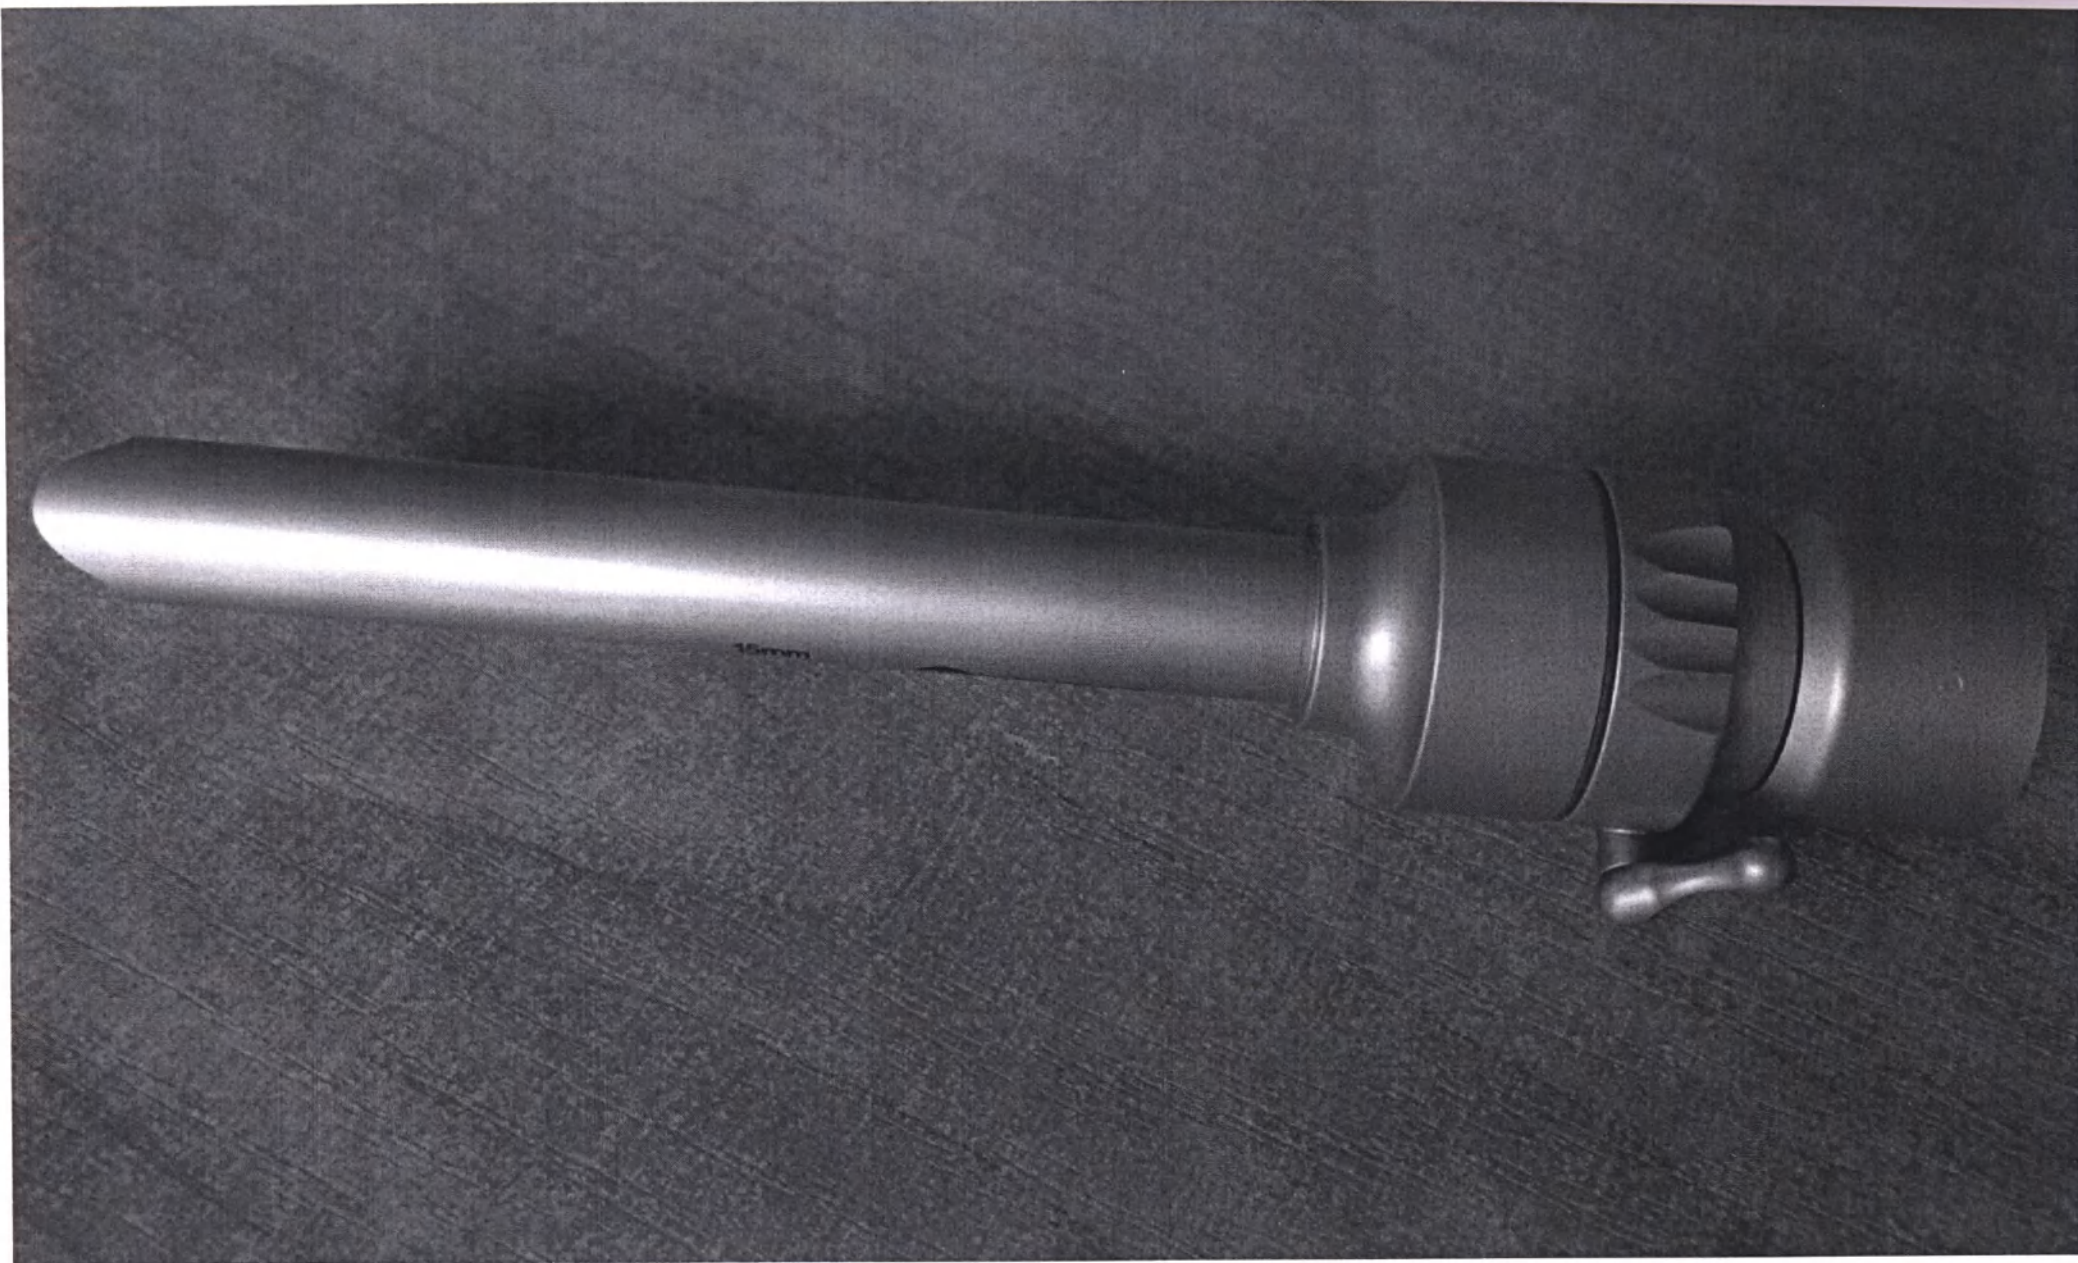


Рис. 11. 5141пou Трубка троакара для инструментов Ø 12 мм.

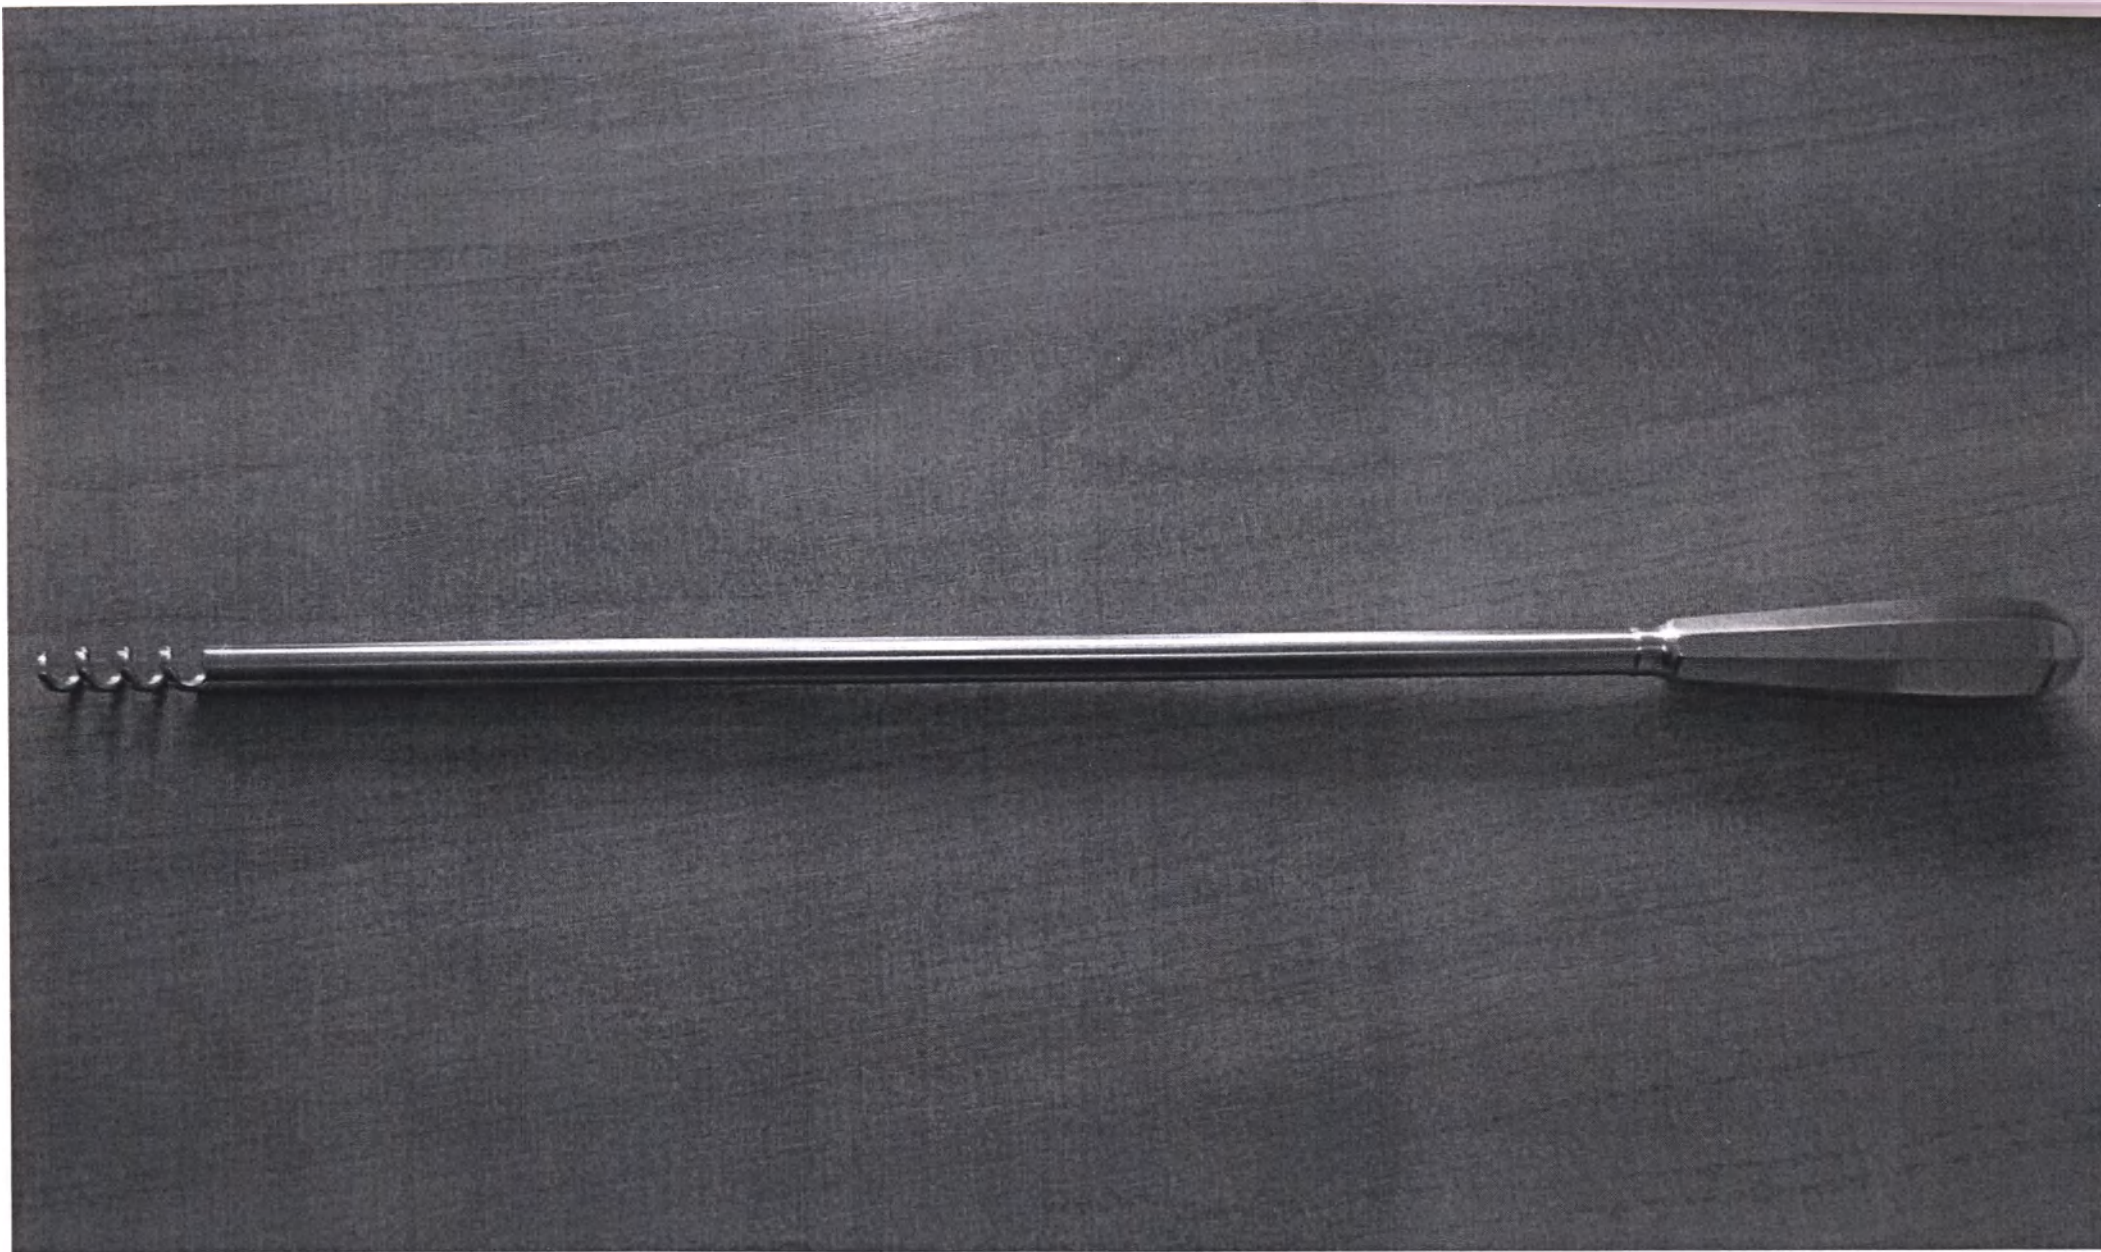


Рис. 12. 5193 Сверло для миомы, Ø 10 мм.

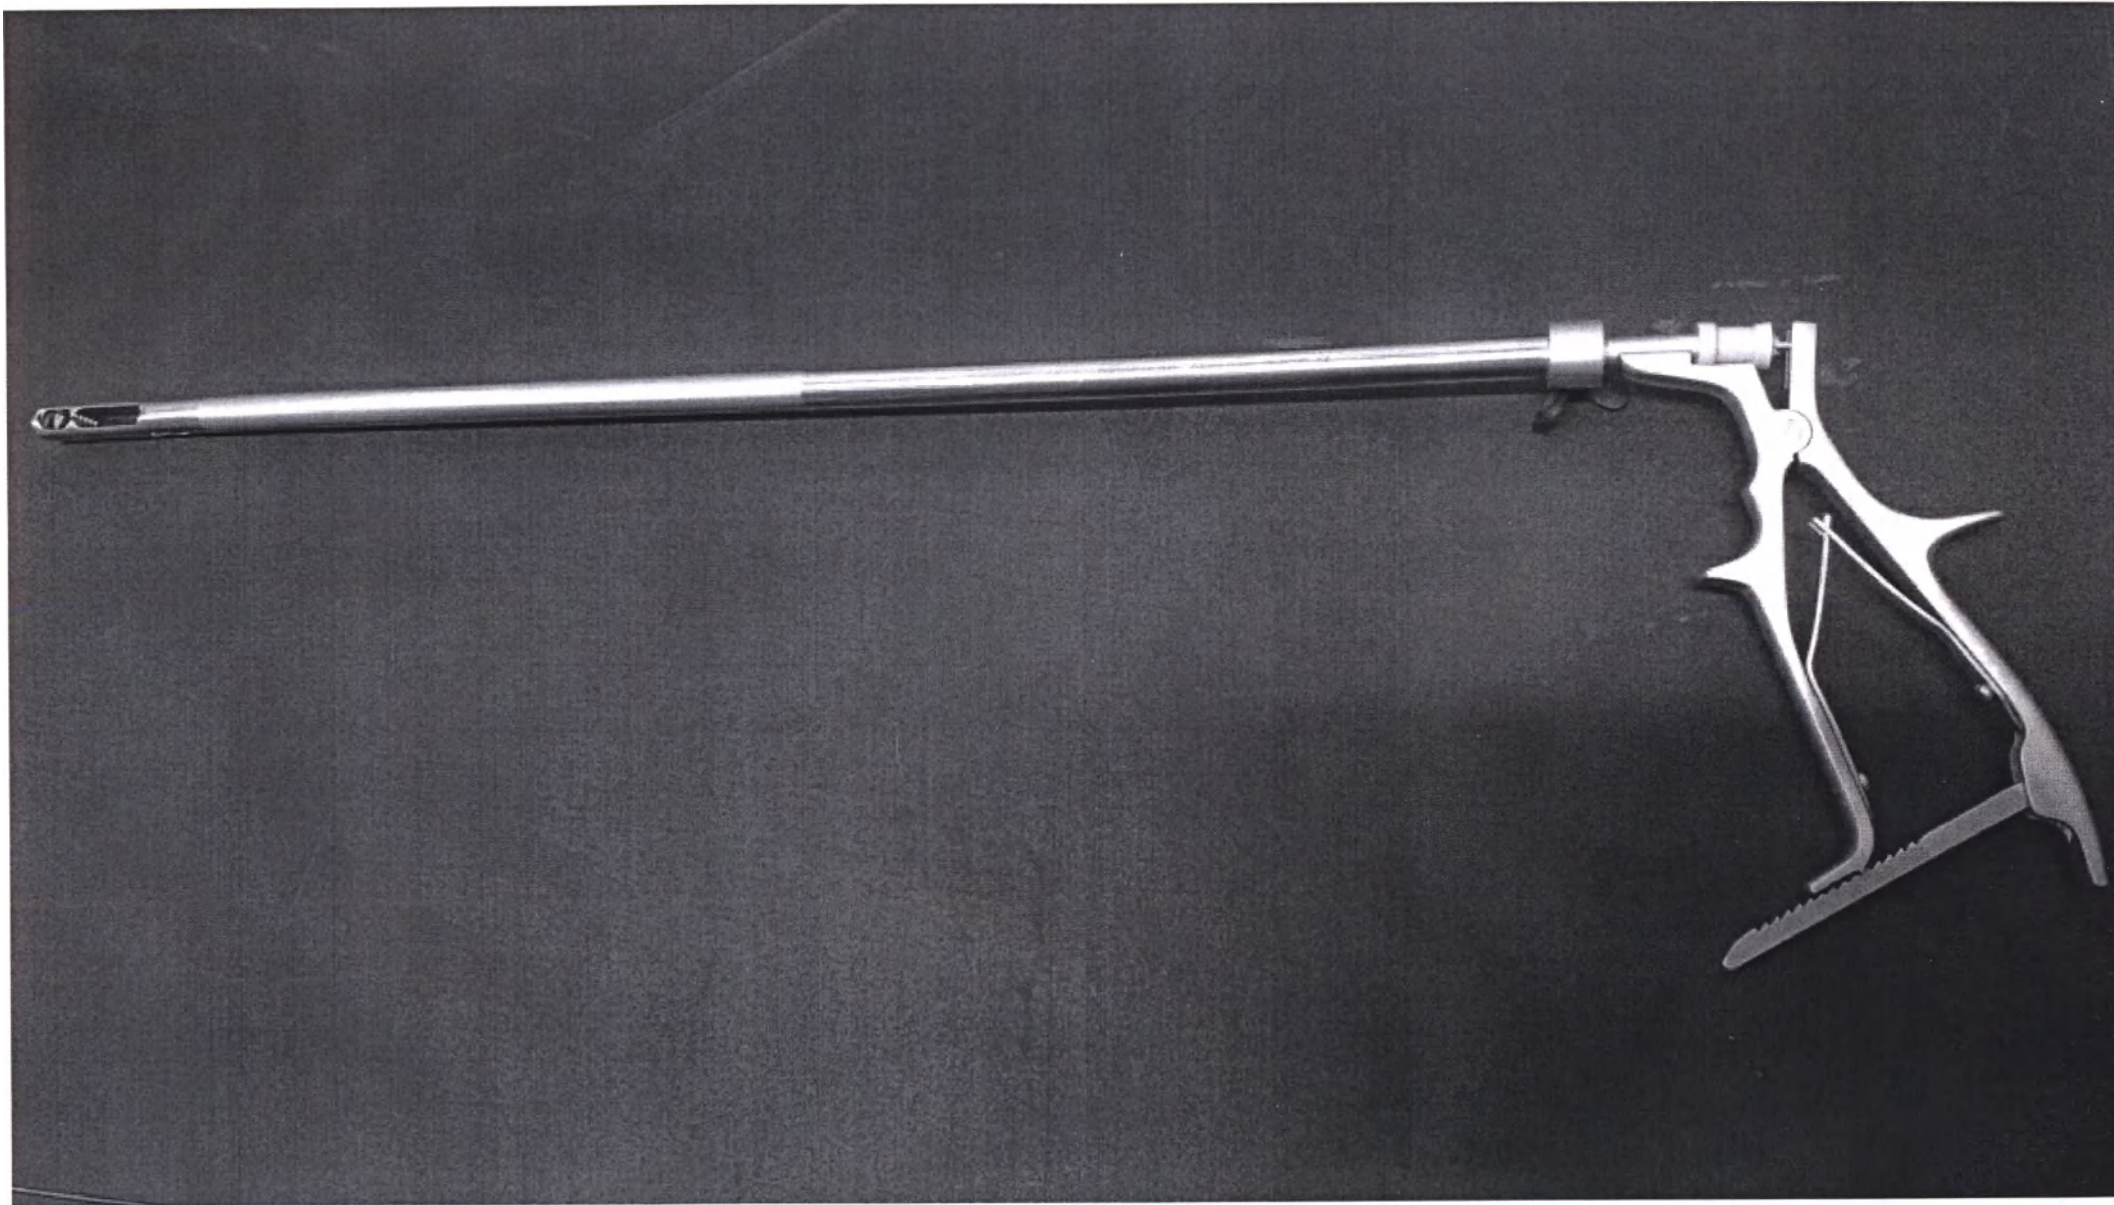


Рис. 13. 5195 Щипцы когтевидные, Ø 10 мм.

