




РАЗМЕР ЗАКАЗА ПРОИЗВЕДЕН 10/2016 ПОД № 10-11-0000

СПЕЦДЕТАЛЬ

Рег № ФСР 2009/05052 от 18/09/2016 г.
Краснодарский кр. Мостовской р-н п. Псыбай
Время образования устойчивой формы 5-10 мин.
Плотности 385 - 660 г/м.кв.
с 1-20 °С и не дожидаясь его полного растворения,
необходимого количества воды и рупорника.

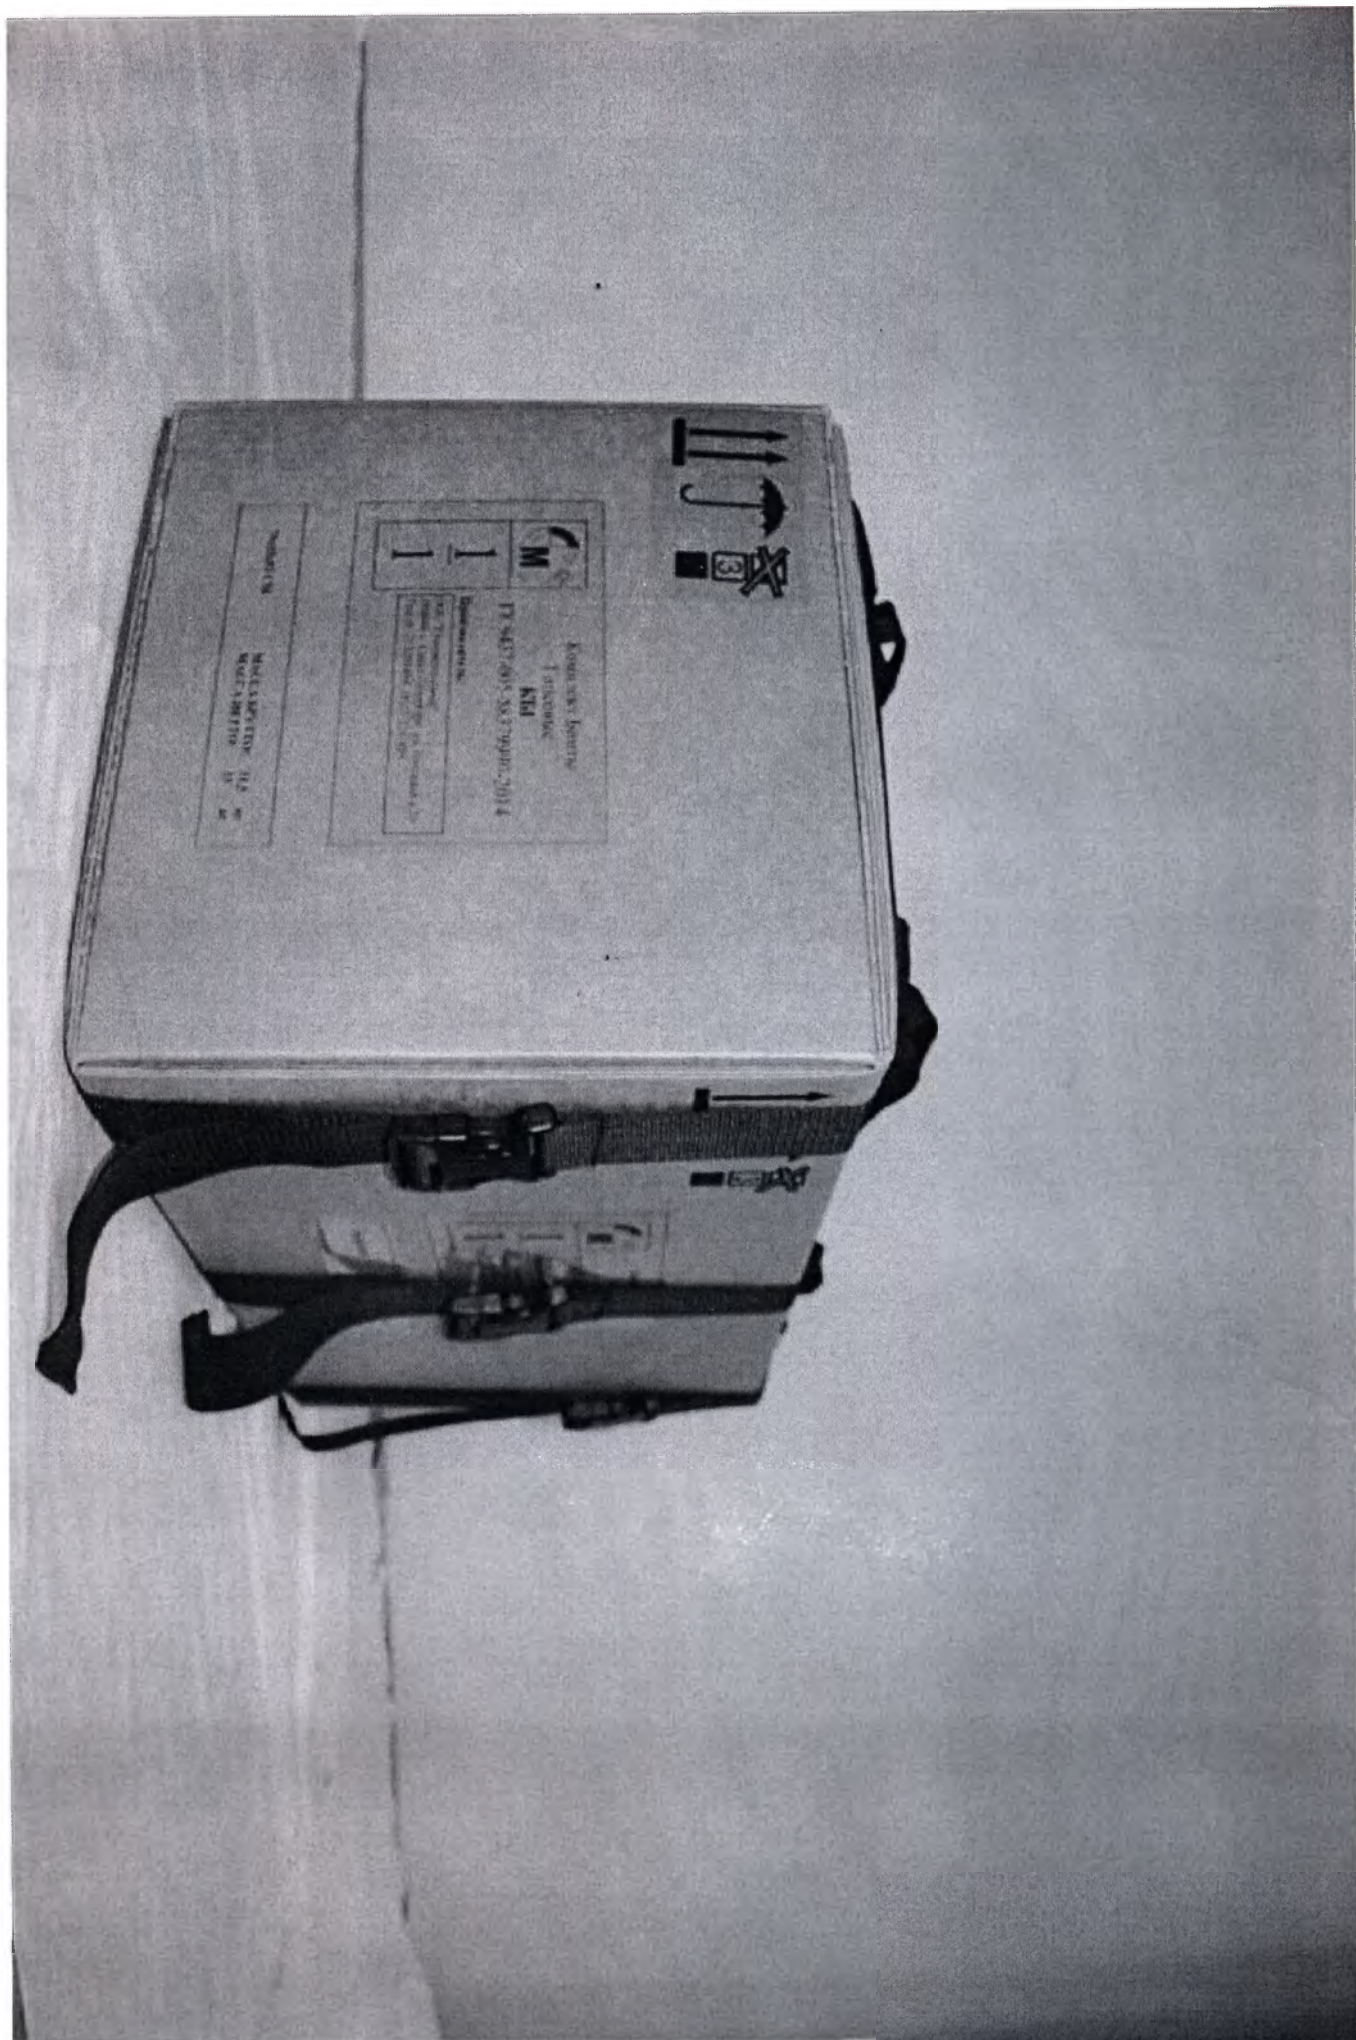

БИНТ МАРЛЕВЫЙ ГИПСОВЫЙ
ООО "Спецдеталь" Россия 350065
г. Краснодар ул. Марьянская, д.22,
комнатные под/А.

СПЕЦДЕТАЛЬ


Рег № ФСР 2009/05052 от 18/09/2016 г.
Краснодарский кр. Мостовской р-н п. Псыбай, ул. 60 лет Октября д. 11
Время образования устойчивой формы 5-10 мин. Диапазон поверхностной
плотности 385 - 660 г/м.кв. Погрузить рупорник на 2-3 секунды в воду
с 1-20 °С и не дожидаясь его полного растворения, извлечь, отжать до
необходимого количества воды и рупорника.



Бинт гипсовый неосыпающийся, размер 3 м × 15 см



ИПН "ОГОНЕК"
127273, Москва, Огневский пр-ект, д.3 "Б"
Тел. (499) 202-02-40, (499)204-06-89, (499)203-48-82
e-mail: info@ogonek.org, ogon@yandex.ru
www.ogonek.org



МЕДИЦИНСКИЕ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ

КОСЫНКА 155 x 80 см
(треугольные)

РУ №ФСР 2010/09737

Количество — 5 шт.

Дата изготовления — 2014 г.

Срок годности не ограничен

Не подлежит обязательной сертификации

Косынка медицинская перевязочная 155×80 см (треугольная)

АО «Армавирский завод
резинных изделий»

ТУ 2514-066-00149498-98

Перчатки латексные анатомические "АЗРИ"

Изготовлены из натурального
латекса
Удобное облегающее руки,
эффективная защита от заражения

AQL 1.5


Качество продукции обеспечено
сертифицированной системой менеджмента
качества соответствующей требованиям
ГОСТ ISO 9001:2011

Предназначены для использования
медицинского персонала при проведении
хирургических операций

Срок службы
не менее 10 лет




Перчатки анатомические не менее №8

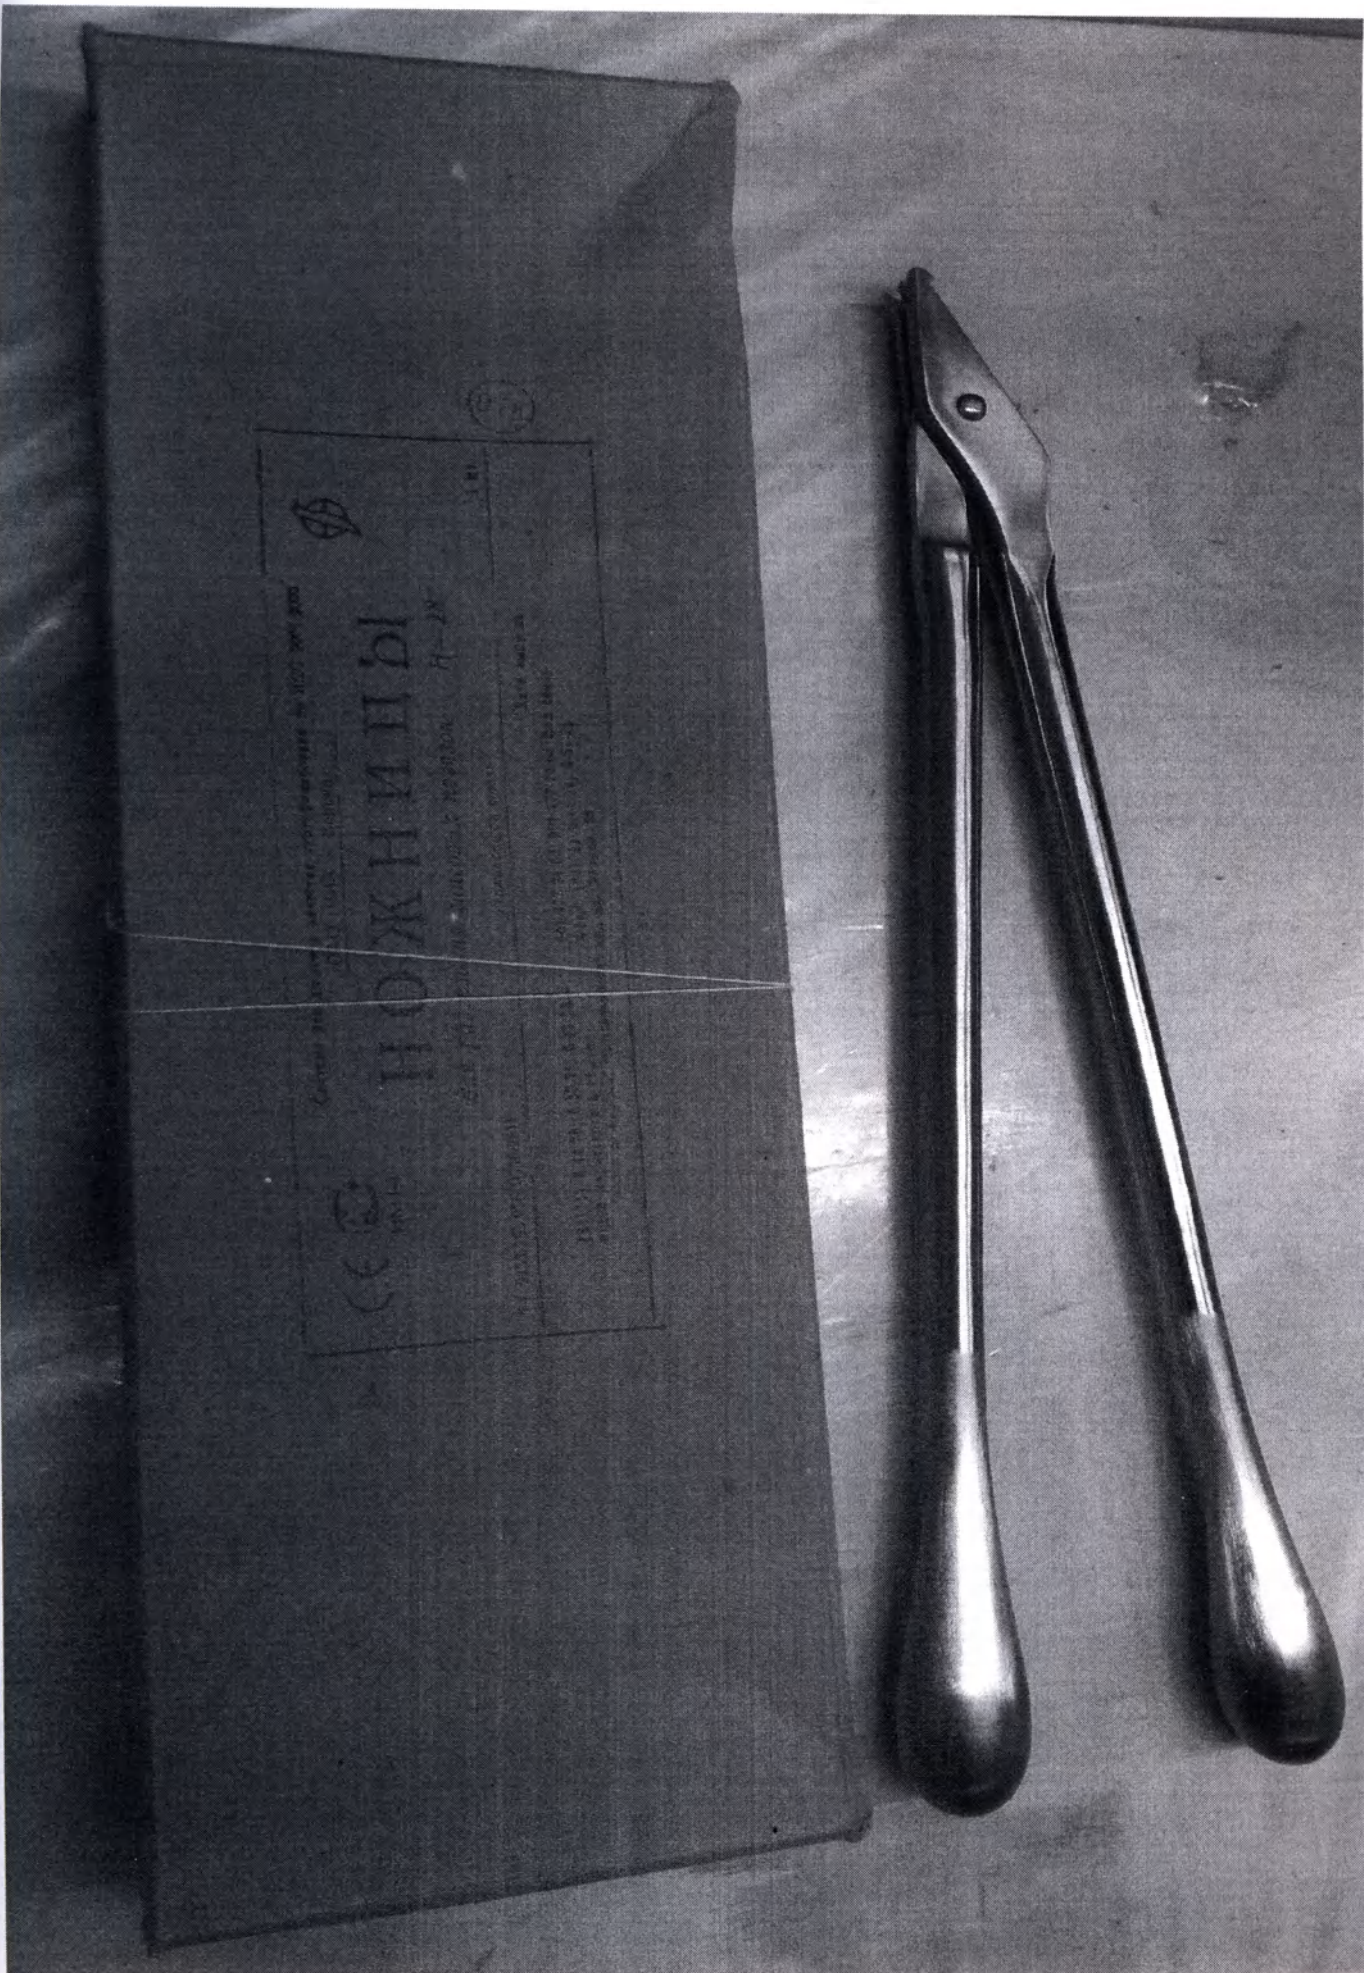


Ножницы для разрезания гипсовых повязок



Пленка полиэтиленовая

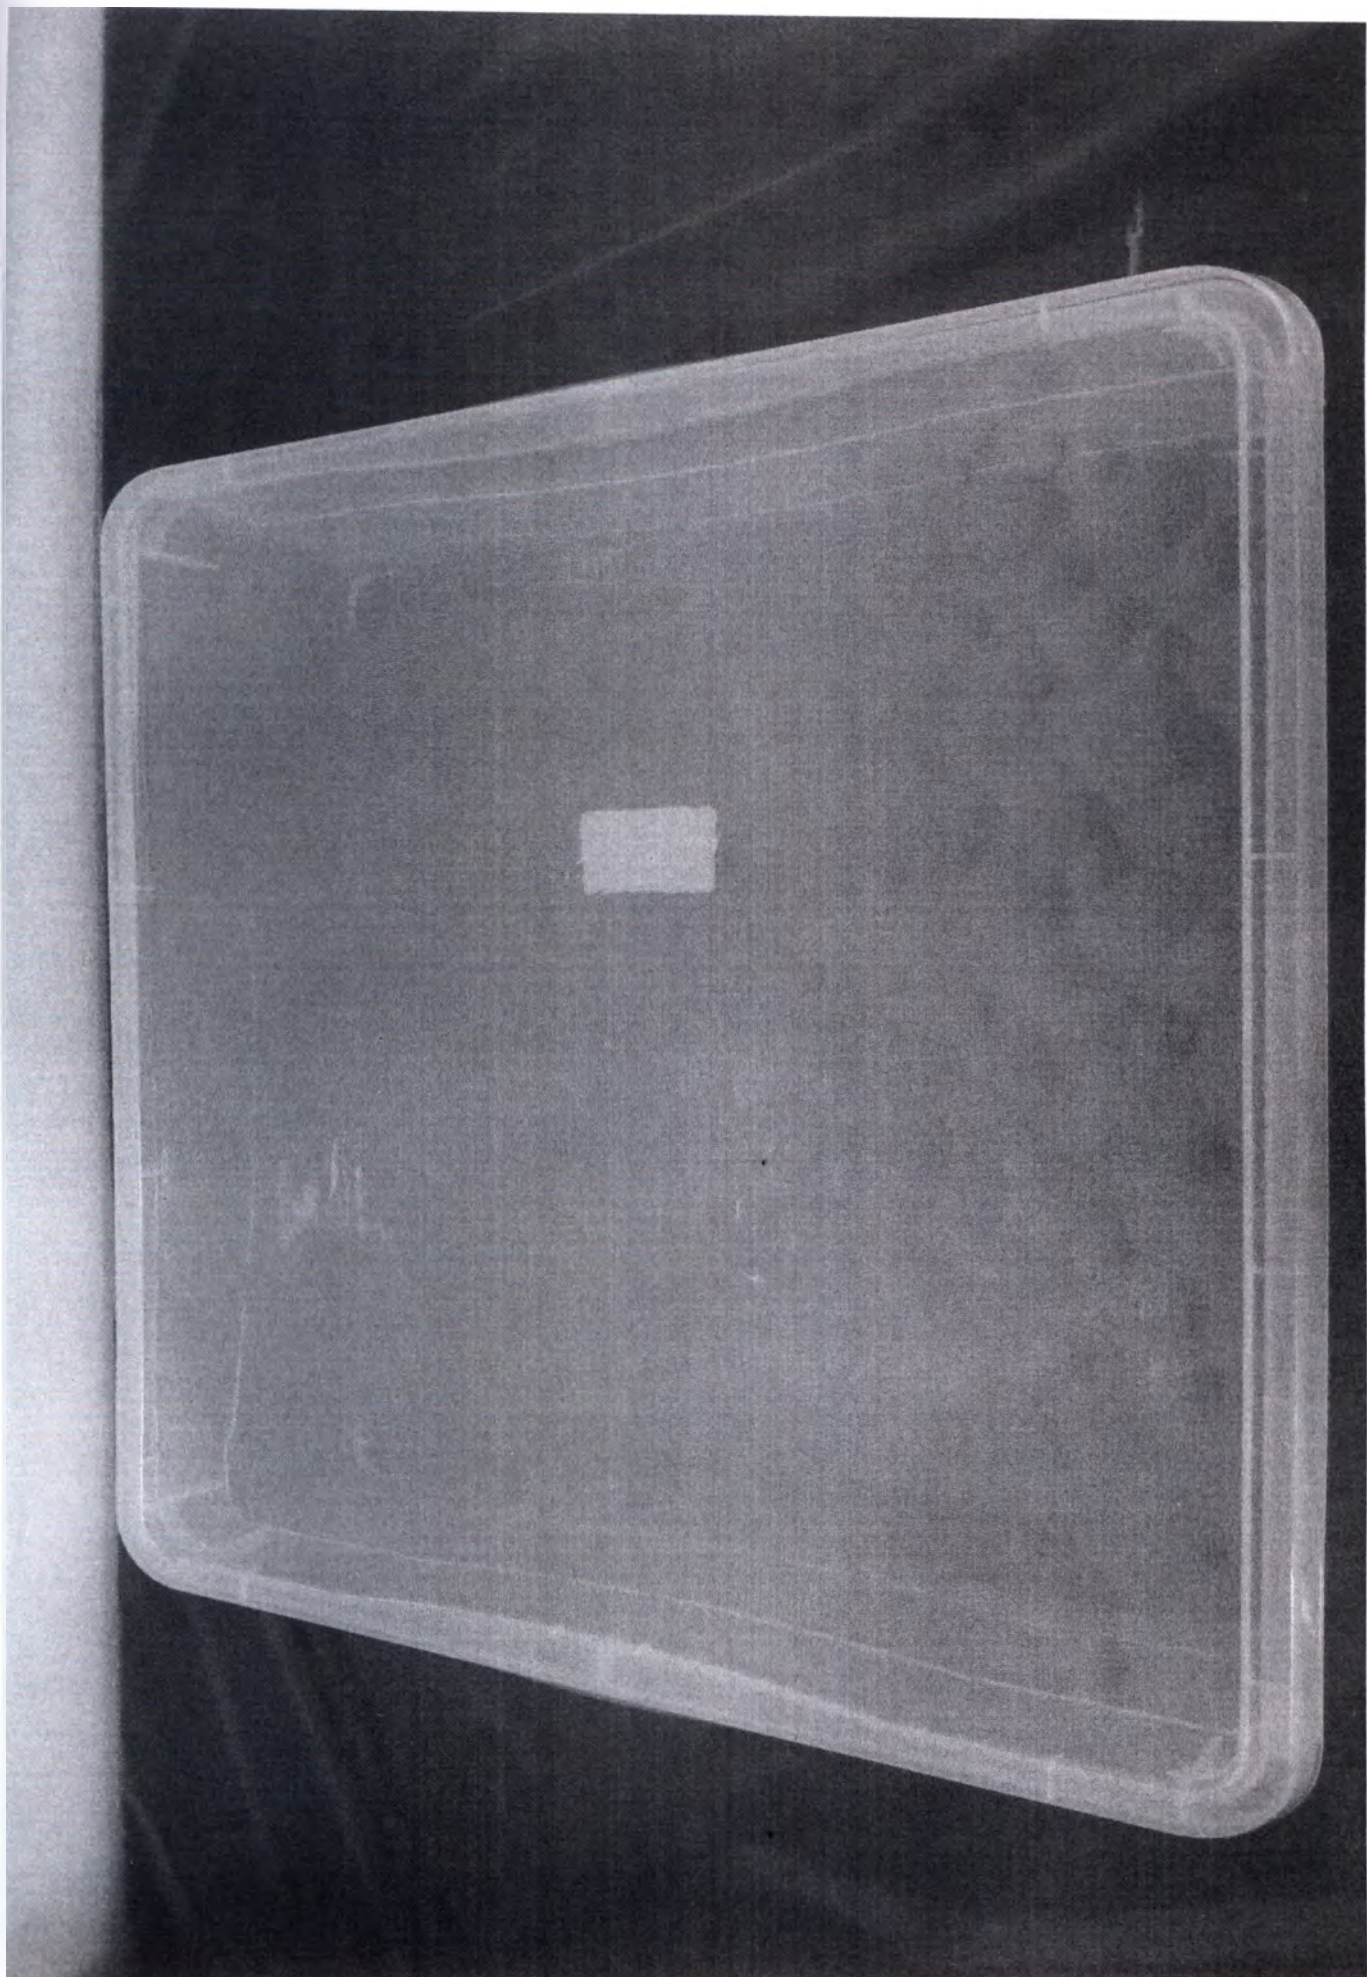


Емкость для замачивания (хранения) гипсовых бинтов

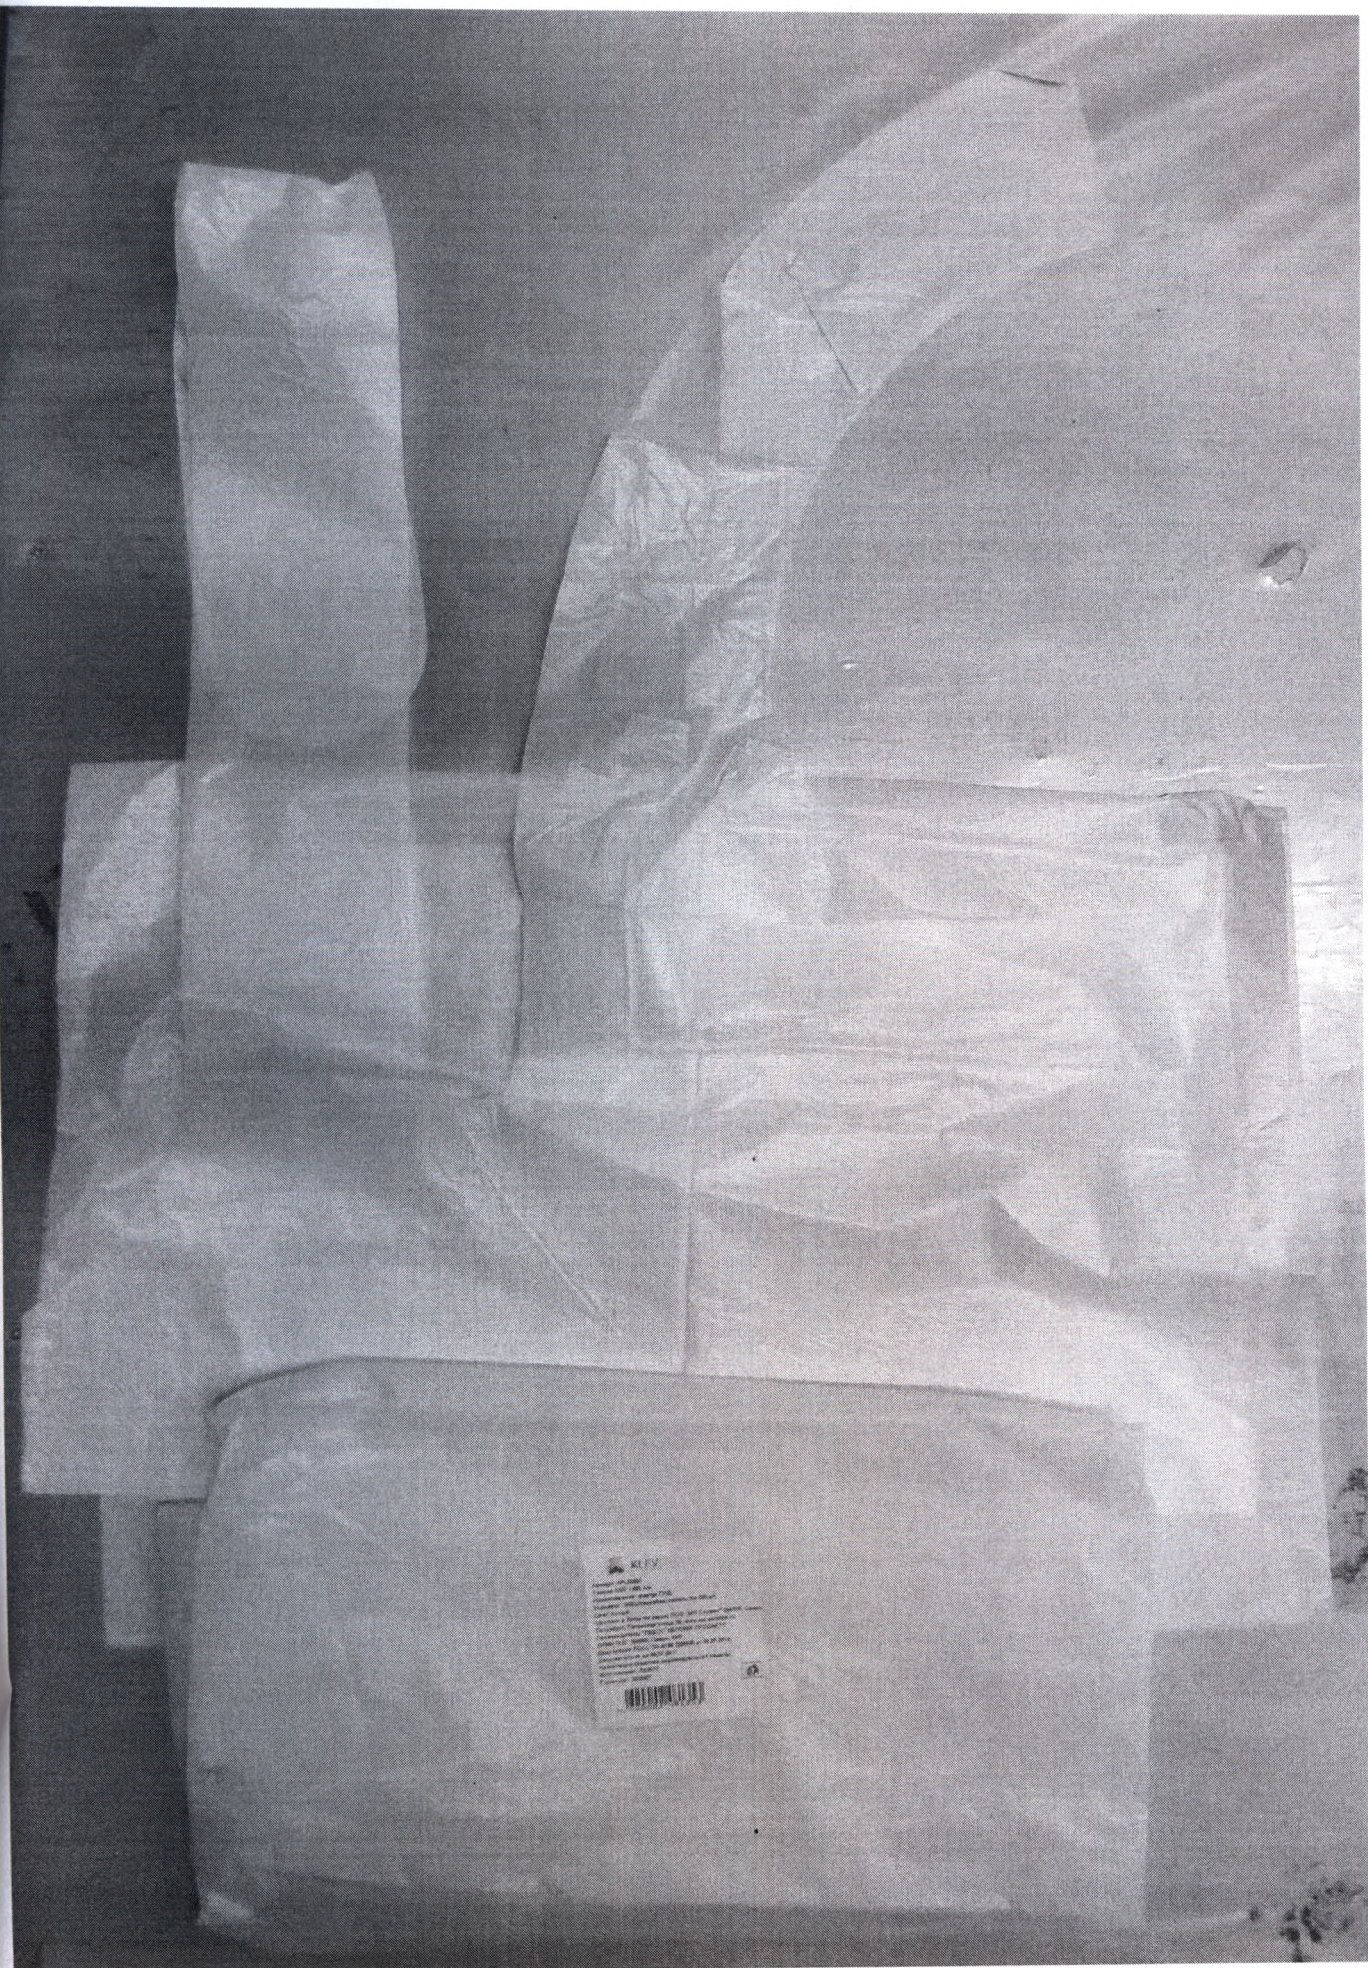

Фартук из полимерных материалов

Руководитель организации



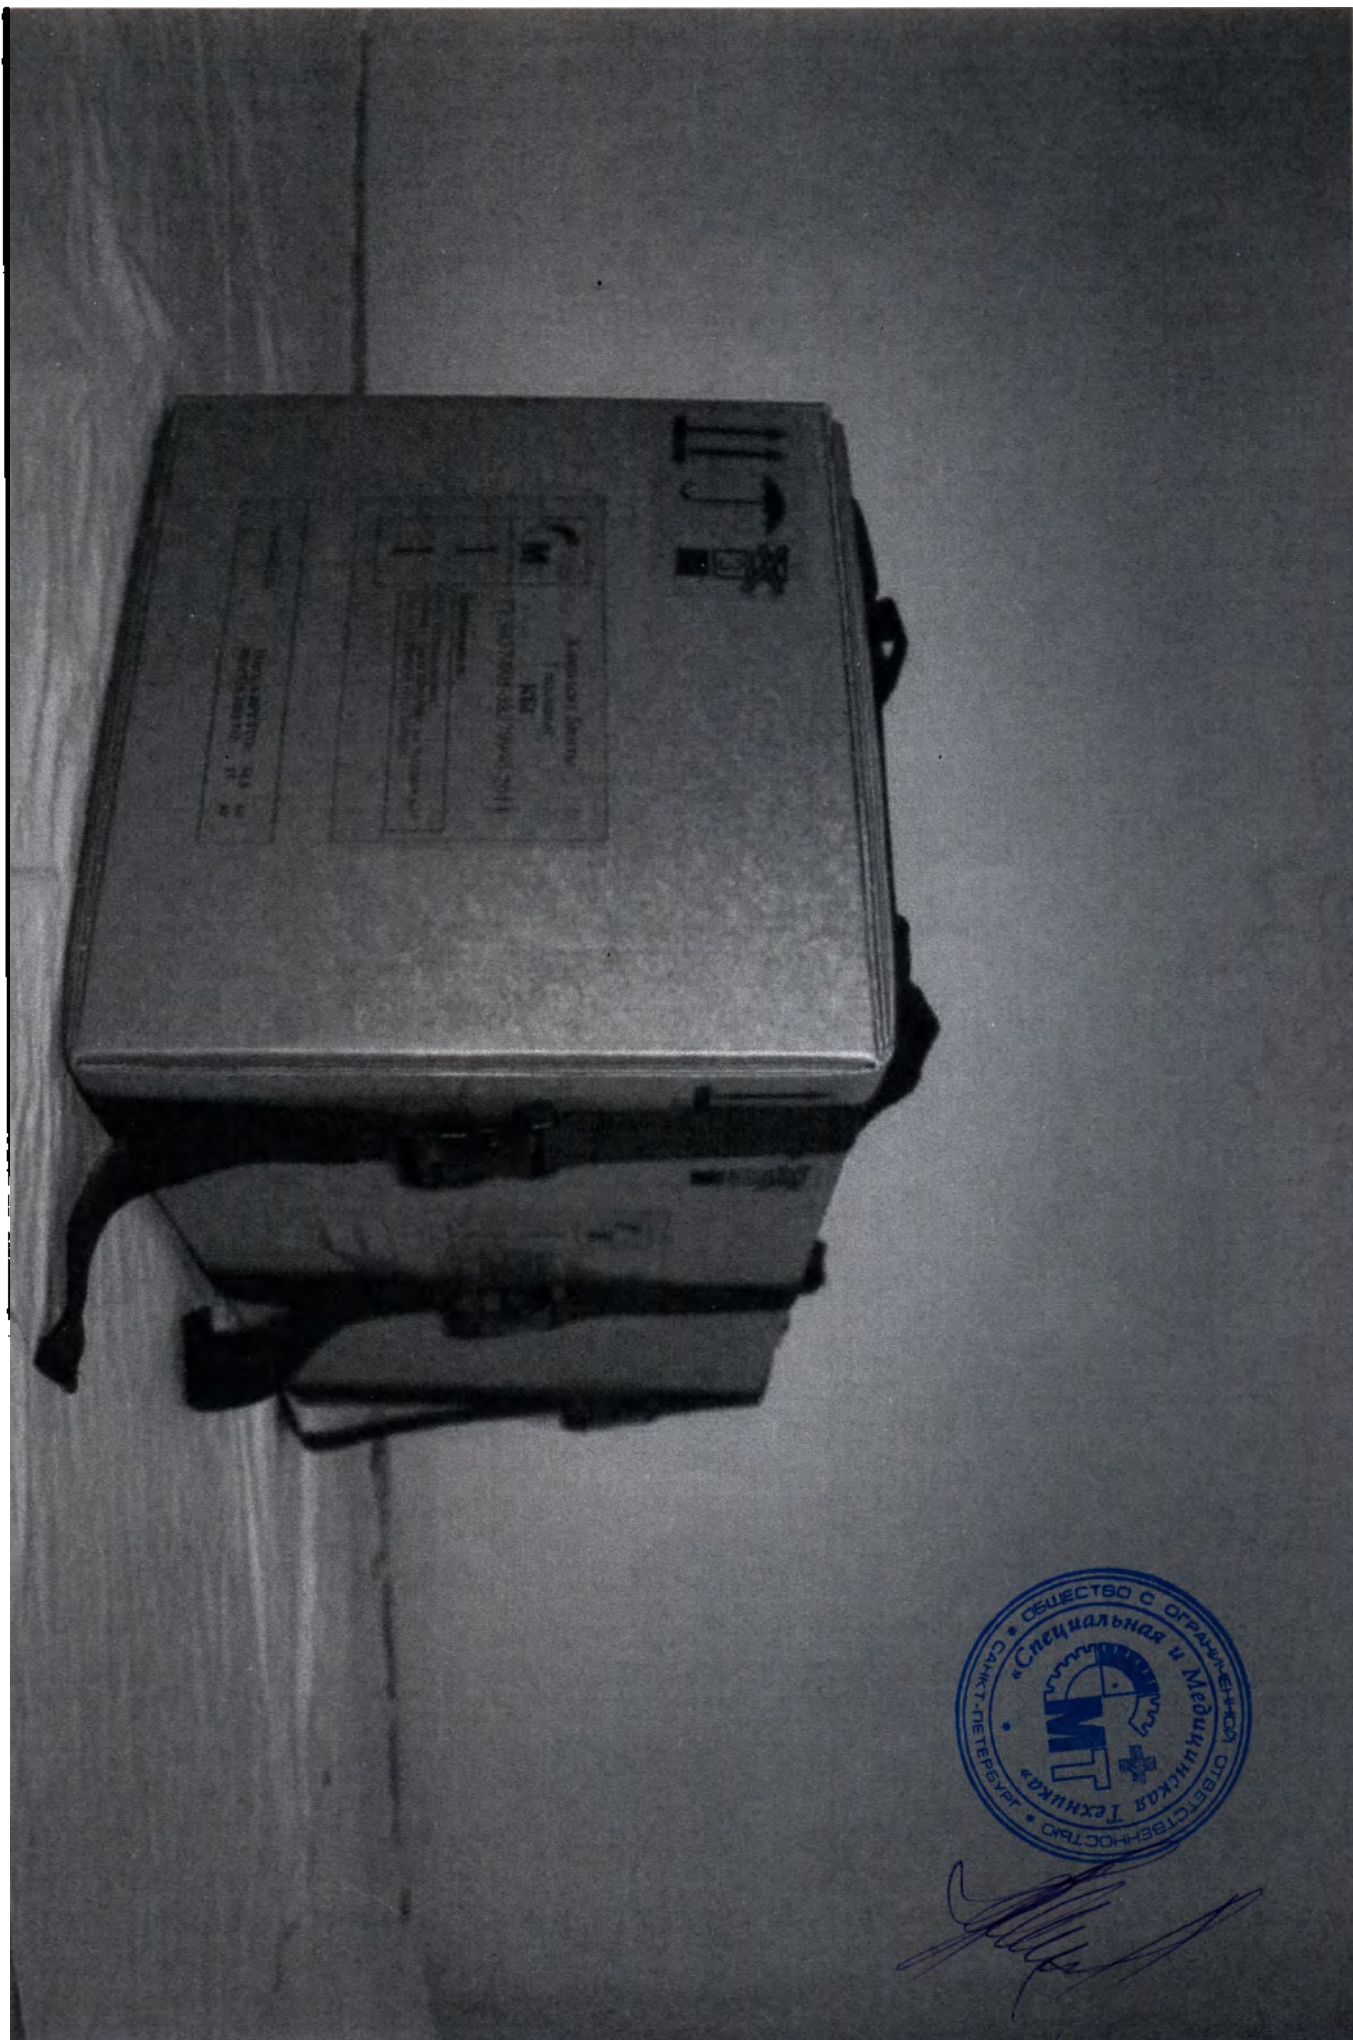

[Handwritten signature]

РАЗМЕР 3мх15см ПРОИЗВЕДЕН 10/2016 ГОДА

СПЕЦИФИКАЦИЯ



БИНТ МАЛПЕВЫЙ ГИПСОВЫЙ
ООО "Специализация" Россия 350055
г. Краснодар ул. Марьянская, д.22
пояснение под/А


СПЕЦИФИКАЦИЯ




Рег. № ФСР 2009/05052 от 08.09.2016 г. № 10
Краснодарский кр. Мостовской р-н г. Побай
Время образования устойчивой формы 5-10
плотности 385 - 660 г/м.кв. Потрошить рулон
с 1-20 °С и не дожидаясь его полного растворения
необходимого количества воды для растворения

Рег. № ФСР 2009/05052 от 18/09/2016 г. Место производства: 352586,
Краснодарский кр. Мостовской р-н п. Побай, ул. 60 лет Октября д. 11
Время образования устойчивой формы 5-10 мин. Диапазон поверхностной
плотности 385 - 660 г/м.кв. Потрошить рулонные на 2-3 секунды в воду
с 1-20 °С и не дожидаясь его полного растворения, извлечь, отжать до
необходимого количества воды и использовать

Бинт гипсовый неосыпающийся, размер 3 м × 15 см

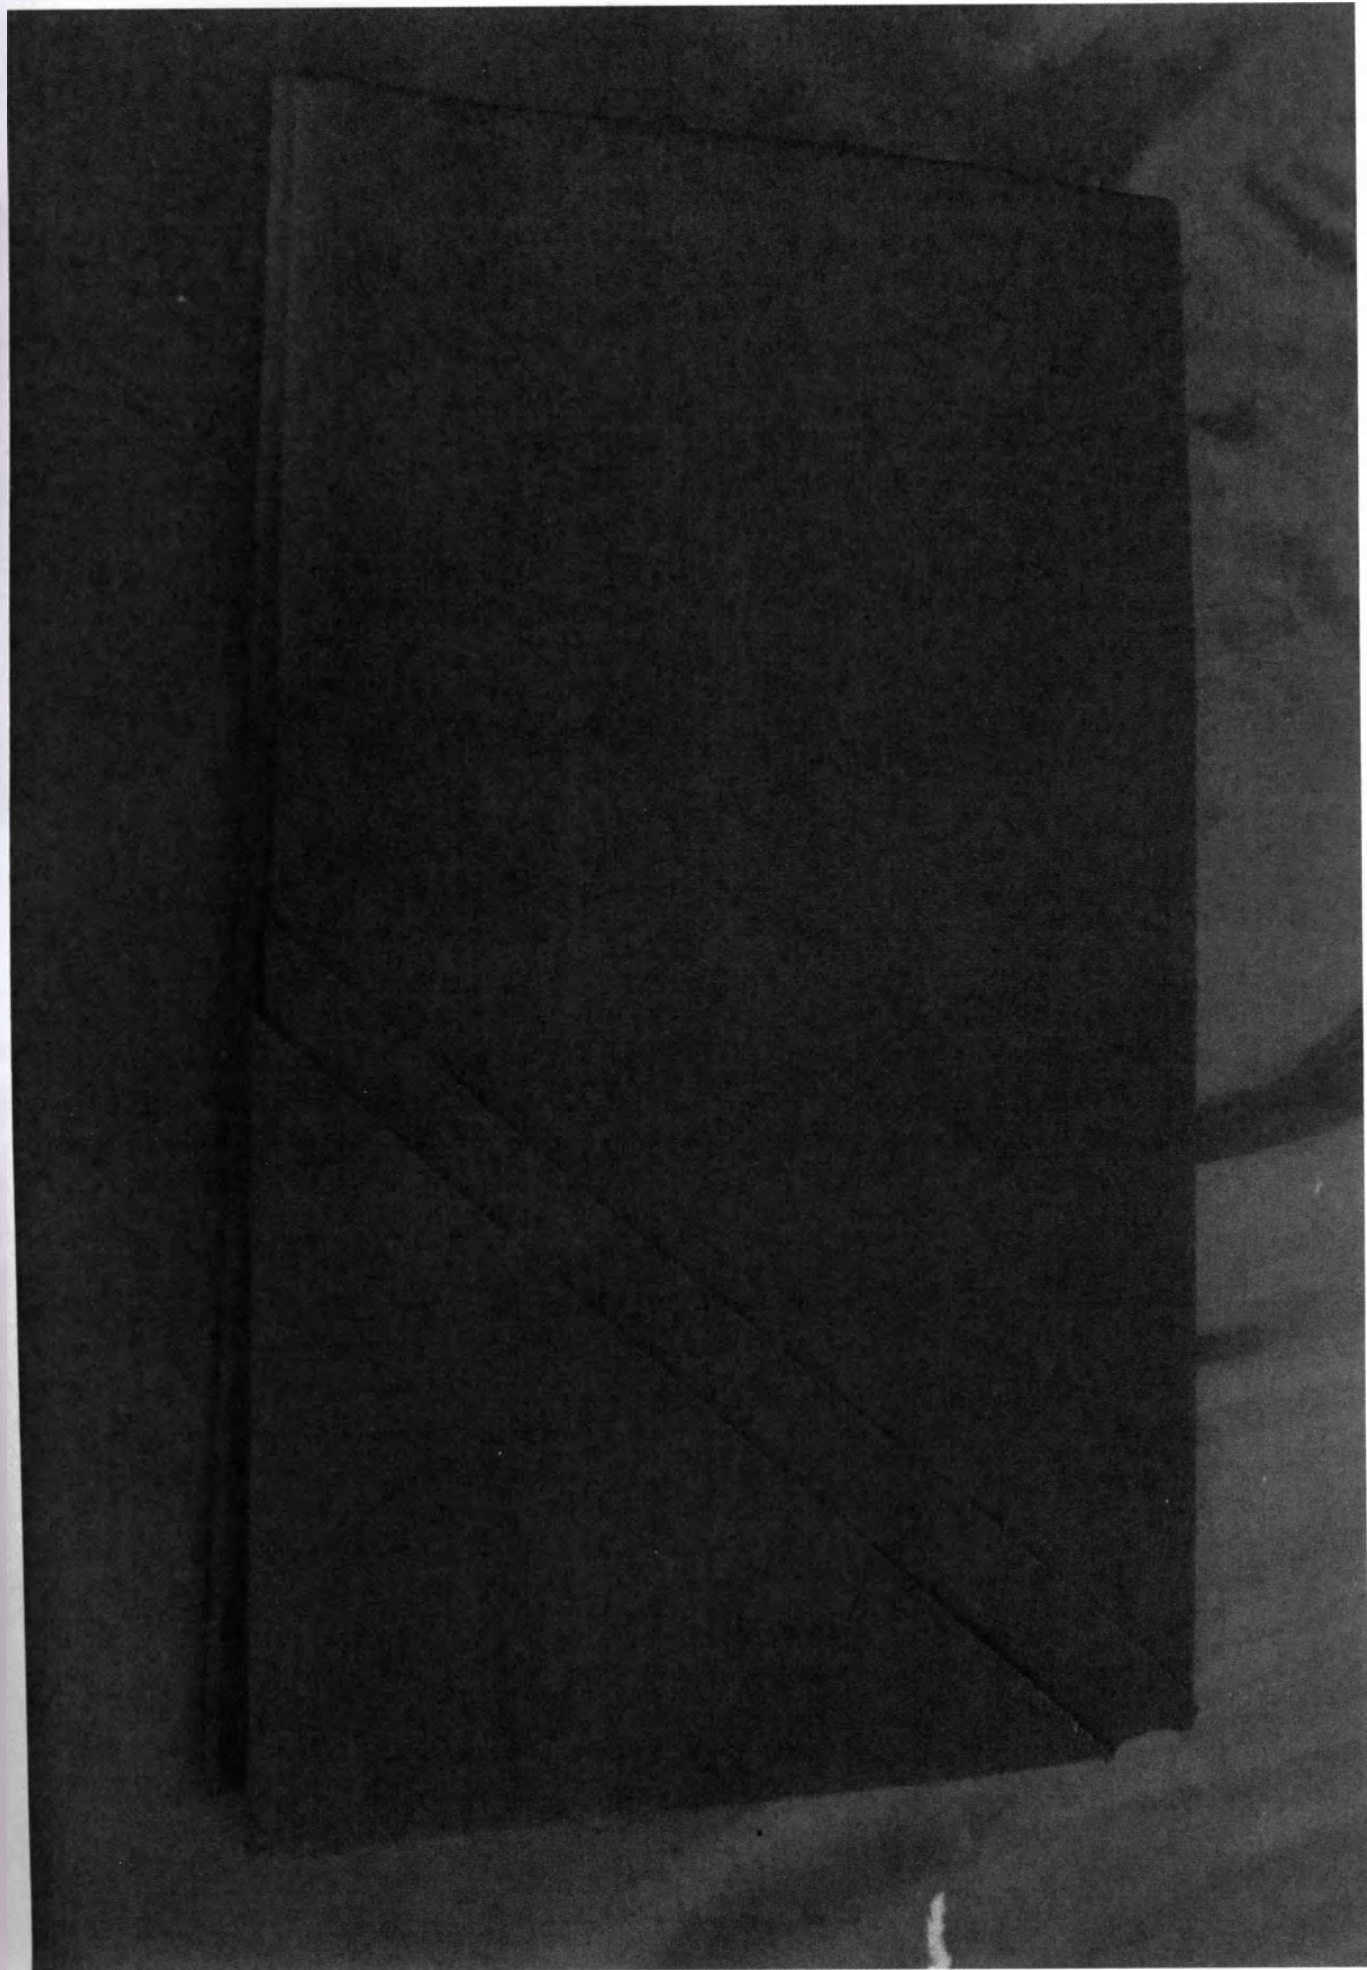


Косынка медицинская перевязочная 155×80 см (треугольная)

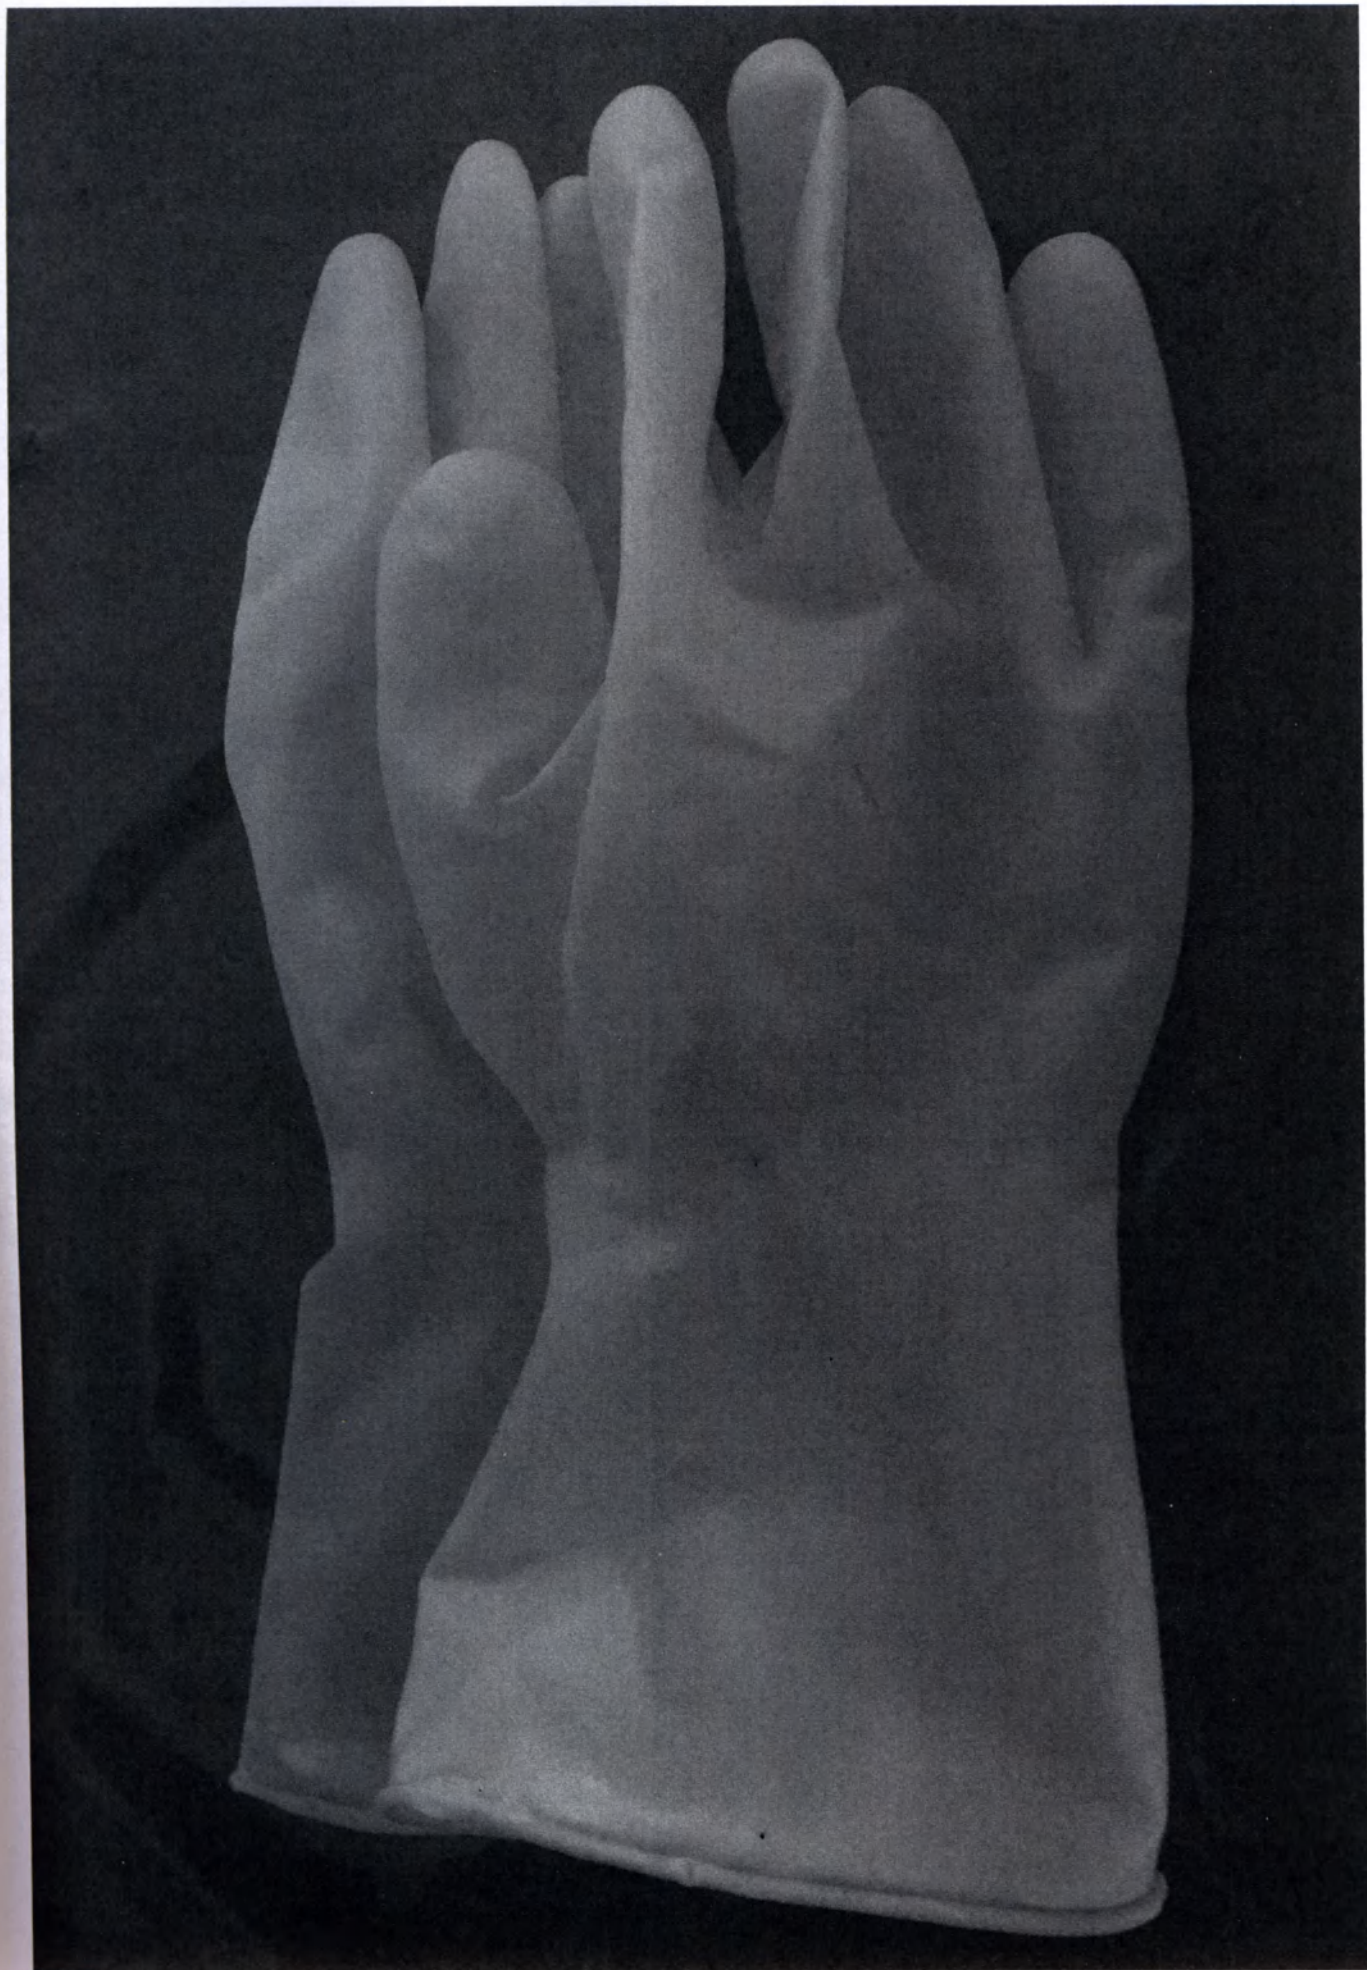


Перчатки анатомические не менее №8



Ножницы для разрезания гипсовых повязок

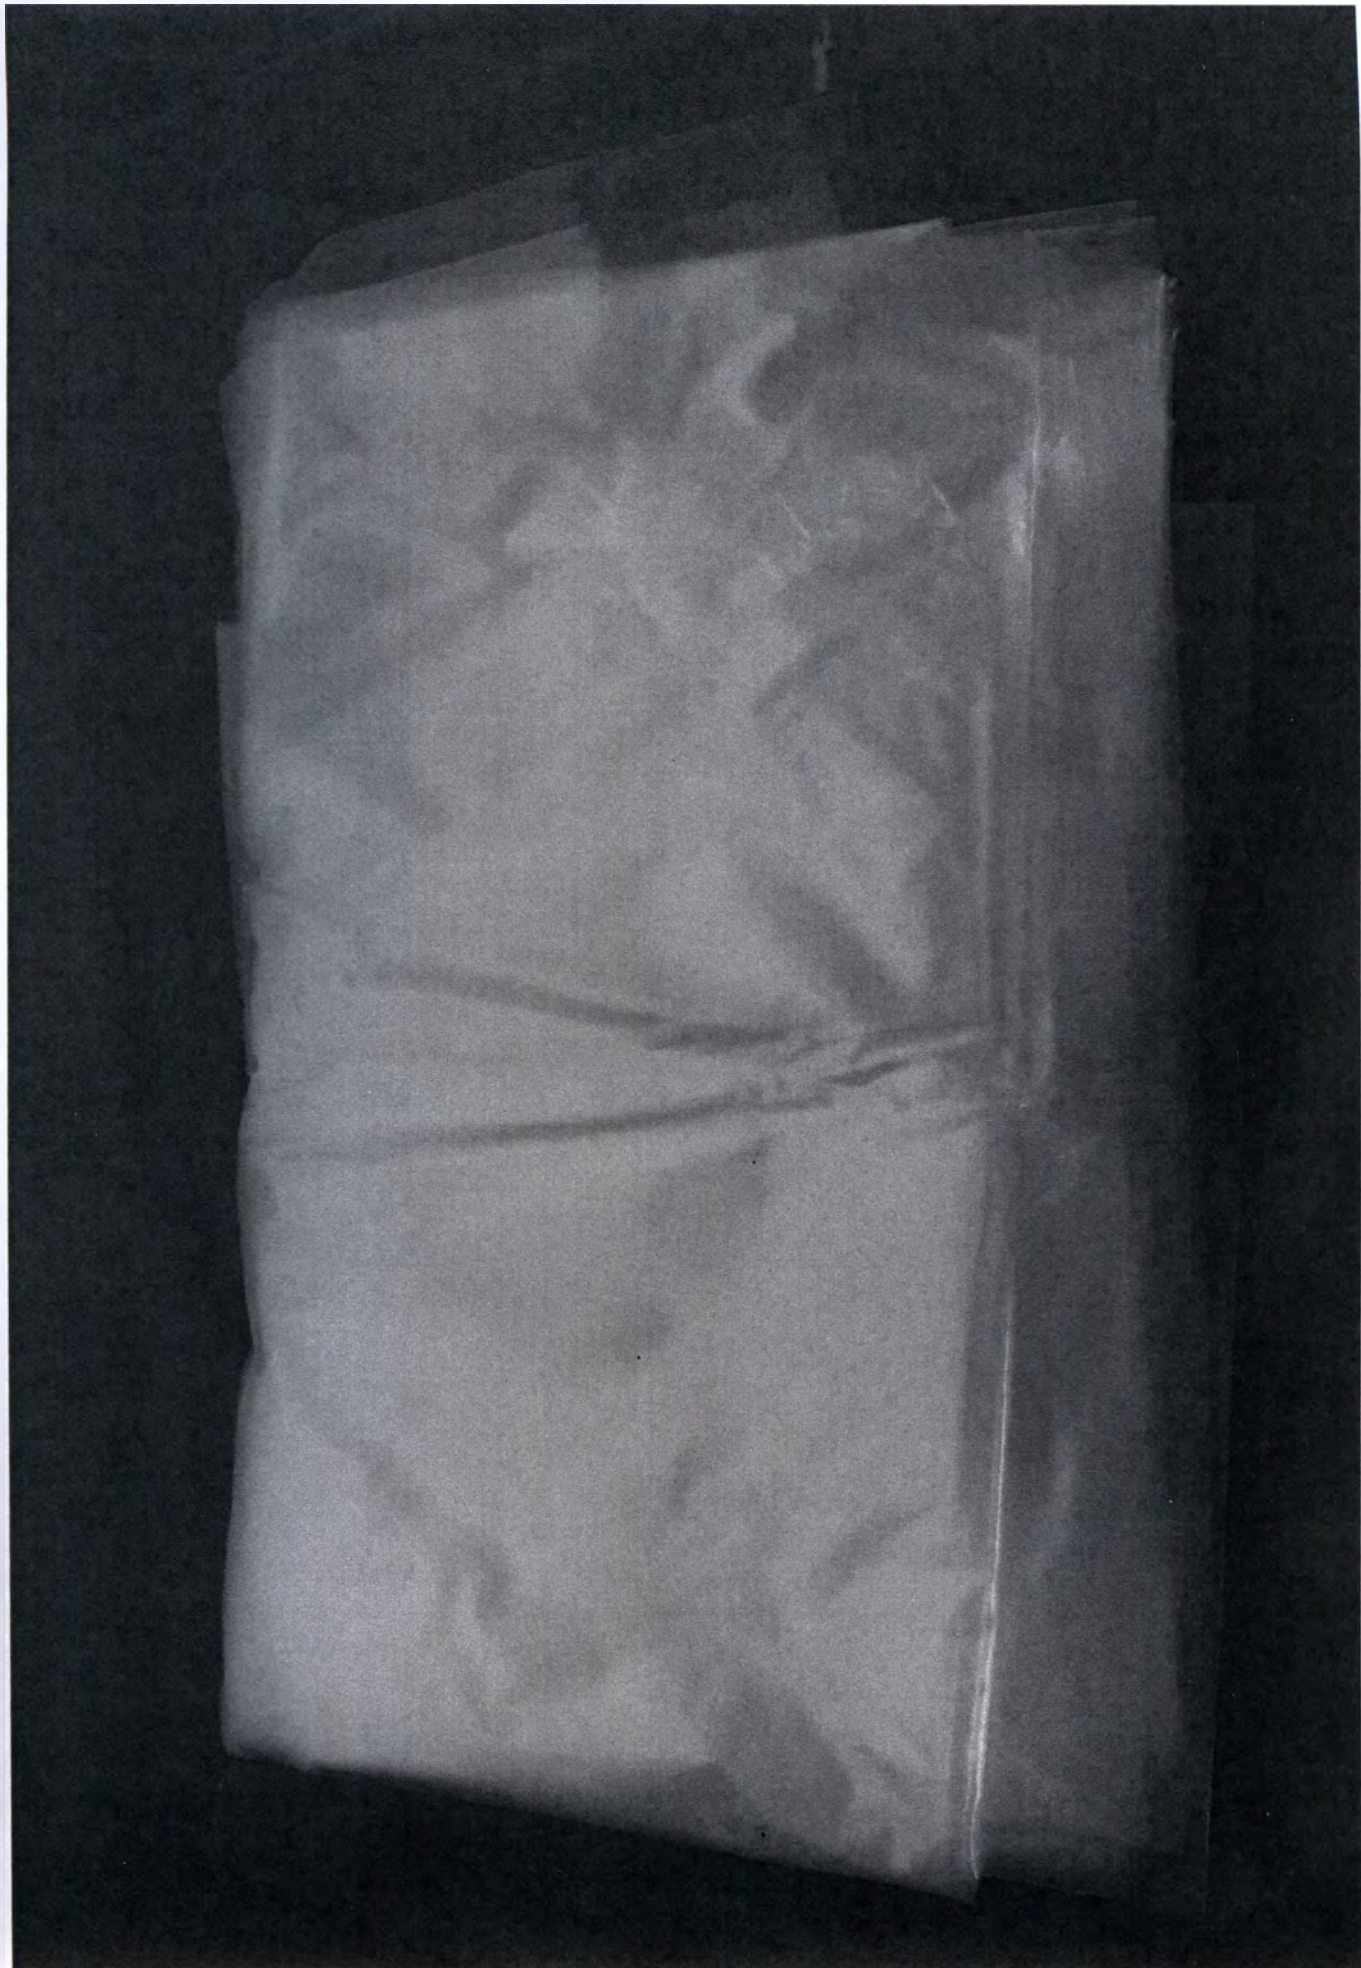

Пленка полиэтиленовая

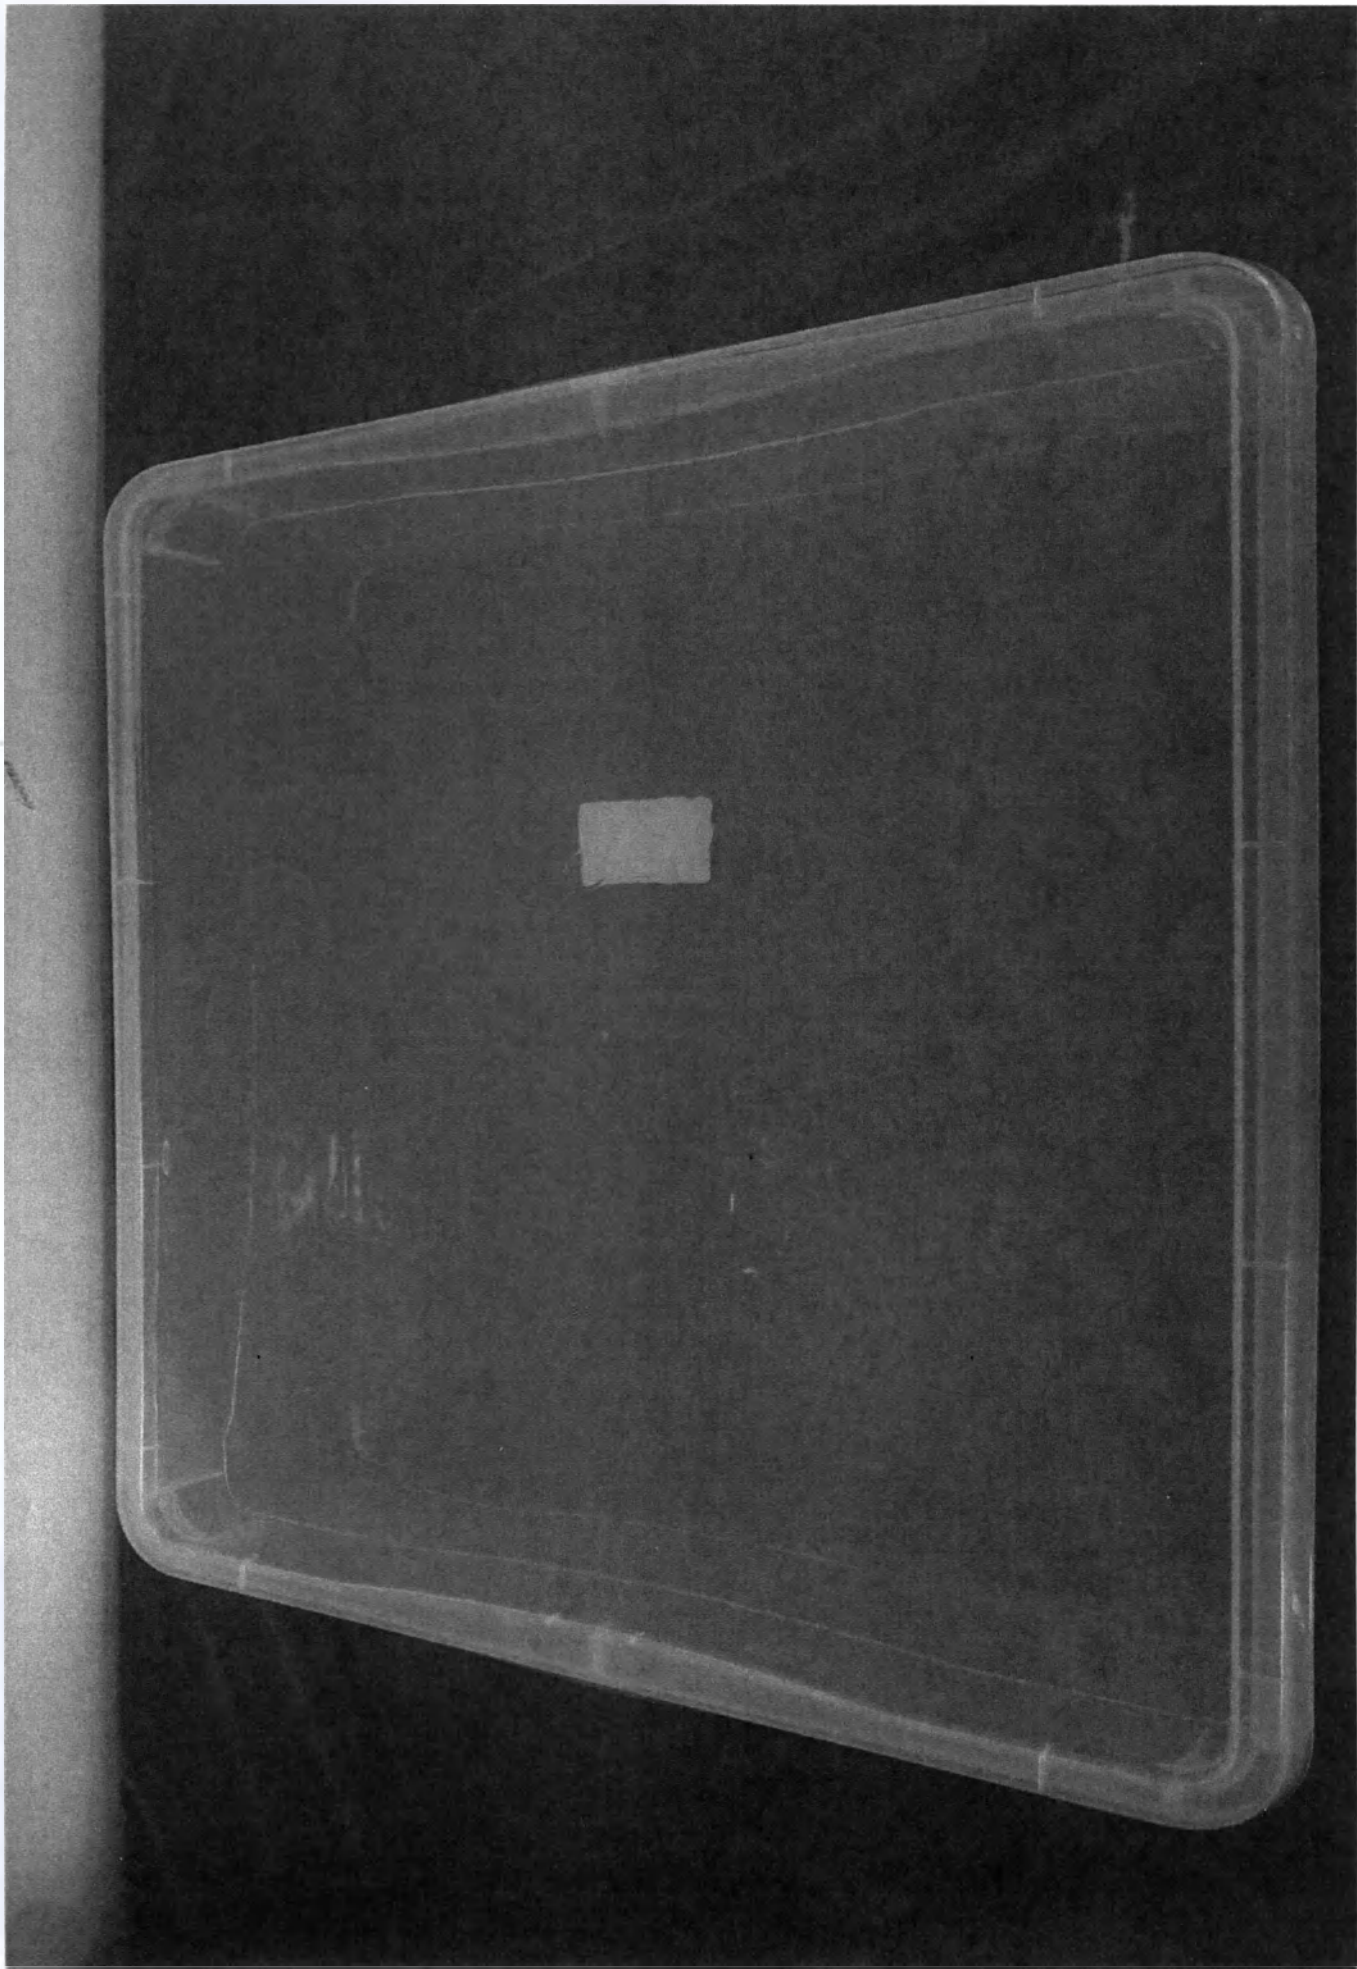

Емкость для замачивания (хранения) гипсовых бинтов



Фартук из полимерных материалов

7 (с. 16) листов(а)

Директор ООО «Спецмедтехника»

Миляев А.В.

