


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

медицинского изделия

**Видеопроцессор медицинский эндоскопический "PENTAX
(ПЕНТАКС)", "PENTAX Medical (ПЕНТАКС МЕДИКАЛ)" ЕРК-i7000,
ЕРК-i7010 с принадлежностями**


Видеопроцессор медицинский эндоскопический “ПЕНТАКС” ЕРК-і7010



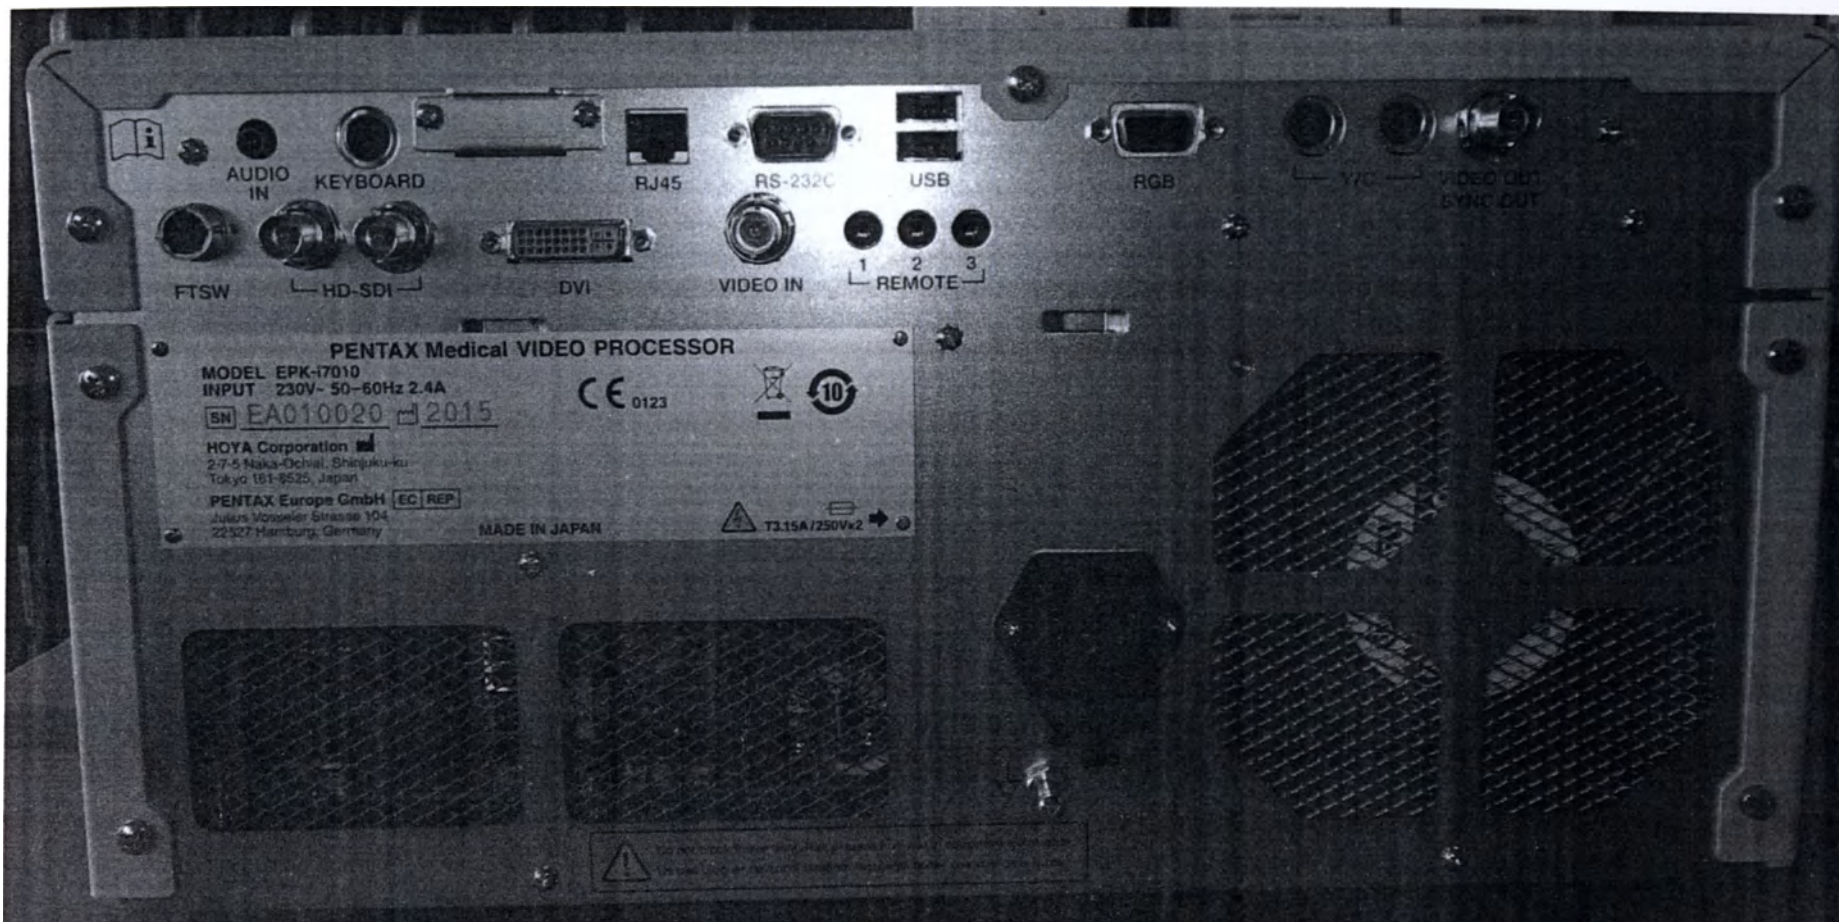

Видеопроцессор медицинский эндоскопический "ПЕНТАКС" ЕРК-і7000



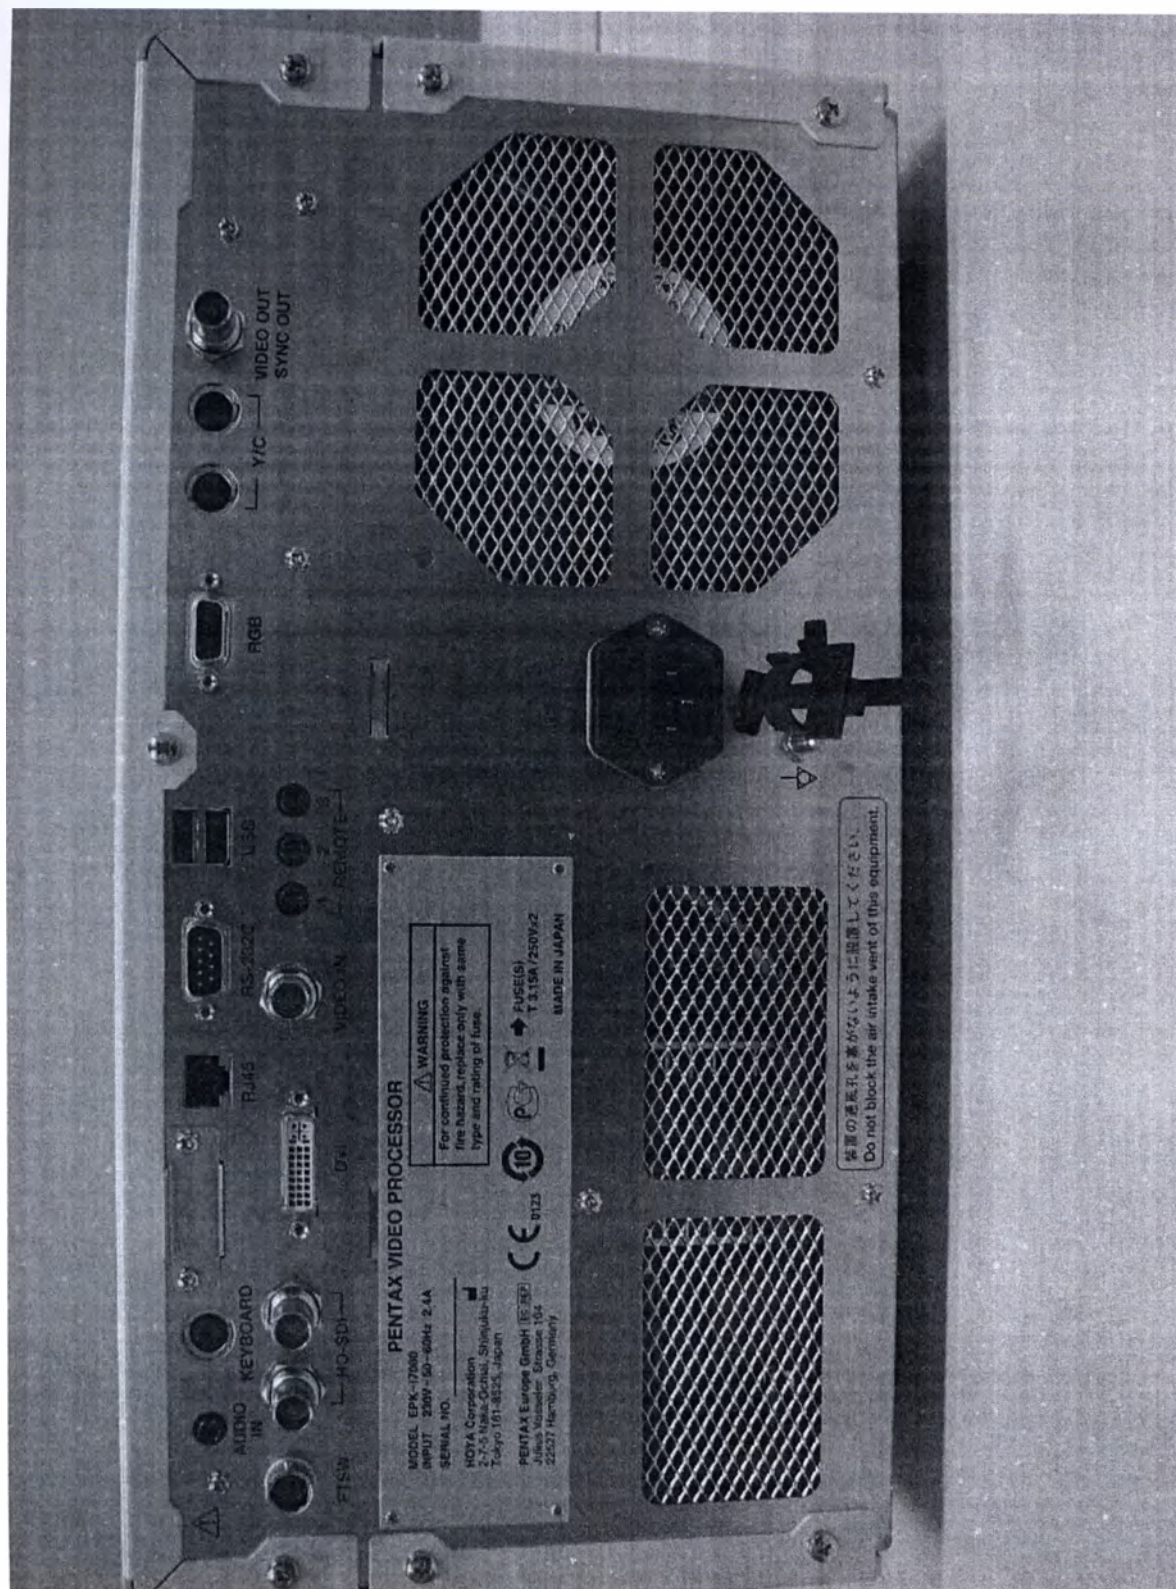

PENTAX VIDEO PROCESSOR

MODEL EPX-17000
INPUT 230V-50-60Hz 2.4A
SERIAL NO.

NOTA Corporation
2-2-5, Minami-Ogino, Shinjuku-ku
Tokyo 161-8525, Japan

PENTAX Europe GmbH (E.E.P.)
Jules-Maximilien-Strasse 104
22527 Hamburg, Germany


WARNING
For continued protection against
fire hazard, replace only with same
type and rating of fuse.

FUSE(S)
T 3.15A / 250V-2


MADE IN JAPAN

後面の通風孔を塞がないように設置してください。
Do not block the air intake vent of this equipment.


Принадлежности.
1. Клавиатура типа OS-A

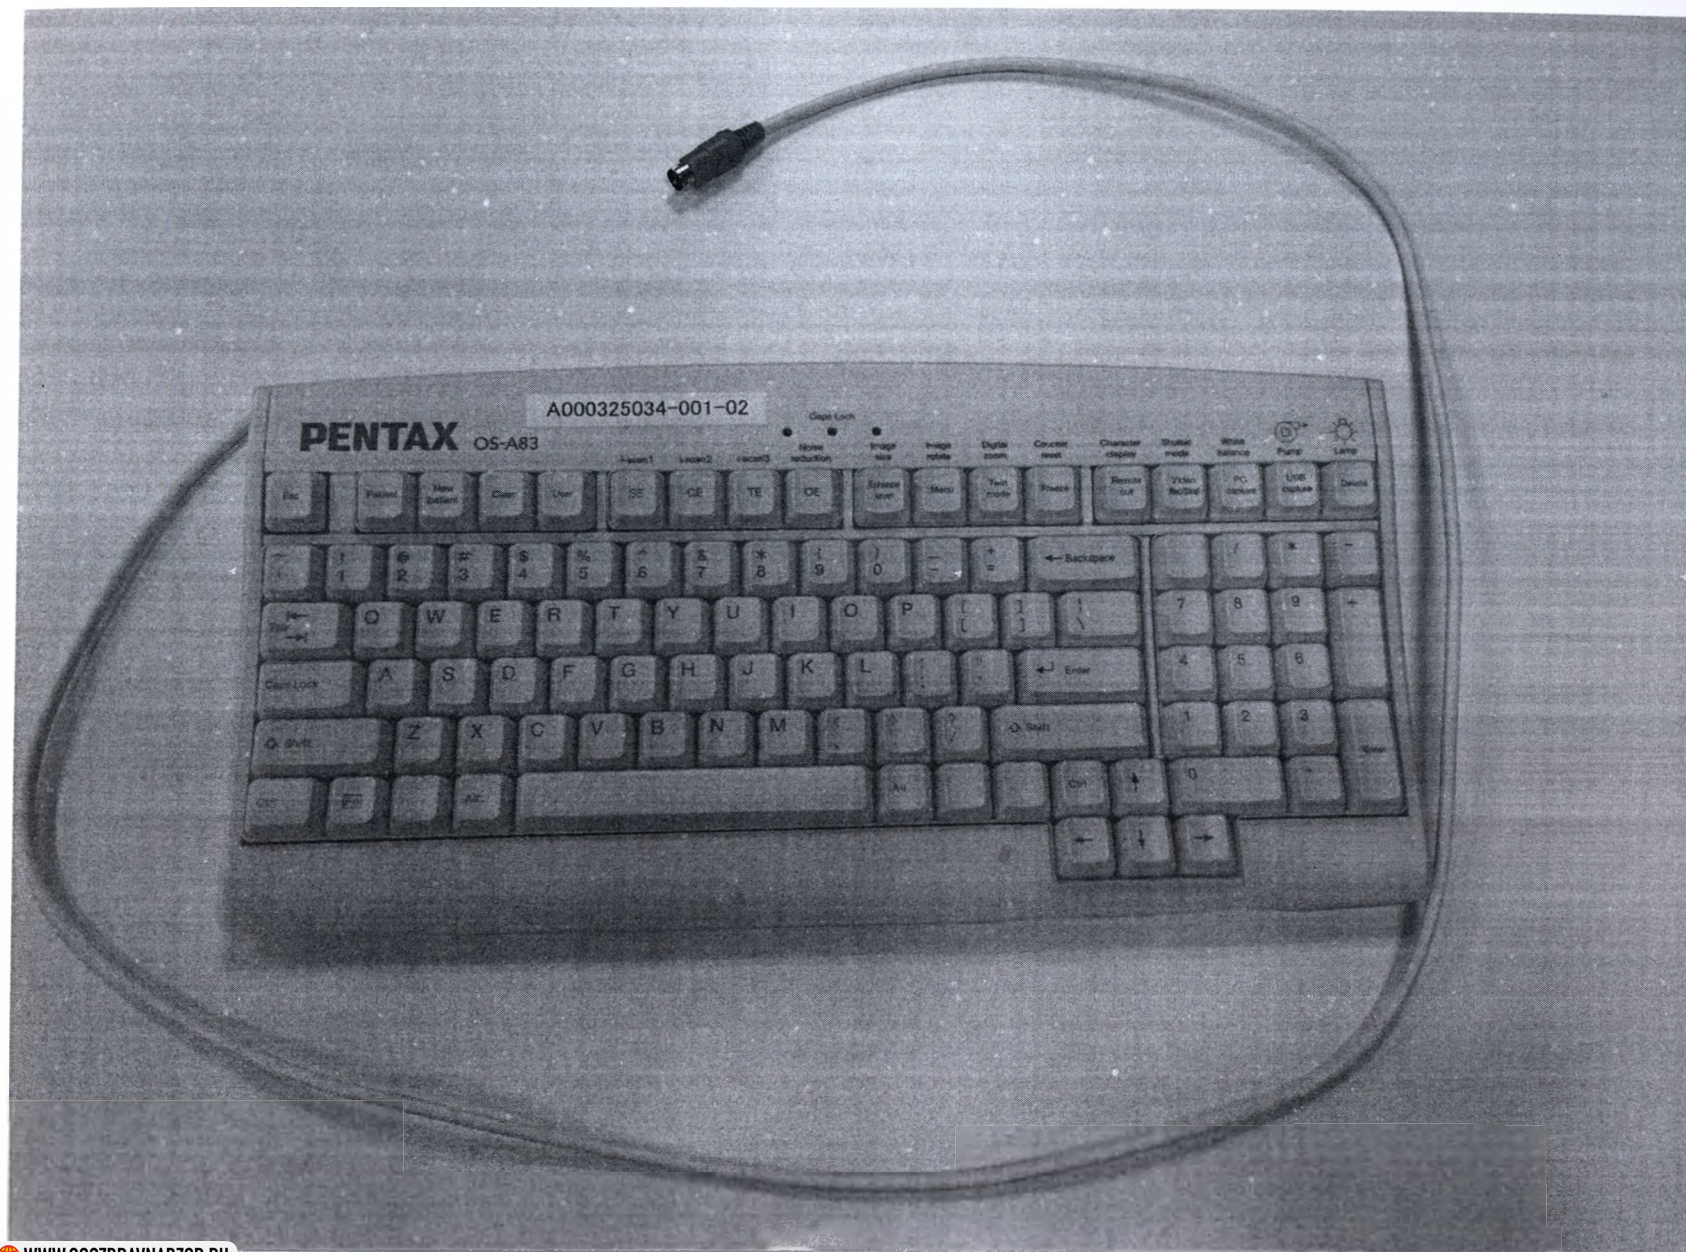


2. Заглушки для установки баланса белого типа OS-A

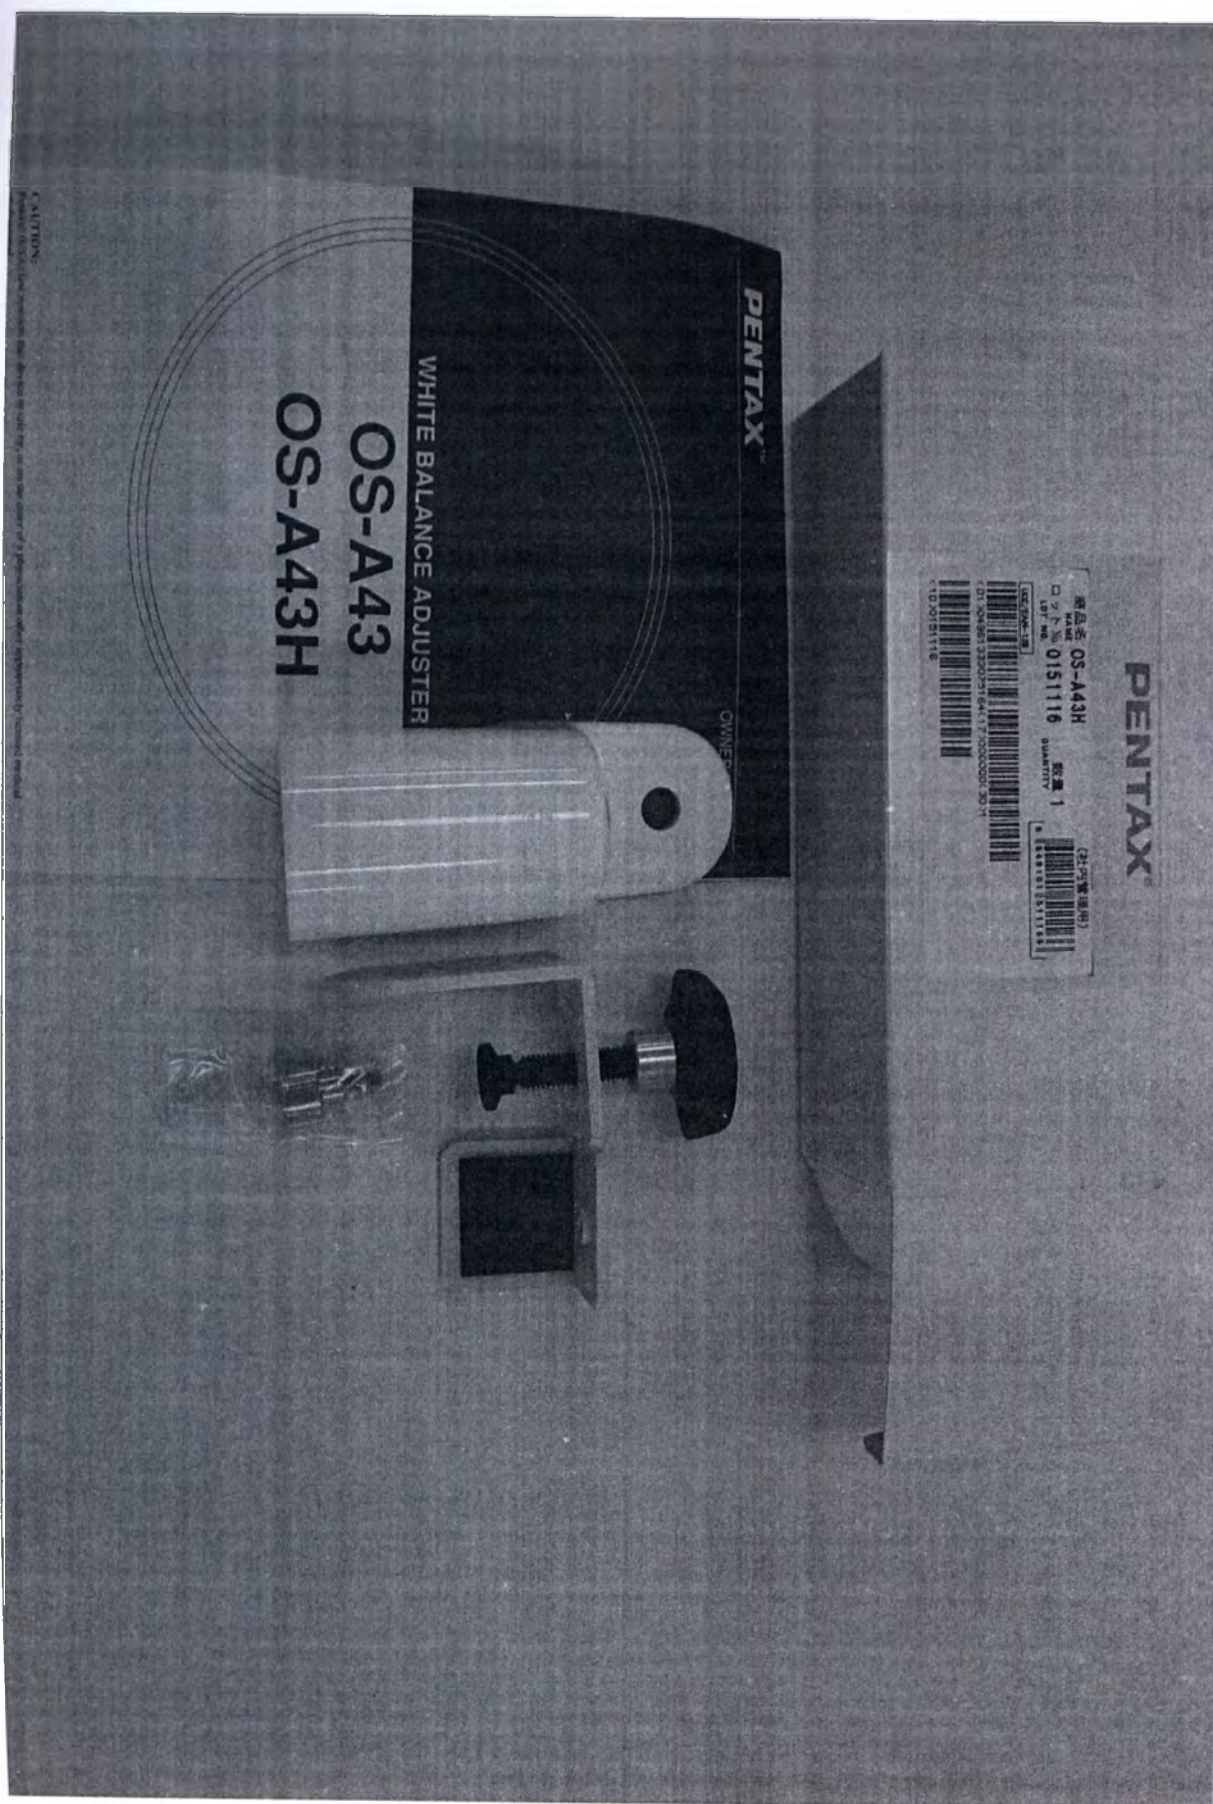


3. Кабели BNC-BNC типа OS (не более 3 шт.).

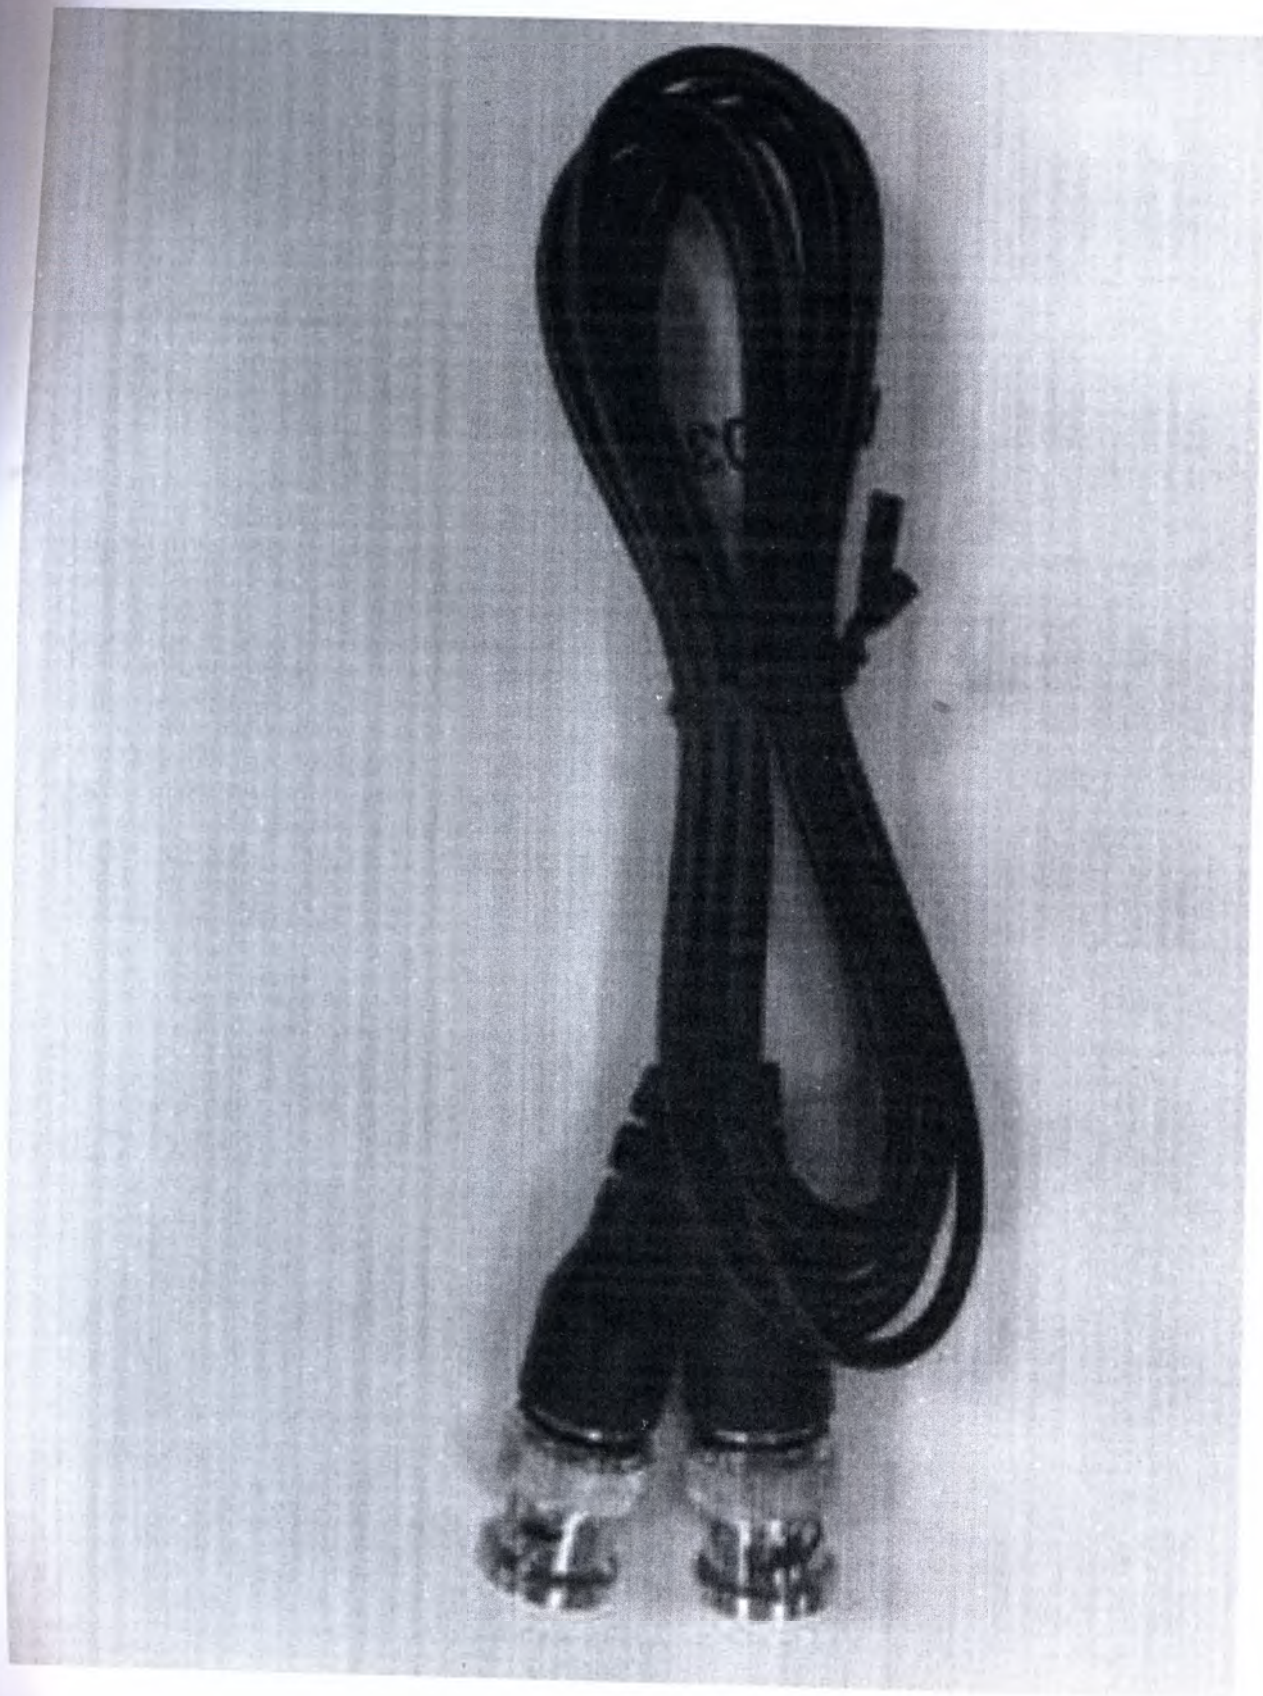


4. Кабели Y/C типа OS-A.

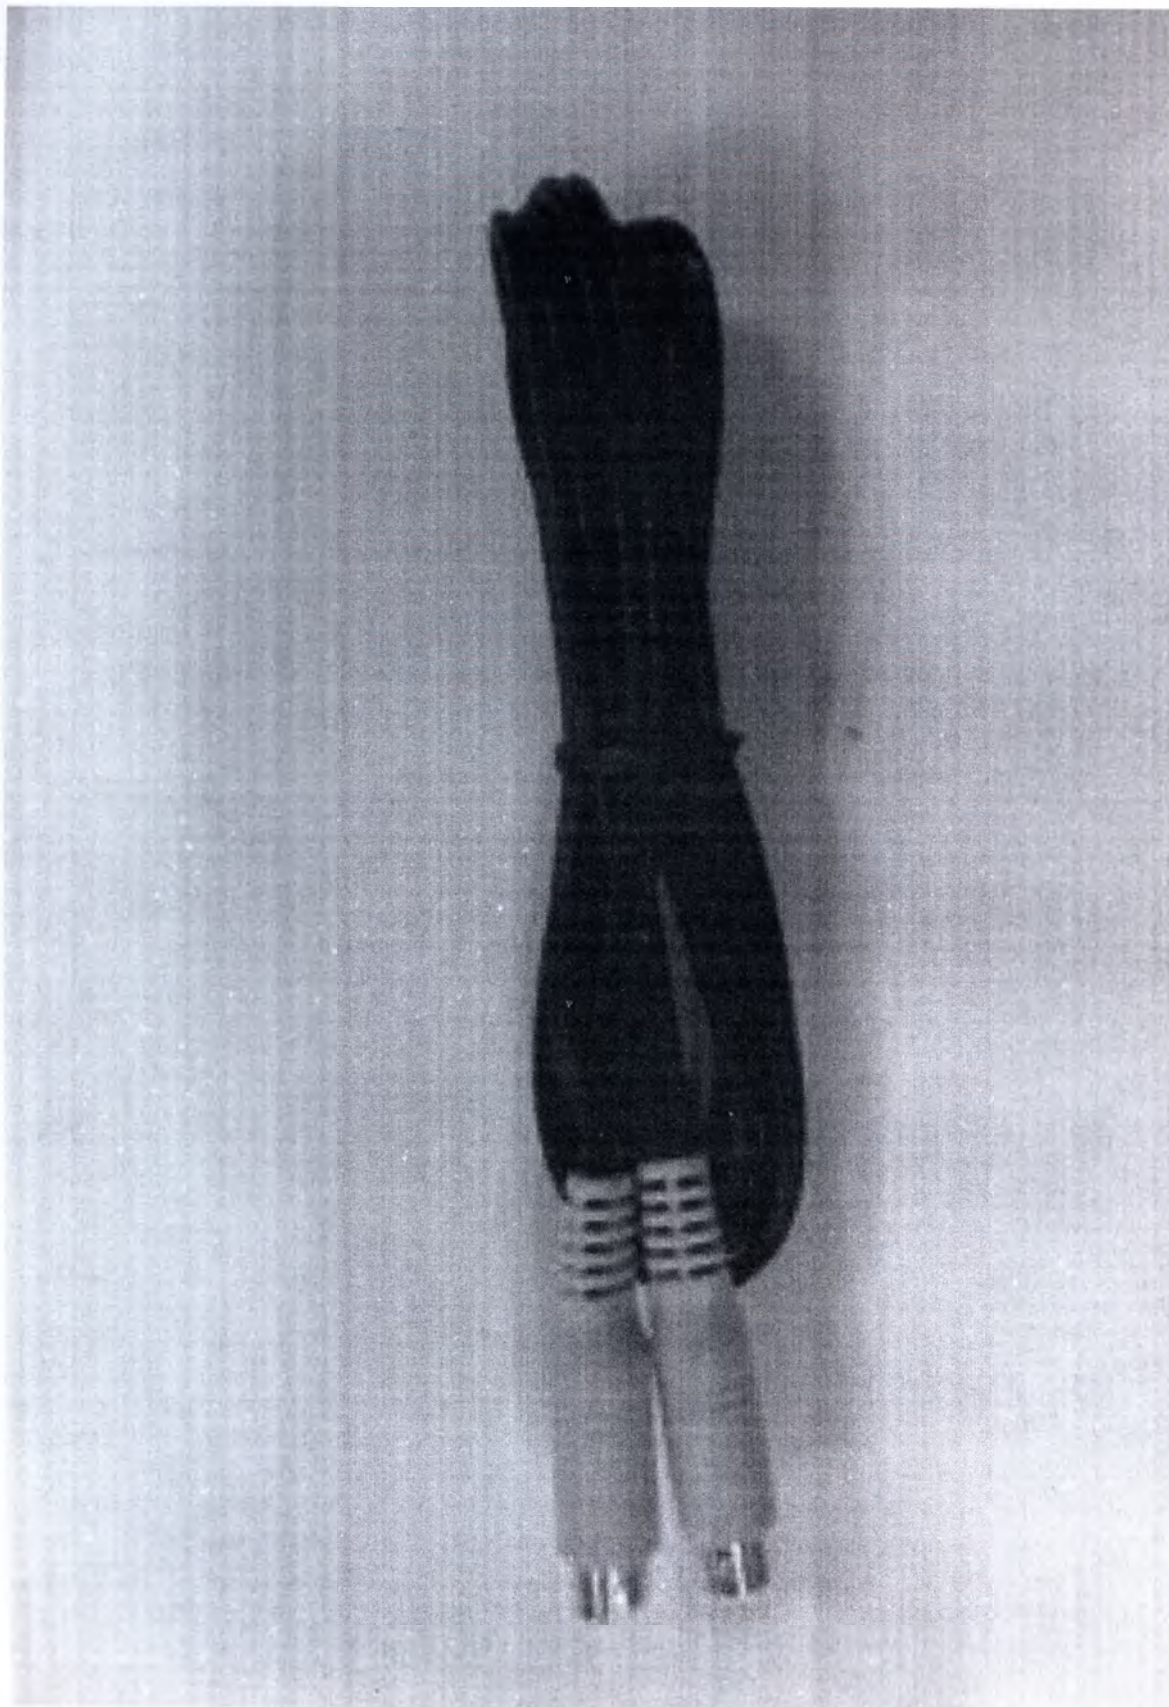


5. Кабель RGB типа OS-A.

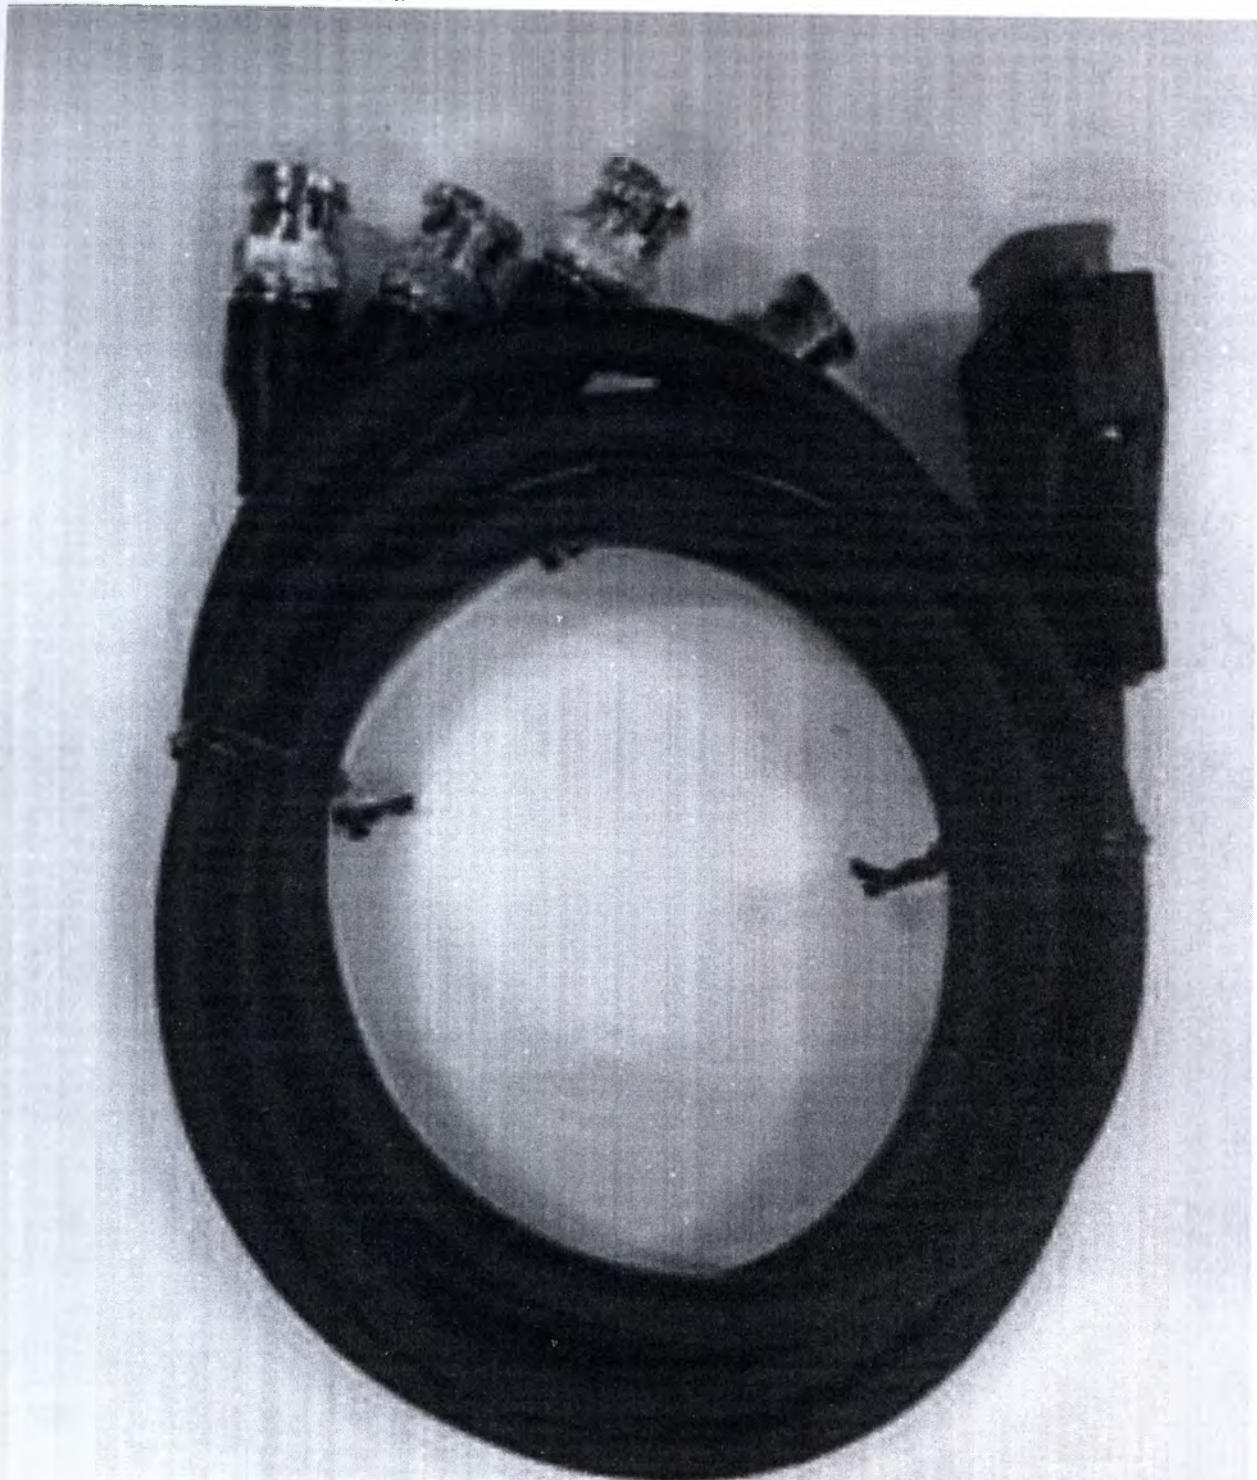


6. Кабель управления типа OS-A (не более 4 шт.)

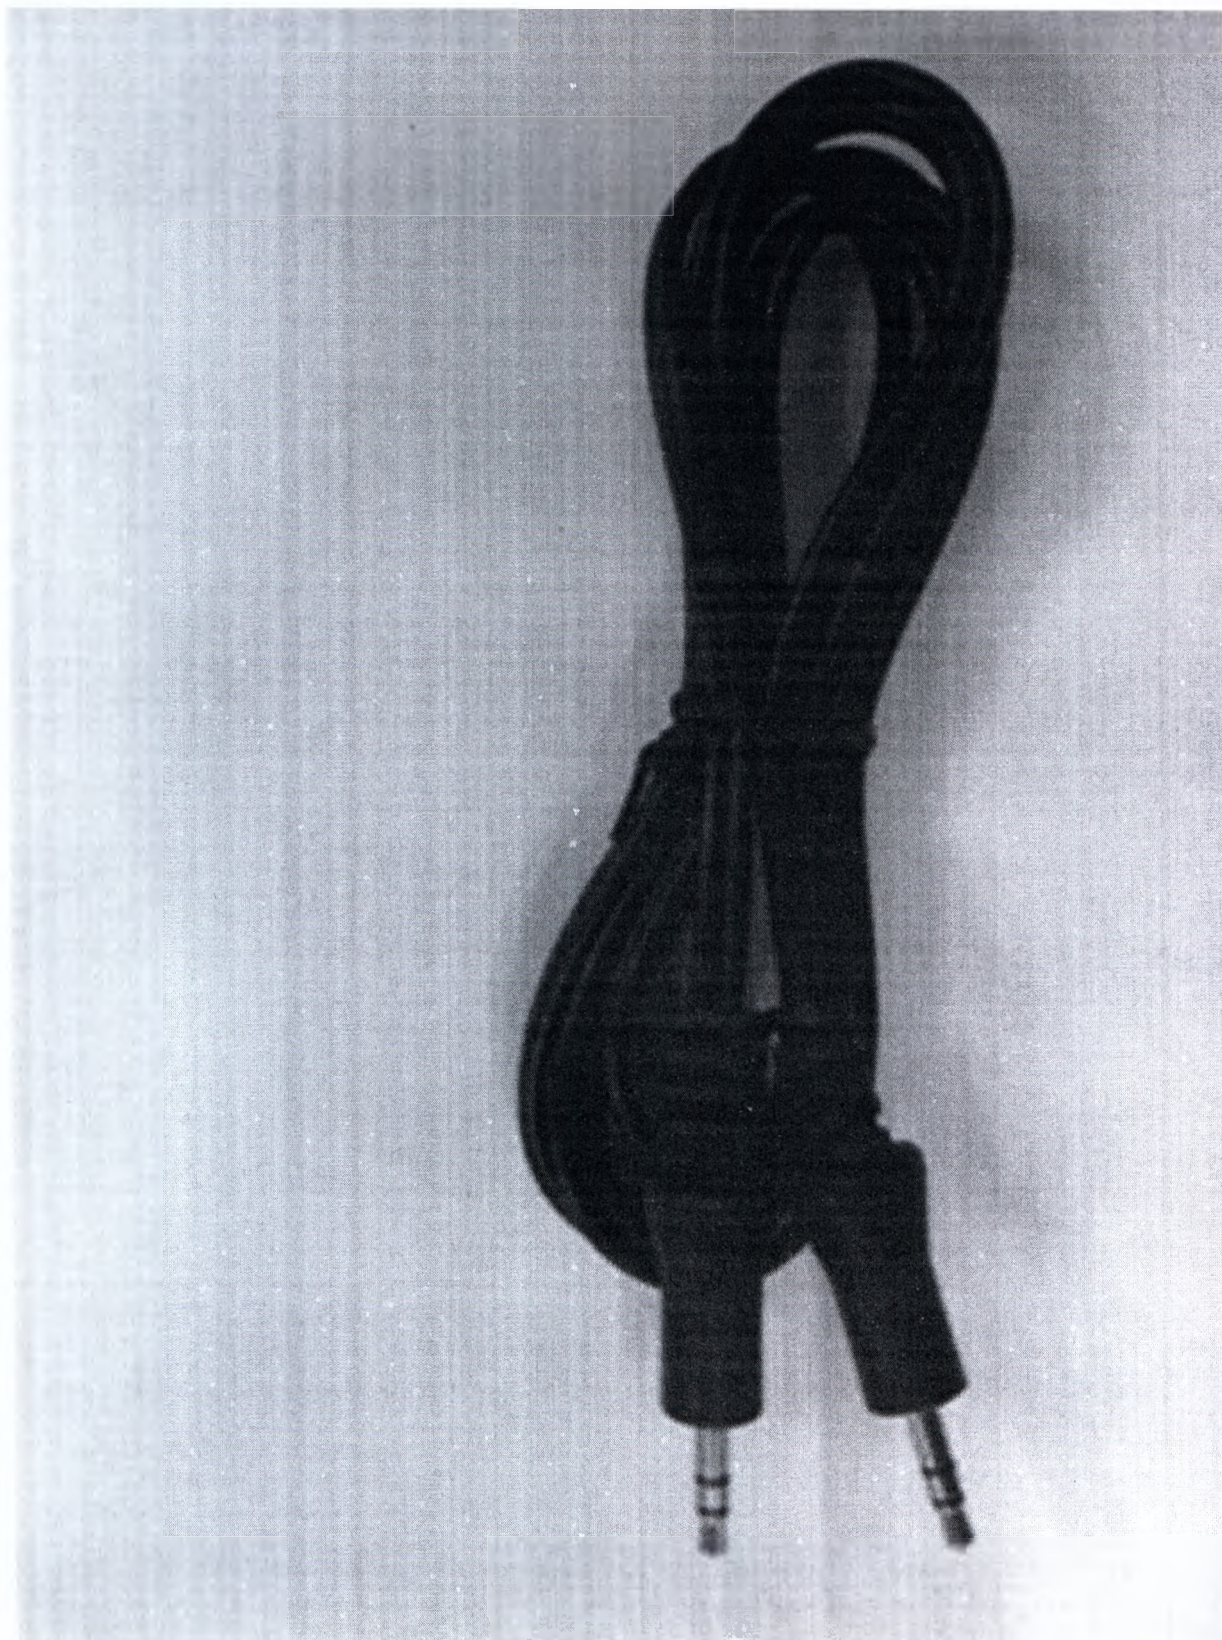


7. Кабели DVI типа OS (не более 3 шт.).

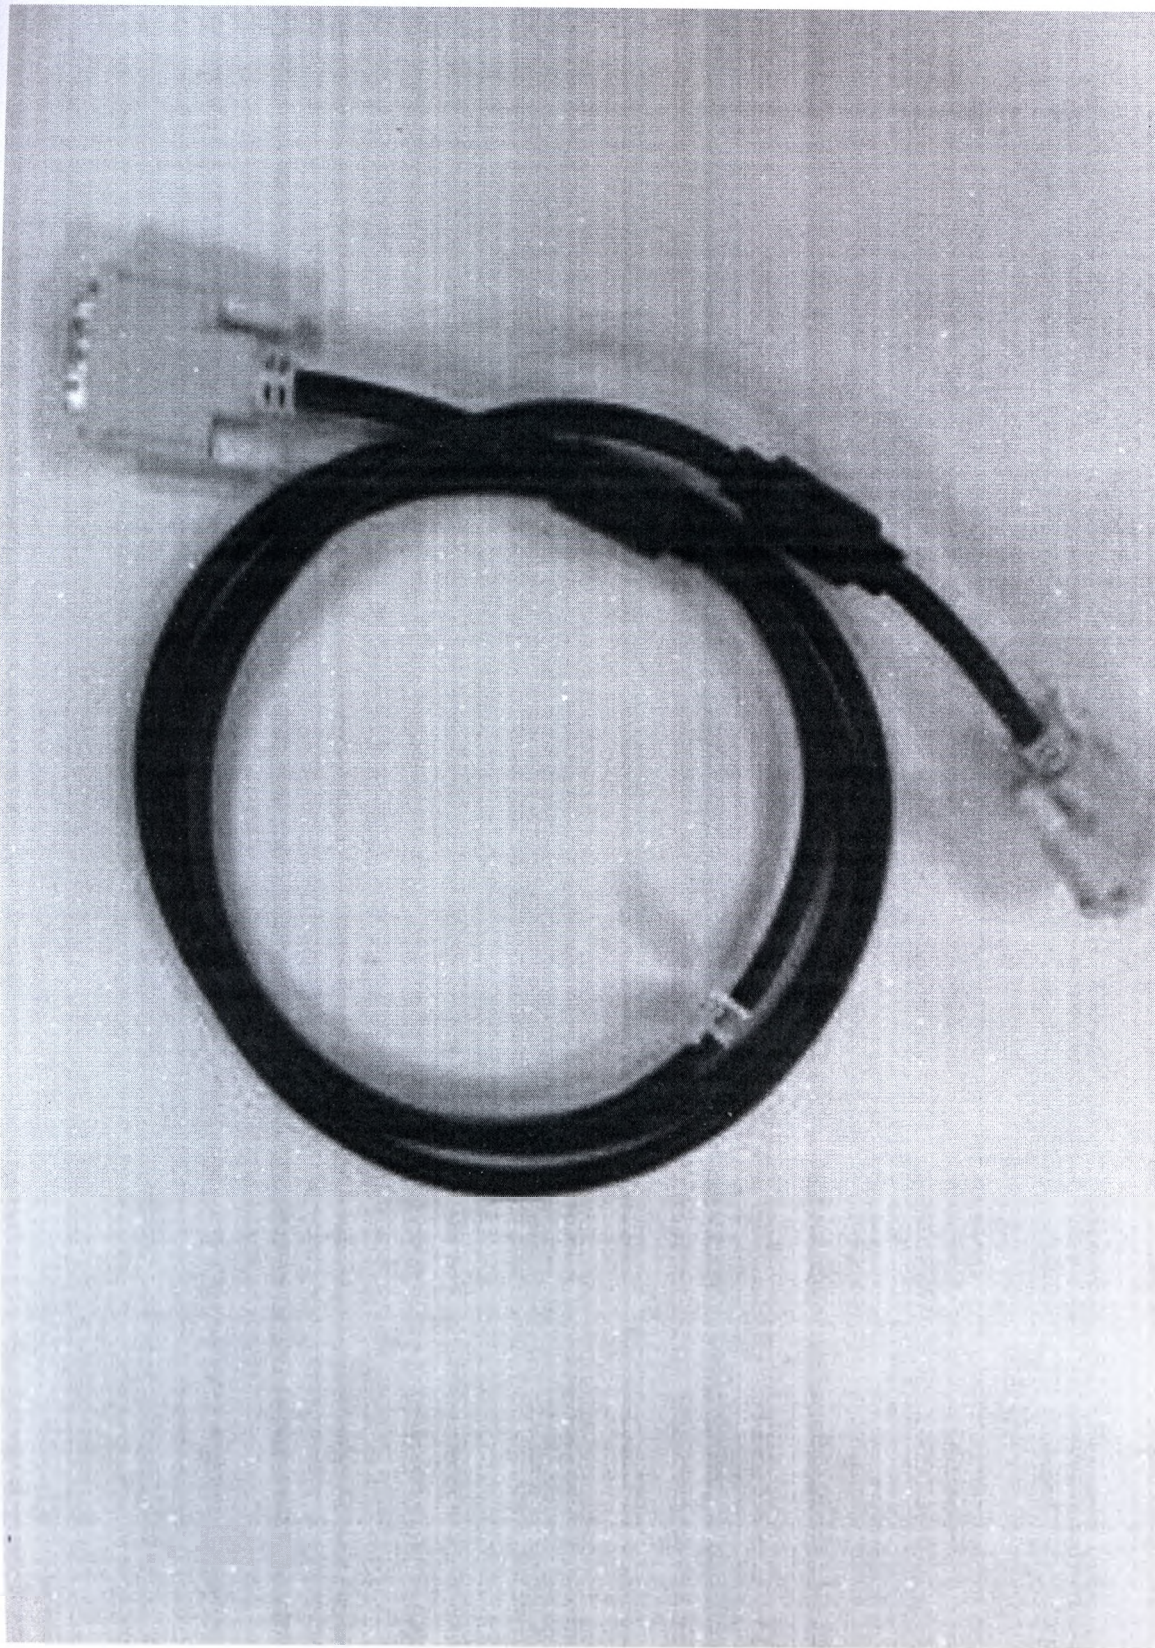


8. Кабели HD-SDI типа OS-A (не более 2 шт.)

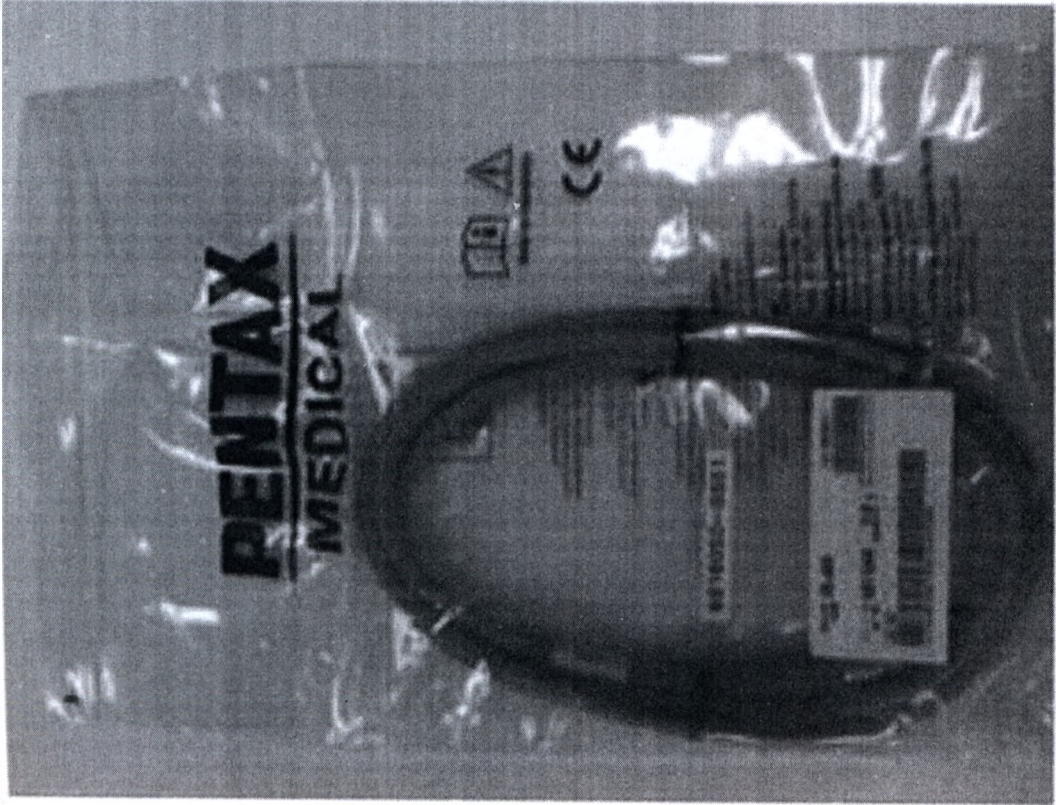

9. Емкость для воды типа OS-H

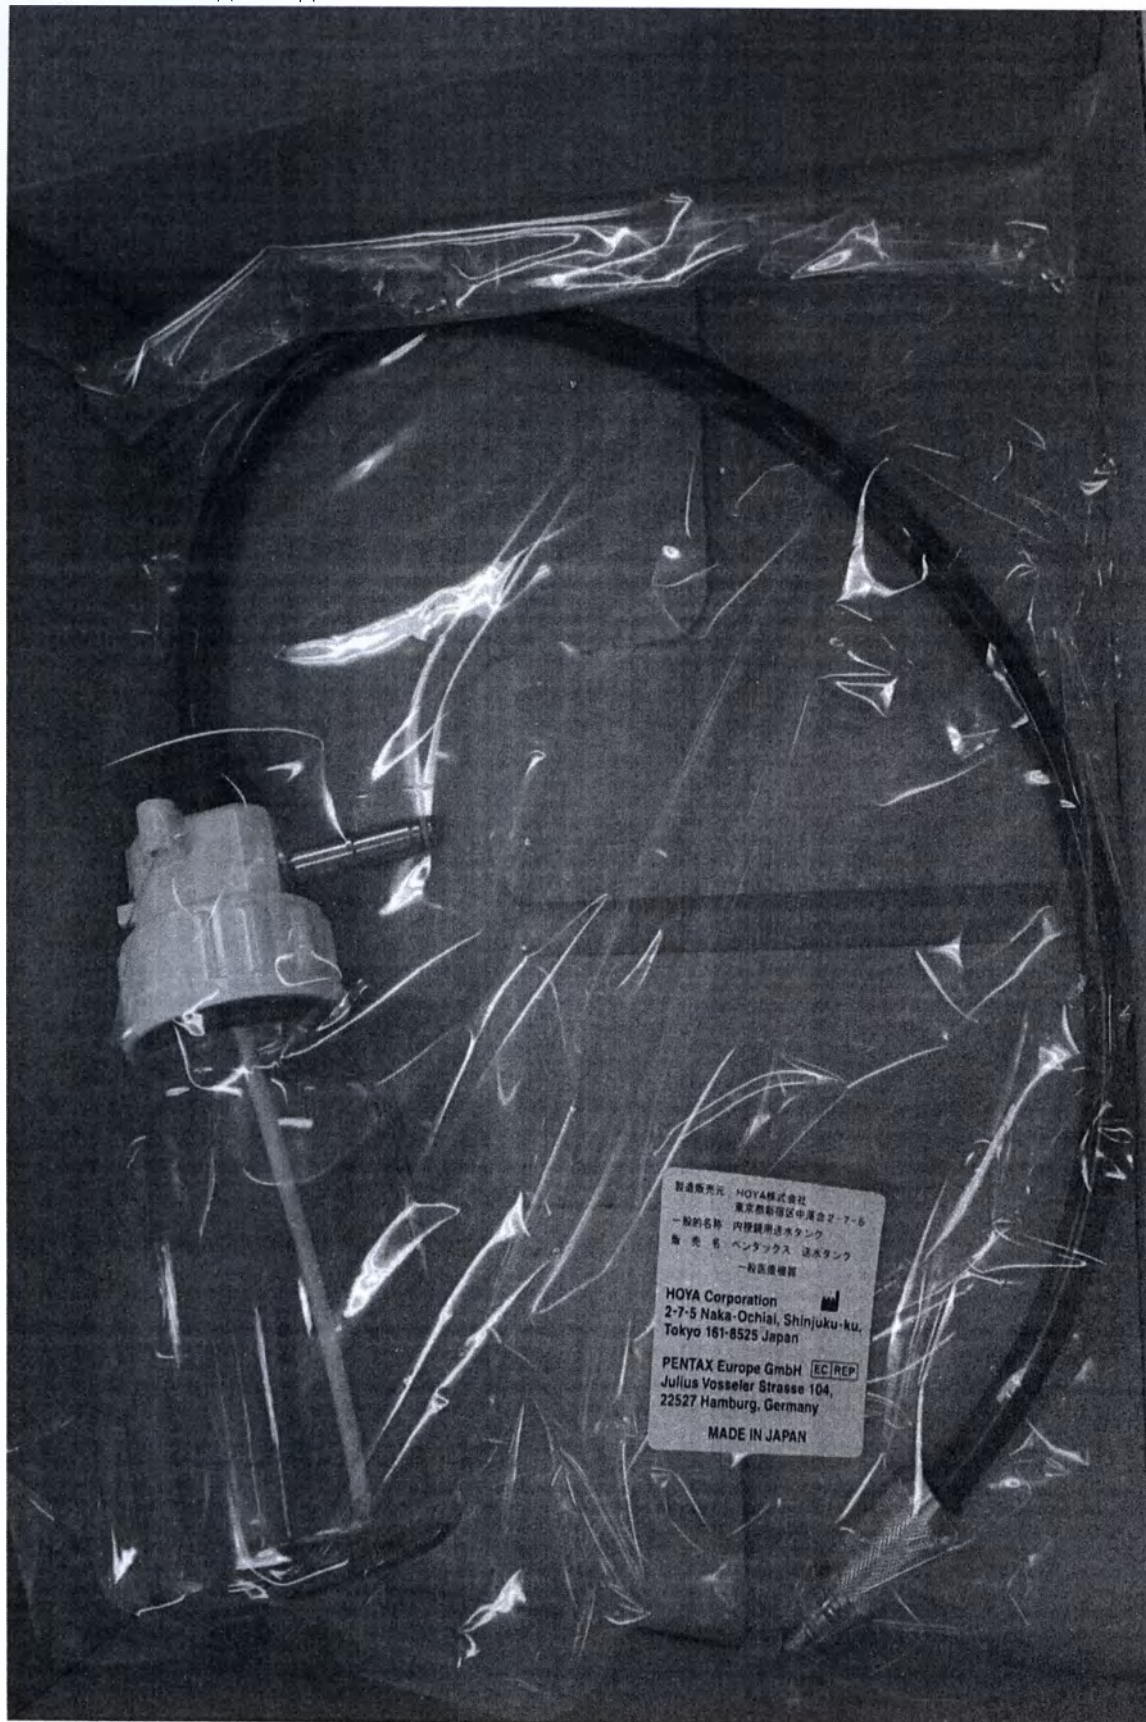


10. Программное обеспечение для процессора Endoimage2 типа OS-I на диске

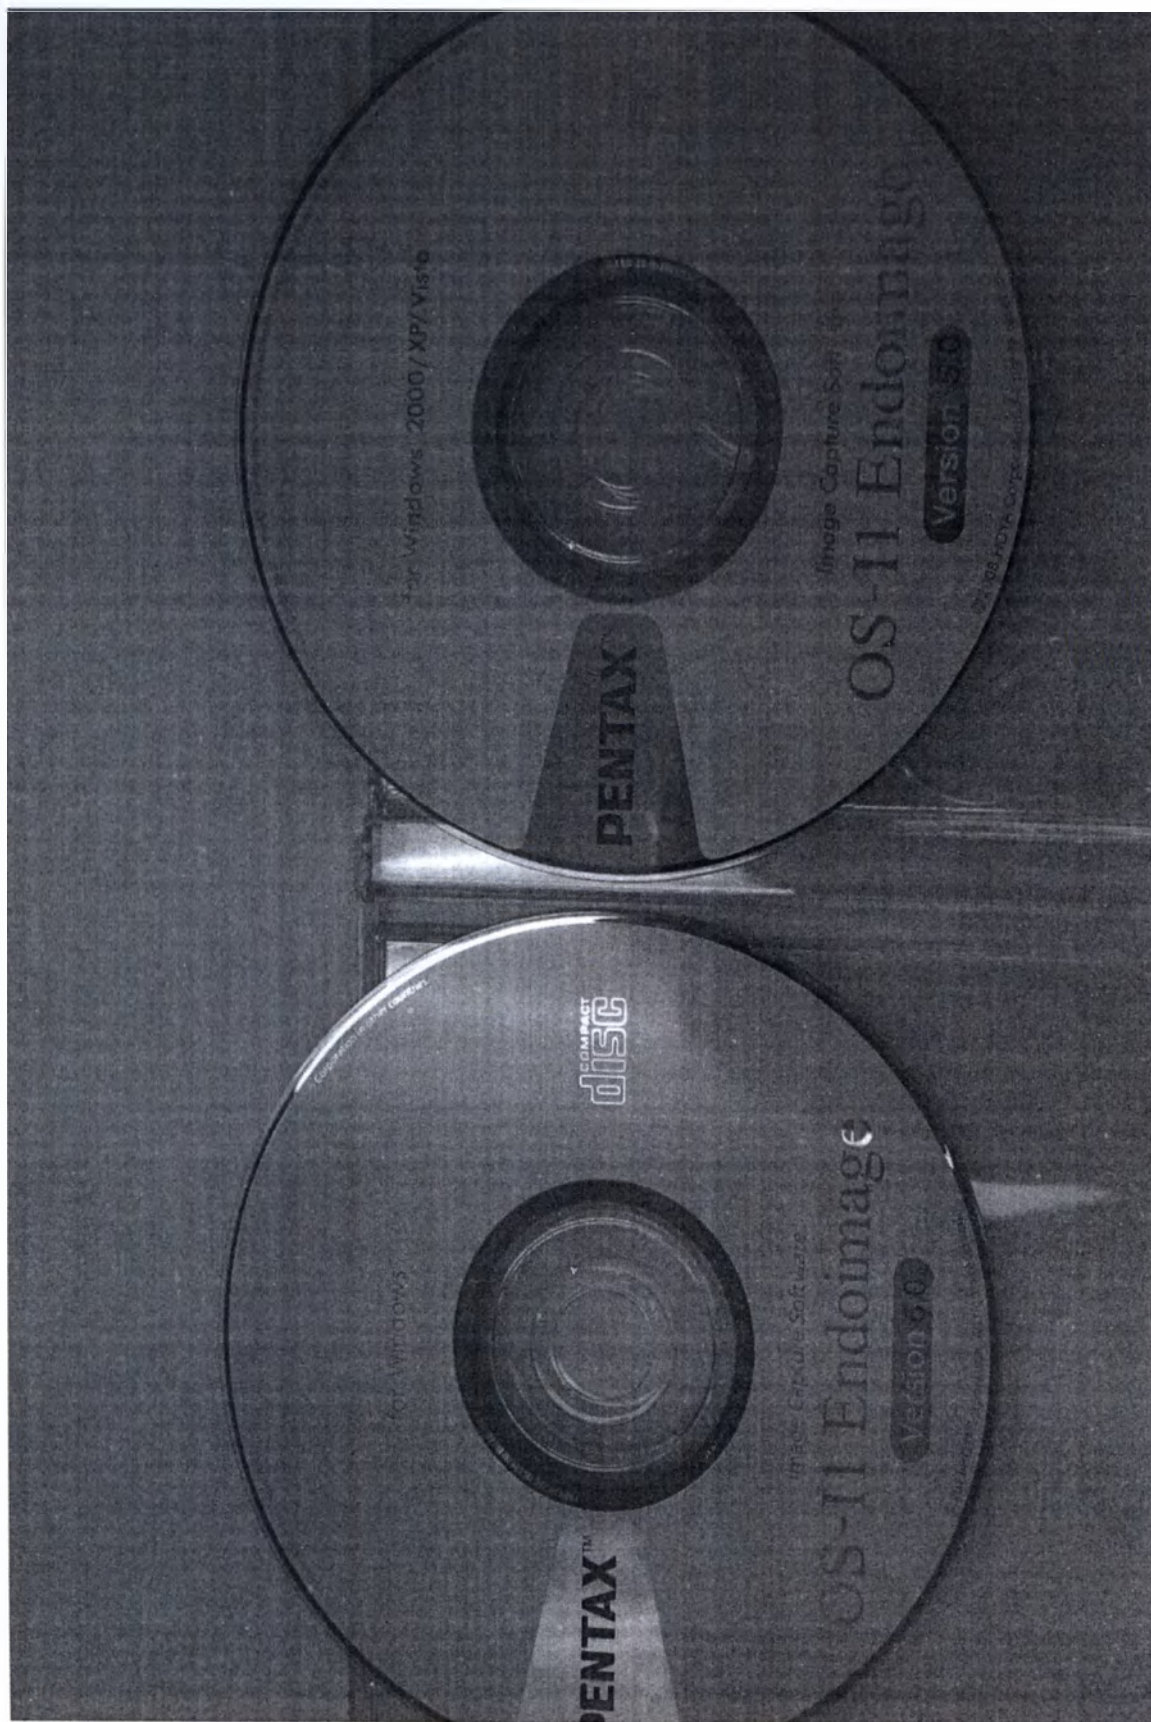


11. Кабели заземления типа OL-Z




12. Кабель сетевой.

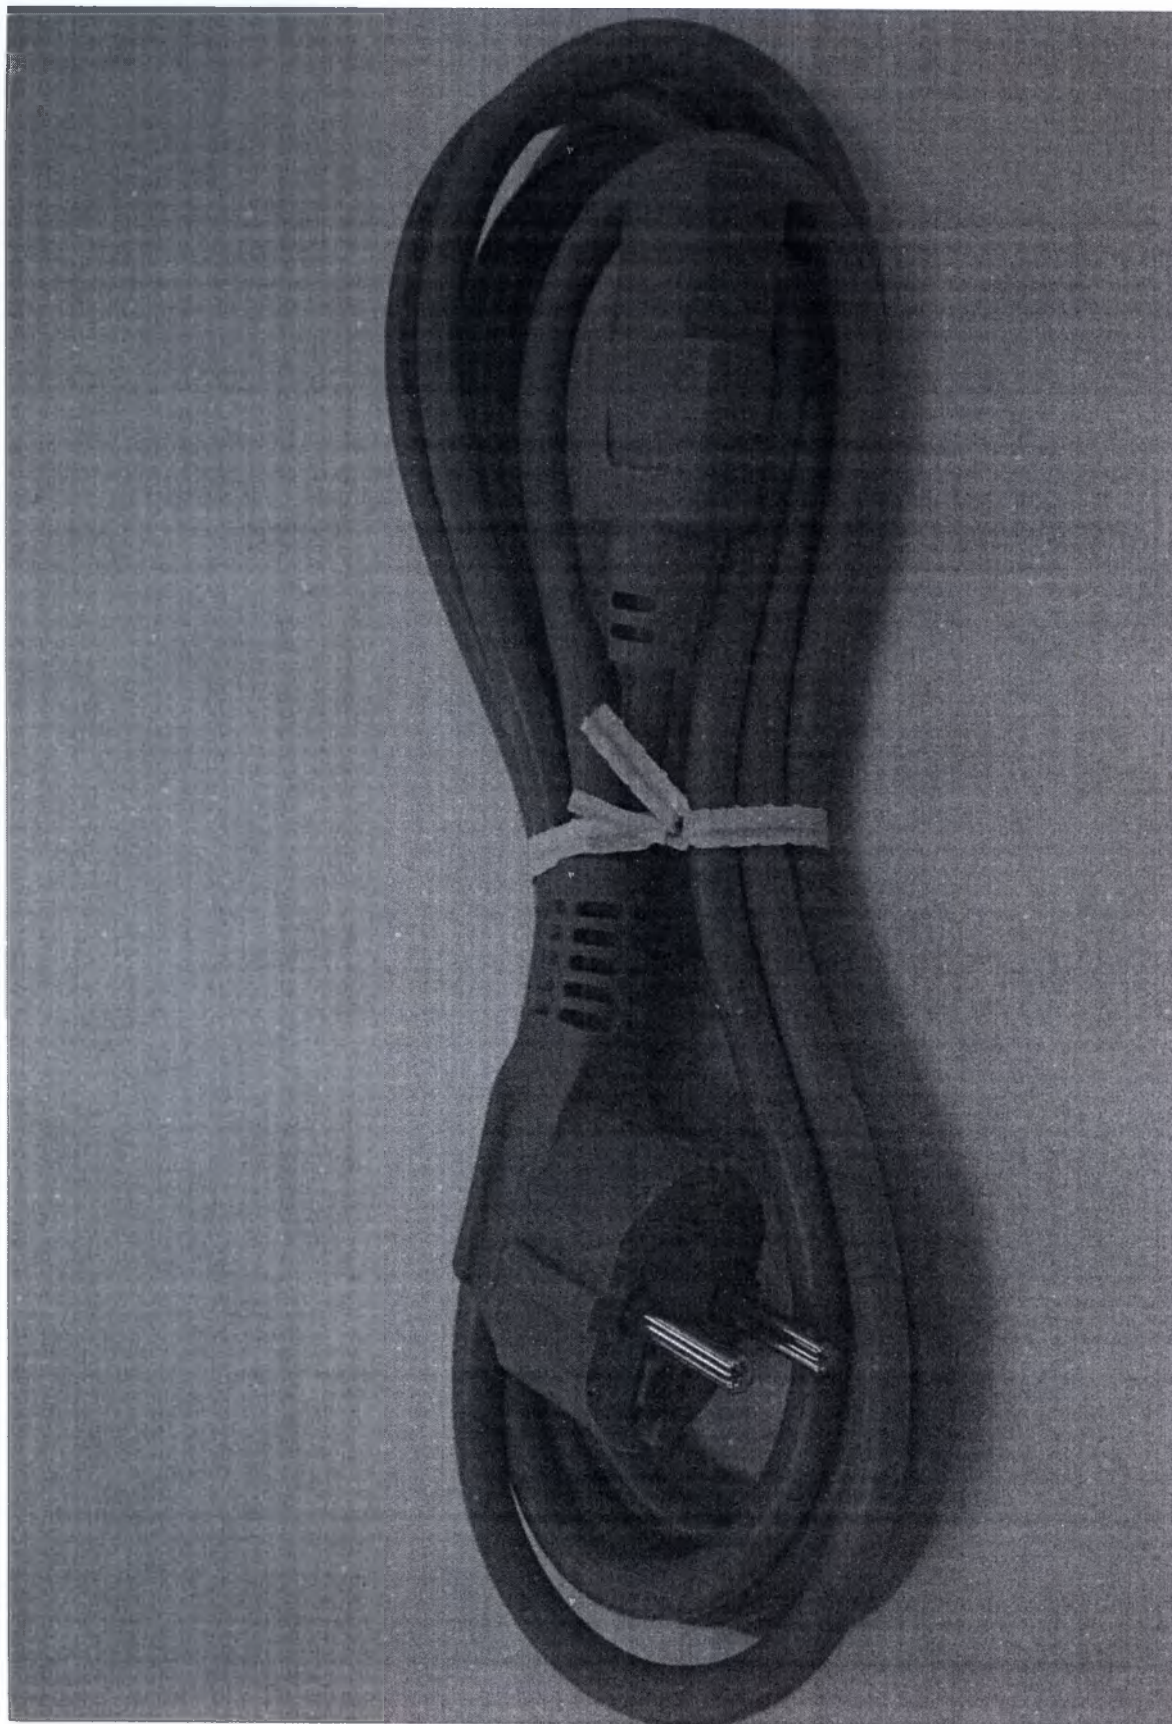


13. Предохранители

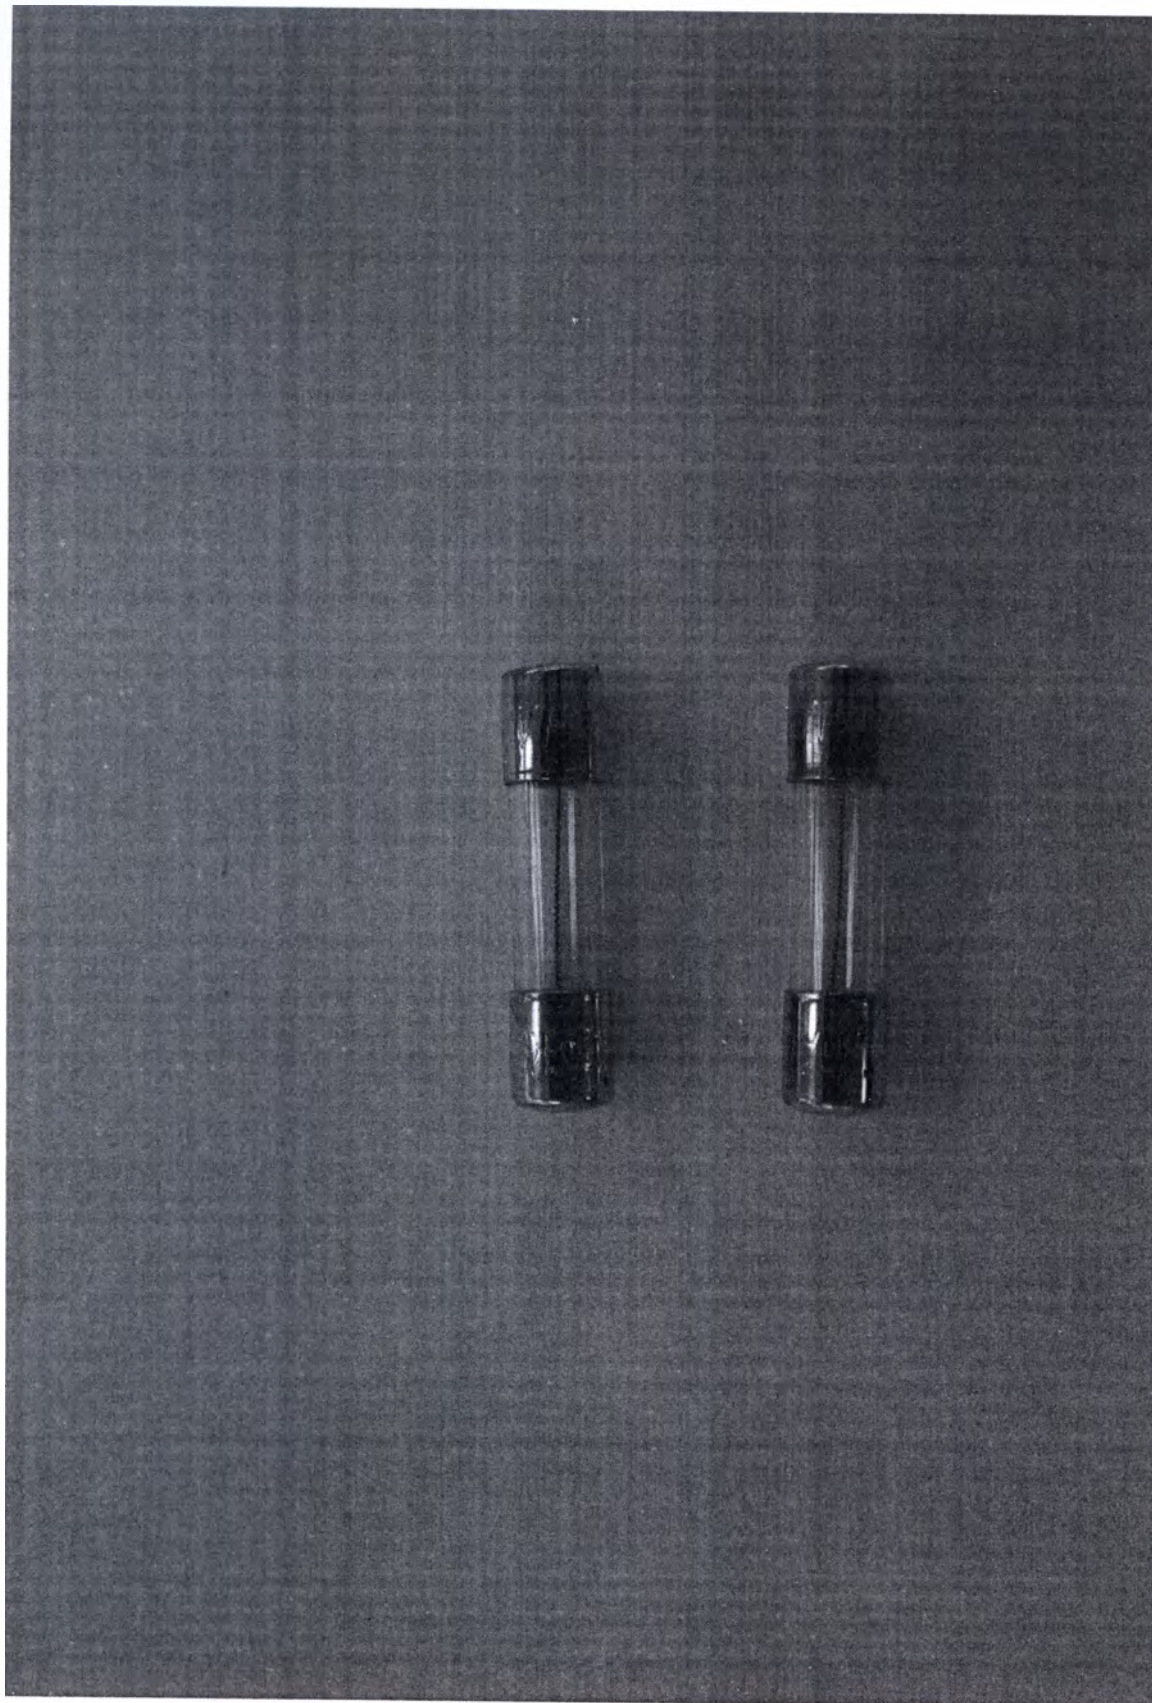


14. Педали управления типа OS-A

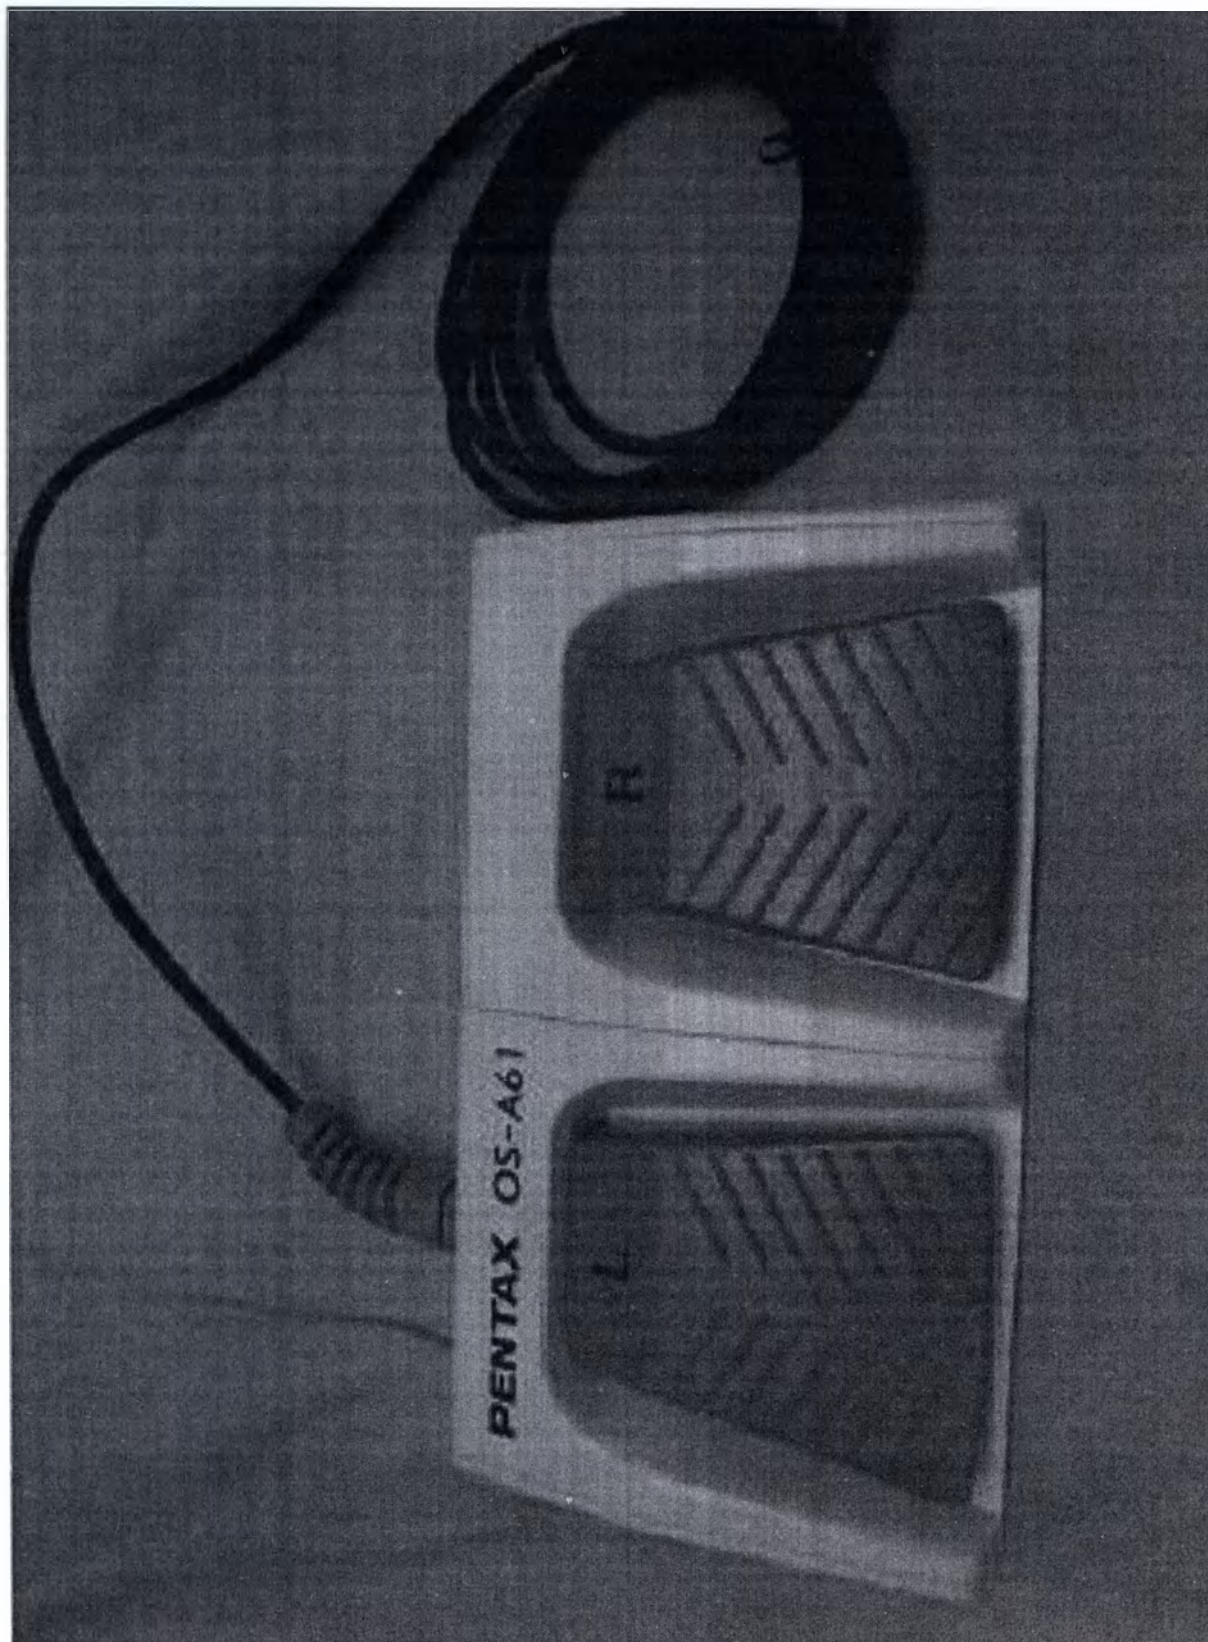


15. Лампы с картриджем типа ROL-X

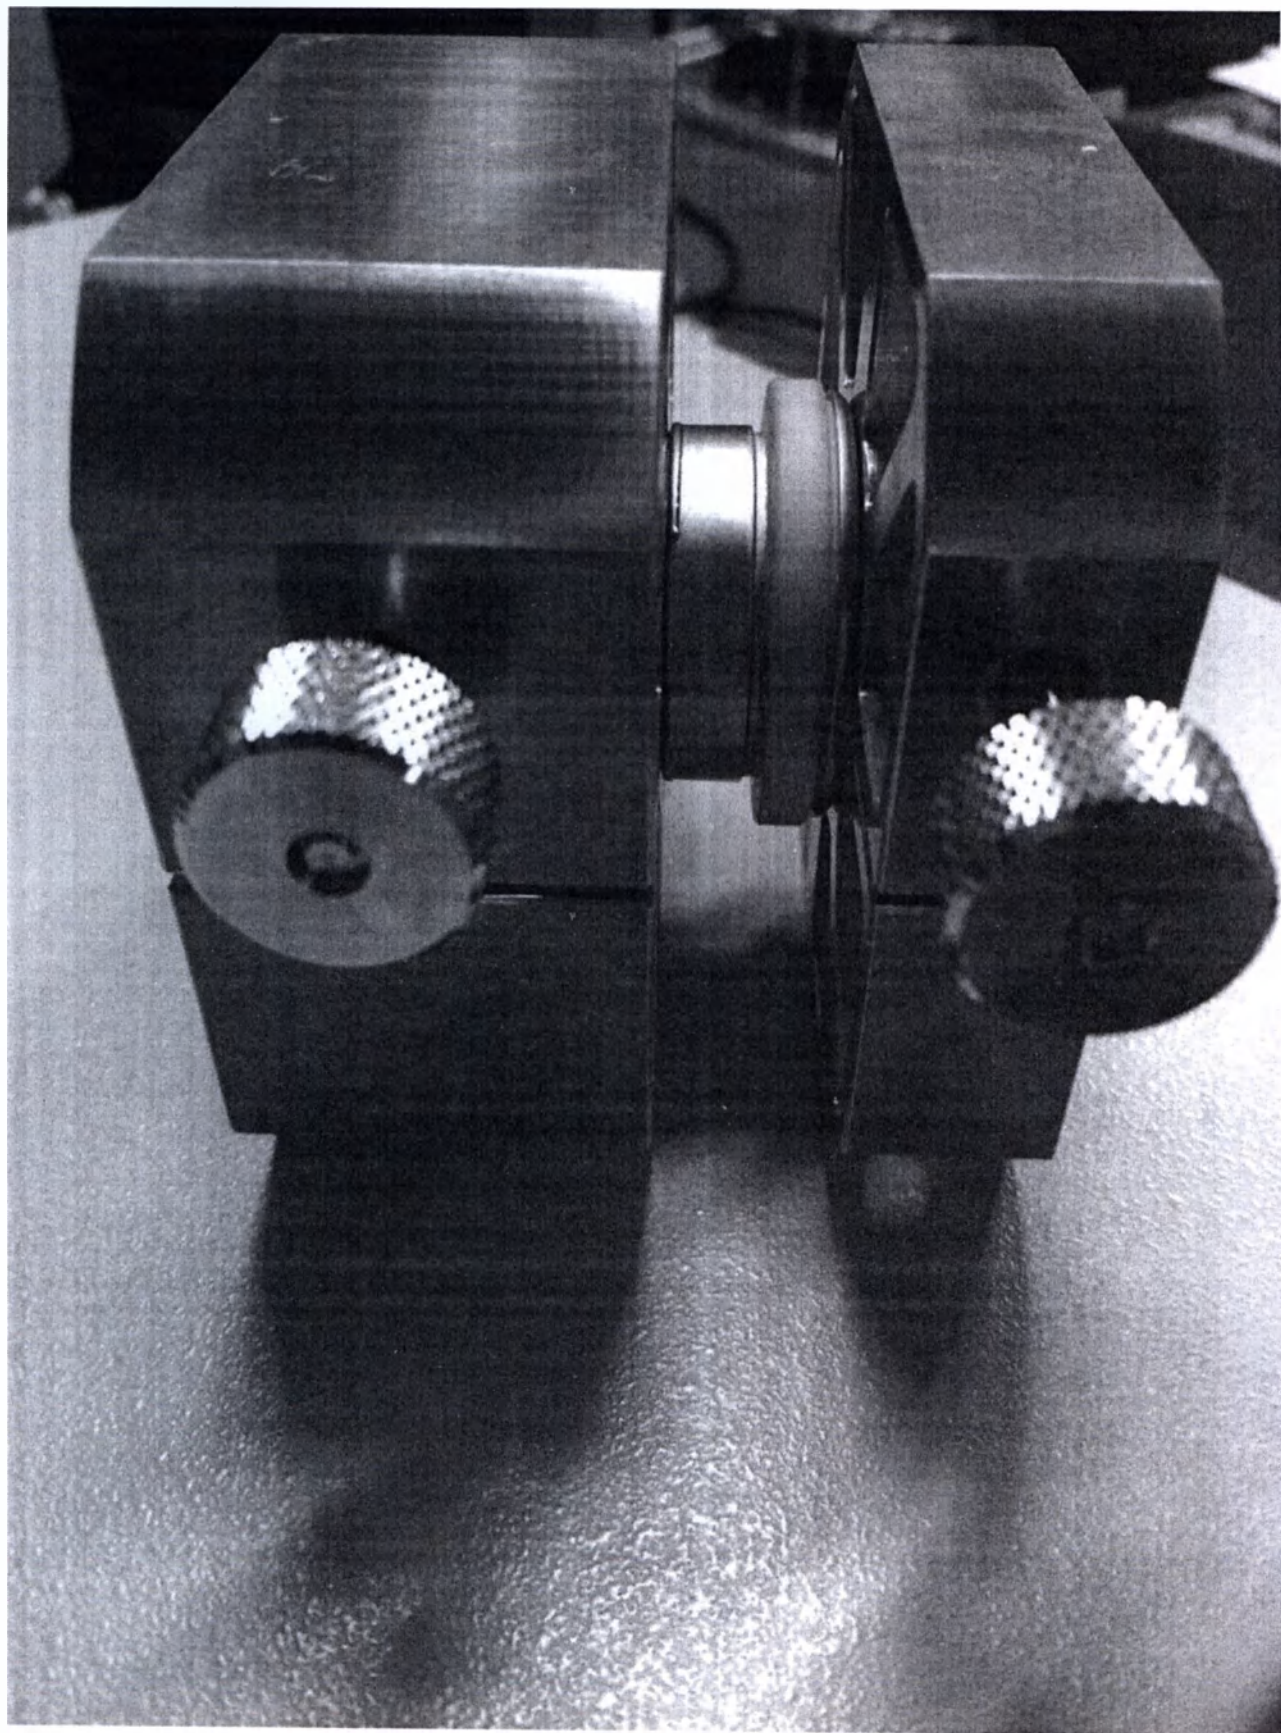

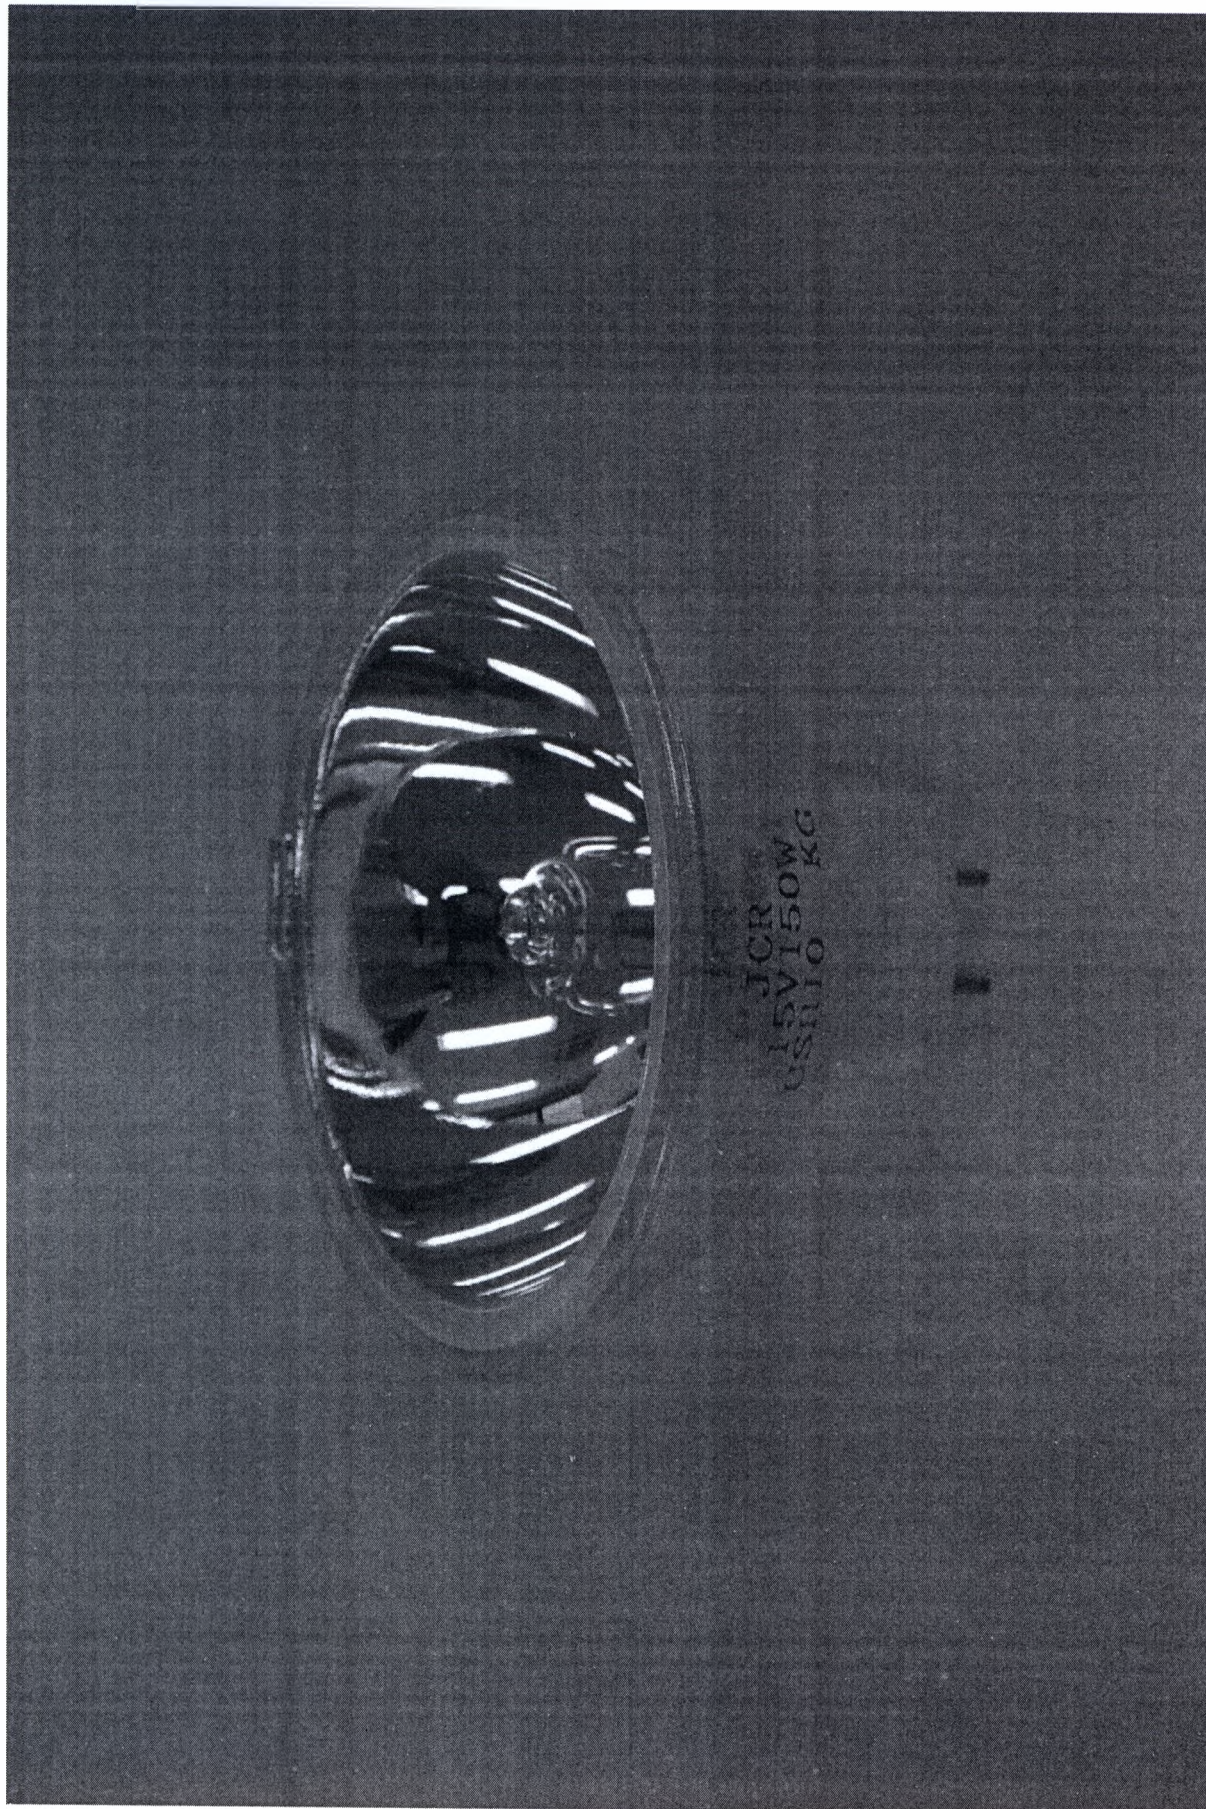

18. Инструкция к программному обеспечению для процессора.

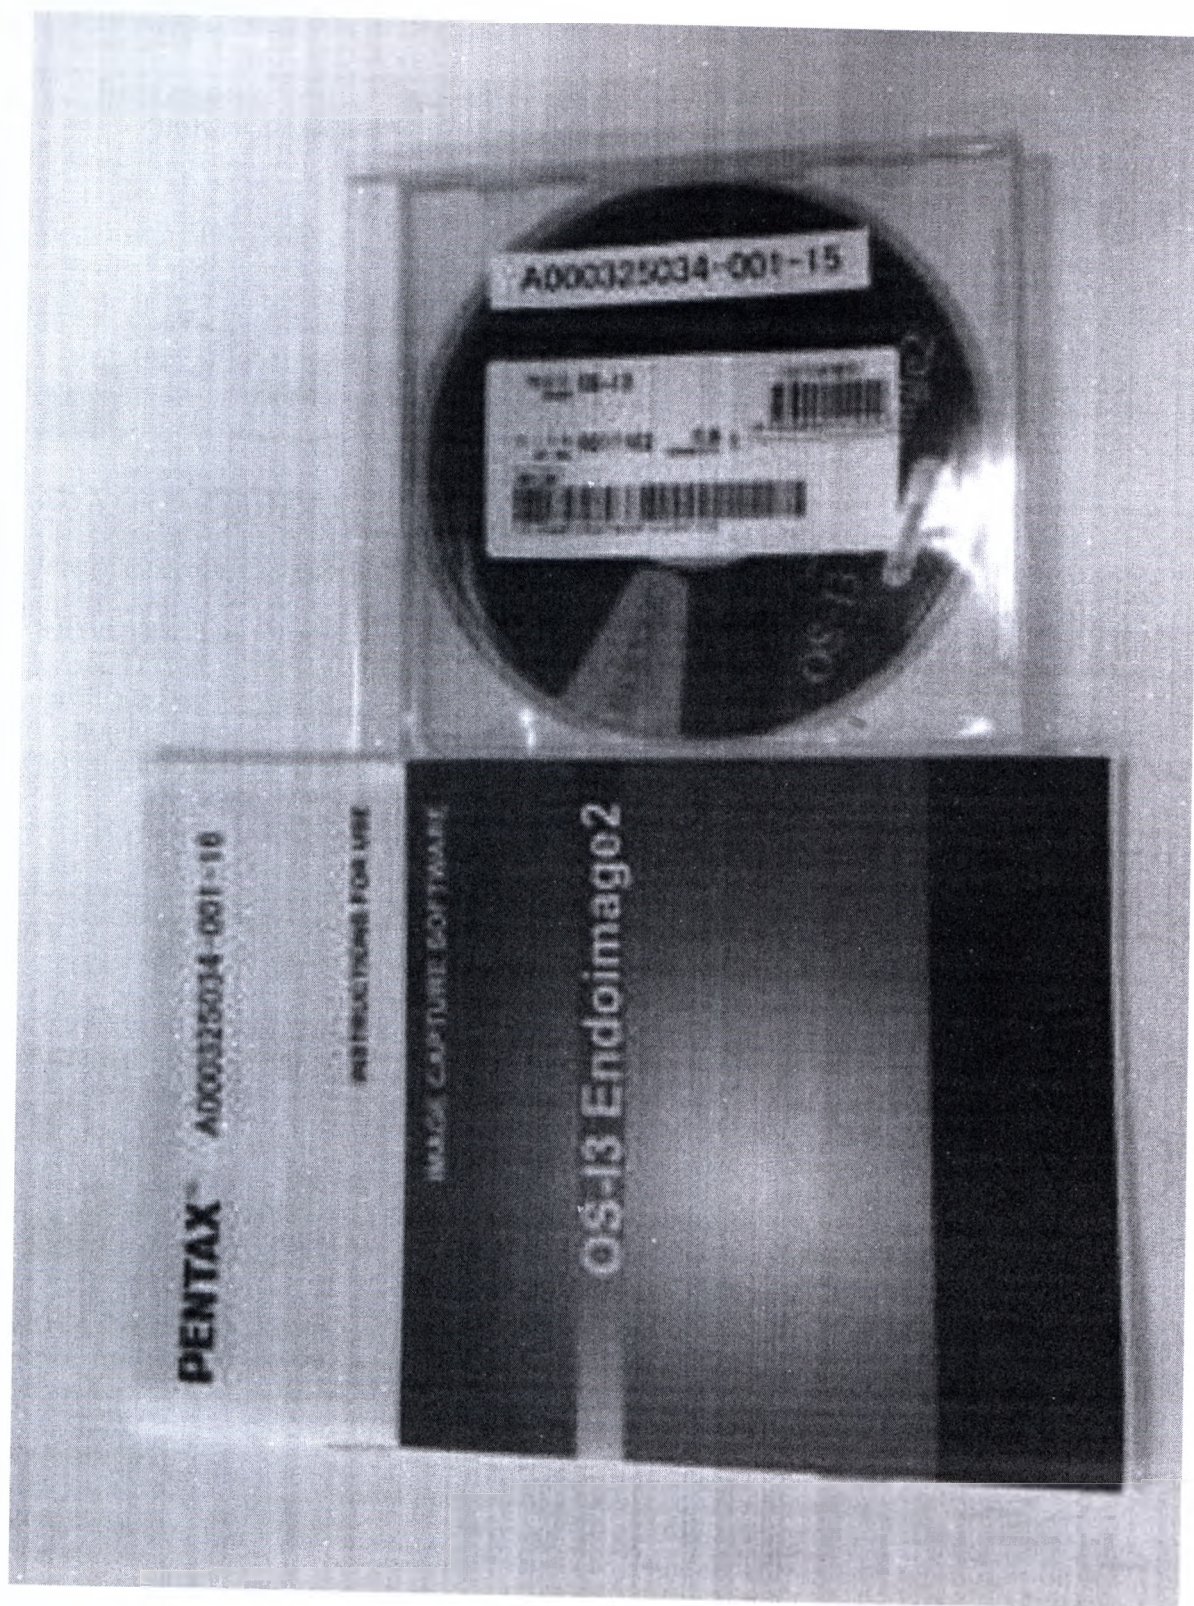

Проект маркировки для медицинского изделия

Видеопроцессор медицинский эндоскопический "PENTAX" (ПЕНТАКС),
"PENTAX Medical" (ПЕНТАКС Медикал) ЕРК-і7000, ЕРК-і7010 с
принадлежностями

Модель: ЕРК-і7010

SN



HOYA Corporation (ХОЯ Корпорейшн)

Адрес производства: 6-10-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023 Japan/6-10-1
Ниси- Синдзюку, Синдзюку-ку, Токио 160-0023 Япония.

ООО «МИП-Тест»

Россия, 123100, г. Москва, улица Пресненская наб., д.12, этаж 45, комната 10, офис 1

e-mail: mipTest15@vandex.ru

тел. 8(495)978-04-93

Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2012/13385

Видеопроцессор медицинский эндоскопический "PENTAX" (ПЕНТАКС),
"PENTAX Medical" (ПЕНТАКС Медикал) ЕРК-і7000, ЕРК-і7010 с
принадлежностями

Модель: ЕРК-і7000

SN



HOYA Corporation (ХОЯ Корпорейшн)

Адрес производства: 6-10-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023 Japan/6-10-1
Ниси- Синдзюку, Синдзюку-ку, Токио 160-0023 Япония.

ООО «МИП-Тест»

Россия, 123100, г. Москва, улица Пресненская наб., д.12, этаж 45, комната 10, офис 1

e-mail: mipTest15@vandex.ru

тел. 8(495)978-04-93

Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2012/13385

Проект маркировки для медицинского изделия

Видеопроцессор медицинский эндоскопический "PENTAX" (ПЕНТАКС), "PENTAX Medical" (ПЕНТАКС Медикал) ЕРК-і7000, ЕРК-і7010 с принадлежностями

Принадлежности:

Клавиатура типа OS –А (не более 2 шт.).

SN



HOYA Corporation (ХОЯ Корпорейшн)

Адрес производства: 6-10-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023 Japan/6-10-1 Ниси- Синдзюку, Синдзюку-ку, Токио 160-0023 Япония.

ООО «МИП-Тест»

Россия, 123100, г. Москва, улица Пресненская наб., д.12, этаж 45, комната 10, офис 1

e-mail: mipTest15@yandex.ru

тел. 8(495)978-04-93

Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2012/13385

Видеопроцессор медицинский эндоскопический "PENTAX" (ПЕНТАКС), "PENTAX Medical" (ПЕНТАКС Медикал) ЕРК-і7000, ЕРК-і7010 с принадлежностями

Принадлежности:

Заглушки для установки баланса белого типа OS-A (не более 3 шт.).

SN



HOYA Corporation (ХОЯ Корпорейшн)

Адрес производства: 6-10-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023 Japan/6-10-1 Ниси- Синдзюку, Синдзюку-ку, Токио 160-0023 Япония.

ООО «МИП-Тест»

Россия, 123100, г. Москва, улица Пресненская наб., д.12, этаж 45, комната 10, офис 1

e-mail: mipTest15@yandex.ru

тел. 8(495)978-04-93

Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2012/13385

Видеопроцессор медицинский эндоскопический "PENTAX" (ПЕНТАКС), "PENTAX Medical" (ПЕНТАКС Медикал) ЕРК-і7000, ЕРК-і7010 с принадлежностями

Принадлежности:

Кабели BNC-BNC типа OS (не более 3 шт.).

SN



HOYA Corporation (ХОЯ Корпорейшн)

Адрес производства: 6-10-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023 Japan/6-10-1 Ниси- Синдзюку, Синдзюку-ку, Токио 160-0023 Япония.

ООО «МИП-Тест»

Россия, 123100, г. Москва, улица Пресненская наб., д.12, этаж 45, комната 10, офис 1

e-mail: mipTest15@yandex.ru

тел. 8(495)978-04-93

Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2012/13385

Видеопроцессор медицинский эндоскопический "PENTAX" (ПЕНТАКС), "PENTAX Medical" (ПЕНТАКС Медикал) ЕРК-і7000, ЕРК-і7010 с принадлежностями

Принадлежности:

Кабели Y/C типа OS-A.

SN



HOYA Corporation (ХОЯ Корпорейшн)

Адрес производства: 6-10-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023 Japan/6-10-1 Ниси- Синдзюку, Синдзюку-ку, Токио 160-0023 Япония.

ООО «МИП-Тест»

Россия, 123100, г. Москва, улица Пресненская наб., д.12, этаж 45, комната 10, офис 1

e-mail: mipTest15@yandex.ru

тел. 8(495)978-04-93

Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2012/13385

Видеопроцессор медицинский эндоскопический "PENTAX" (ПЕНТАКС), "PENTAX Medical" (ПЕНТАКС Медикал) ЕРК-і7000, ЕРК-і7010 с принадлежностями

Принадлежности:

Кабель RGB типа OS-A.

SN



HOYA Corporation (ХОЯ Корпорейшн)

Адрес производства: 6-10-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023 Japan/6-10-1 Ниси- Синдзюку, Синдзюку-ку, Токио 160-0023 Япония.

ООО «МИП-Тест»

Россия, 123100, г. Москва, улица Пресненская наб., д.12, этаж 45, комната 10, офис 1

e-mail: mipTest15@yandex.ru

тел. 8(495)978-04-93

Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2012/13385

Видеопроцессор медицинский эндоскопический "PENTAX" (ПЕНТАКС), "PENTAX Medical" (ПЕНТАКС Медикал) ЕРК-і7000, ЕРК-і7010 с принадлежностями

Принадлежности:

Кабель управления типа OS-A (не более 4 шт.).

SN



HOYA Corporation (ХОЯ Корпорейшн)

Адрес производства: 6-10-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023 Japan/6-10-1 Ниси- Синдзюку, Синдзюку-ку, Токио 160-0023 Япония.

ООО «МИП-Тест»

Россия, 123100, г. Москва, улица Пресненская наб., д.12, этаж 45, комната 10, офис 1

e-mail: mipTest15@yandex.ru

тел. 8(495)978-04-93

Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2012/13385

Видеопроцессор медицинский эндоскопический "PENTAX" (ПЕНТАКС), "PENTAX Medical" (ПЕНТАКС Медикал) ЕРК-і7000, ЕРК-і7010 с принадлежностями

Принадлежности:

Кабели DVI типа OS (не более 3 шт.).

SN



HOYA Corporation (ХОЯ Корпорейшн)

Адрес производства: 6-10-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023 Japan/6-10-1

Ниси- Синдзюку, Синдзюку-ку, Токио 160-0023 Япония.

ООО «МИП-Тест»

Россия, 123100, г. Москва, улица Пресненская наб., д.12, этаж 45, комната 10, офис 1

e-mail: mipTest15@yandex.ru

тел. 8(495)978-04-93

Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2012/13385

Видеопроцессор медицинский эндоскопический "PENTAX" (ПЕНТАКС), "PENTAX Medical" (ПЕНТАКС Медикал) ЕРК-і7000, ЕРК-і7010 с принадлежностями

Принадлежности:

Кабели HD-SDI типа OS-A (не более 2 шт.).

SN



HOYA Corporation (ХОЯ Корпорейшн)

Адрес производства: 6-10-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023 Japan/6-10-1

Ниси- Синдзюку, Синдзюку-ку, Токио 160-0023 Япония.

ООО «МИП-Тест»

Россия, 123100, г. Москва, улица Пресненская наб., д.12, этаж 45, комната 10, офис 1

e-mail: mipTest15@yandex.ru

тел. 8(495)978-04-93

Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2012/13385

Видеопроцессор медицинский эндоскопический "PENTAX" (ПЕНТАКС), "PENTAX Medical" (ПЕНТАКС Медикал) ЕРК-і7000, ЕРК-і7010 с принадлежностями

Принадлежности:

Емкость для воды типа OS-H (не более 3 шт.).

SN



HOYA Corporation (ХОЯ Корпорейшн)

Адрес производства: 6-10-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023 Japan/6-10-1

Ниси- Синдзюку, Синдзюку-ку, Токио 160-0023 Япония.

ООО «МИП-Тест»

Россия, 123100, г. Москва, улица Пресненская наб., д.12, этаж 45, комната 10, офис 1

e-mail: mipTest15@yandex.ru

тел. 8(495)978-04-93

Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2012/13385

Видеопроцессор медицинский эндоскопический "PENTAX" (ПЕНТАКС), "PENTAX Medical" (ПЕНТАКС Медикал) ЕРК-і7000, ЕРК-і7010 с принадлежностями

Принадлежности:

Программное обеспечение для процессора Endoimage2 типа OS-I на диске (не более 3 шт.).

SN



HOYA Corporation (ХОЯ Корпорейшн)

Адрес производства: 6-10-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023 Japan/6-10-1

Ниси- Синдзюку, Синдзюку-ку, Токио 160-0023 Япония.

ООО «МИП-Тест»

Россия, 123100, г. Москва, улица Пресненская наб., д.12, этаж 45, комната 10, офис 1

e-mail: mipTest15@yandex.ru

тел. 8(495)978-04-93

Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2012/13385

Видеопроцессор медицинский эндоскопический "PENTAX" (ПЕНТАКС), "PENTAX Medical" (ПЕНТАКС Медикал) ЕРК-і7000, ЕРК-і7010 с принадлежностями

Принадлежности:

Кабели заземления типа OL-Z (не более 2 шт.).

SN



HOYA Corporation (ХОЯ Корпорейшн)

Адрес производства: 6-10-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023 Japan/6-10-1

Ниси- Синдзюку, Синдзюку-ку, Токио 160-0023 Япония.

ООО «МИП-Тест»

Россия, 123100, г. Москва, улица Пресненская наб., д.12, этаж 45, комната 10, офис 1

e-mail: mipTest15@yandex.ru

тел. 8(495)978-04-93

Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2012/13385

Видеопроцессор медицинский эндоскопический "PENTAX" (ПЕНТАКС), "PENTAX Medical" (ПЕНТАКС Медикал) ЕРК-і7000, ЕРК-і7010 с принадлежностями

Принадлежности:

Кабель сетевой.

SN



HOYA Corporation (ХОЯ Корпорейшн)

Адрес производства: 6-10-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023 Japan/6-10-1

Ниси- Синдзюку, Синдзюку-ку, Токио 160-0023 Япония.

ООО «МИП-Тест»

Россия, 123100, г. Москва, улица Пресненская наб., д.12, этаж 45, комната 10, офис 1

e-mail: mipTest15@yandex.ru

тел. 8(495)978-04-93

Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2012/13385

Видеопроцессор медицинский эндоскопический "PENTAX" (ПЕНТАКС), "PENTAX Medical" (ПЕНТАКС Медикал) ЕРК-і7000, ЕРК-і7010 с принадлежностями

Принадлежности:

Предохранители (не более 10 шт.).

SN



HOYA Corporation (ХОЯ Корпорейшн)

Адрес производства: 6-10-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023 Japan/6-10-1 Ниси- Синдзюку, Синдзюку-ку, Токио 160-0023 Япония.

ООО «МИП-Тест»

Россия, 123100, г. Москва, улица Пресненская наб., д.12, этаж 45, комната 10, офис 1

e-mail: mipTest15@yandex.ru

тел. 8(495)978-04-93

Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2012/13385

Видеопроцессор медицинский эндоскопический "PENTAX" (ПЕНТАКС), "PENTAX Medical" (ПЕНТАКС Медикал) ЕРК-і7000, ЕРК-і7010 с принадлежностями

Принадлежности:

Педали управления типа OS-A (не более 2 шт.).

SN



HOYA Corporation (ХОЯ Корпорейшн)

Адрес производства: 6-10-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023 Japan/6-10-1 Ниси- Синдзюку, Синдзюку-ку, Токио 160-0023 Япония.

ООО «МИП-Тест»

Россия, 123100, г. Москва, улица Пресненская наб., д.12, этаж 45, комната 10, офис 1

e-mail: mipTest15@yandex.ru

тел. 8(495)978-04-93

Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2012/13385

Видеопроцессор медицинский эндоскопический "PENTAX" (ПЕНТАКС), "PENTAX Medical" (ПЕНТАКС Медикал) ЕРК-і7000, ЕРК-і7010 с принадлежностями

Принадлежности:

Лампы с картрижем типа ROL-X (не более 3 шт.).

SN



HOYA Corporation (ХОЯ Корпорейшн)

Адрес производства: 6-10-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023 Japan/6-10-1 Ниси- Синдзюку, Синдзюку-ку, Токио 160-0023 Япония.

ООО «МИП-Тест»

Россия, 123100, г. Москва, улица Пресненская наб., д.12, этаж 45, комната 10, офис 1

e-mail: mipTest15@yandex.ru

тел. 8(495)978-04-93

Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2012/13385

Видеопроцессор медицинский эндоскопический "PENTAX" (ПЕНТАКС), "PENTAX Medical" (ПЕНТАКС Медикал) ЕРК-і7000, ЕРК-і7010 с принадлежностями

Принадлежности:

Лампы типа ROL-X (не более 3 шт.).

SN



HOYA Corporation (ХОЯ Корпорейшн)

Адрес производства: 6-10-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023 Japan/6-10-1 Ниси- Синдзюку, Синдзюку-ку, Токио 160-0023 Япония.


ООО «МИП-Тест»

Россия, 123100, г. Москва, улица Пресненская наб., д.12, этаж 45, комната 10, офис 1

e-mail: mipTest15@yandex.ru

тел. 8(495)978-04-93

Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2012/і3385

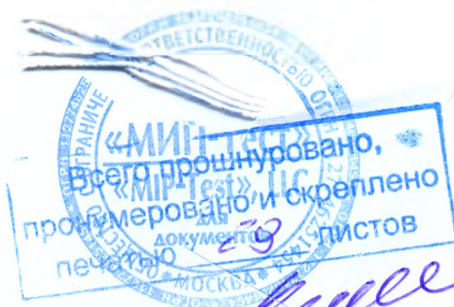

Сидорова