

"УТВЕРЖДАЮ

Менеджер по управлению процессами
регистрации и сертификации России и СНГ

ООО «ДжиИ Хэлскеа»
И.А. Суханов
2017




**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**


**" Система ультразвуковая диагностическая медицинская
Venue 50 с принадлежностями"**

I. Система ультразвуковая диагностическая медицинская Venue 50:

1. Консоль для системы ультразвуковой диагностической медицинской Venue 50.

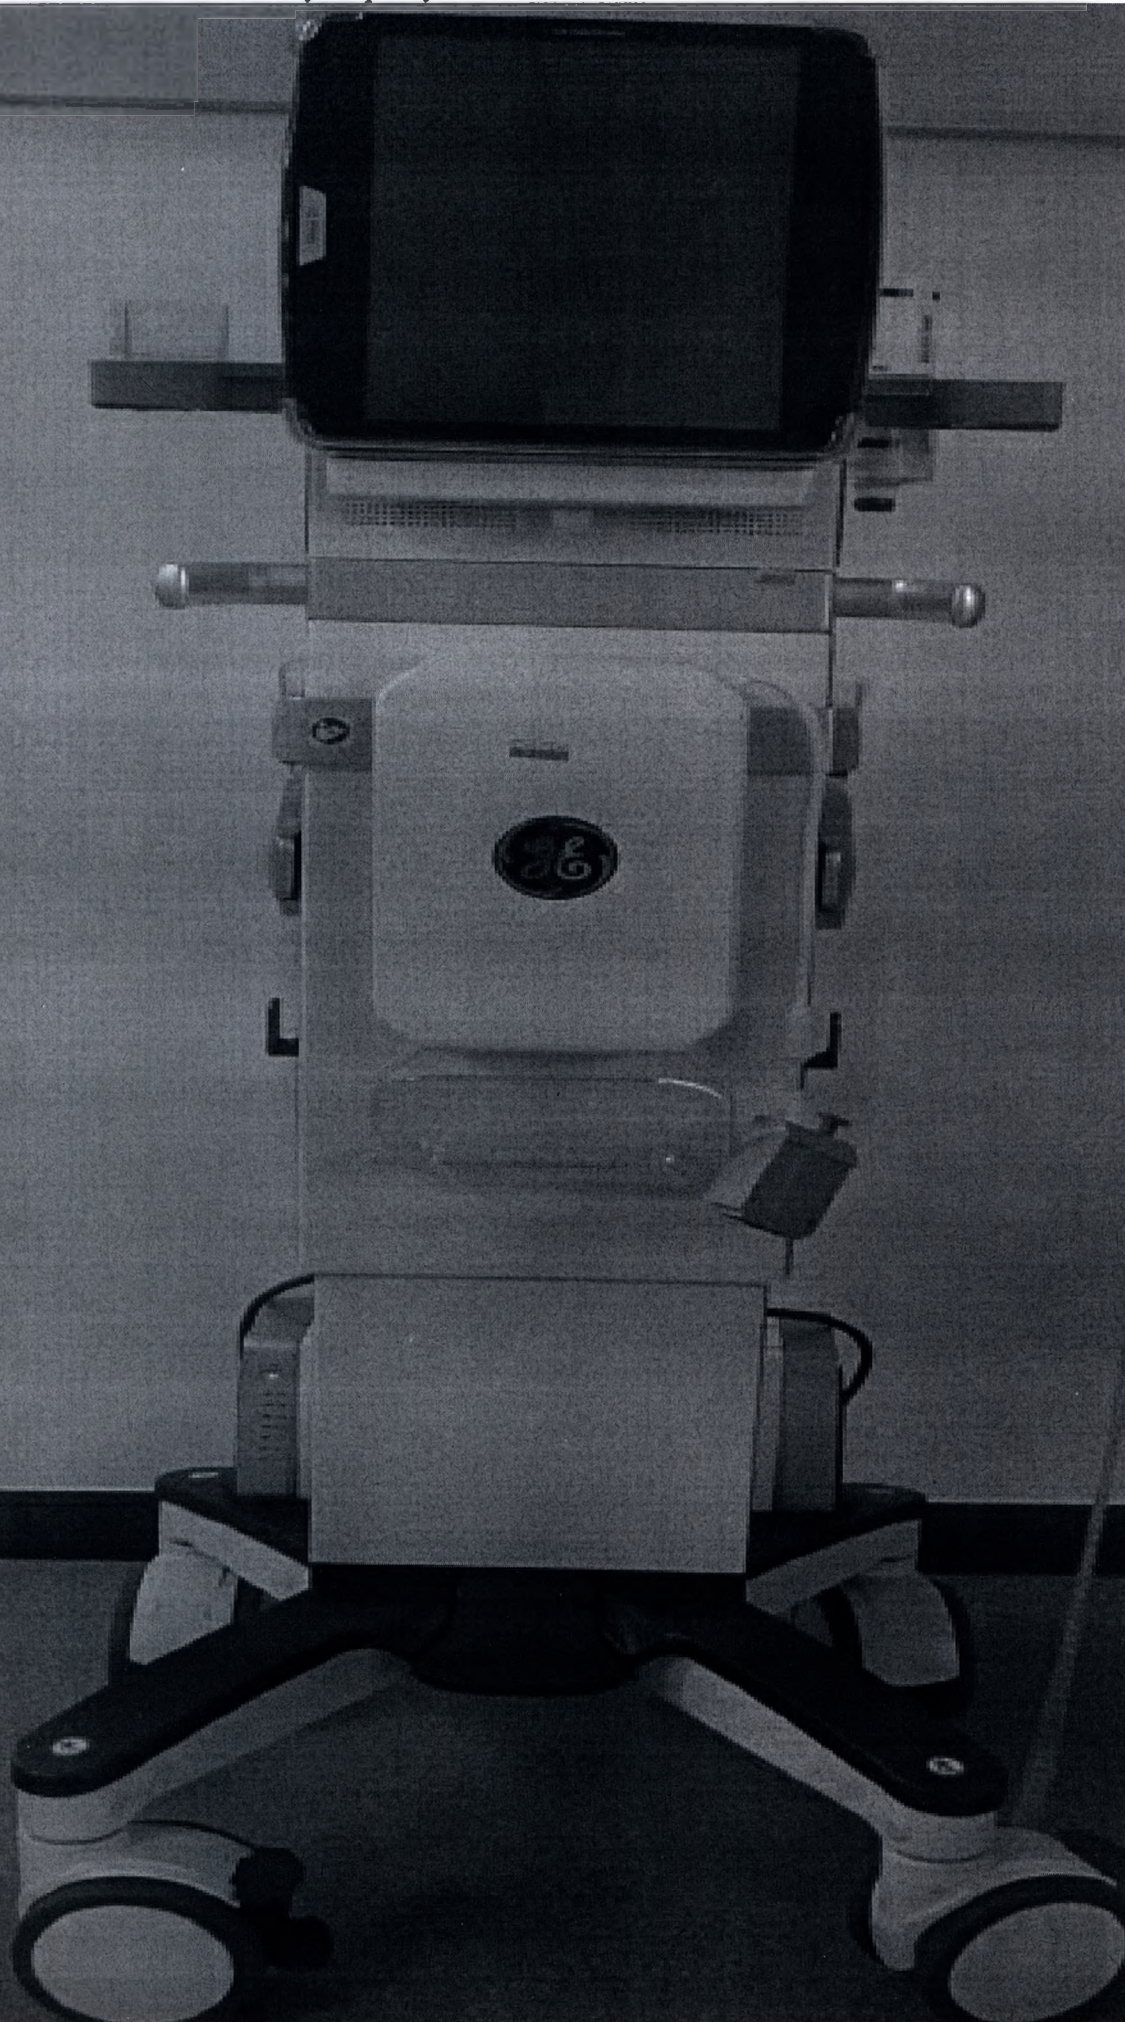

2. Кабель электропитания для системы ультразвуковой диагностической медицинской

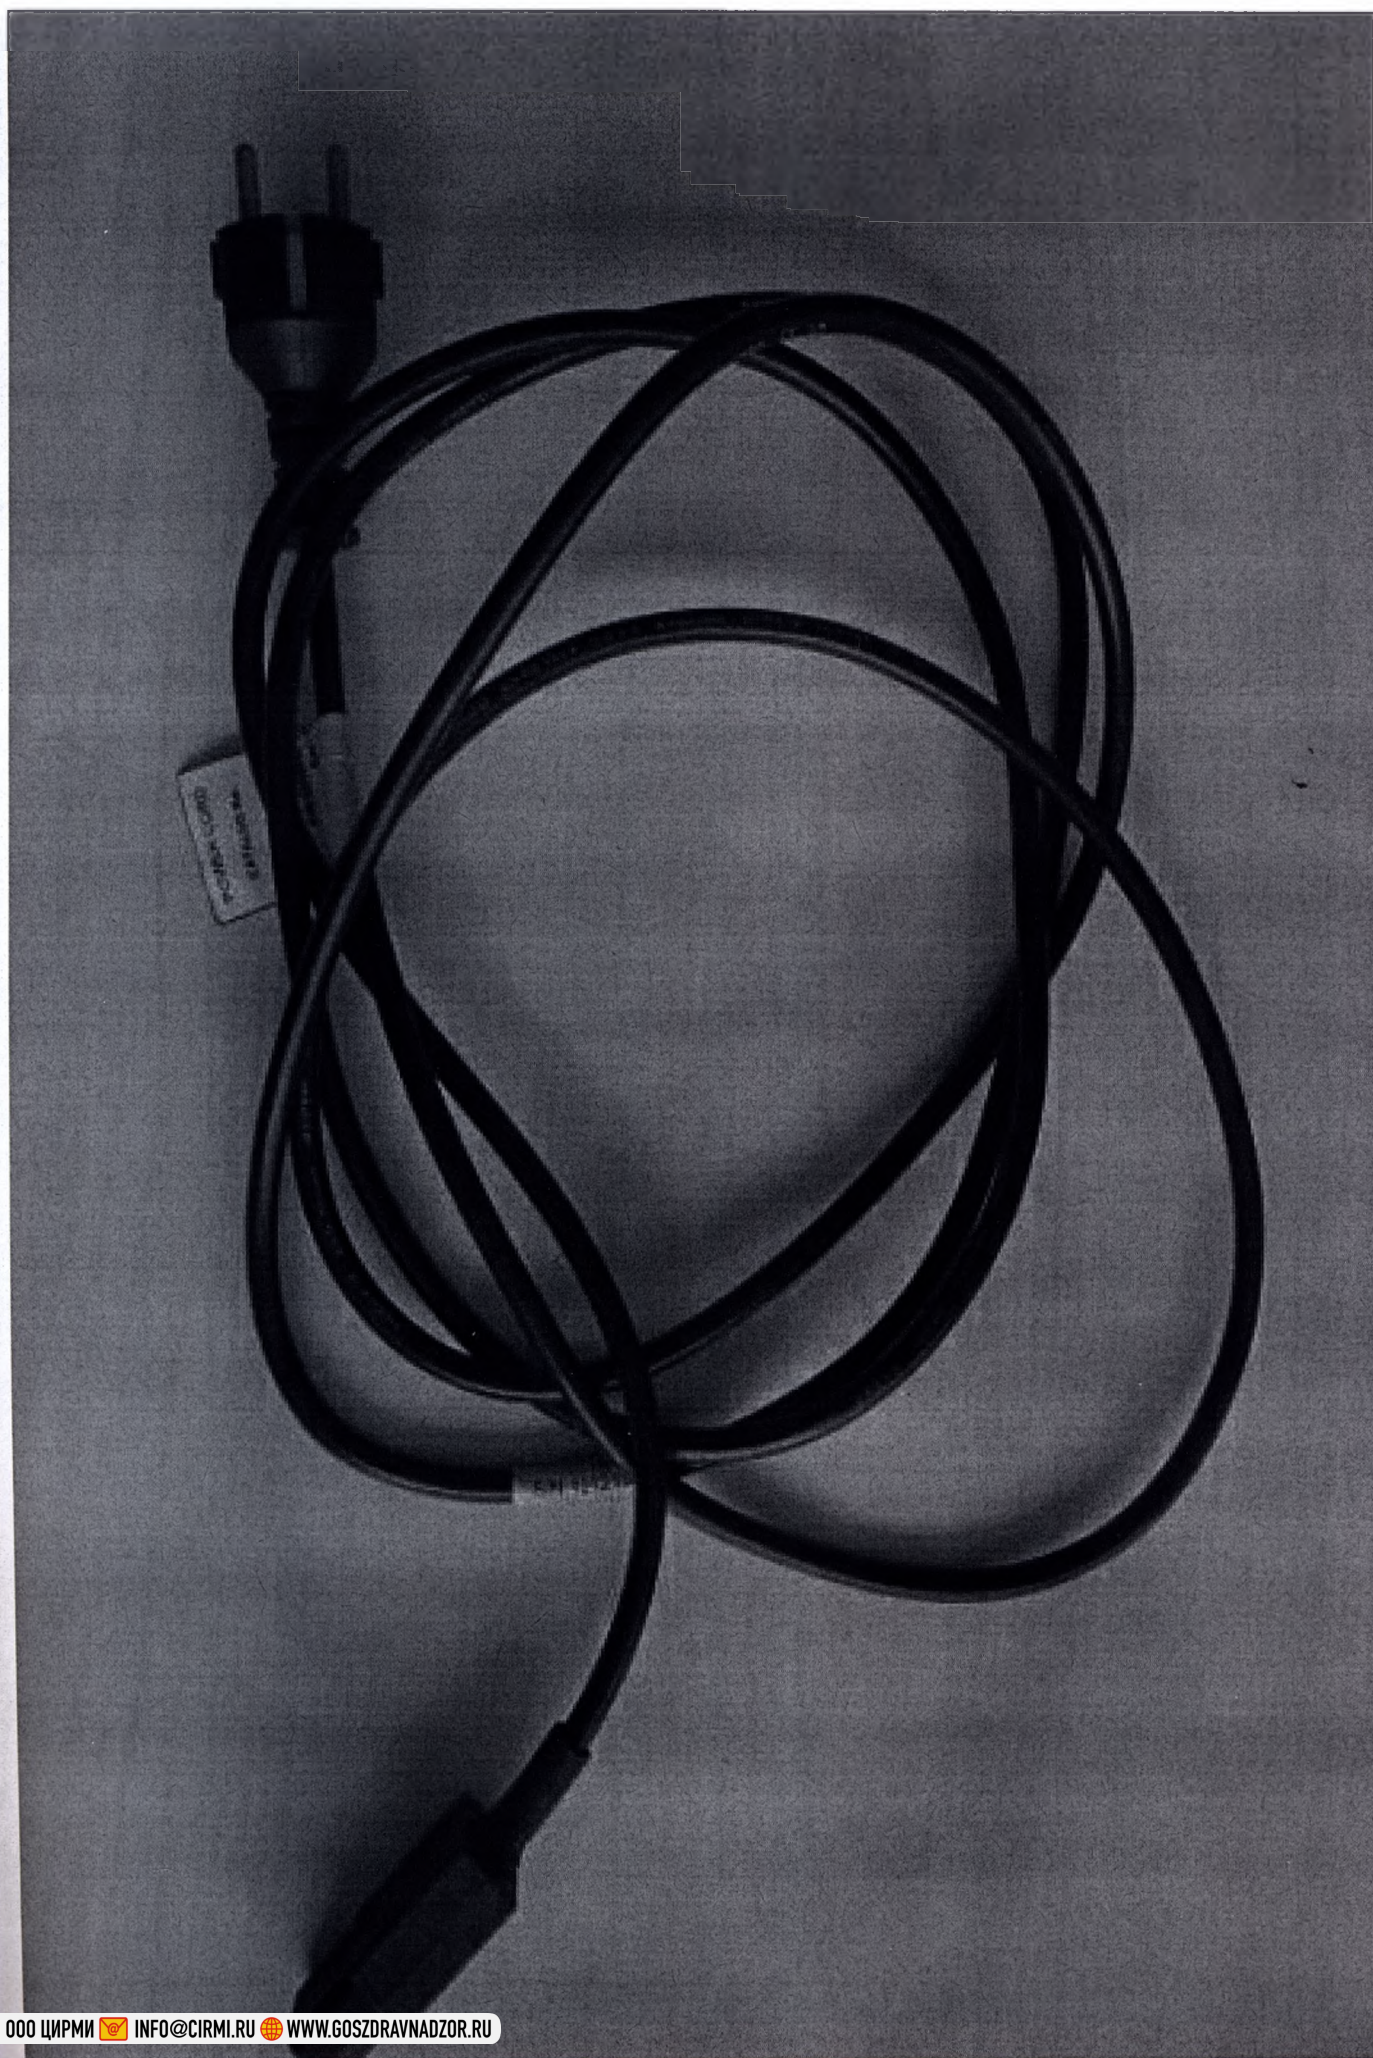




GE

Venue 50


Basic User Manual

Direction. 5589758 -100

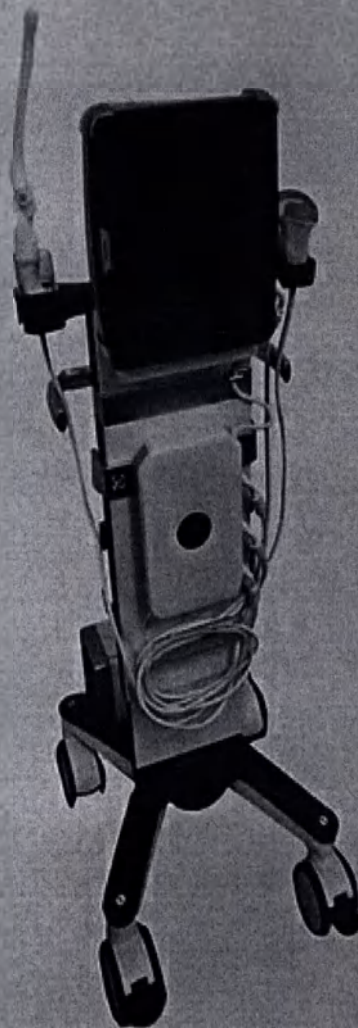


II. Принадлежности:


1. Датчики конвексные серии С. (не более 2 шт.)

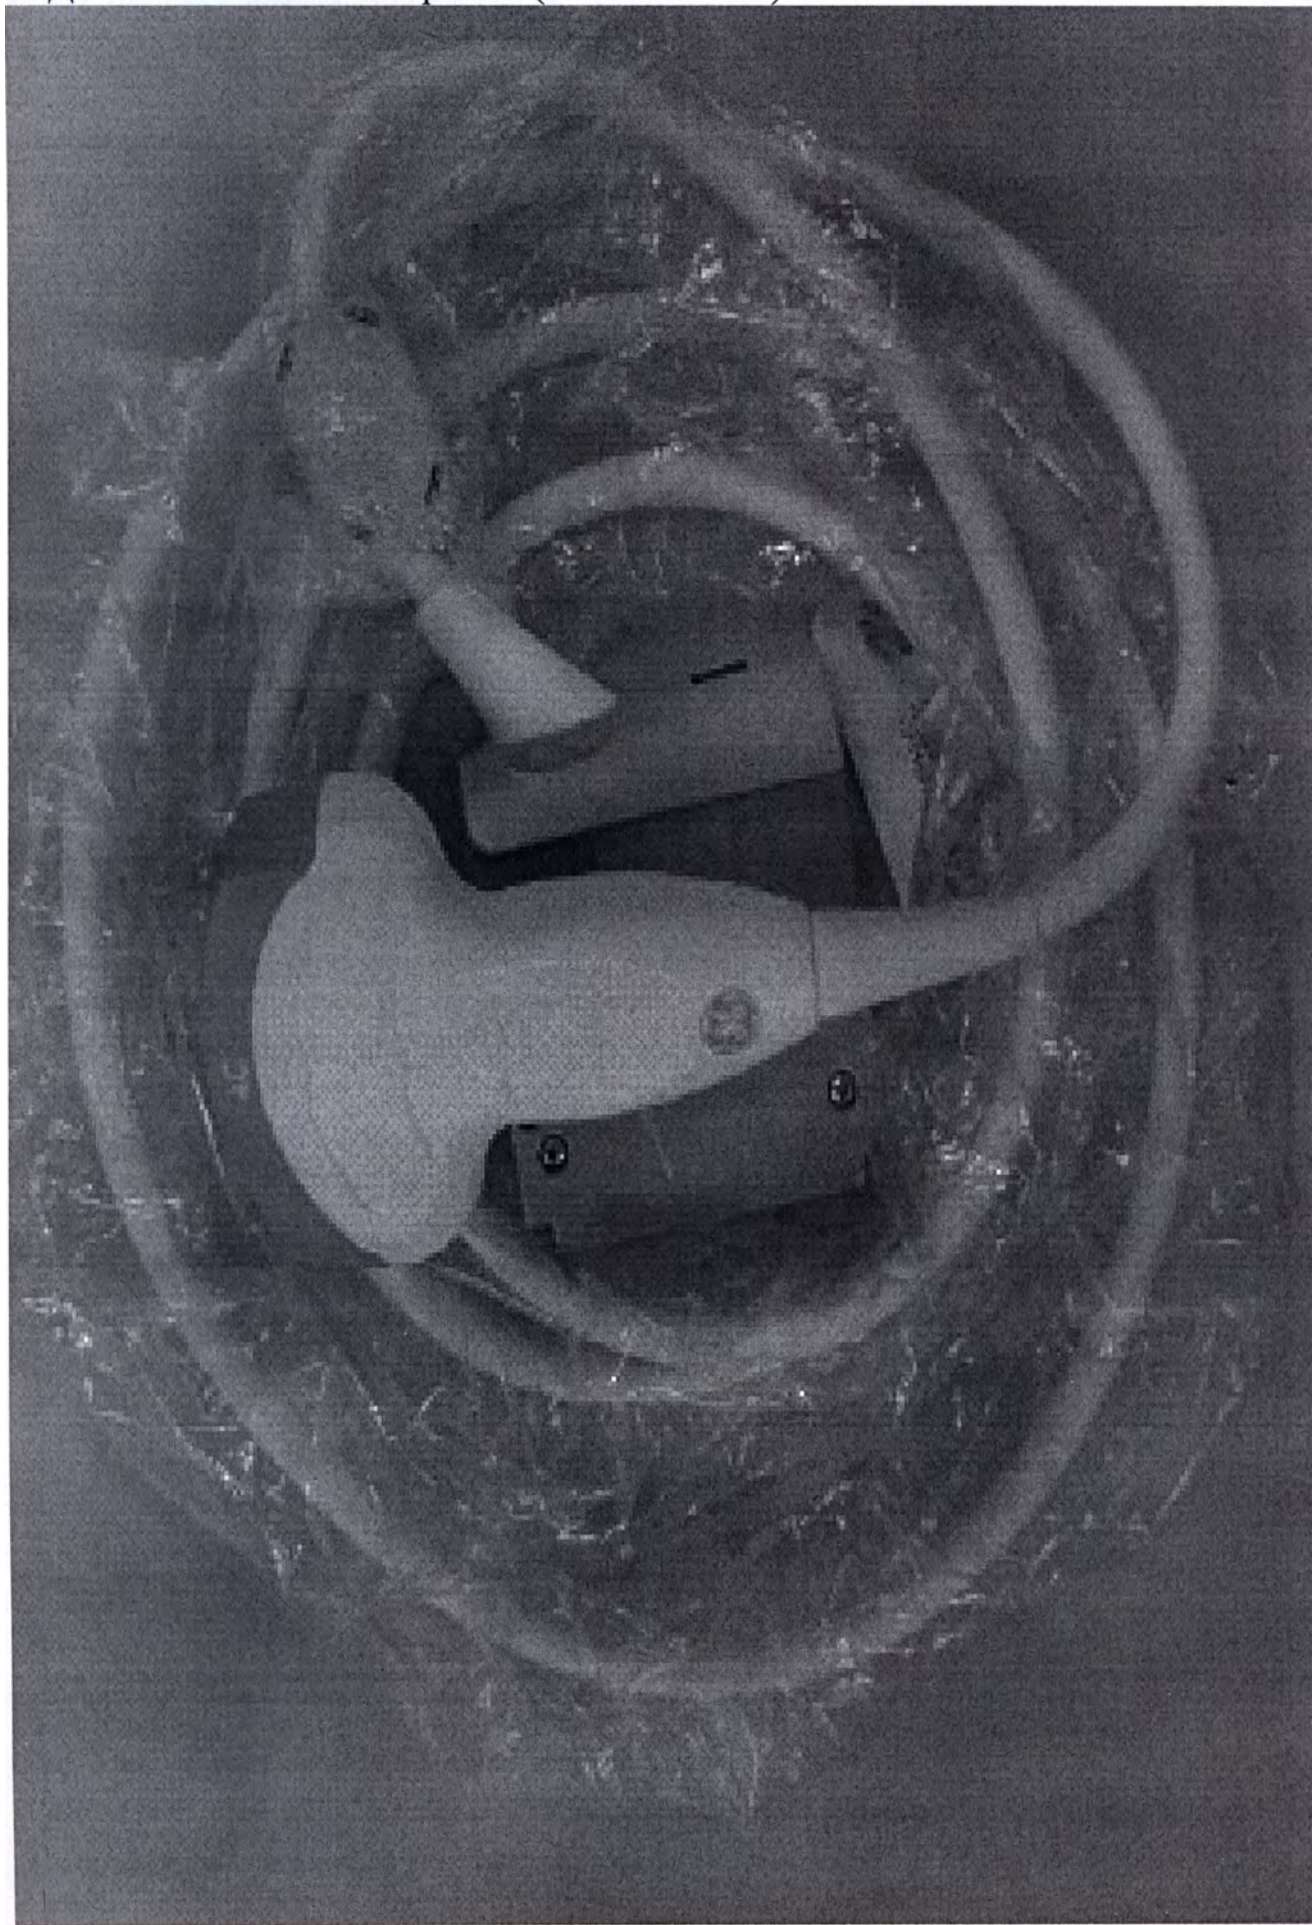


2. Конвексный датчик 4С-SC

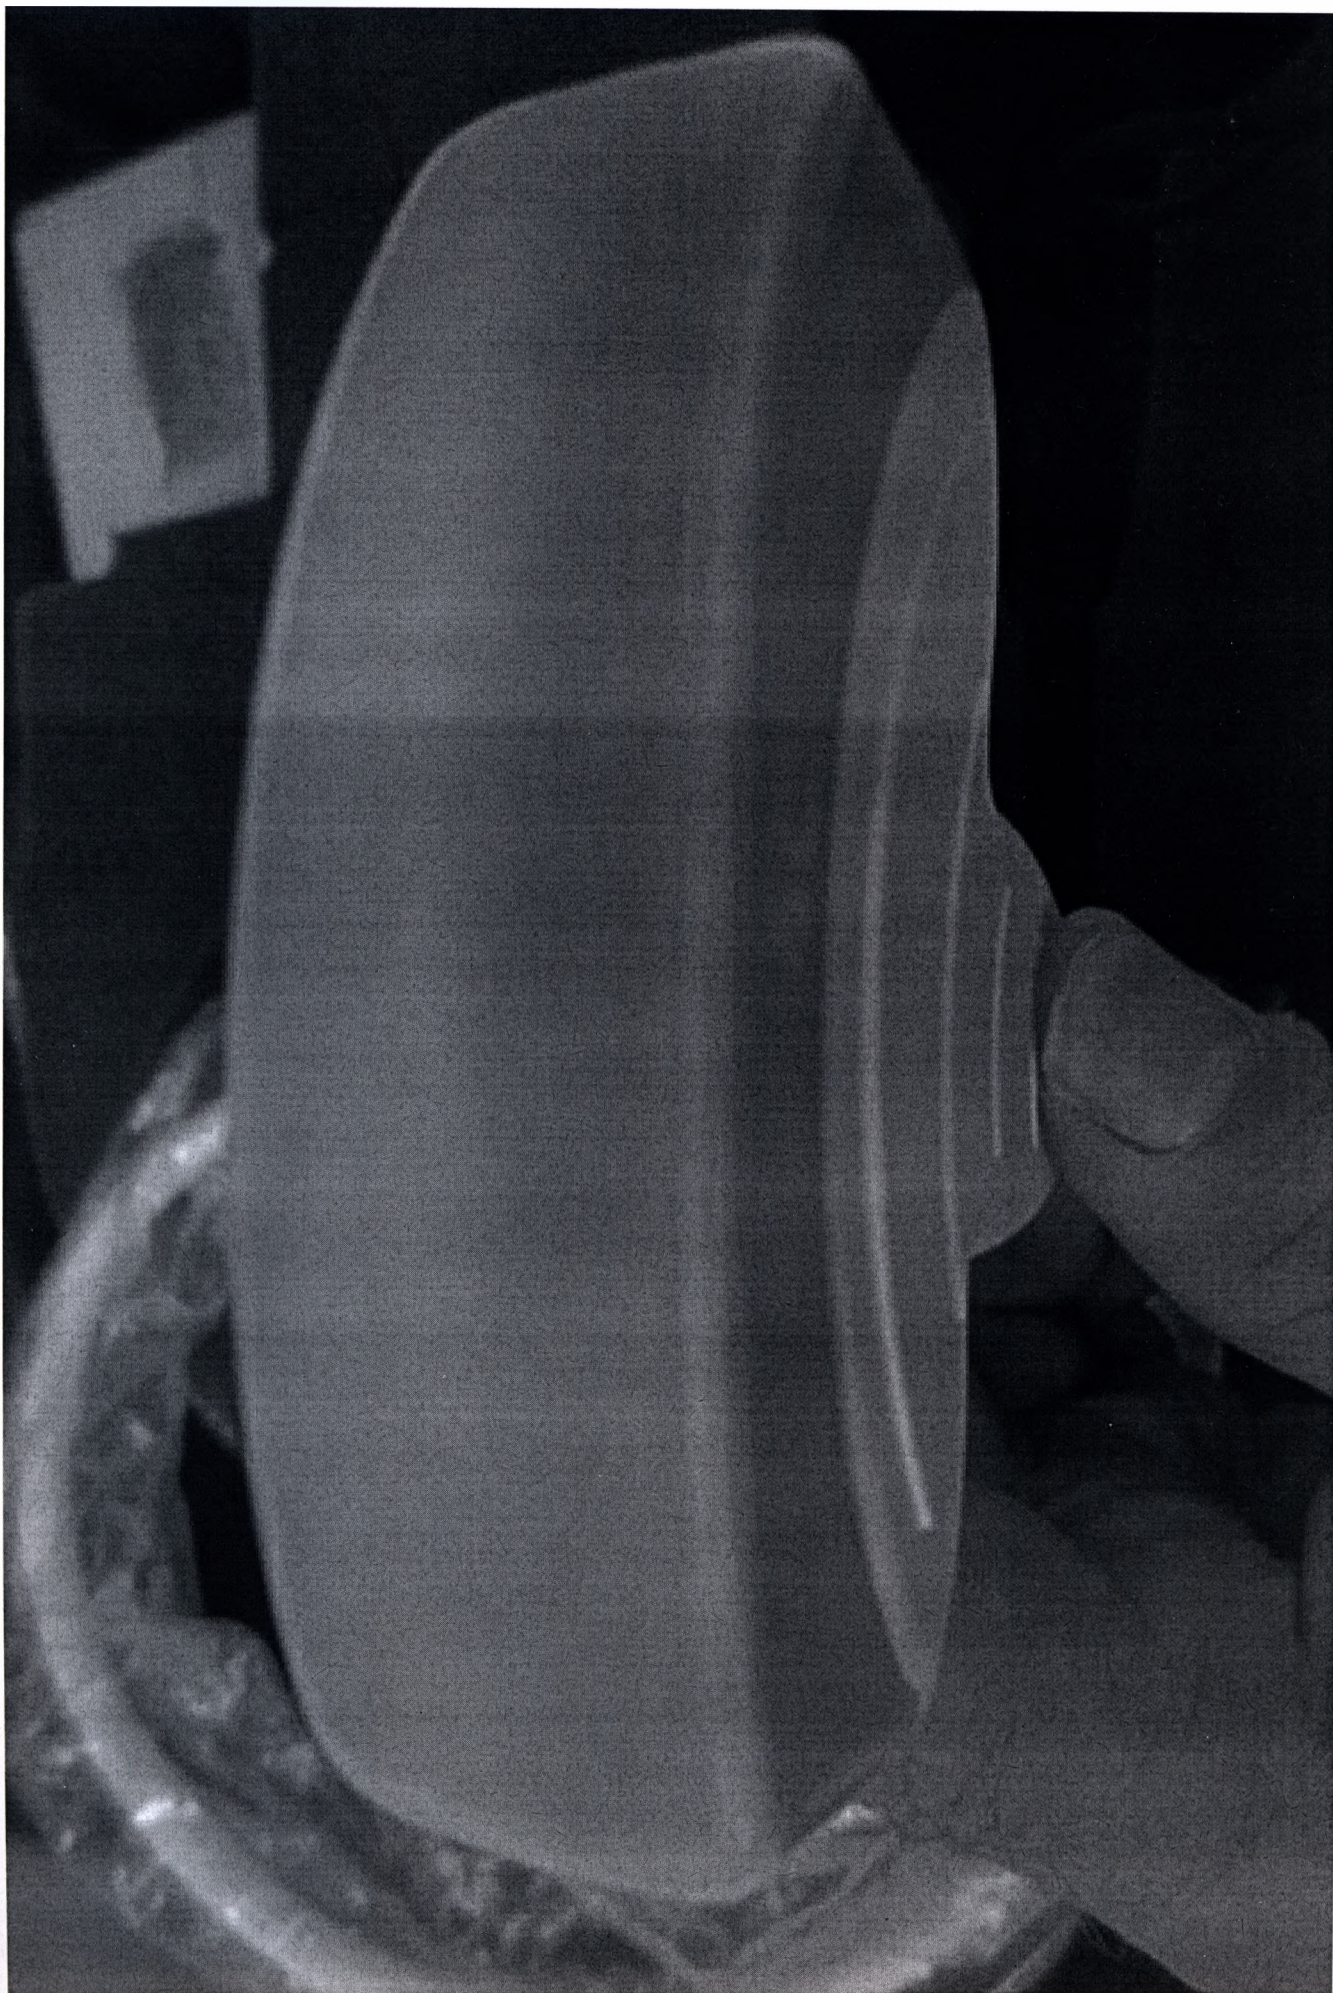


3. Насадка биопсийная для датчиков конвексных 4С-SC.

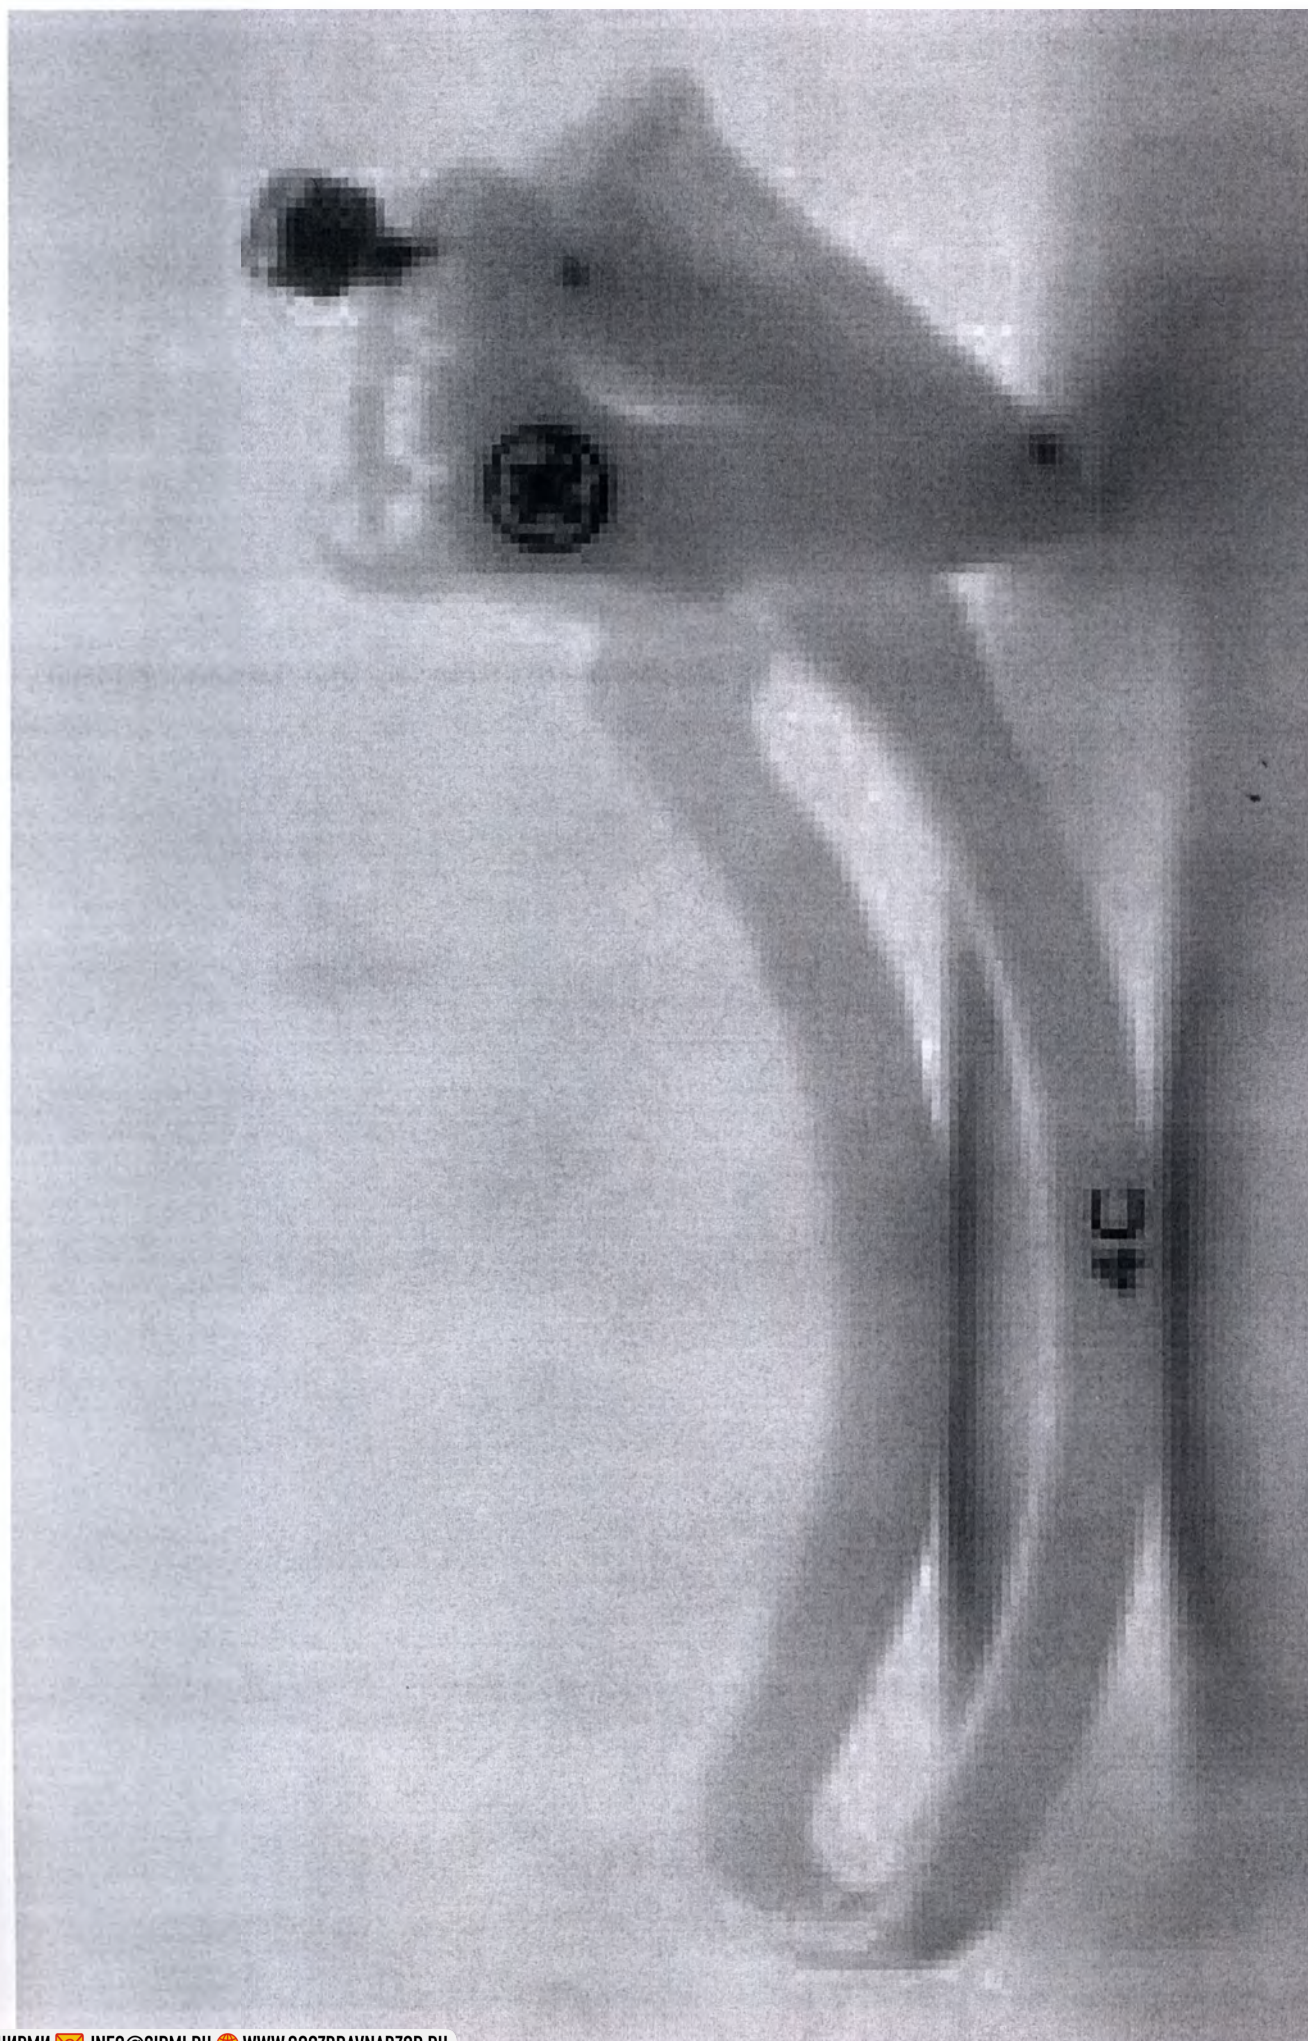


4. Датчики микроконвексные серии С (не более 2 шт.)

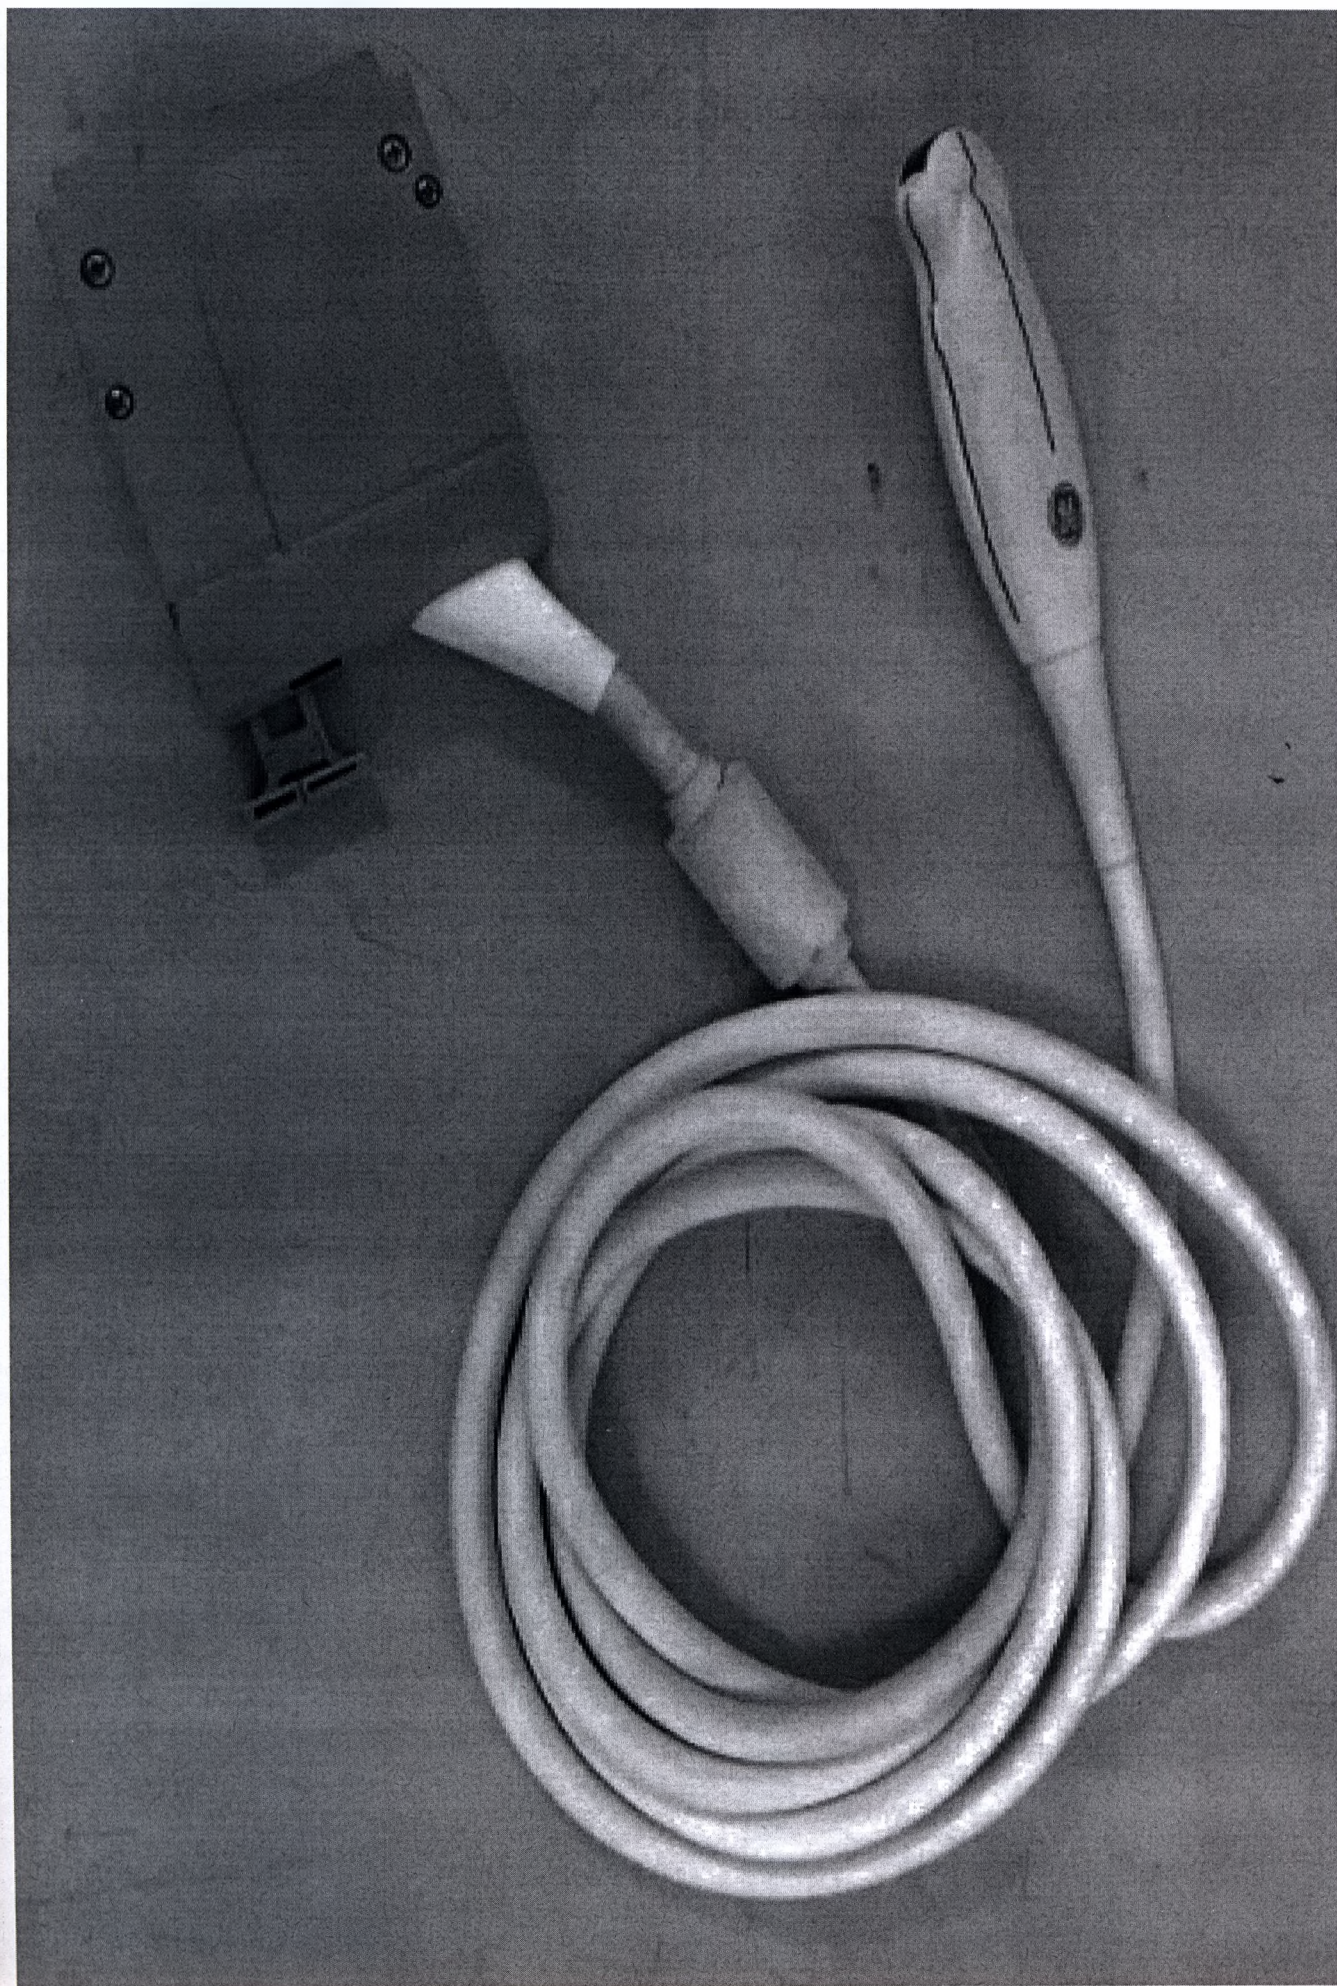

5. Датчик микроконвексный 10С-SC

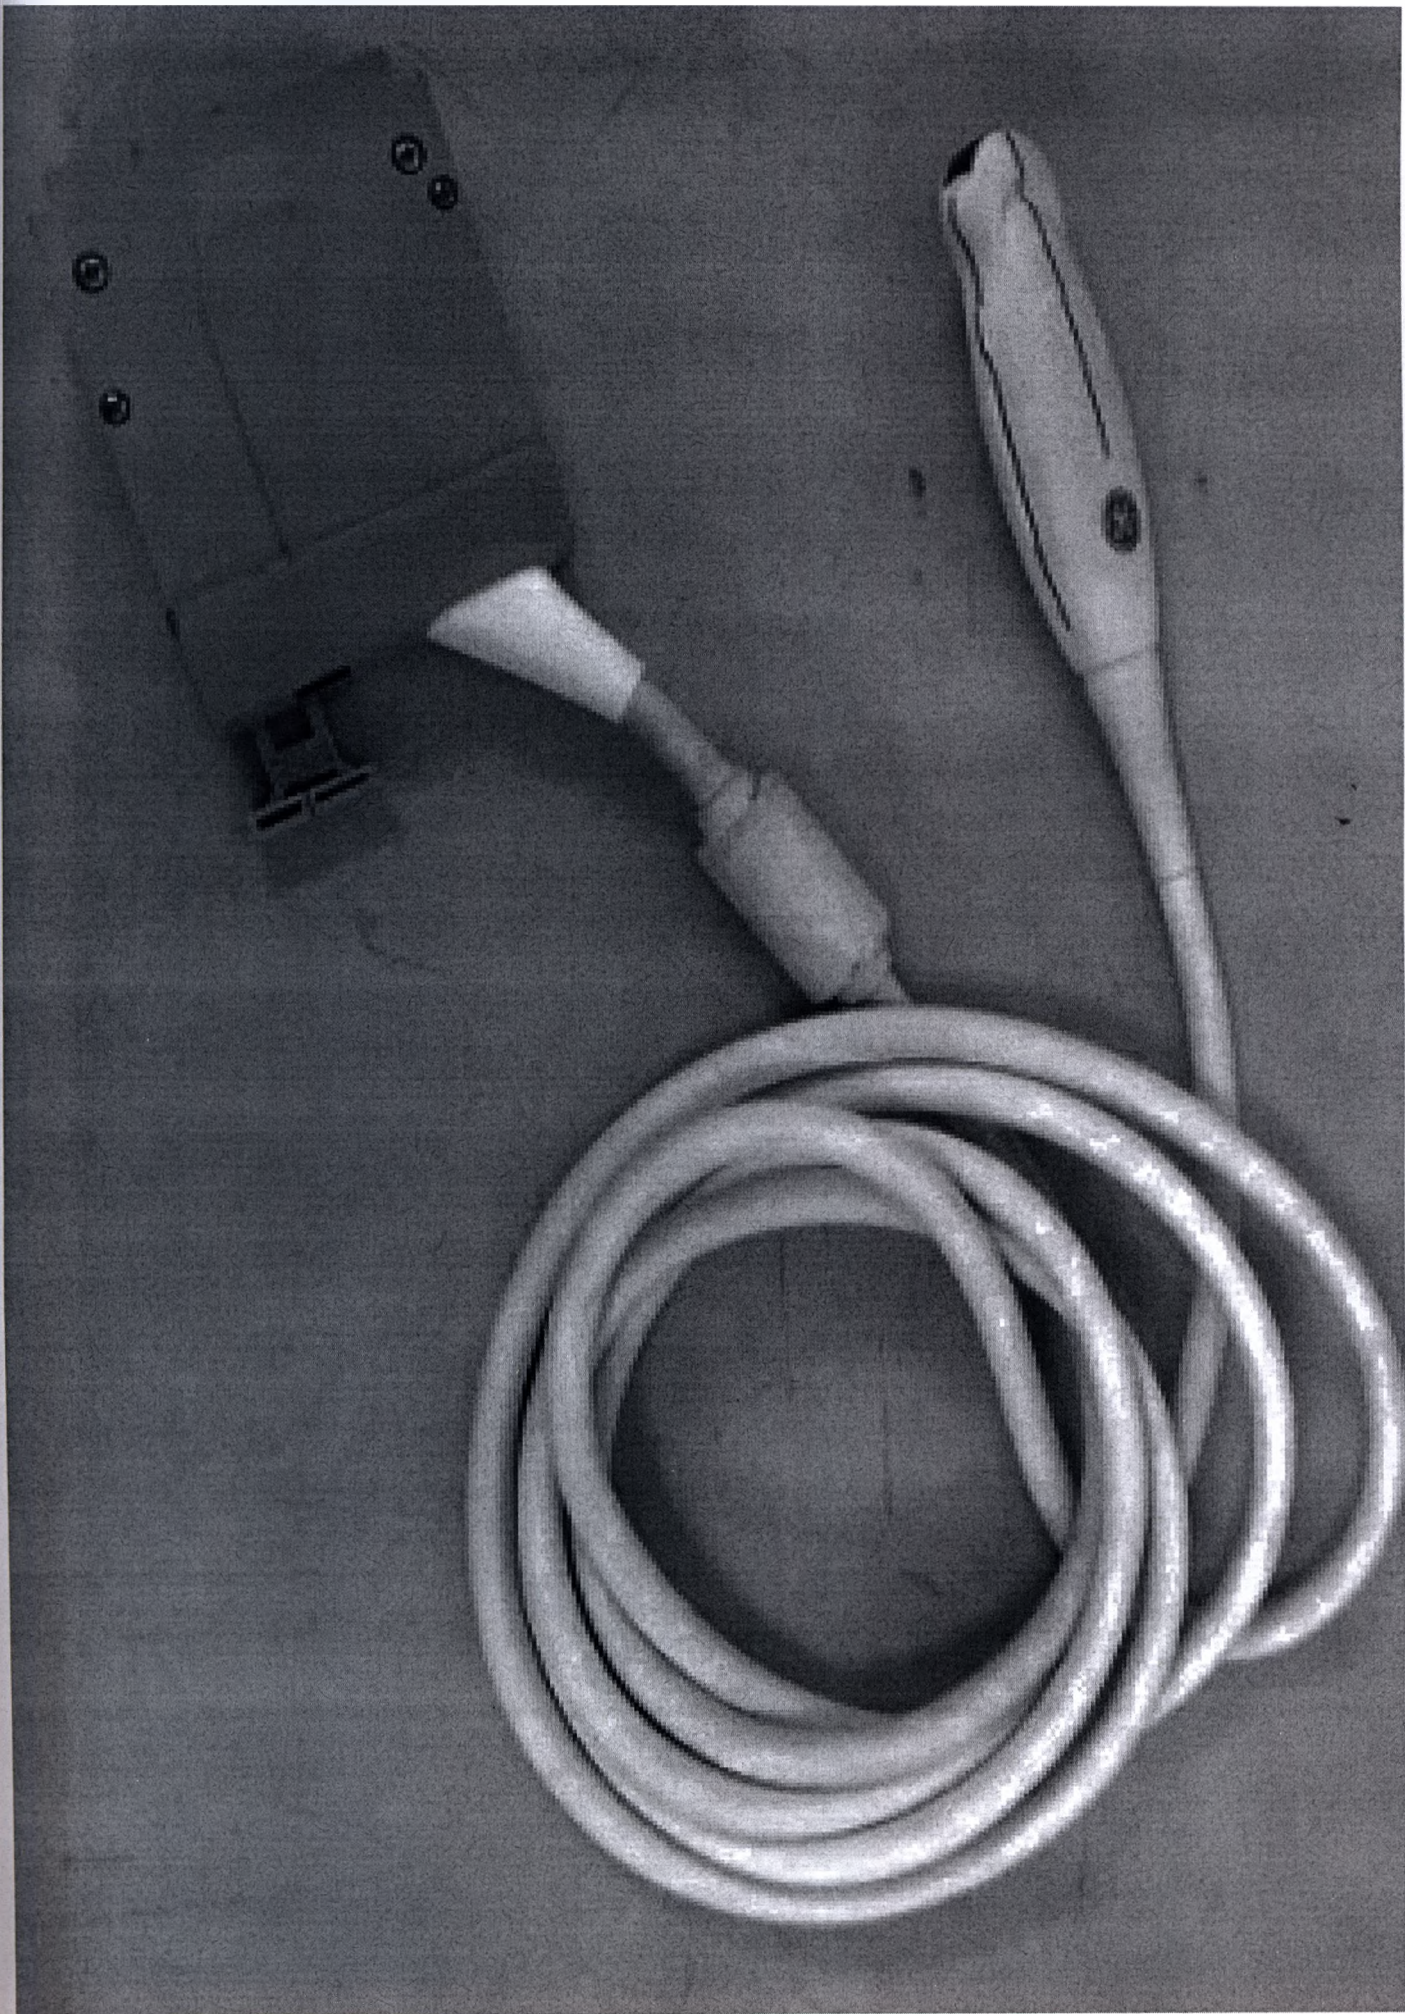


6. Датчик микроконвексный внутриполостной E8CS-SC

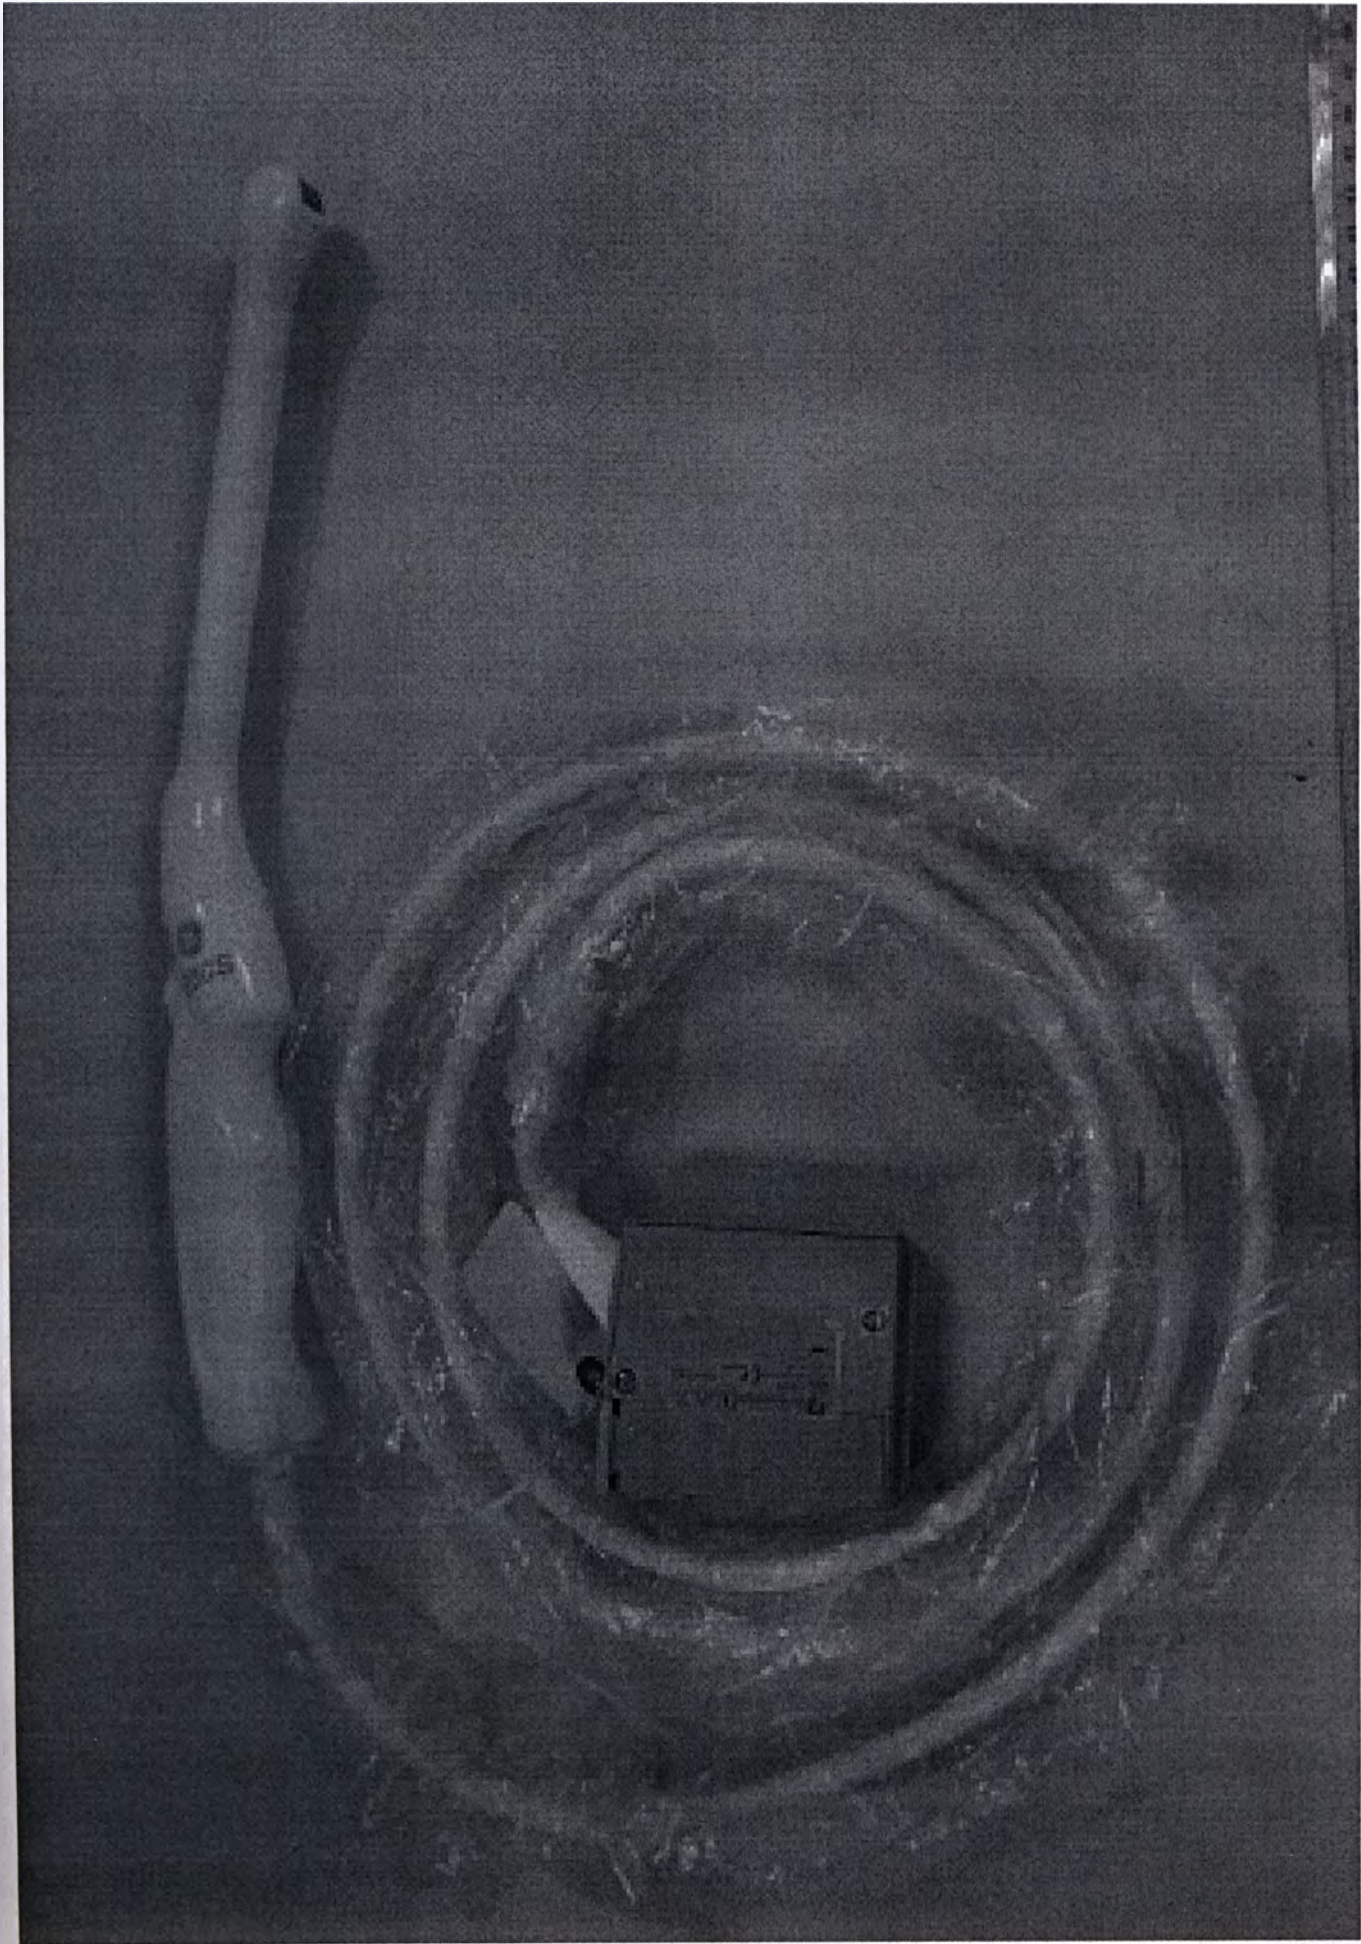


7. Насадки биопсийные для датчиков микроконвексных. (не более 2 шт.)




8. Датчики секторные фазированные серии S. (не более 2 шт.)

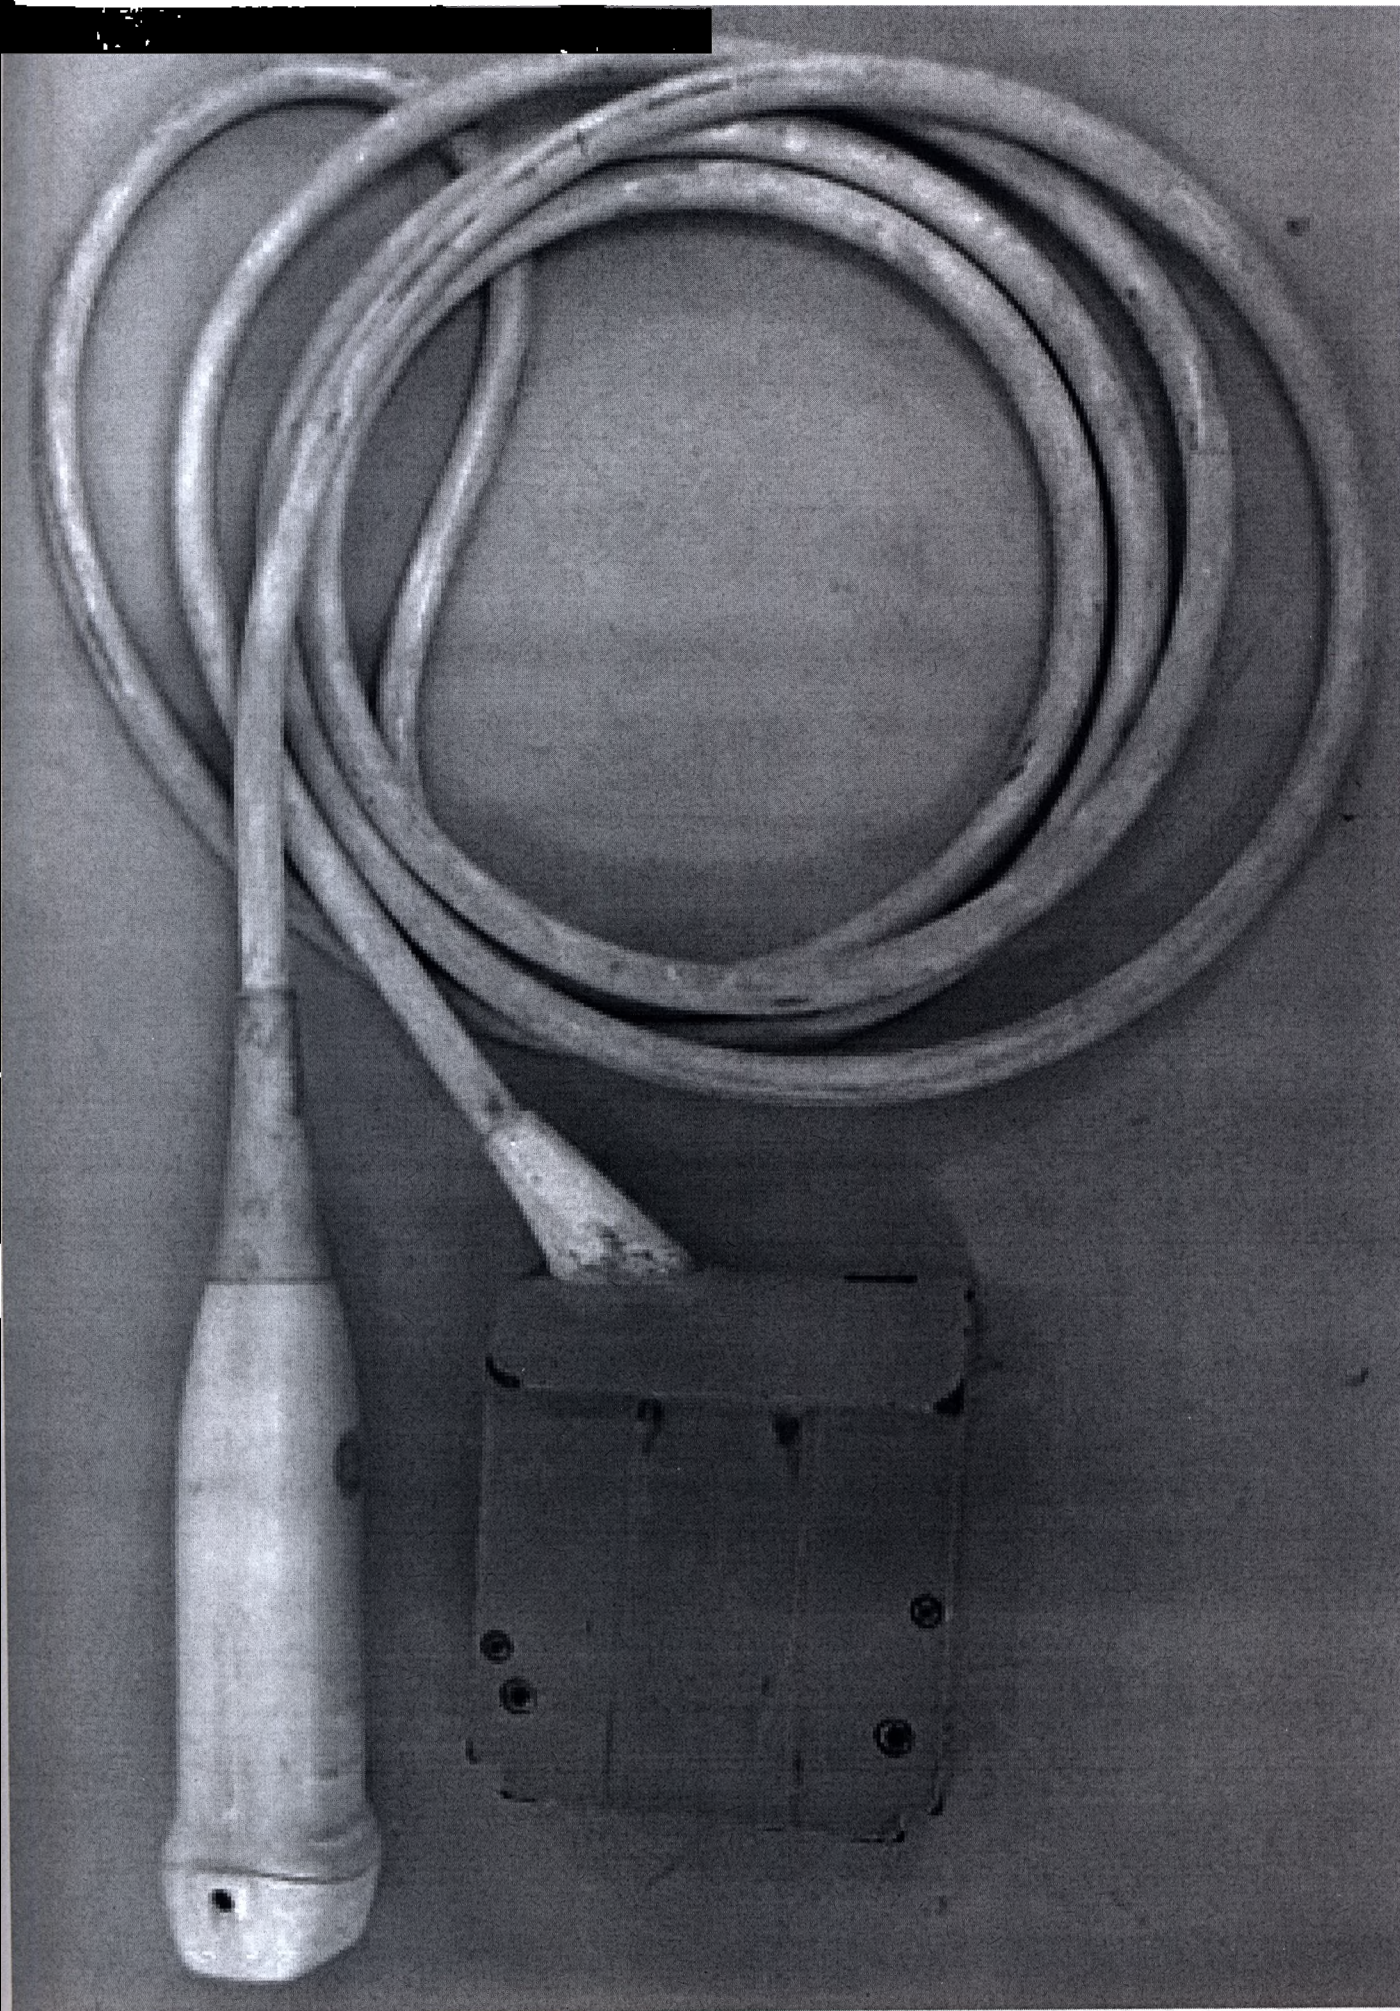


9. Датчик секторный фазированный 3S-SC

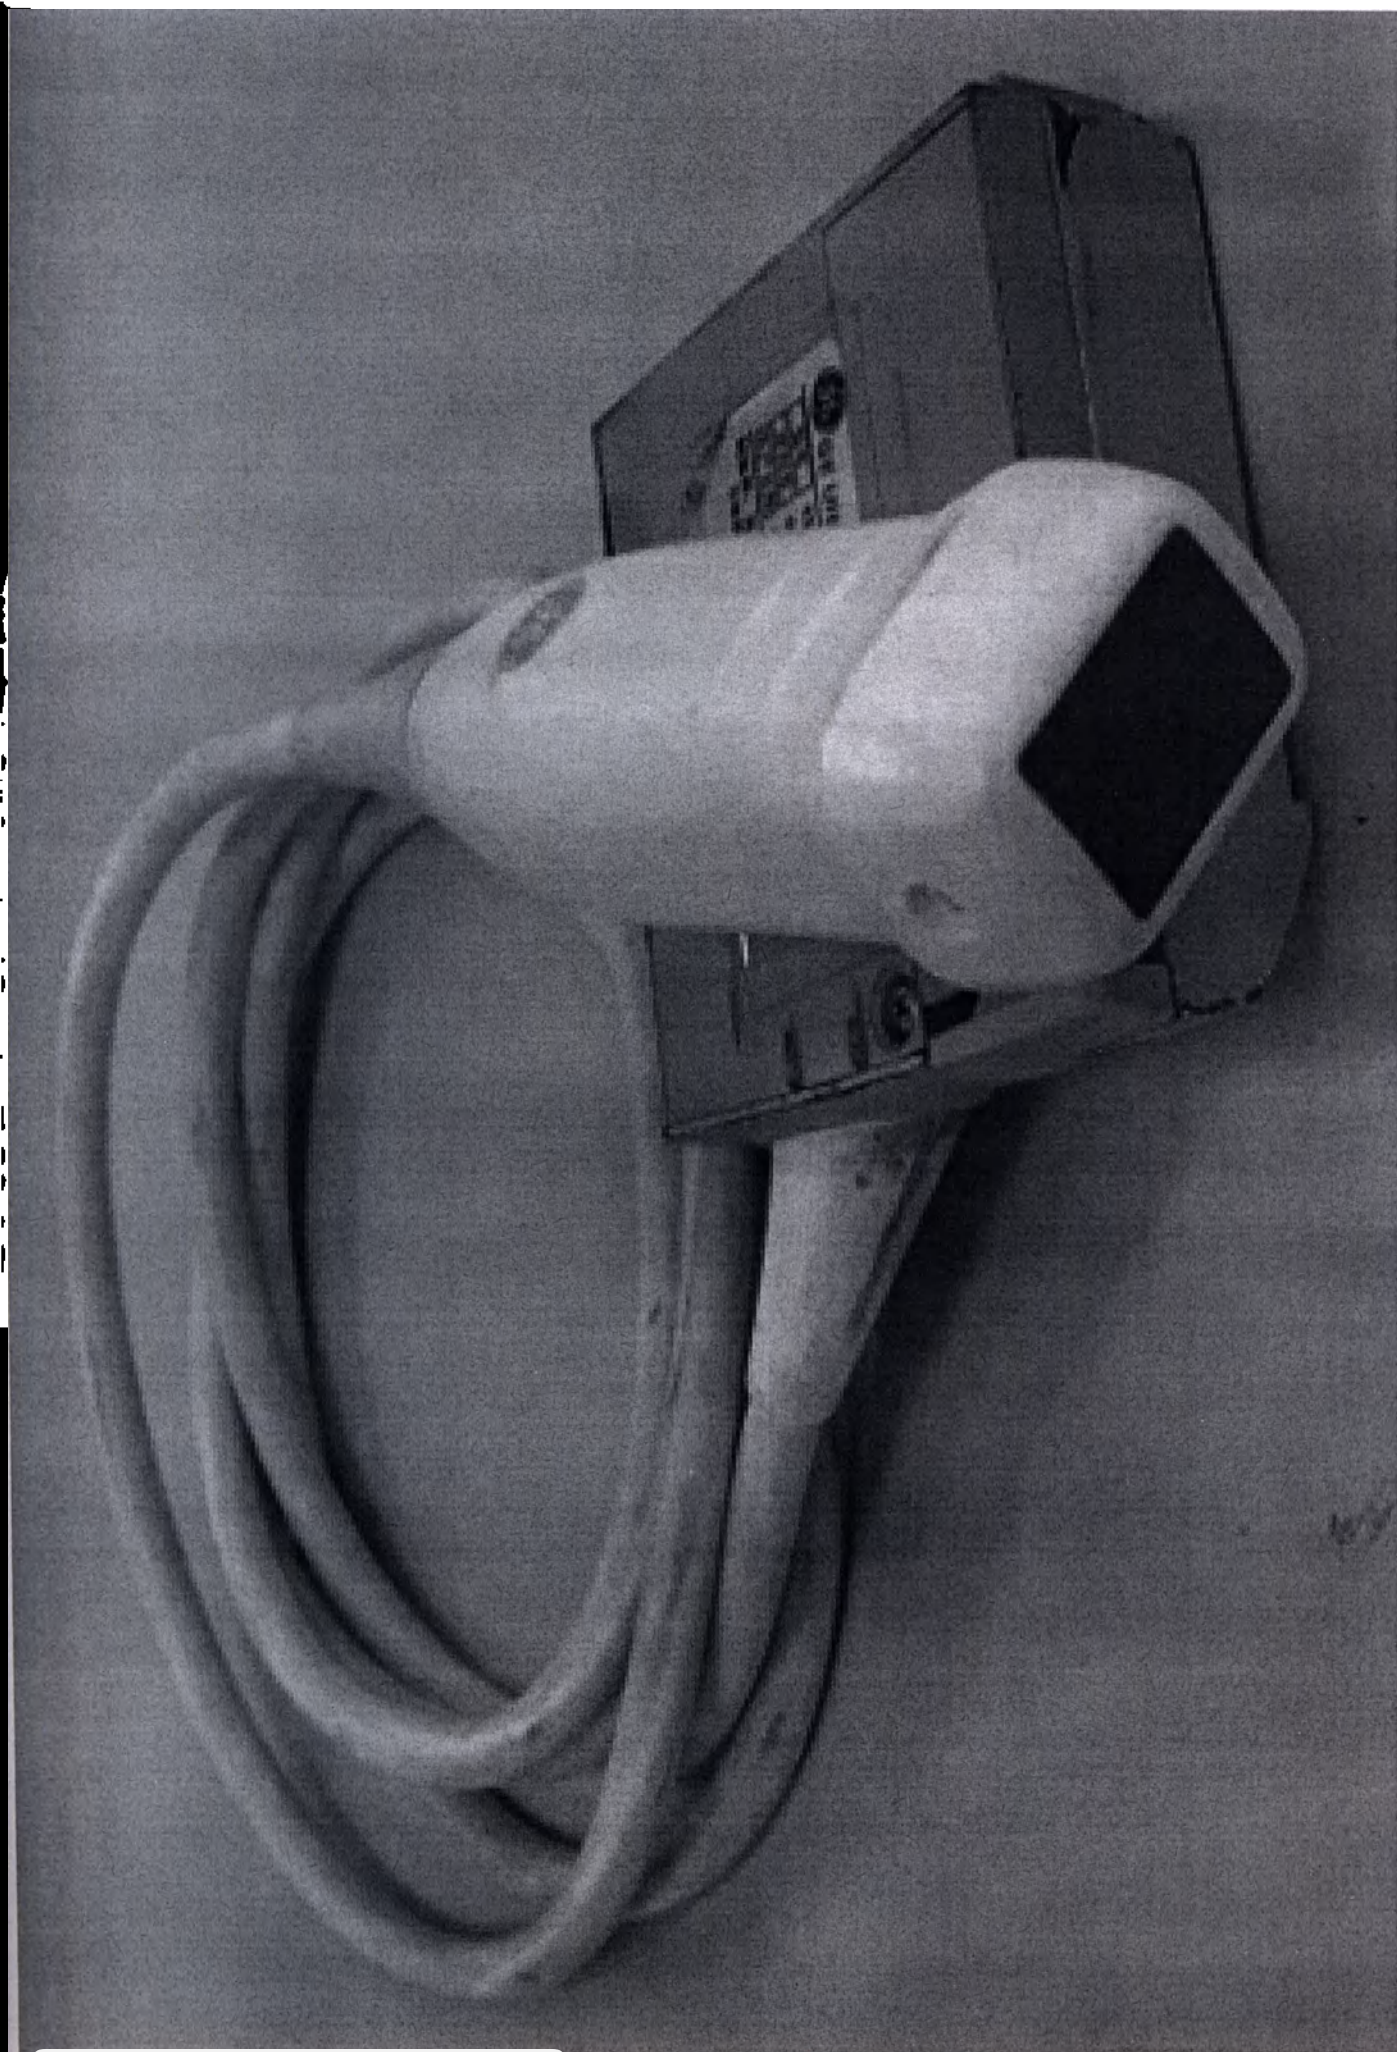


10. Насадка биопсийная для датчиков секторных фазированных 3S-SC

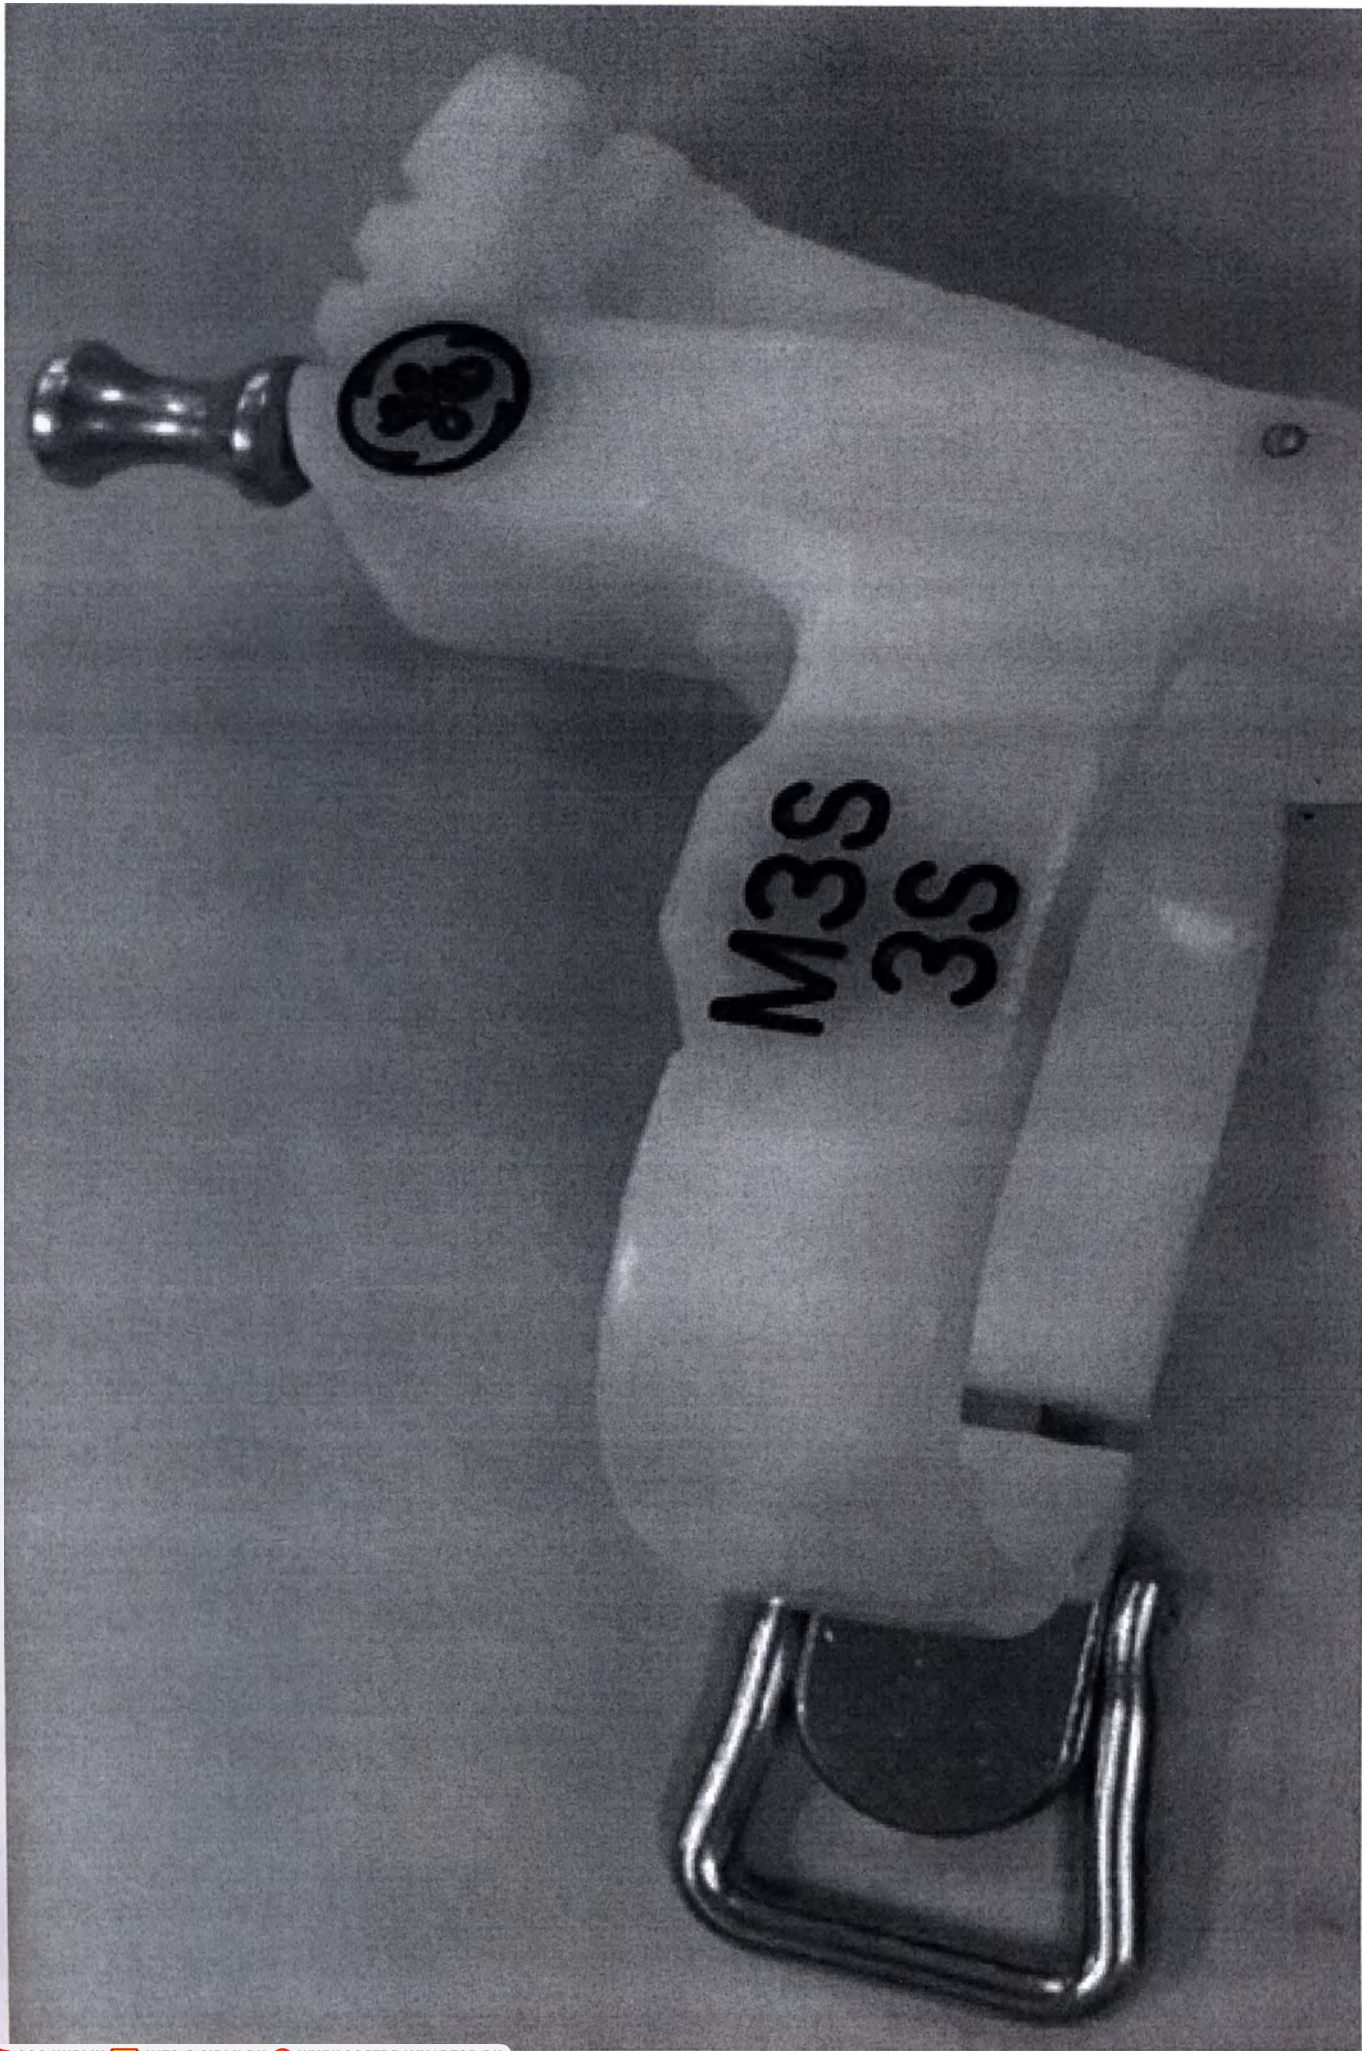

11. Датчики линейные серии L. (не более 3 шт.)

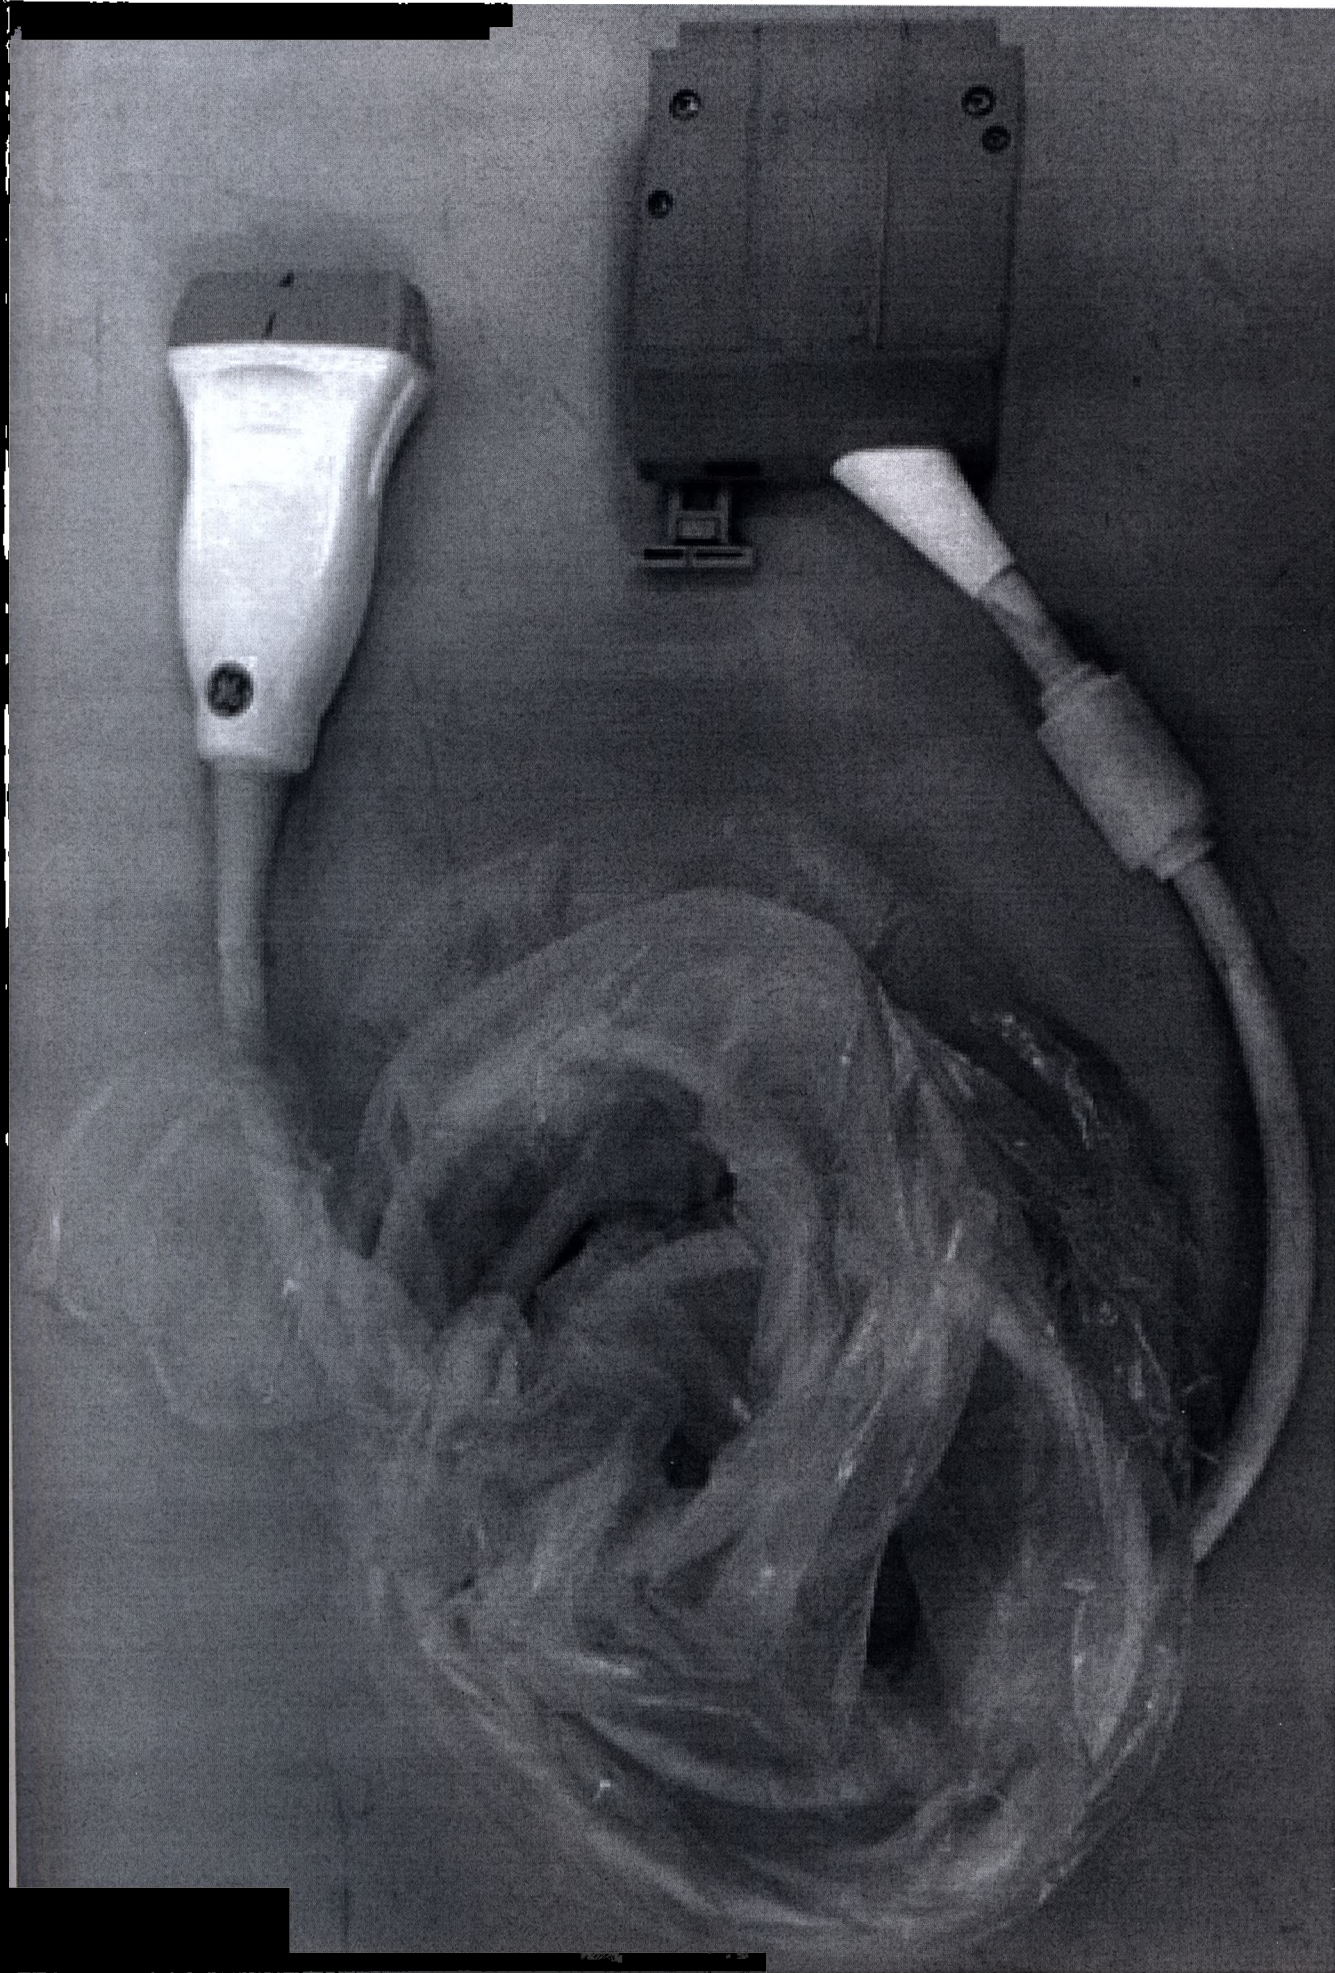


12. Датчик линейный 12L-SC

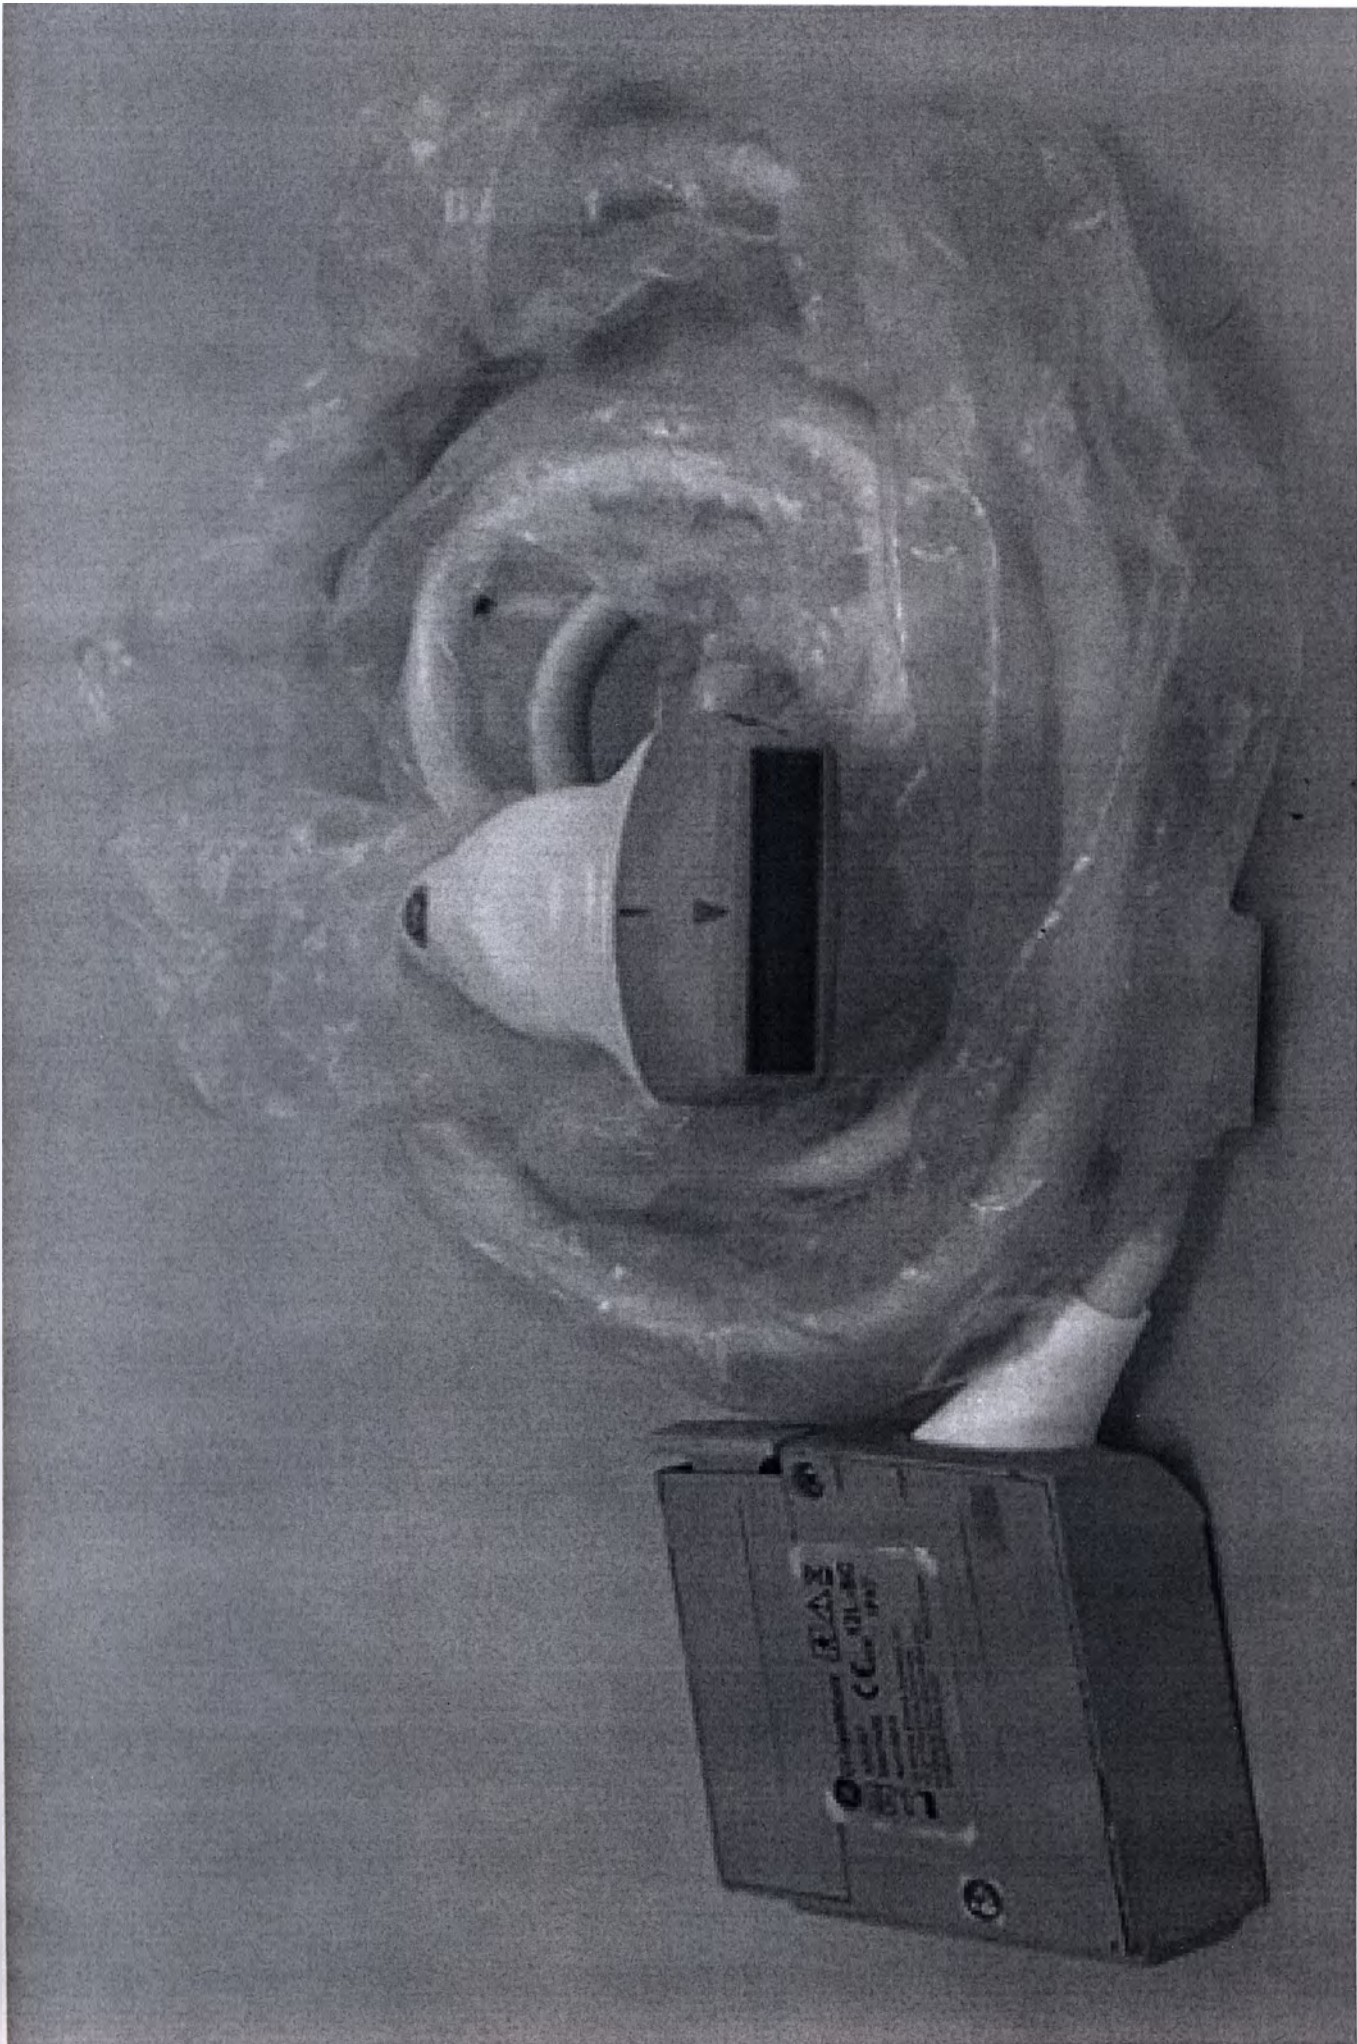


13. Насадка биопсийная для датчиков линейных. (не более 3 шт.)




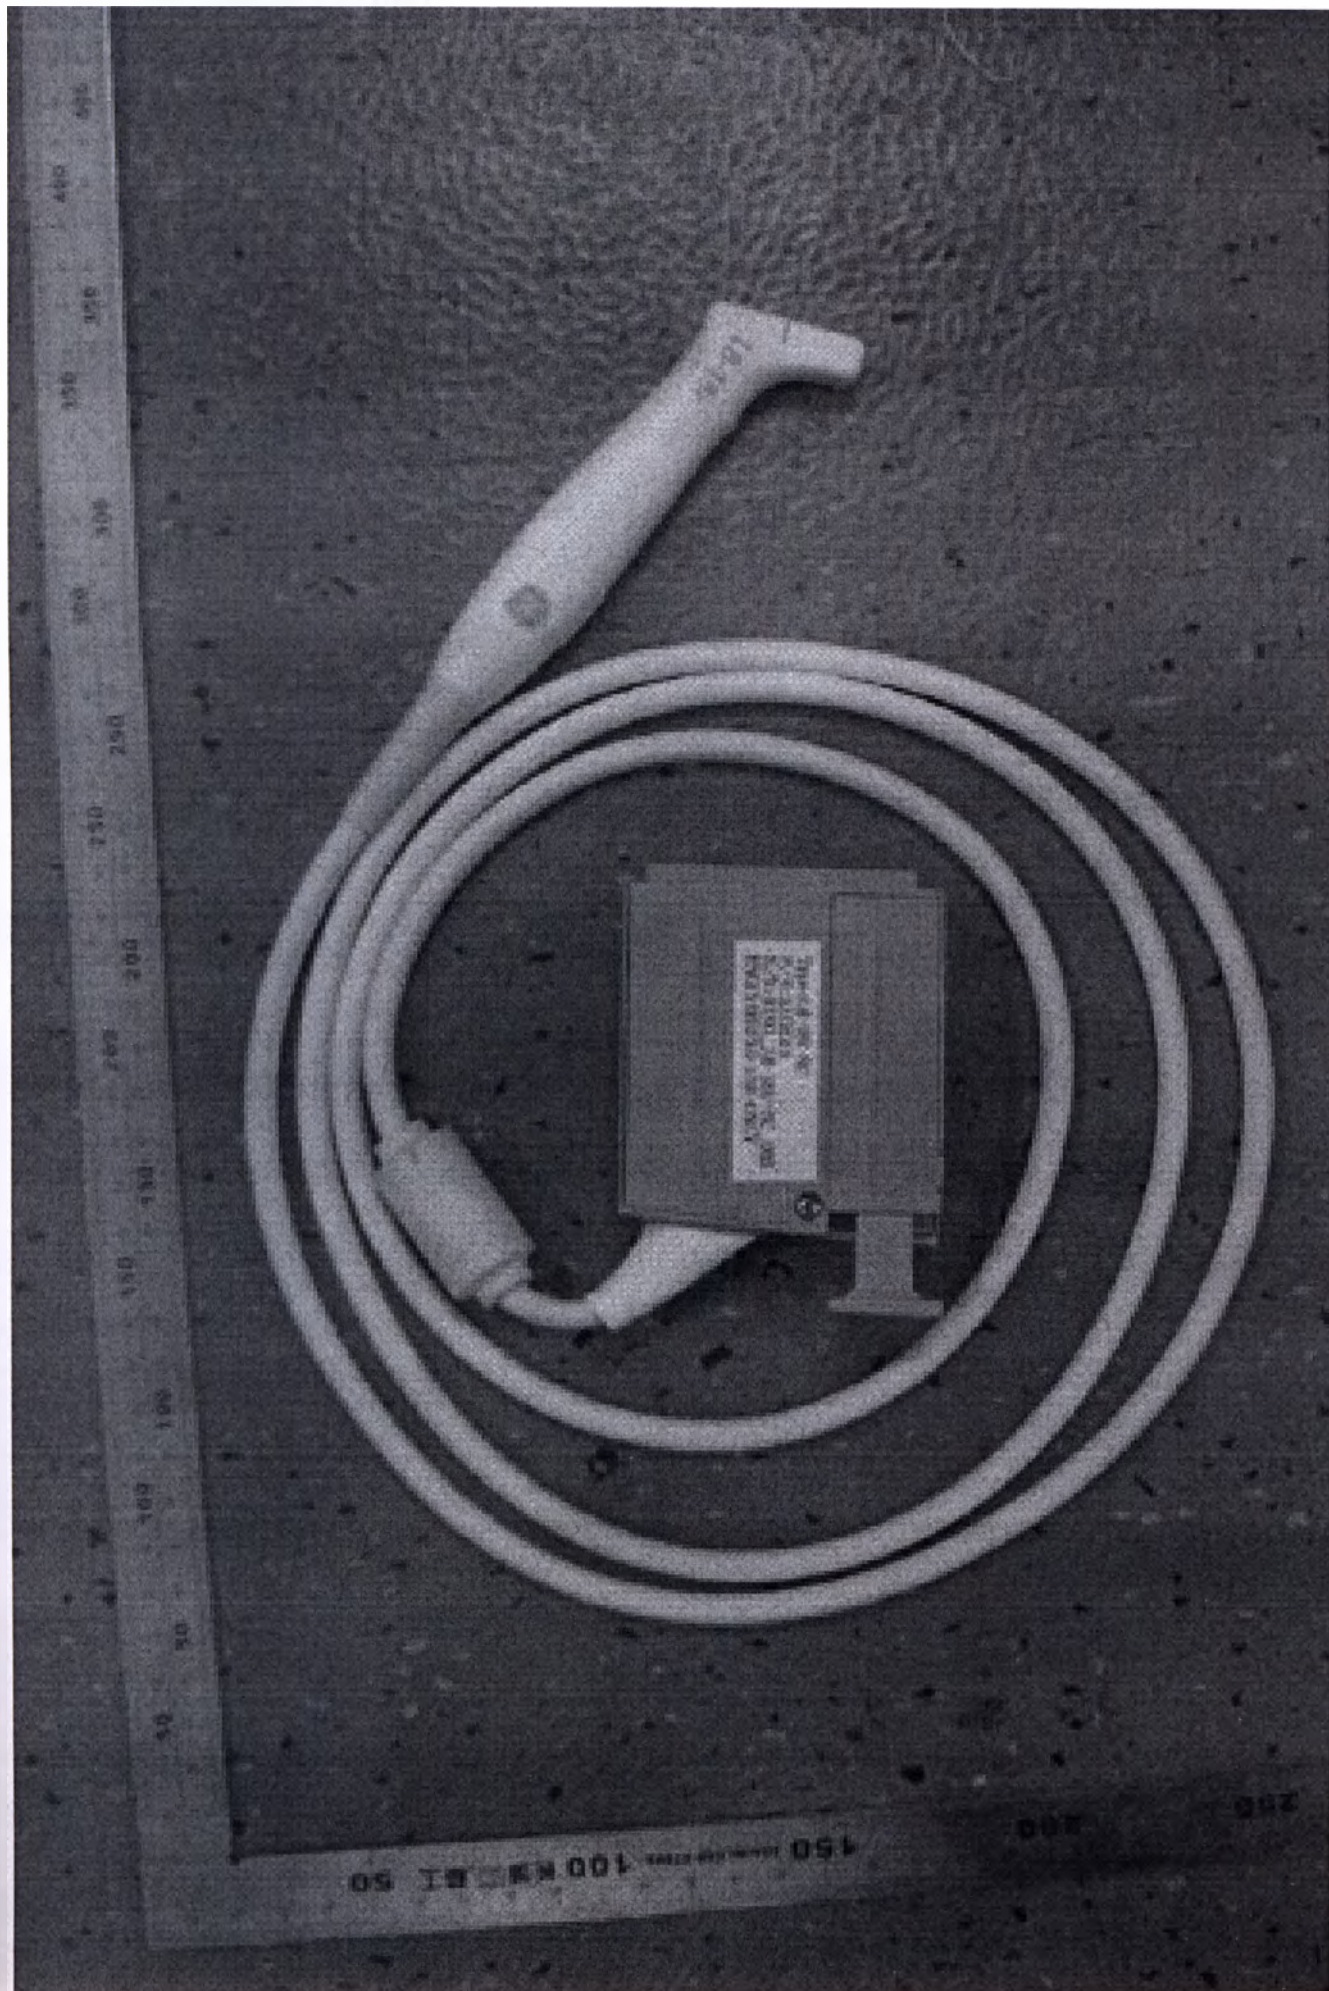


15. Датчик Линейный L12n-SC.

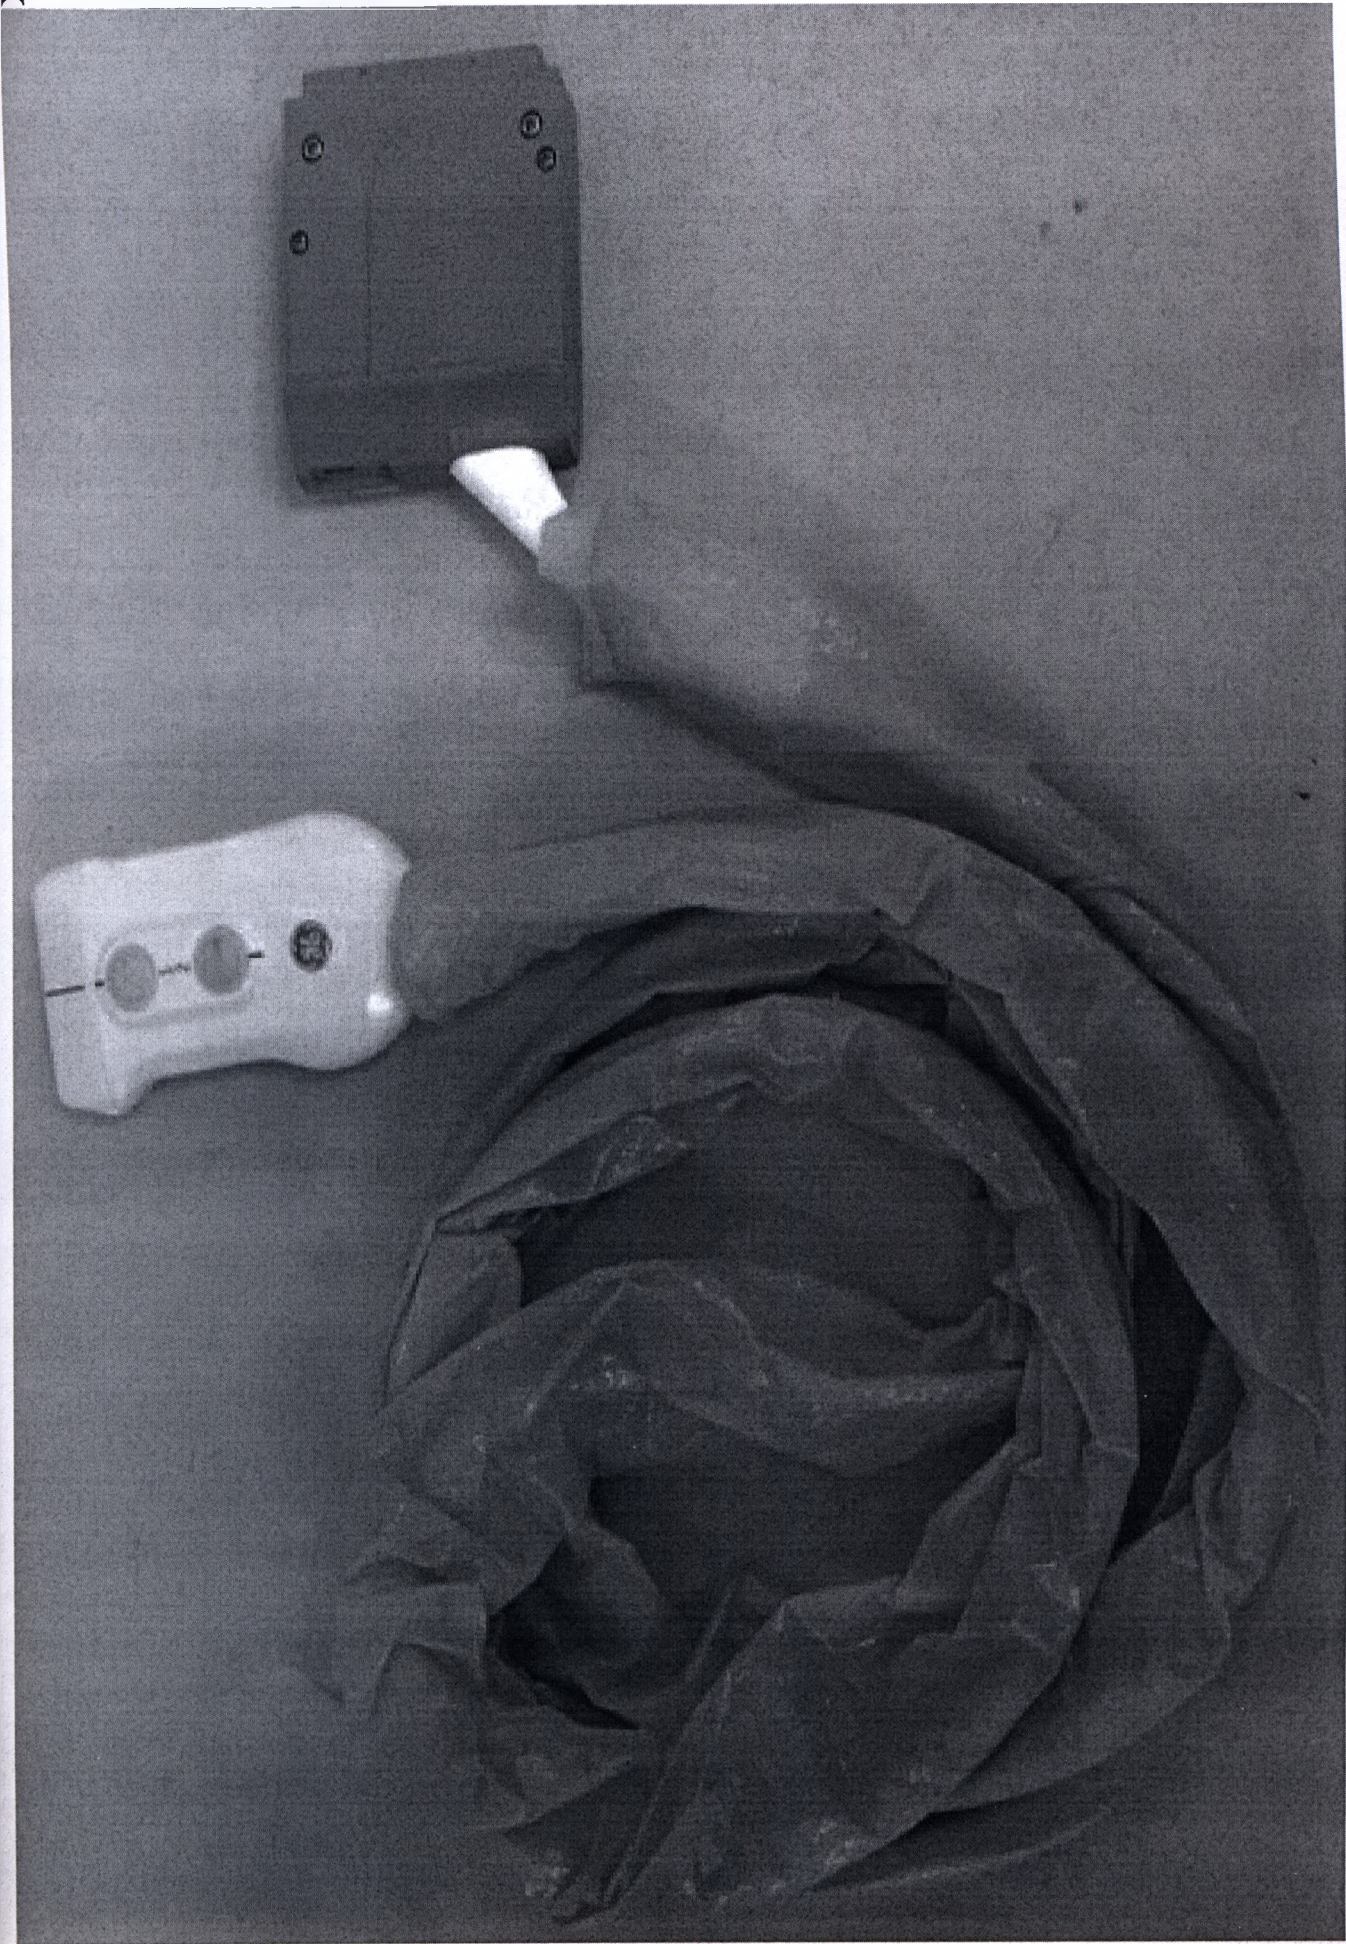

16. Датчик линейный L12n

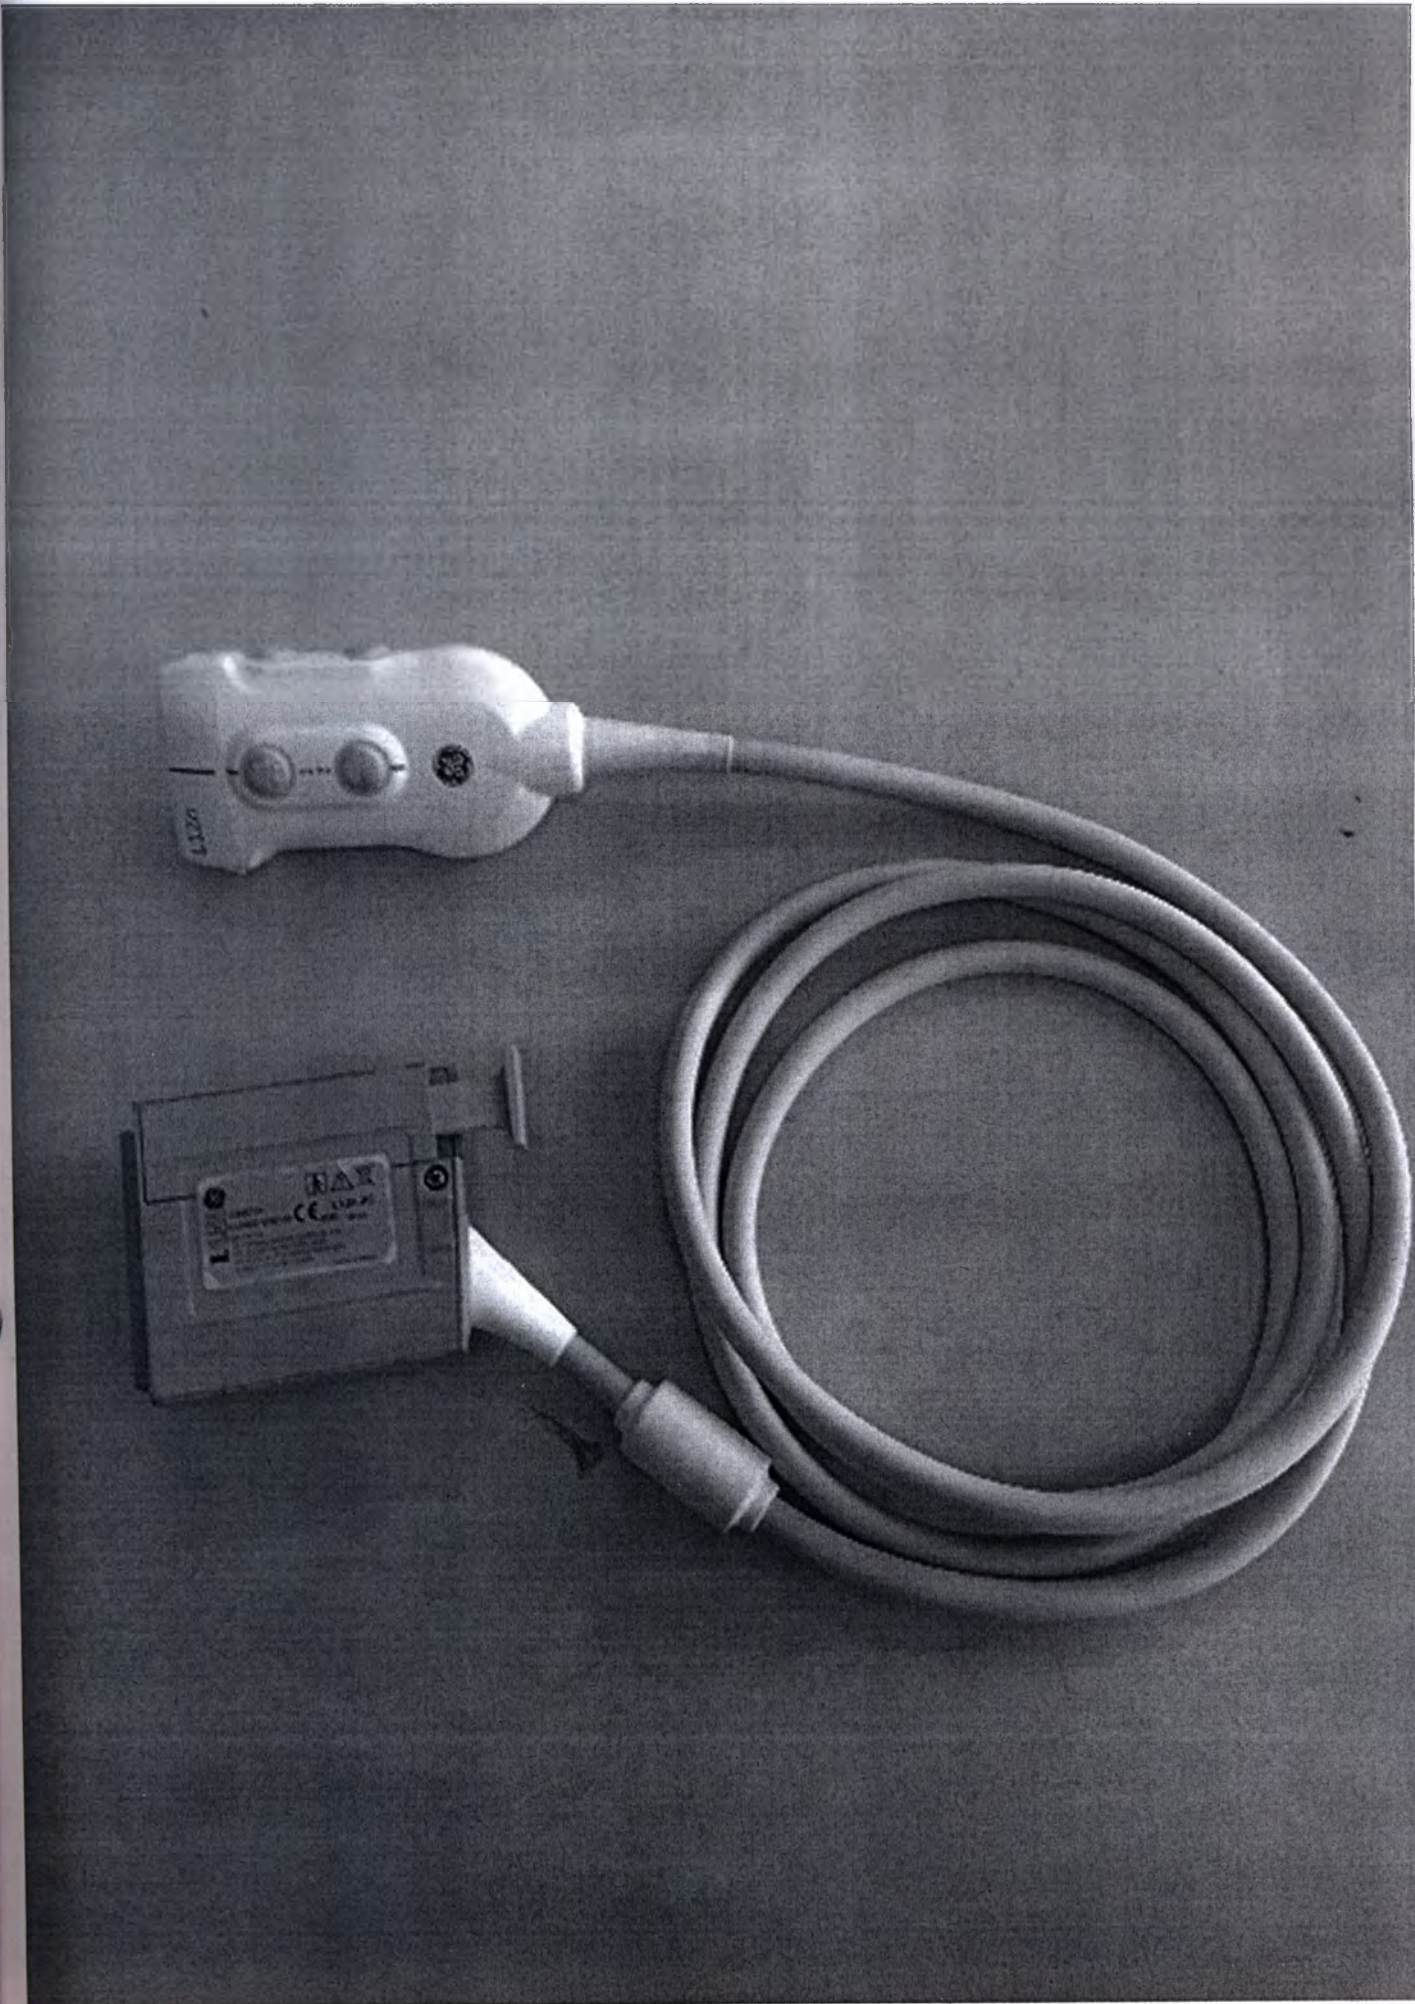

17. USB-кабель и крючок для подключения датчика L12n

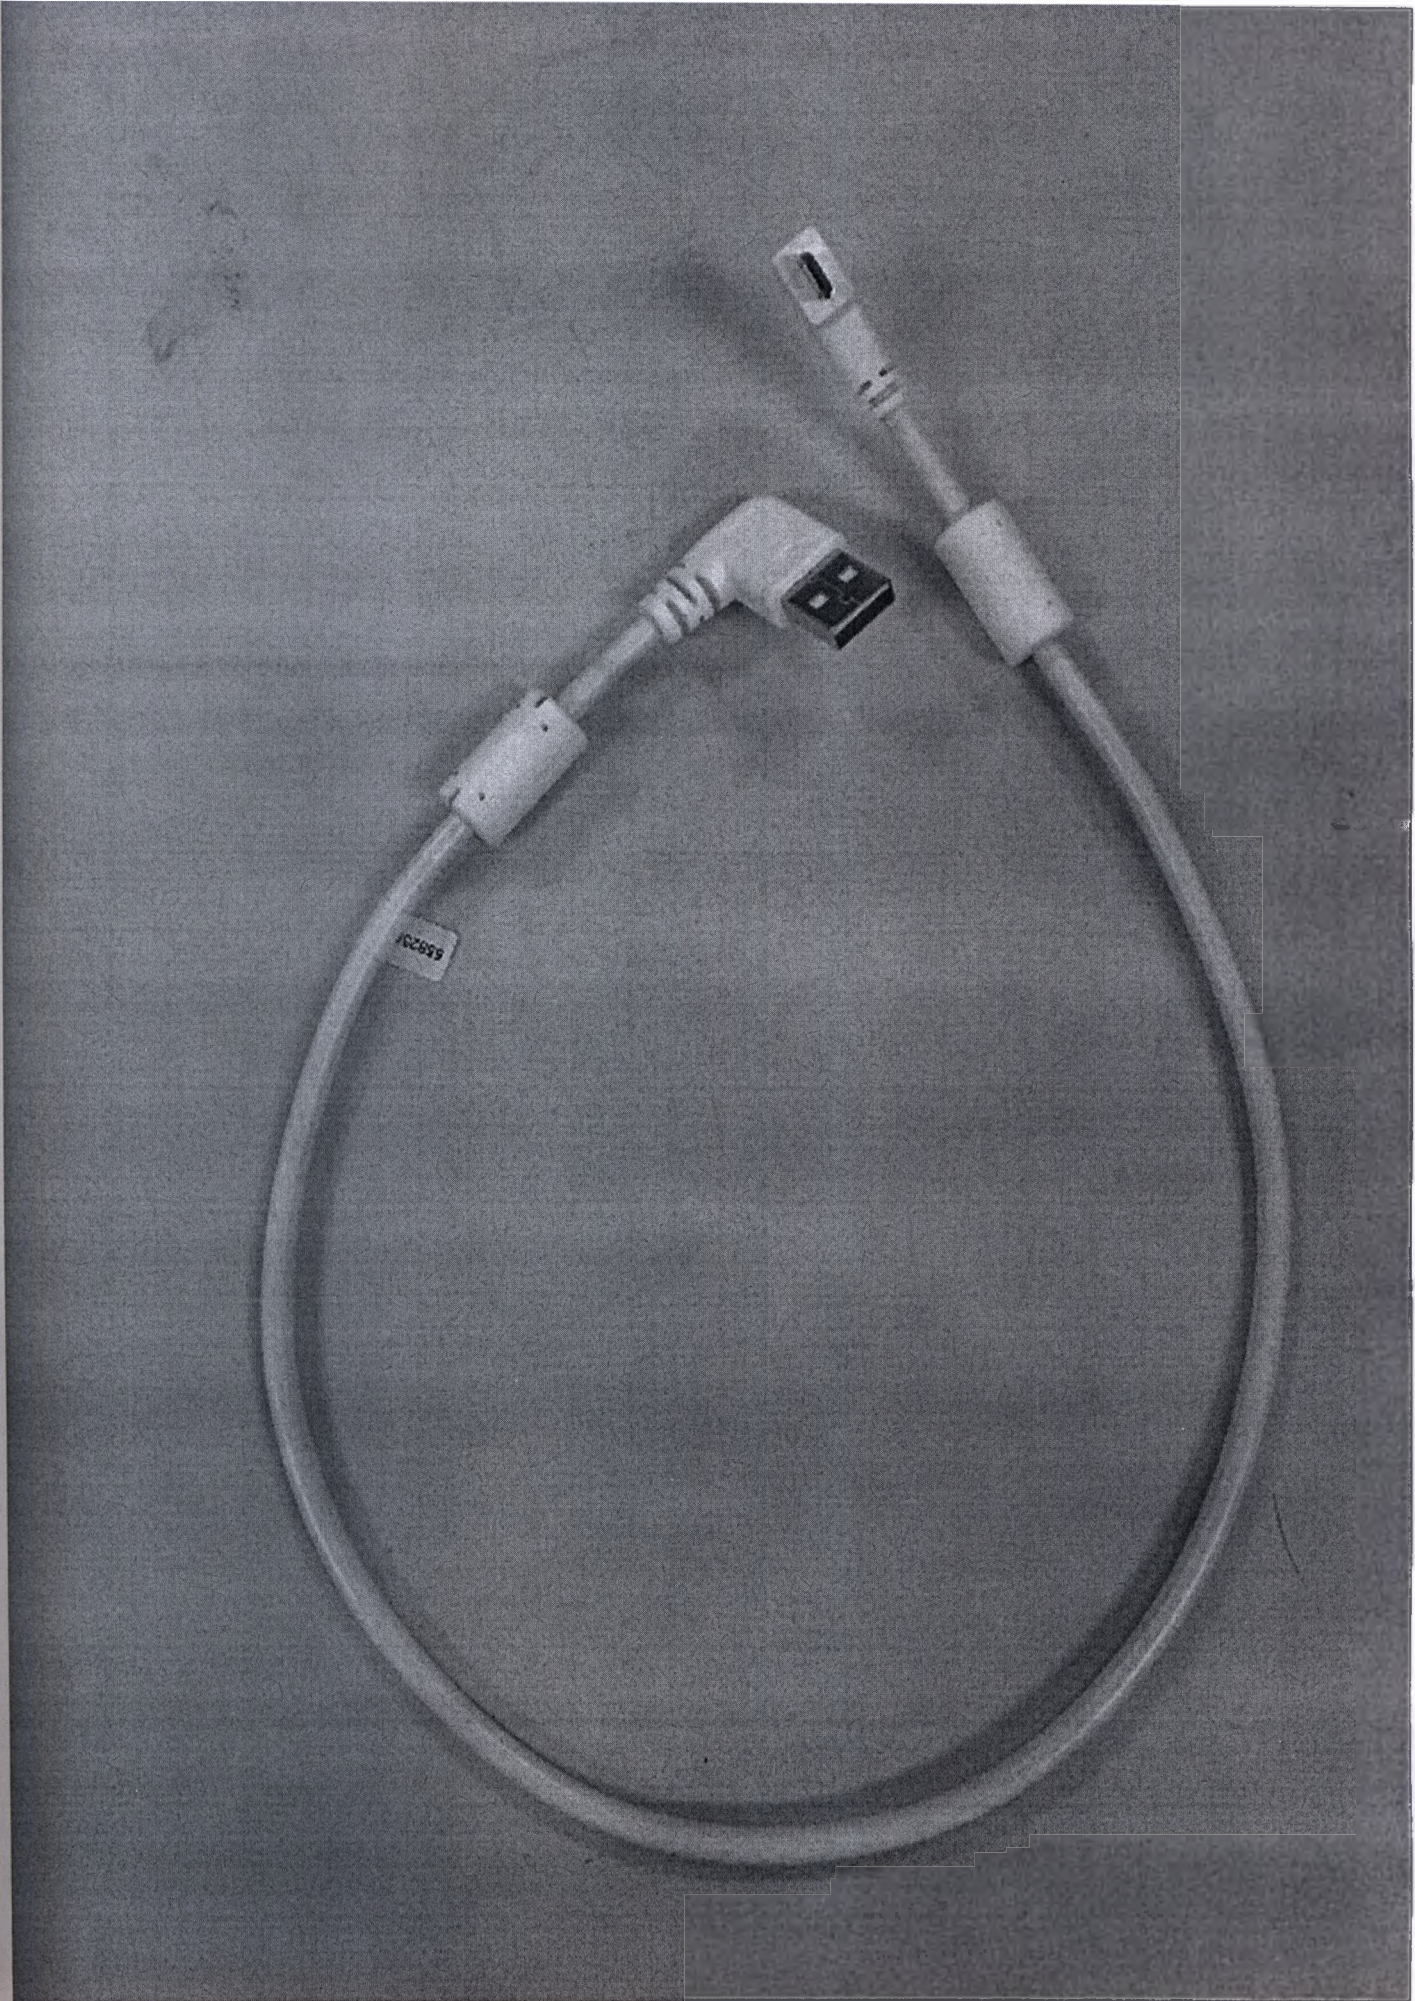

Функция встроенная для получения медицинских ультразвуковых изображений в офтальмологии – Ophtalmic application, активируемая электронным ключом.



Функция встроенная для получения медицинских ультразвуковых изображений в
шерстве – Application for OB, активируемая электронным ключом



20. Функция встроенная для получения медицинских ультразвуковых изображений в М-режиме, активируемая электронным ключом



21. Функция встроенная для распознавания иглы, активируемая электронным ключом




22. Модуль программный для обучающего набора Pinpoint GT – виртуальное отслеживание иглы, активируемый электронным ключом



23. Обучающий набор-симулятор Pinpoint GT Practice Kit в составе: набор игл, фантом и симулятор крови для виртуального отслеживания иглы




24. Функция встроенная, обеспечивающая возможность сетевой передачи данных – DICOM, активируемая электронным ключом




25. Функция для обучения пользователя – eSmart Trainer, активируемая электронным ключом.

Bladder Long

26. Функция встроенная для отслеживания положения иглы, активируемая электронным ключом

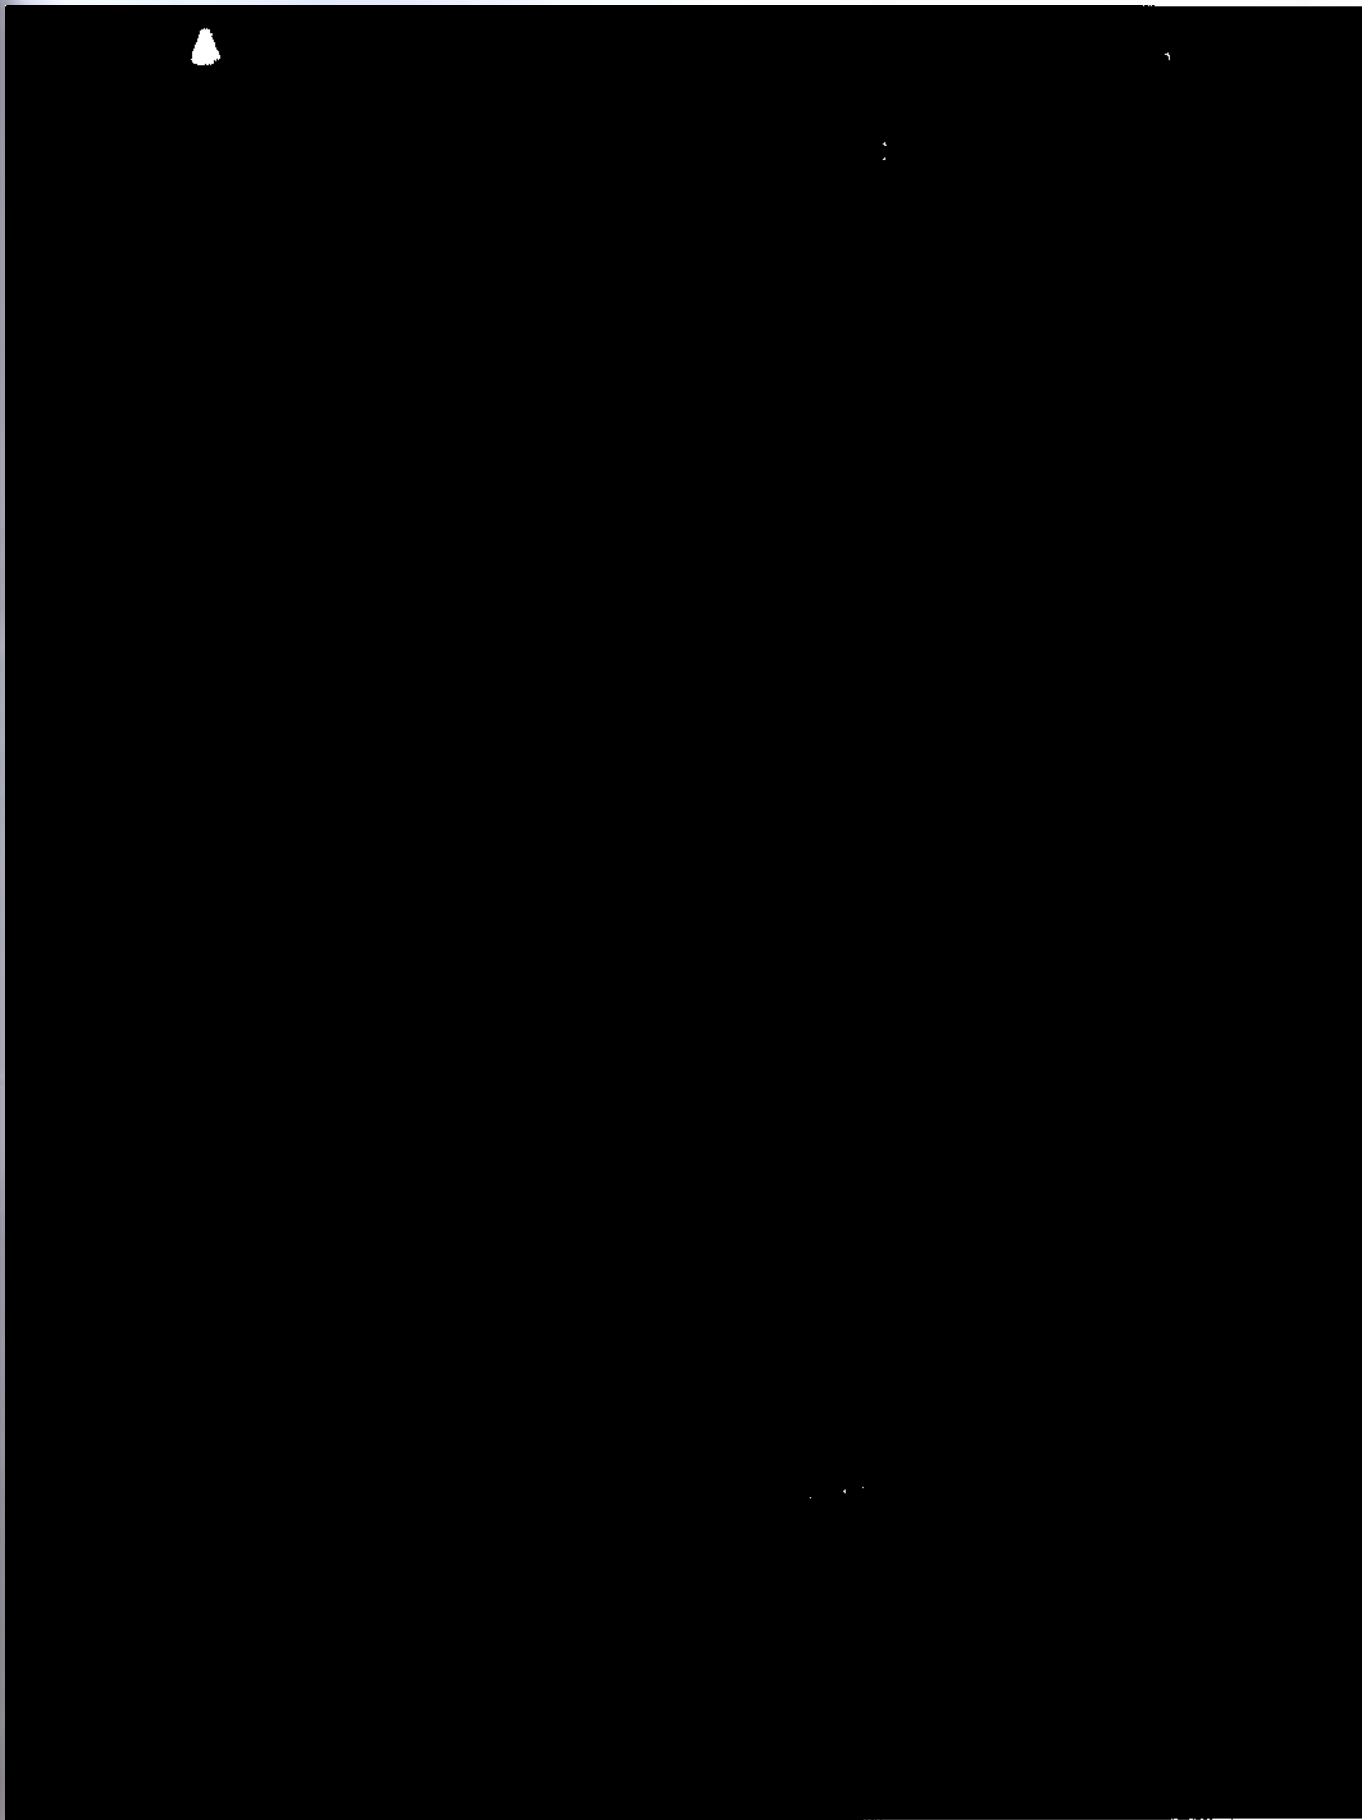


27. Блок с тремя разъемами для датчиков

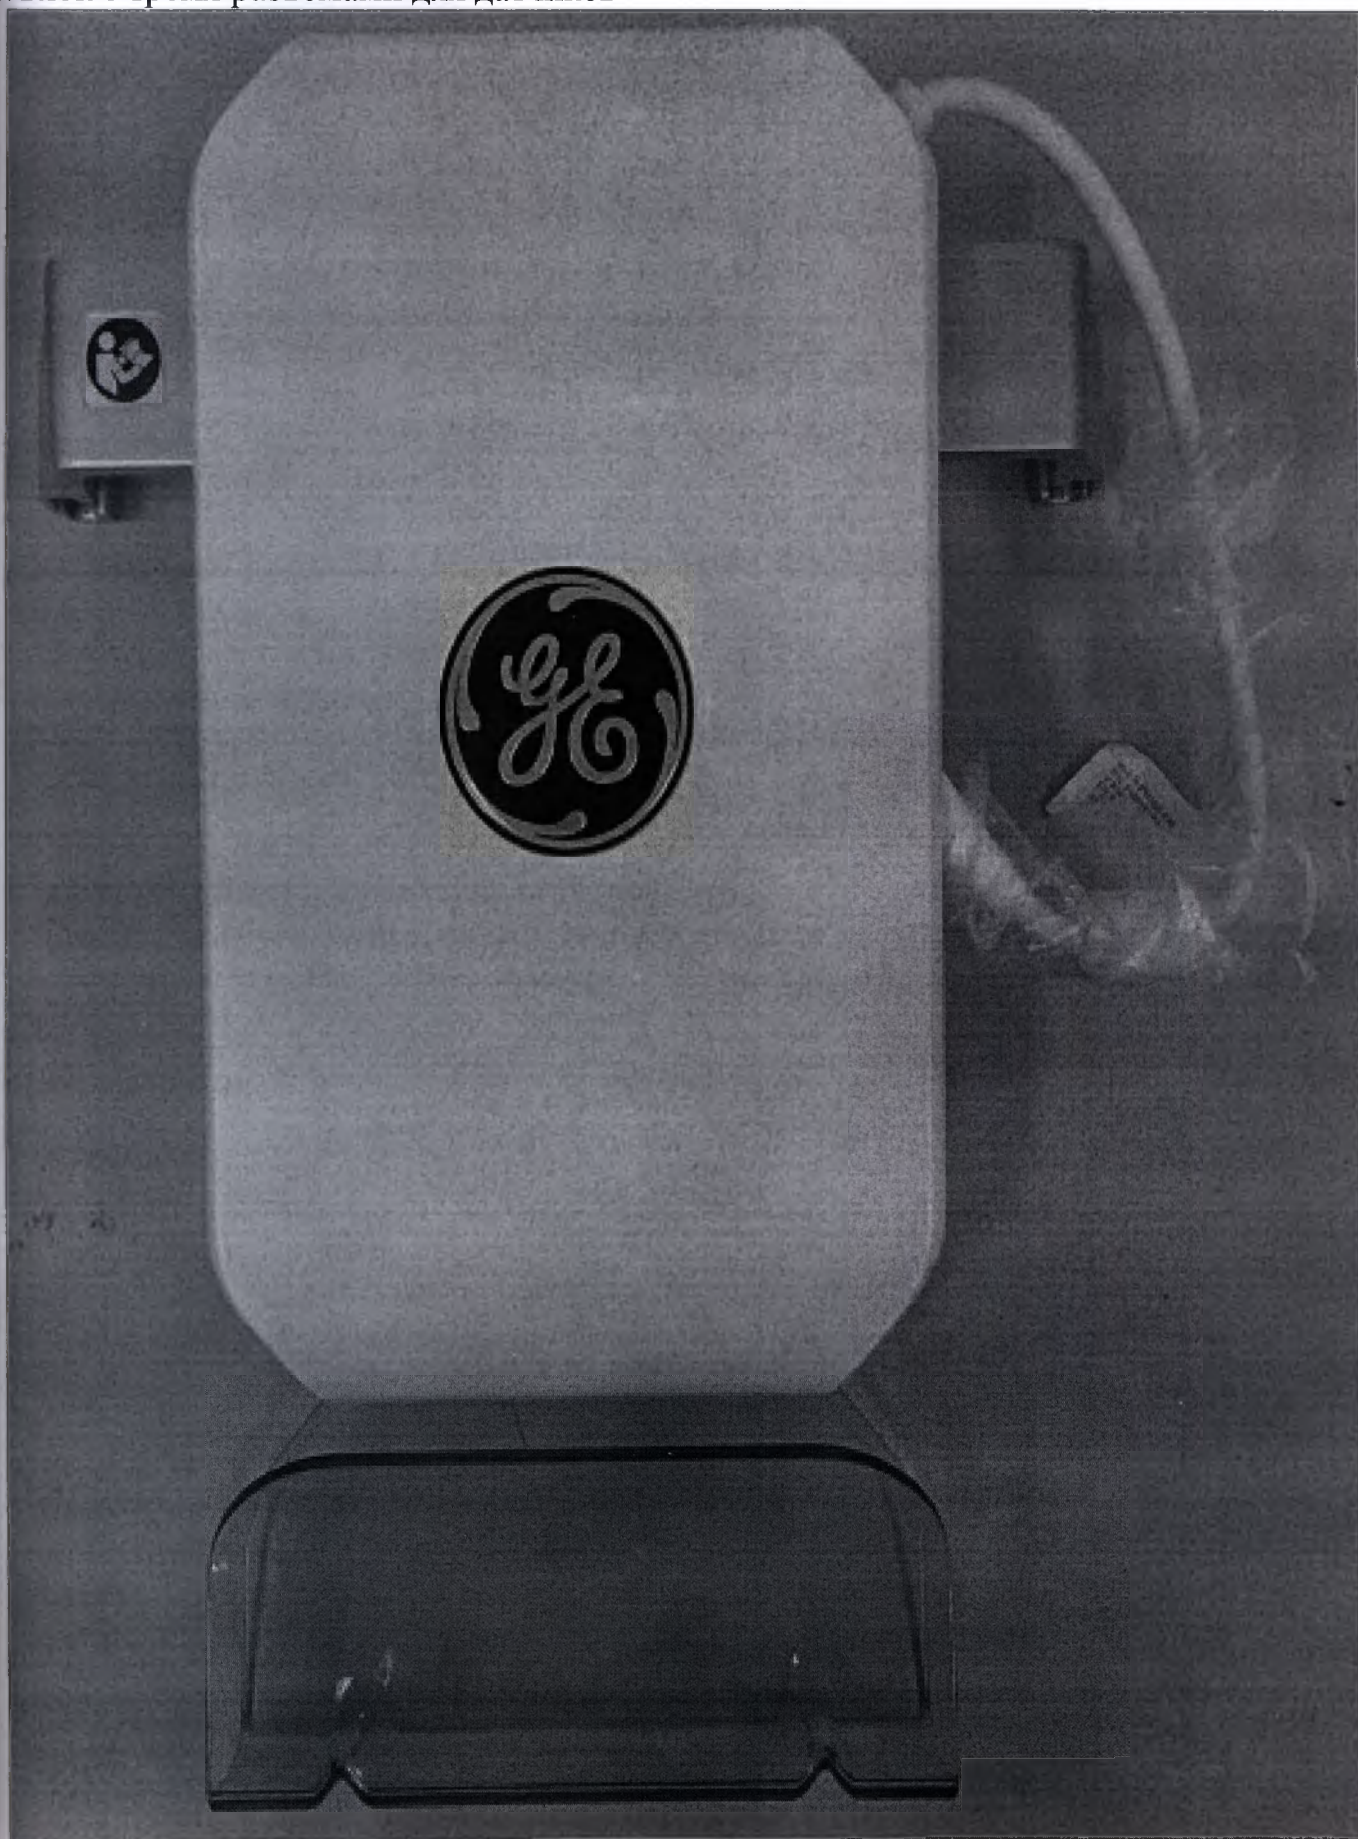


28.Сканер штрих-кодов данных с медицинских карт пациентов




29. Устройство для беспроводной передачи данных – адаптер Wireless LAN (WLAN).

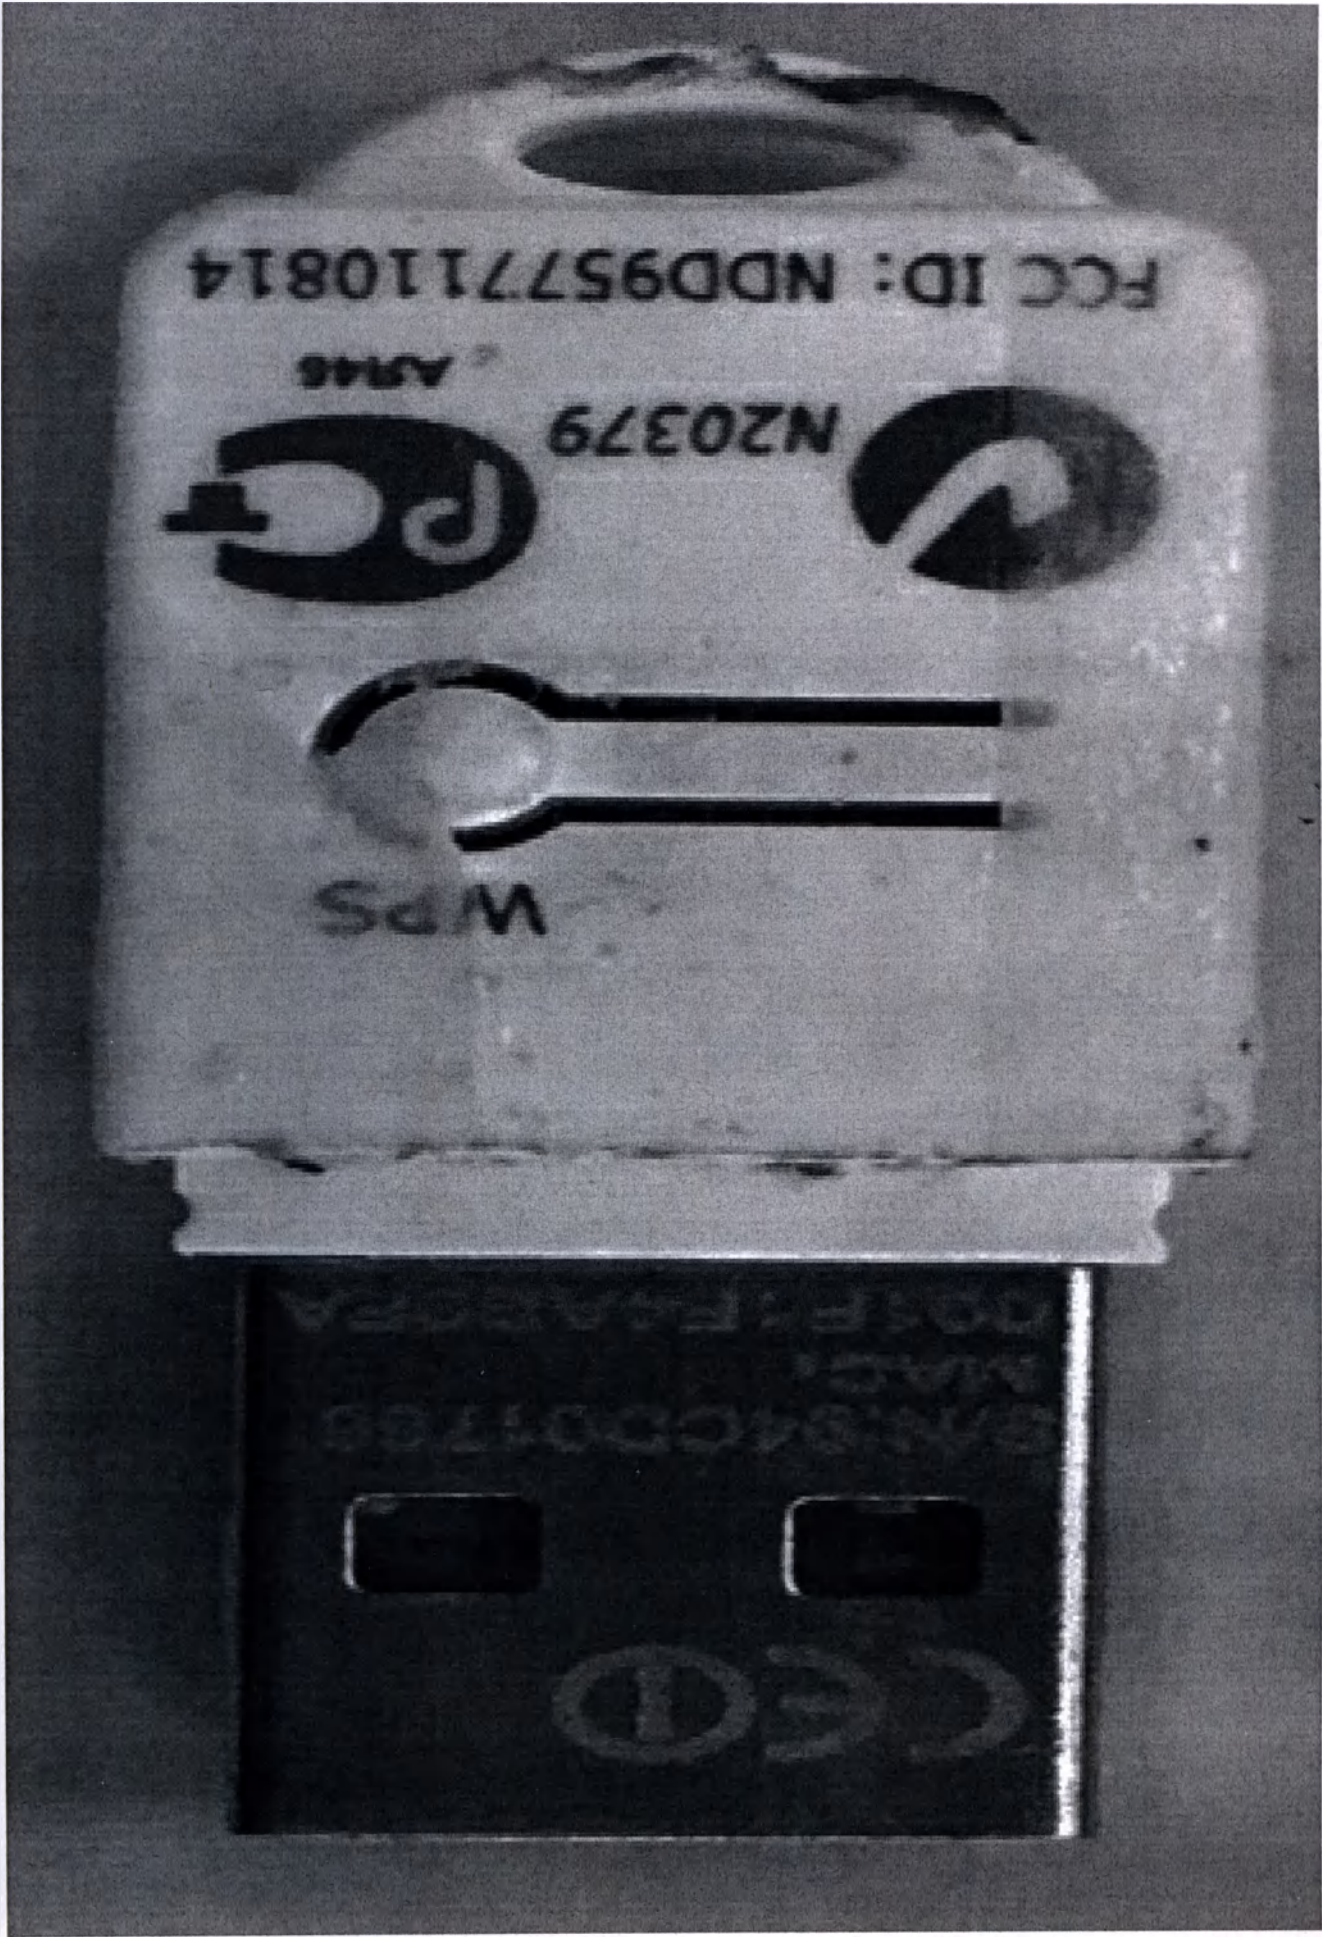


30.Кабели USB для подключения устройств к ультразвуковой консоли. (не более 2 шт.)

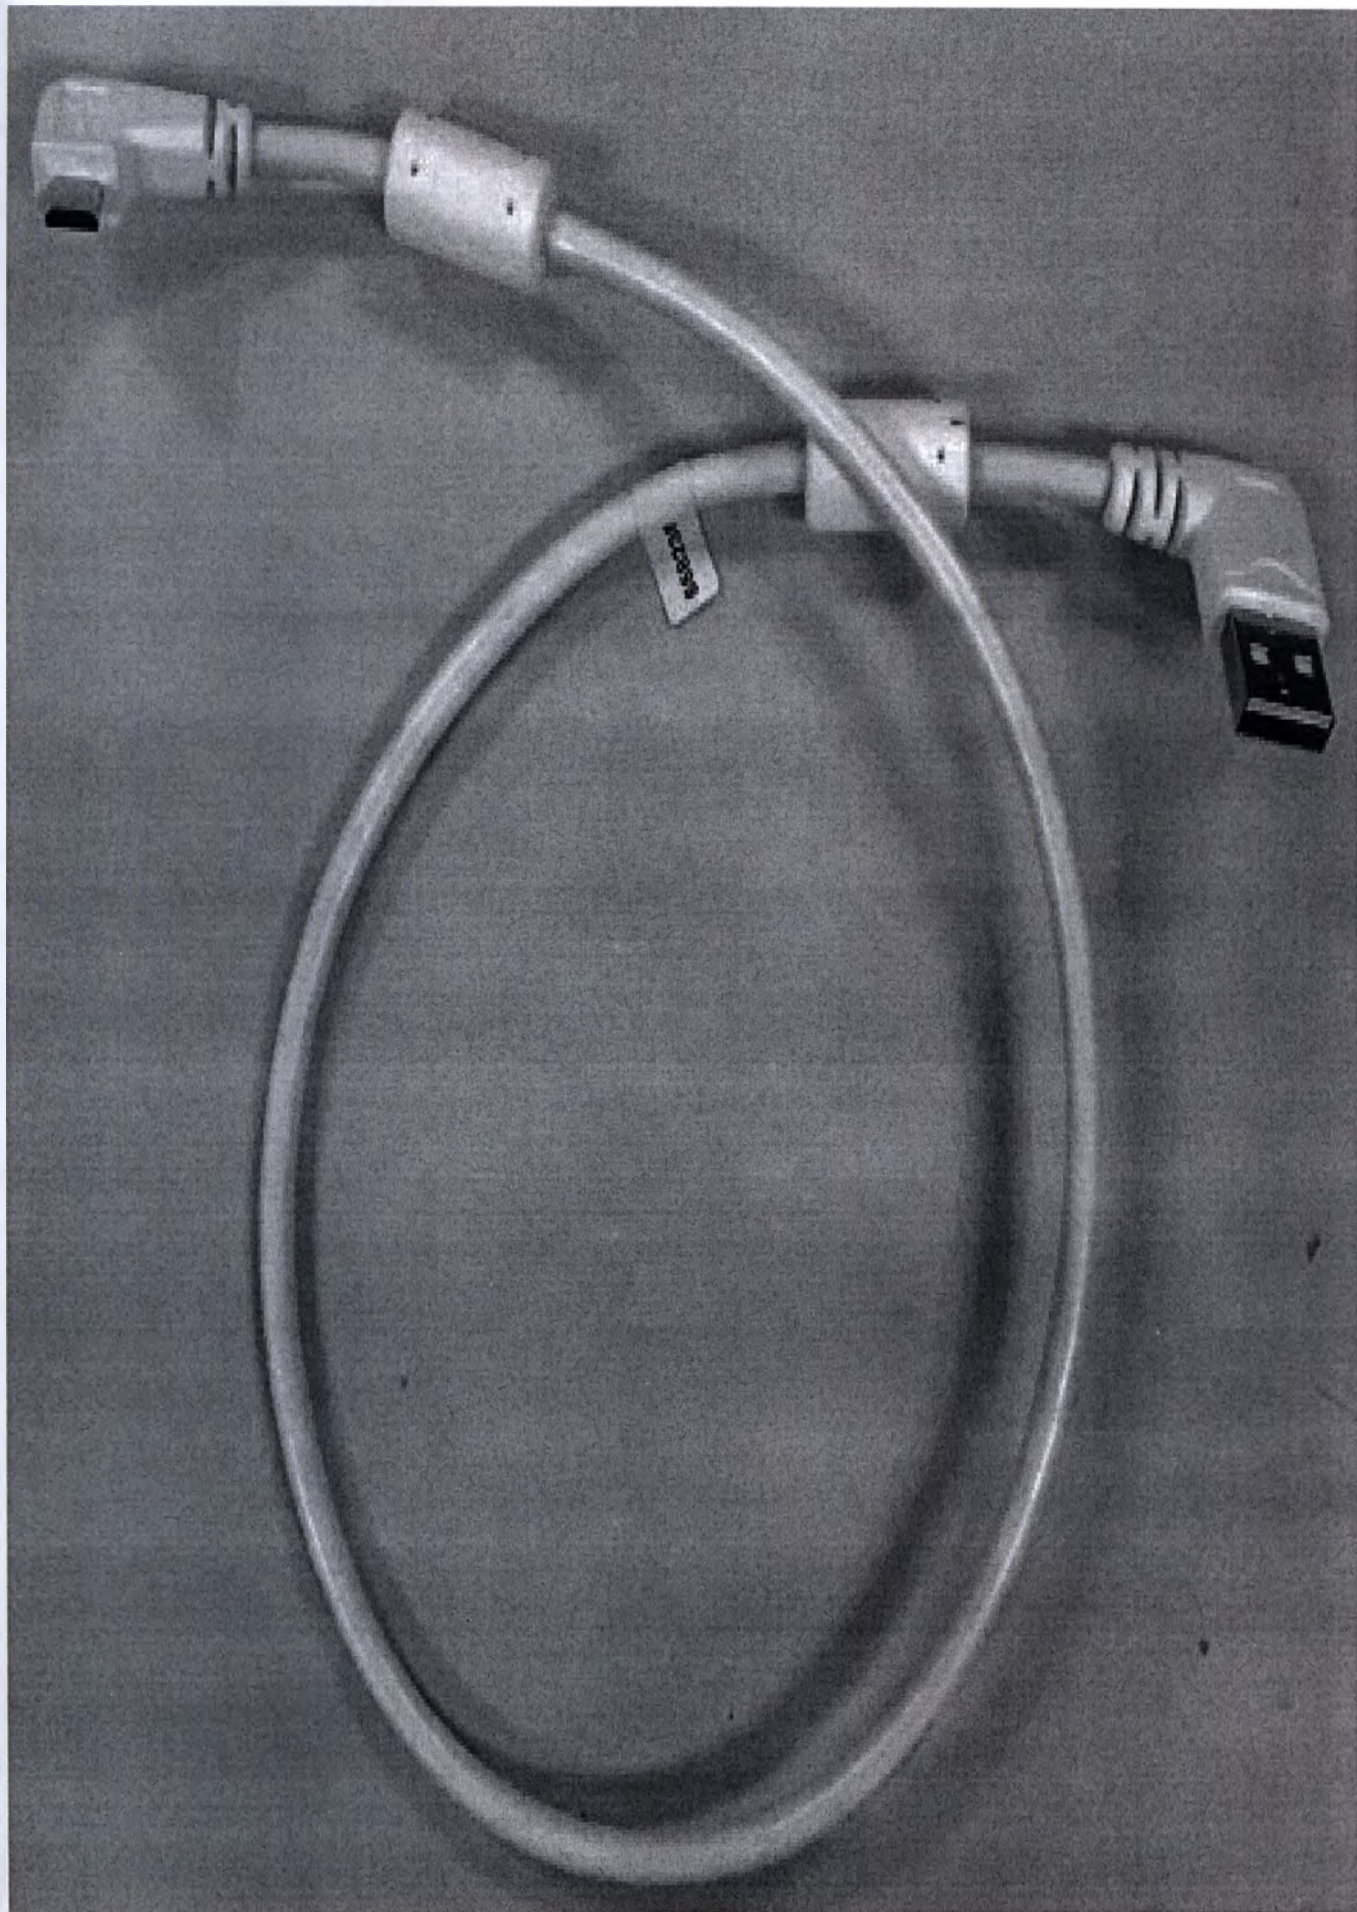

31.Батареи аккумуляторные дополнительные. (не более 3 шт.)

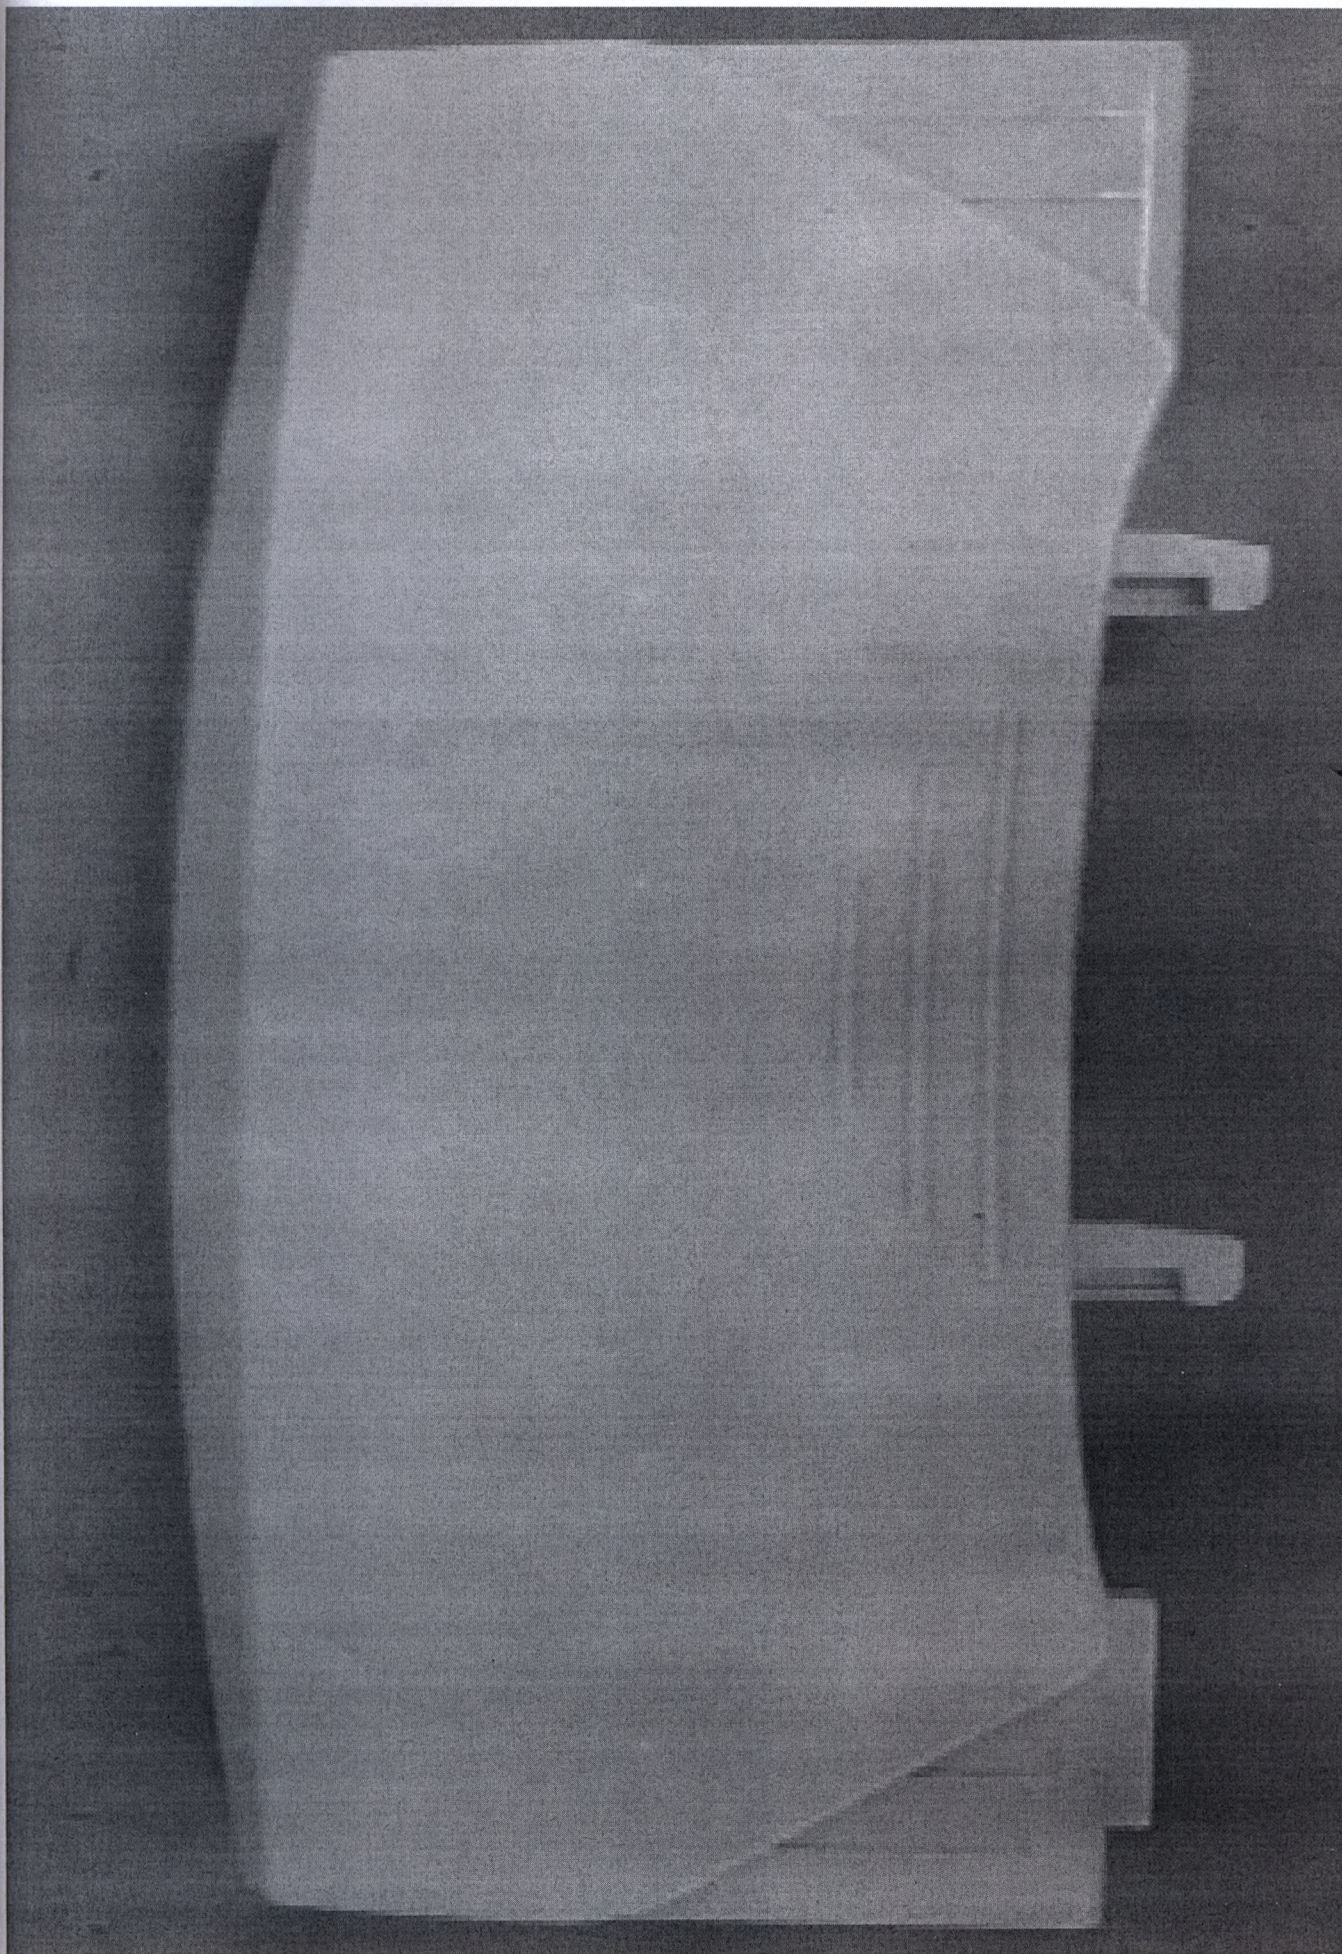

32. Педальный переключатель Footswitch

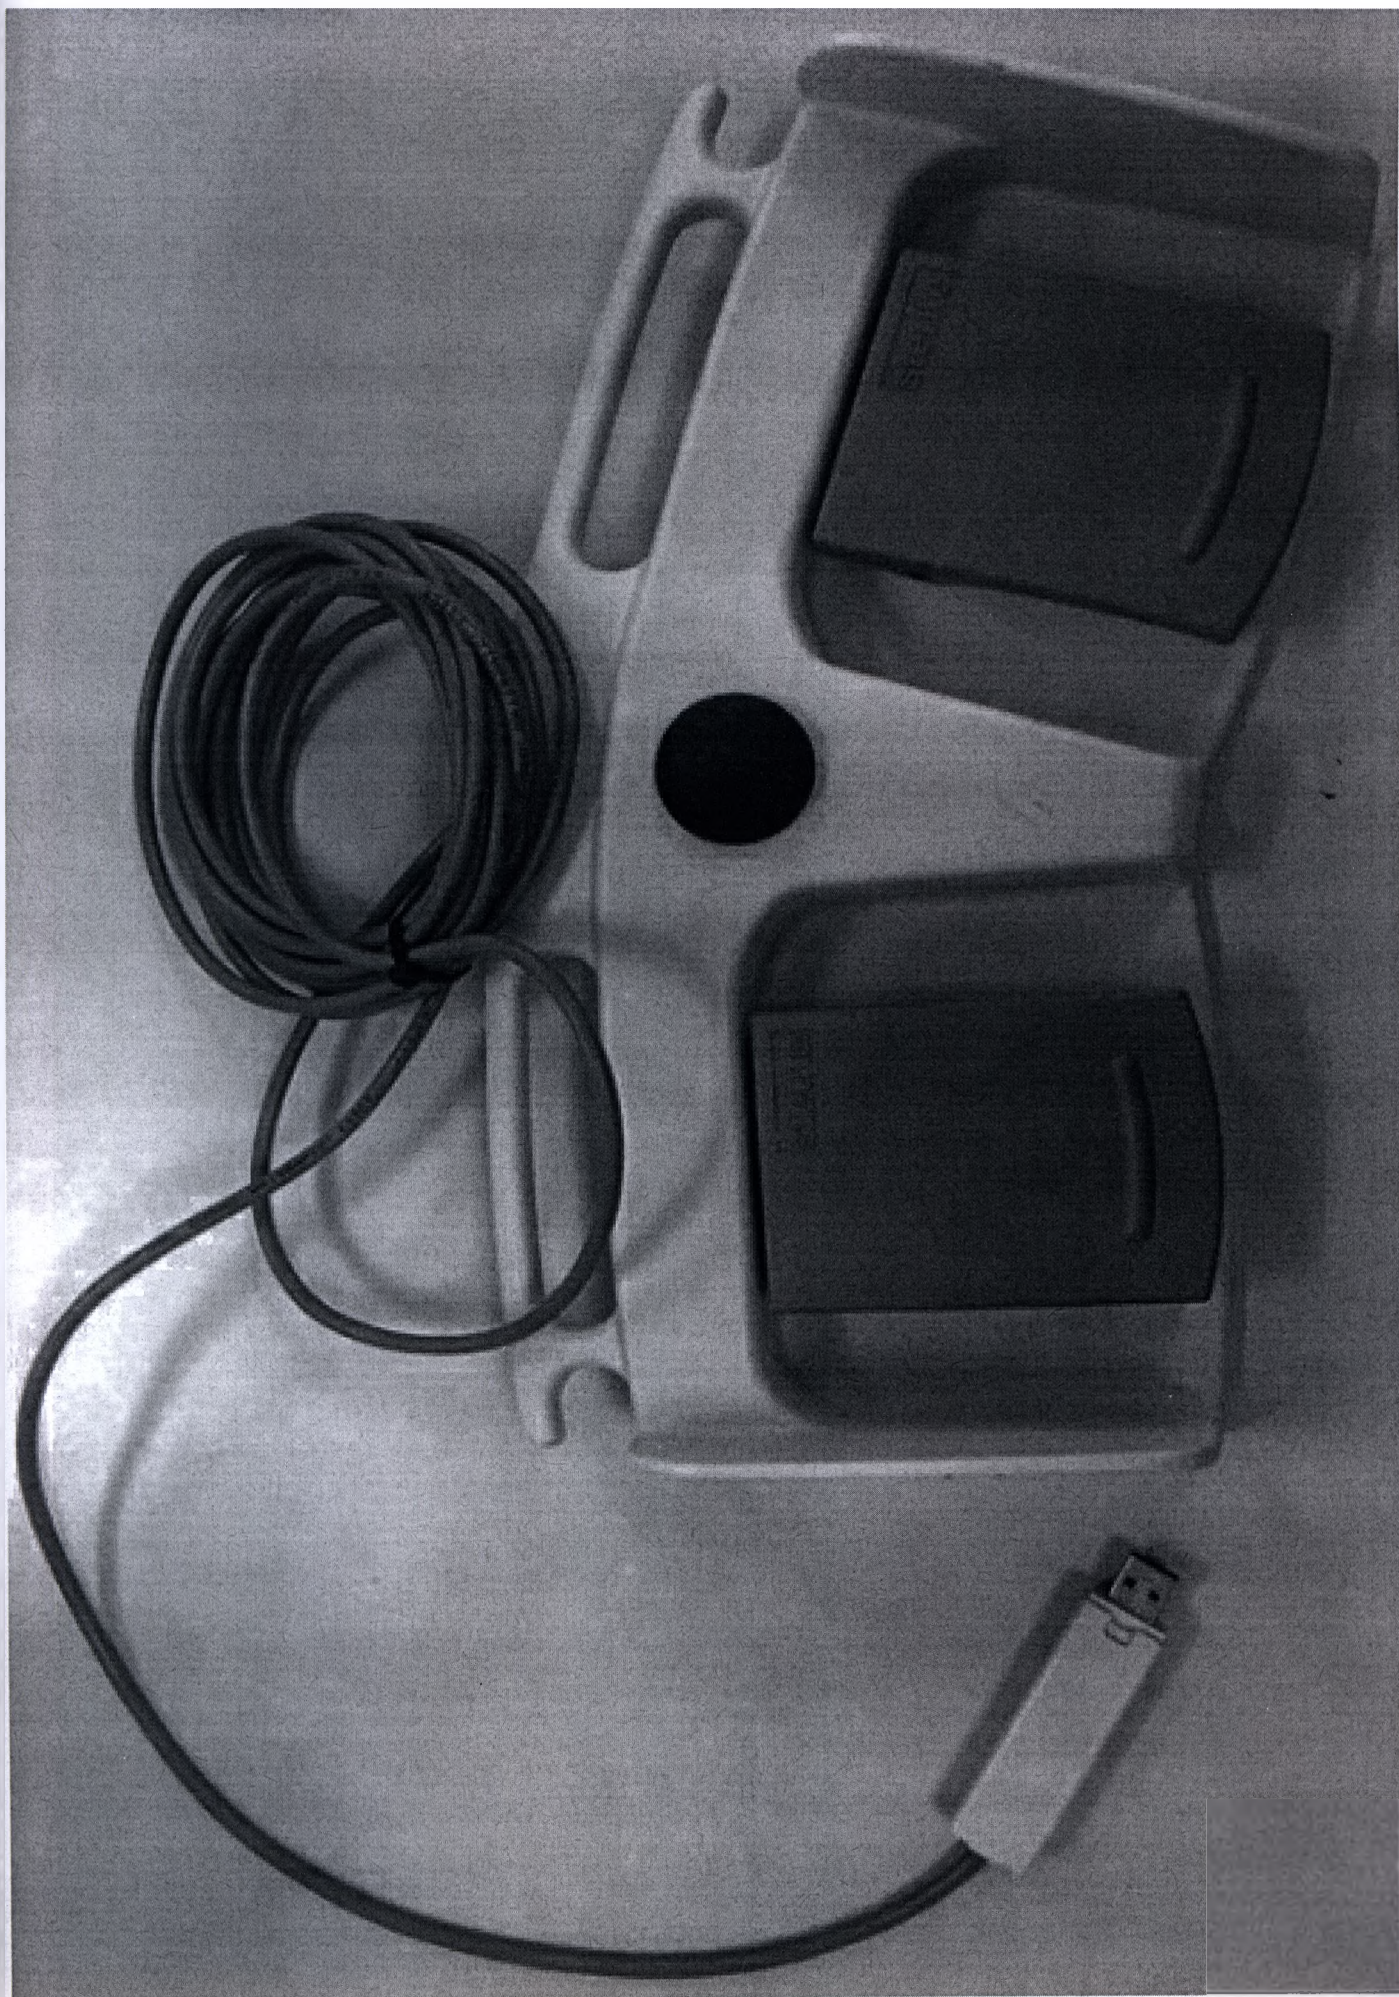

33. Руководство пользователя для системы ультразвуковой Venue 50 на английском языке.




GE


Venue 50

Basic User Manual


Direction. 5589758 -145

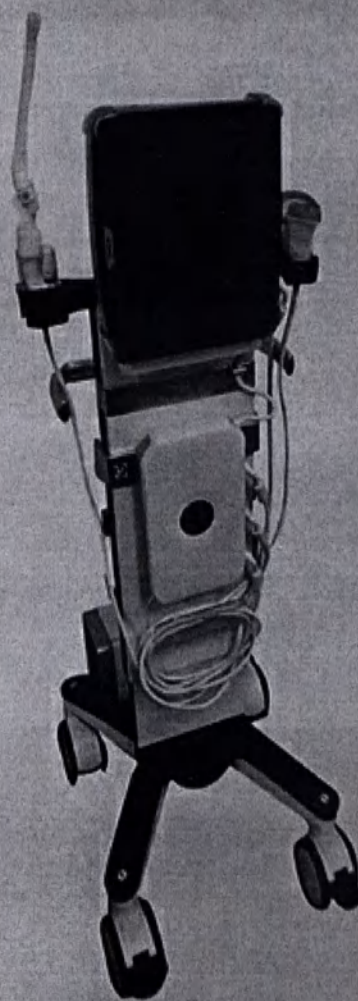


34. Стыковочная тележка для установки и перевозки аппарата

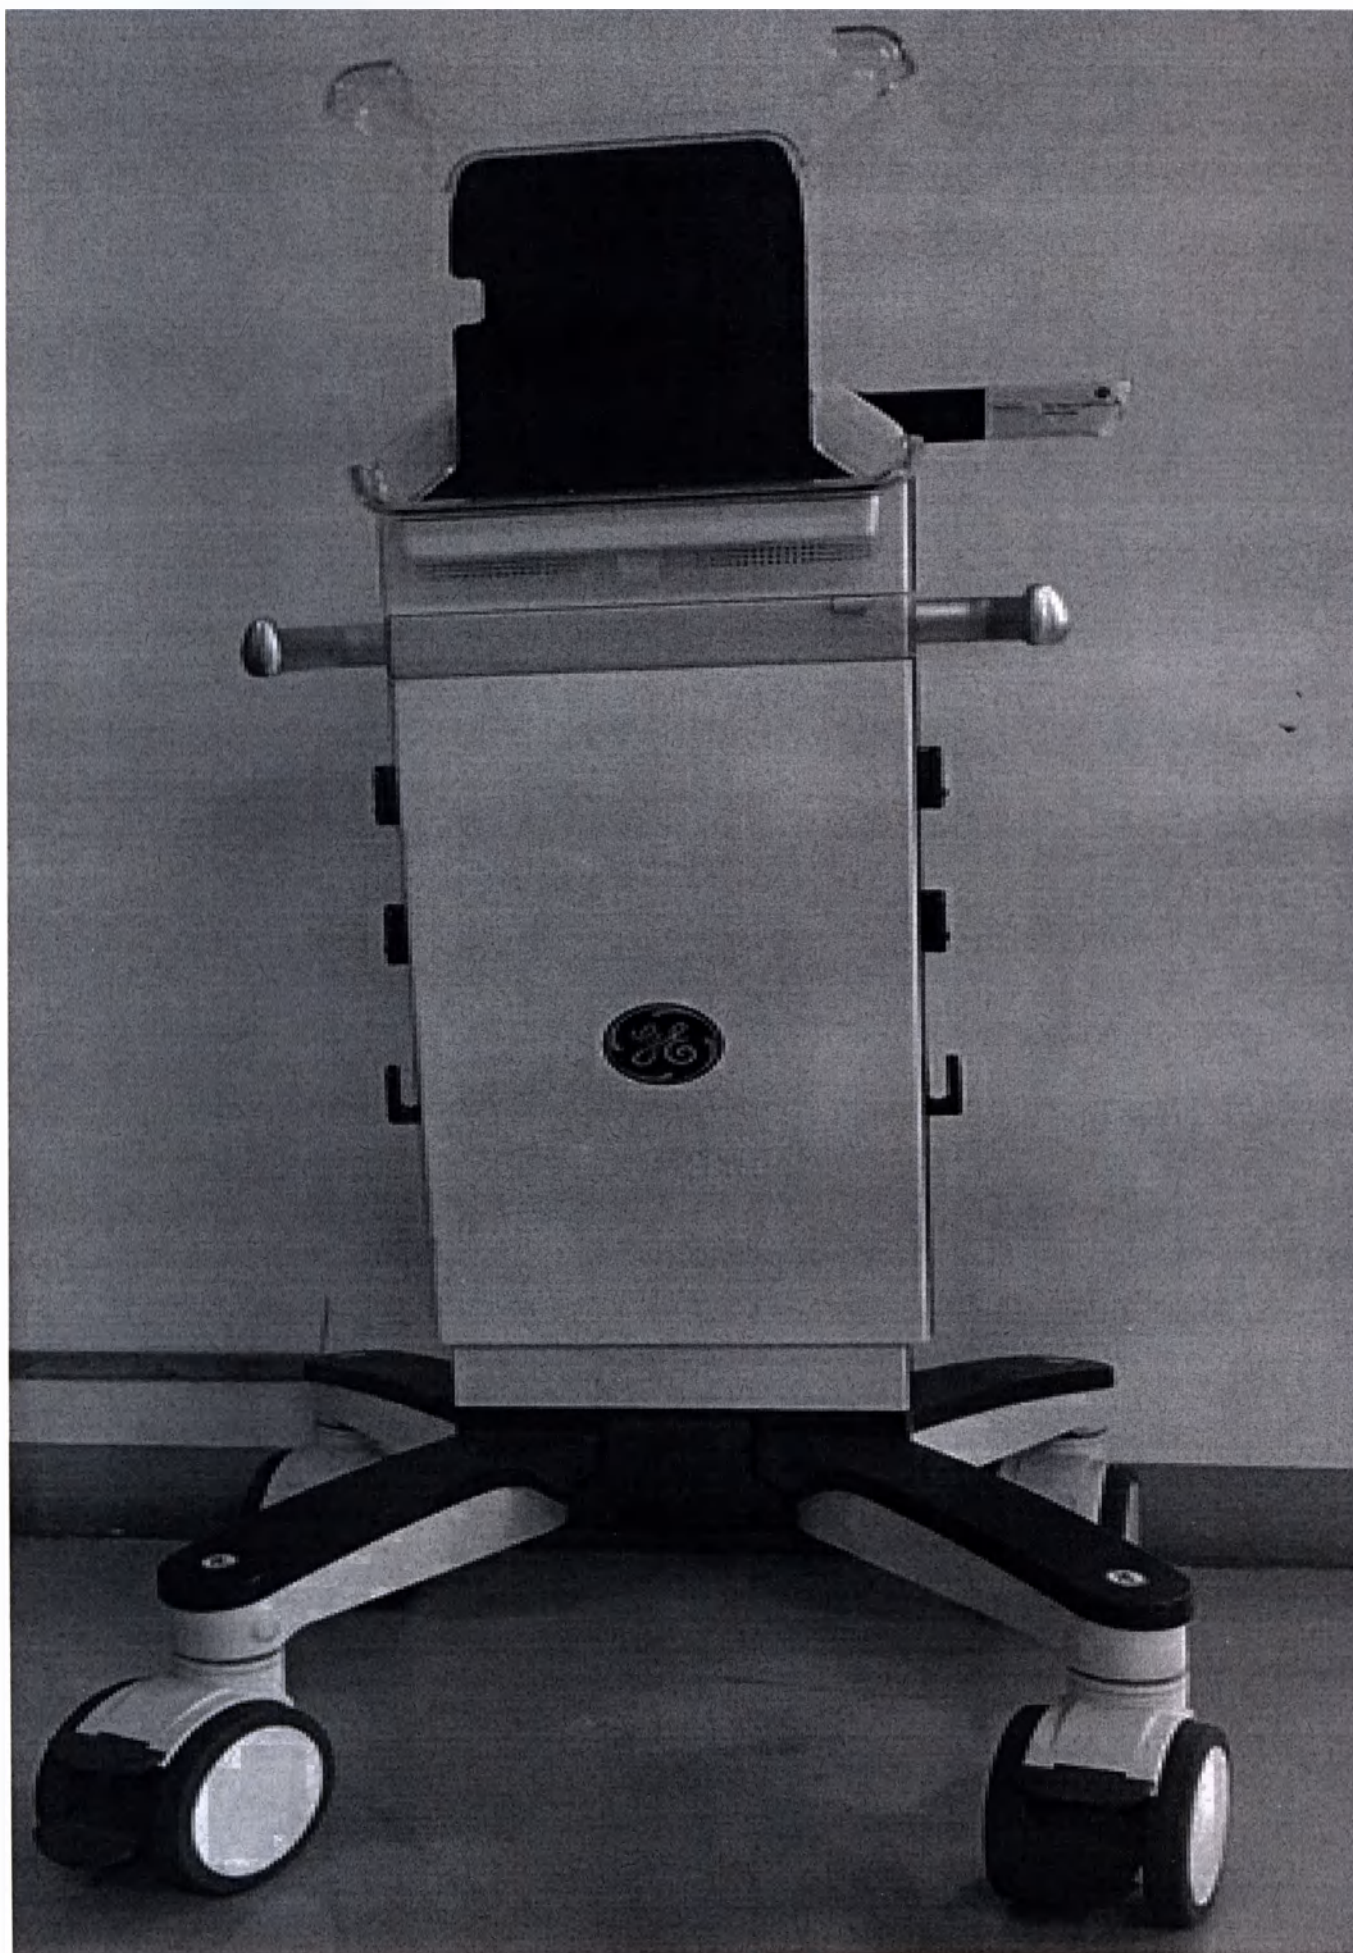


35. Устройство настольное для установки и зарядки системы

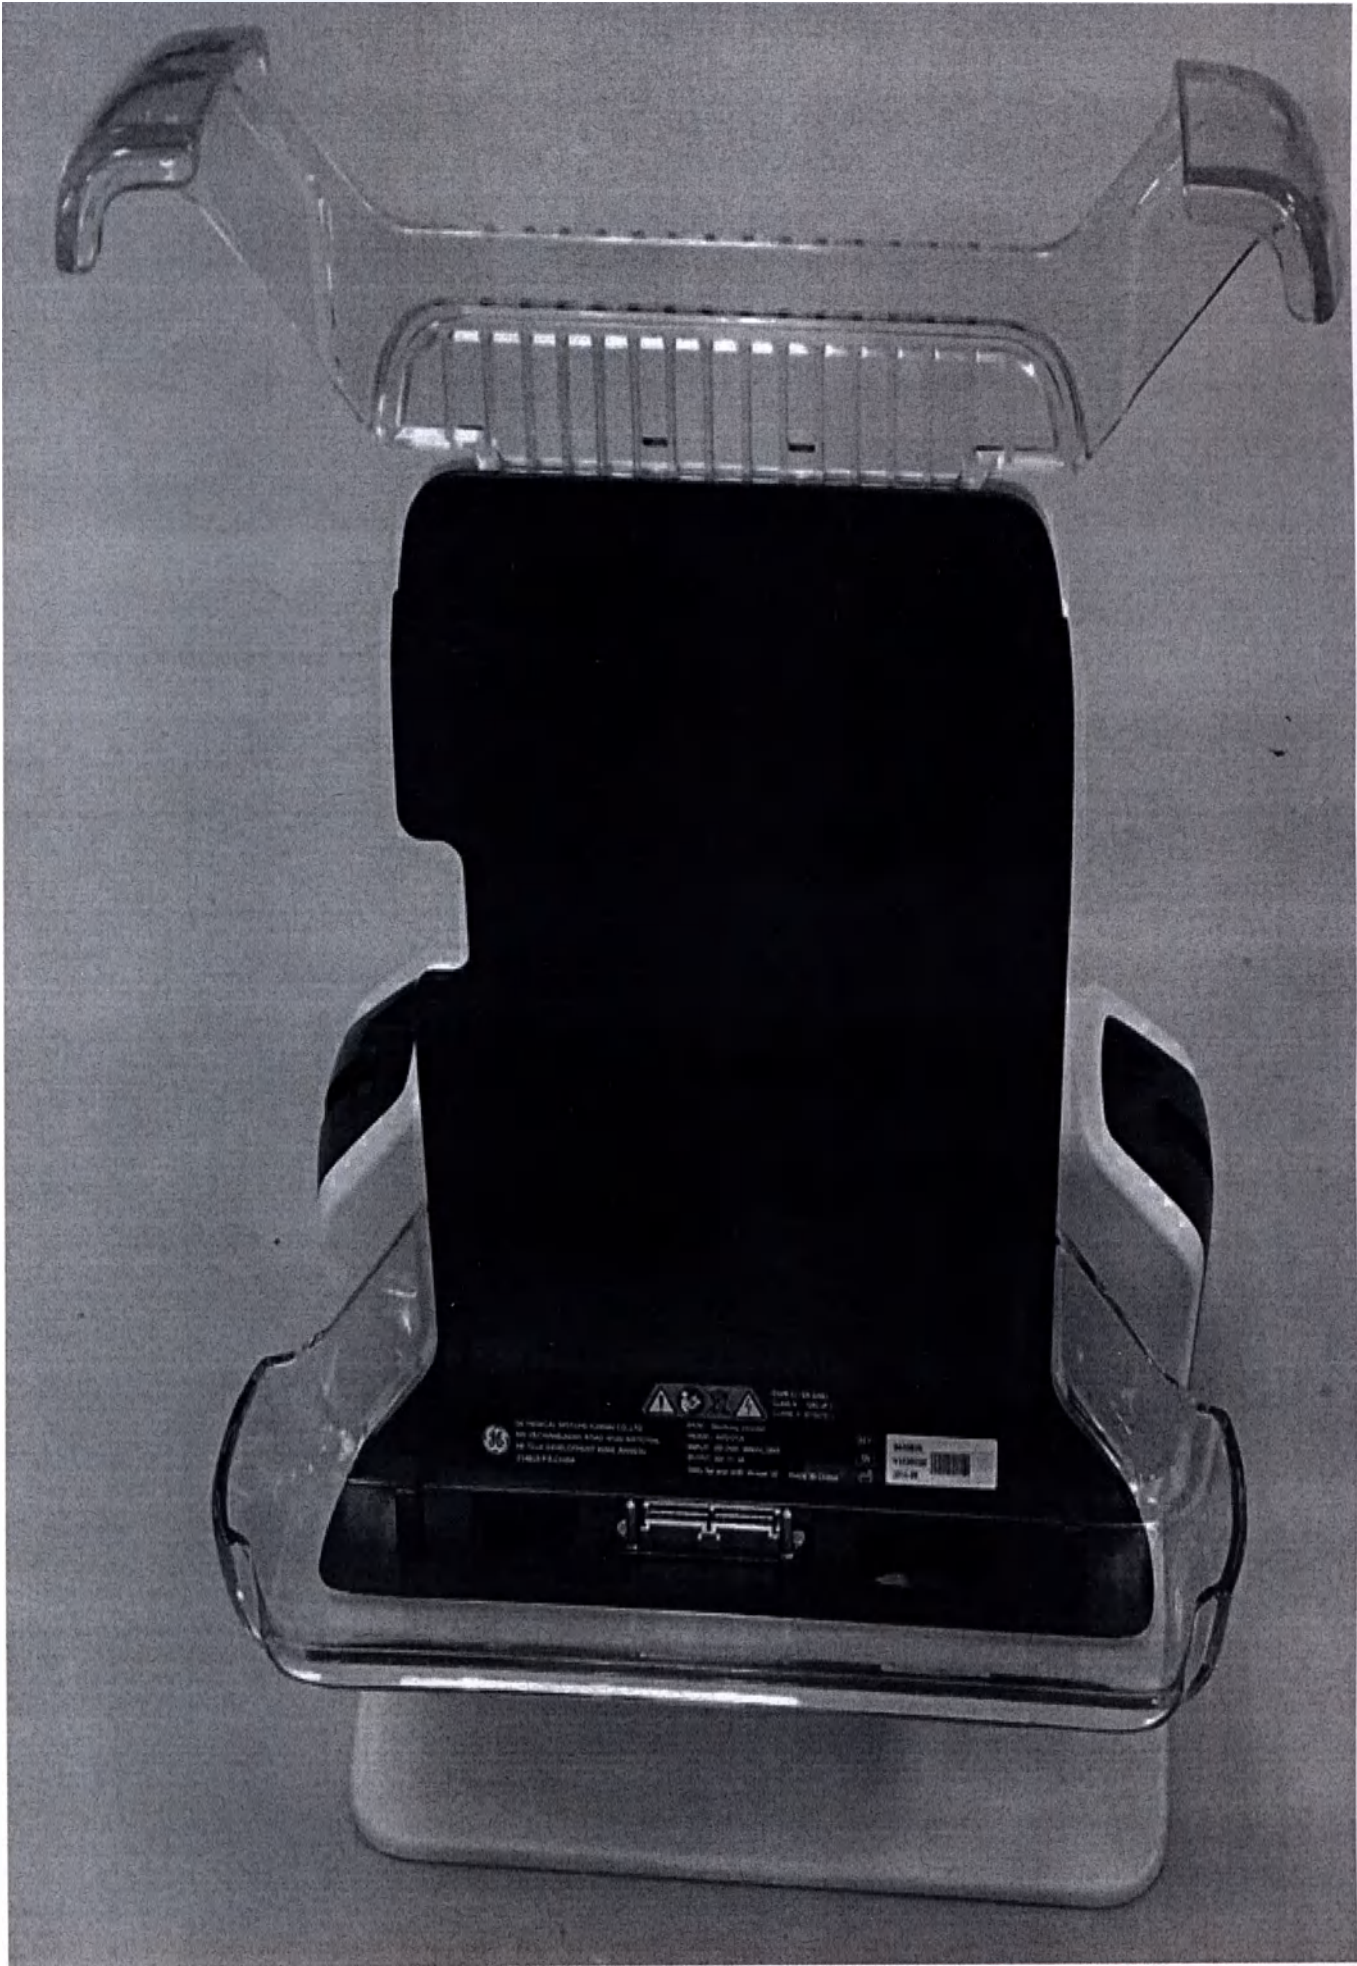

36. Полка для дополнительных принадлежностей и расходных материалов

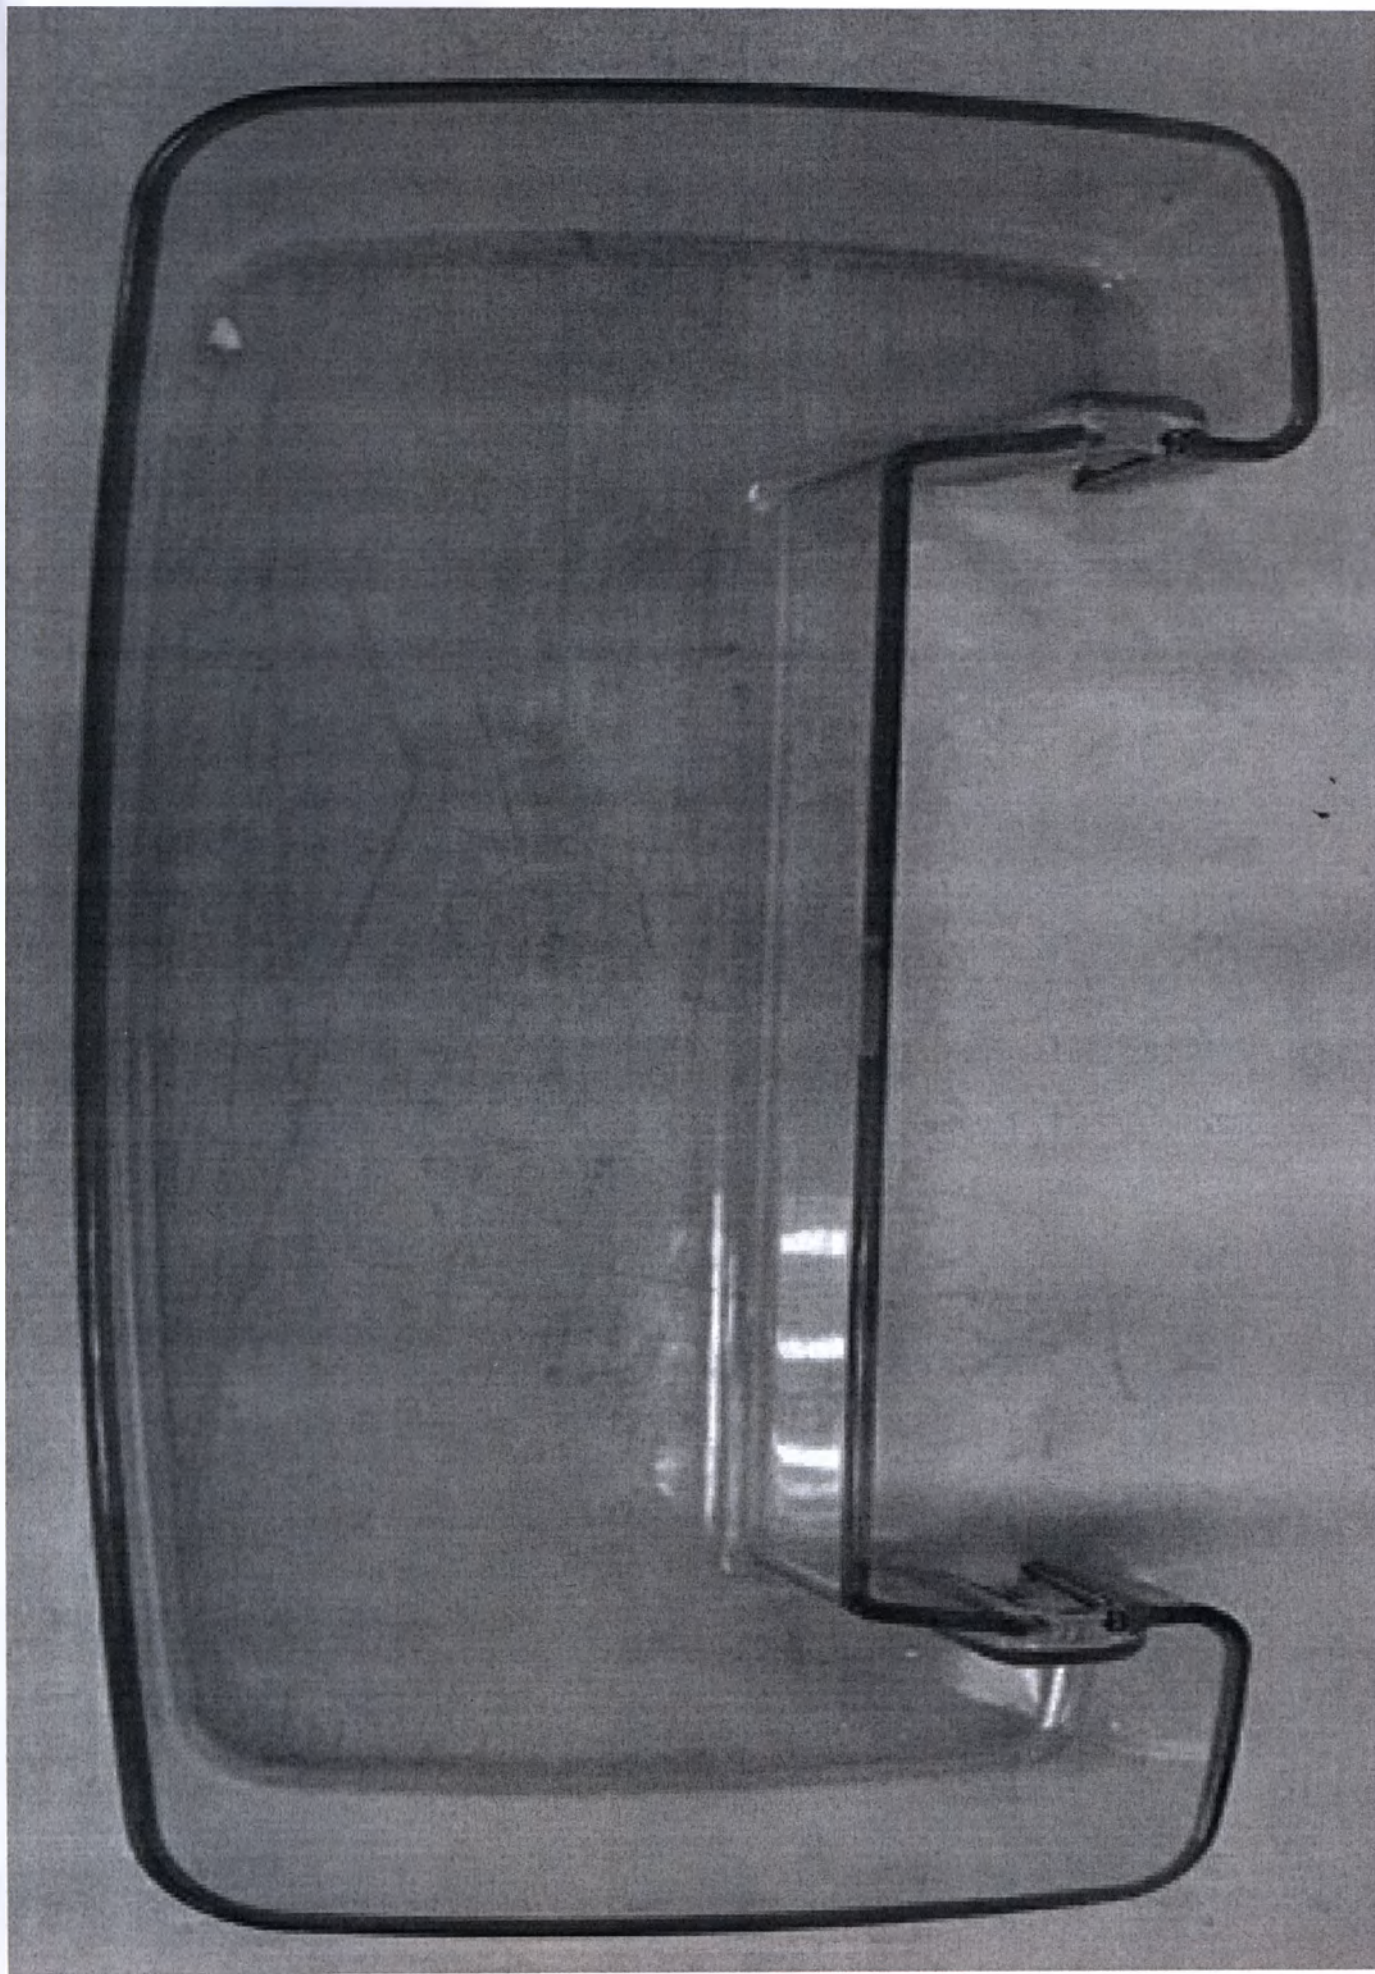

37. Корзина для принадлежностей и расходных материалов

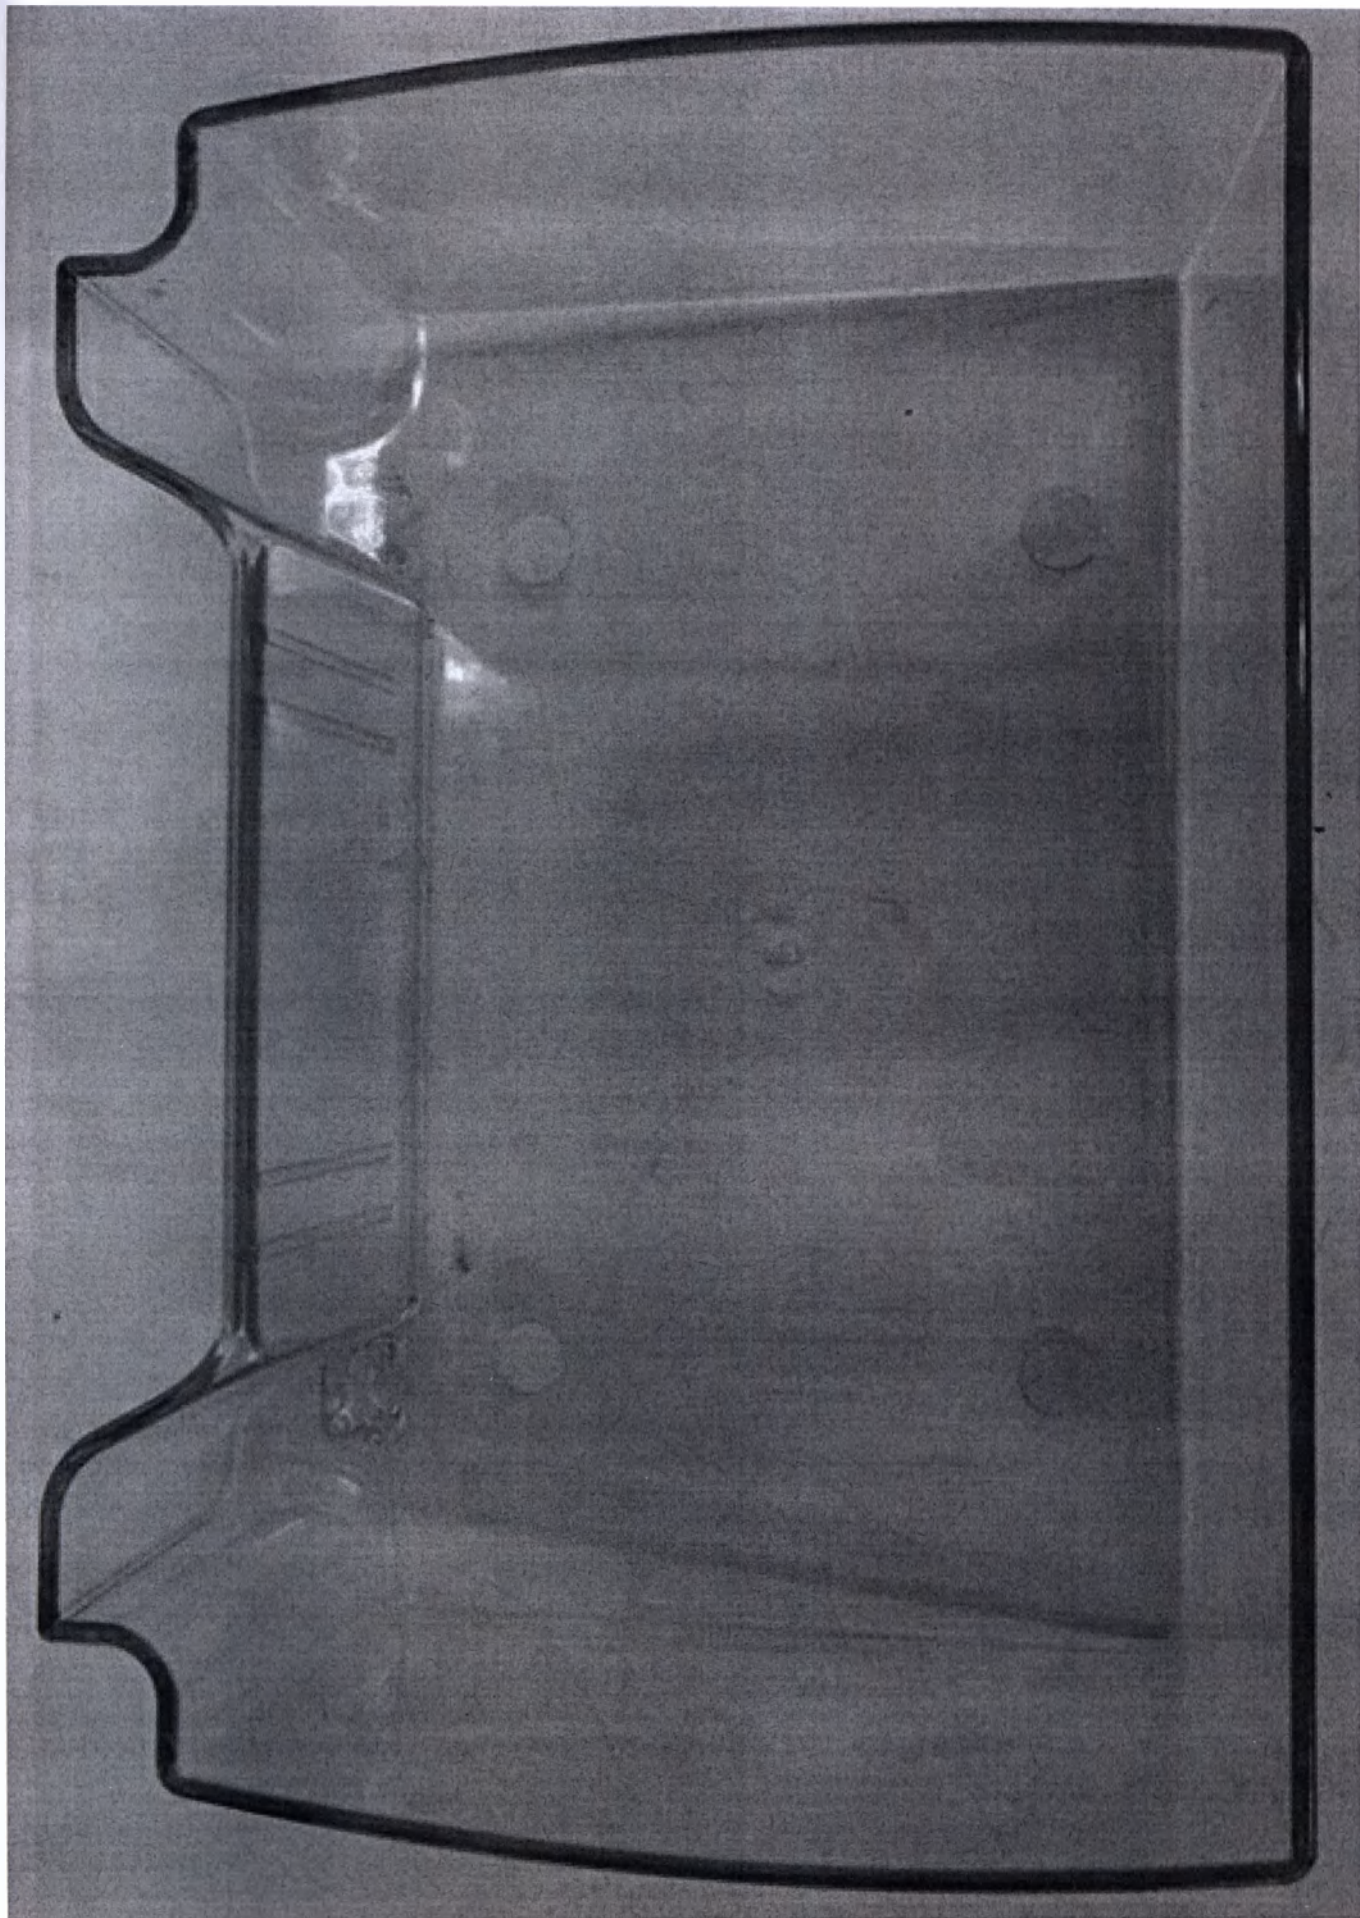


38. USB-накопитель для хранения медицинских ультразвуковых изображений. (не более 2 шт.)




39. SD-карта для хранения медицинских ультразвуковых изображений. (не более 2 шт.)




40. Устройство для подключения карт SD к компьютеру.

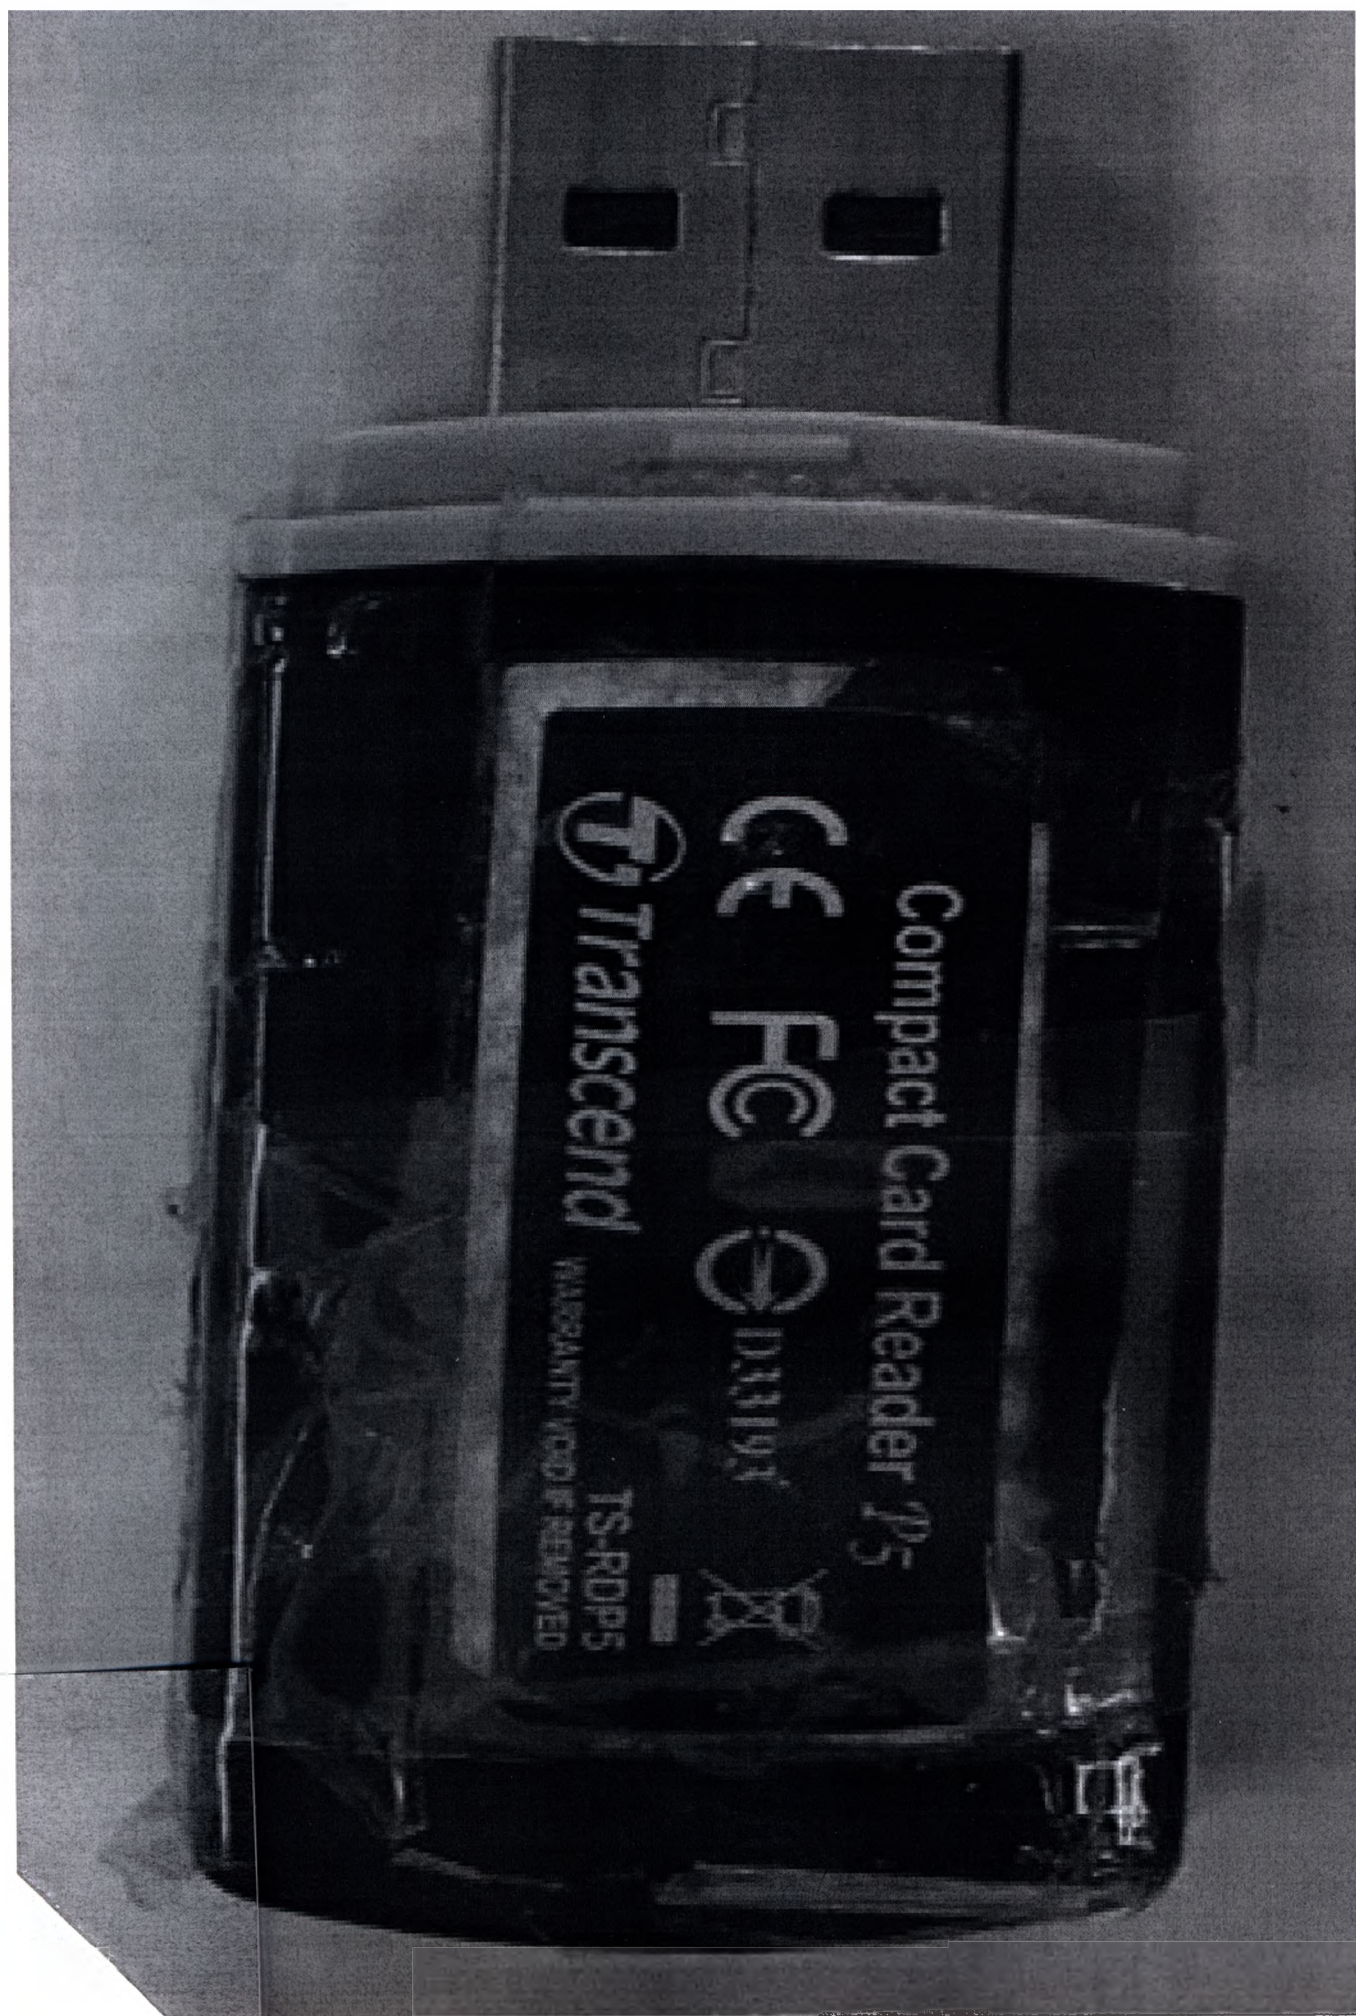


41. Устройство печатающее черно-белые ультразвуковые изображения

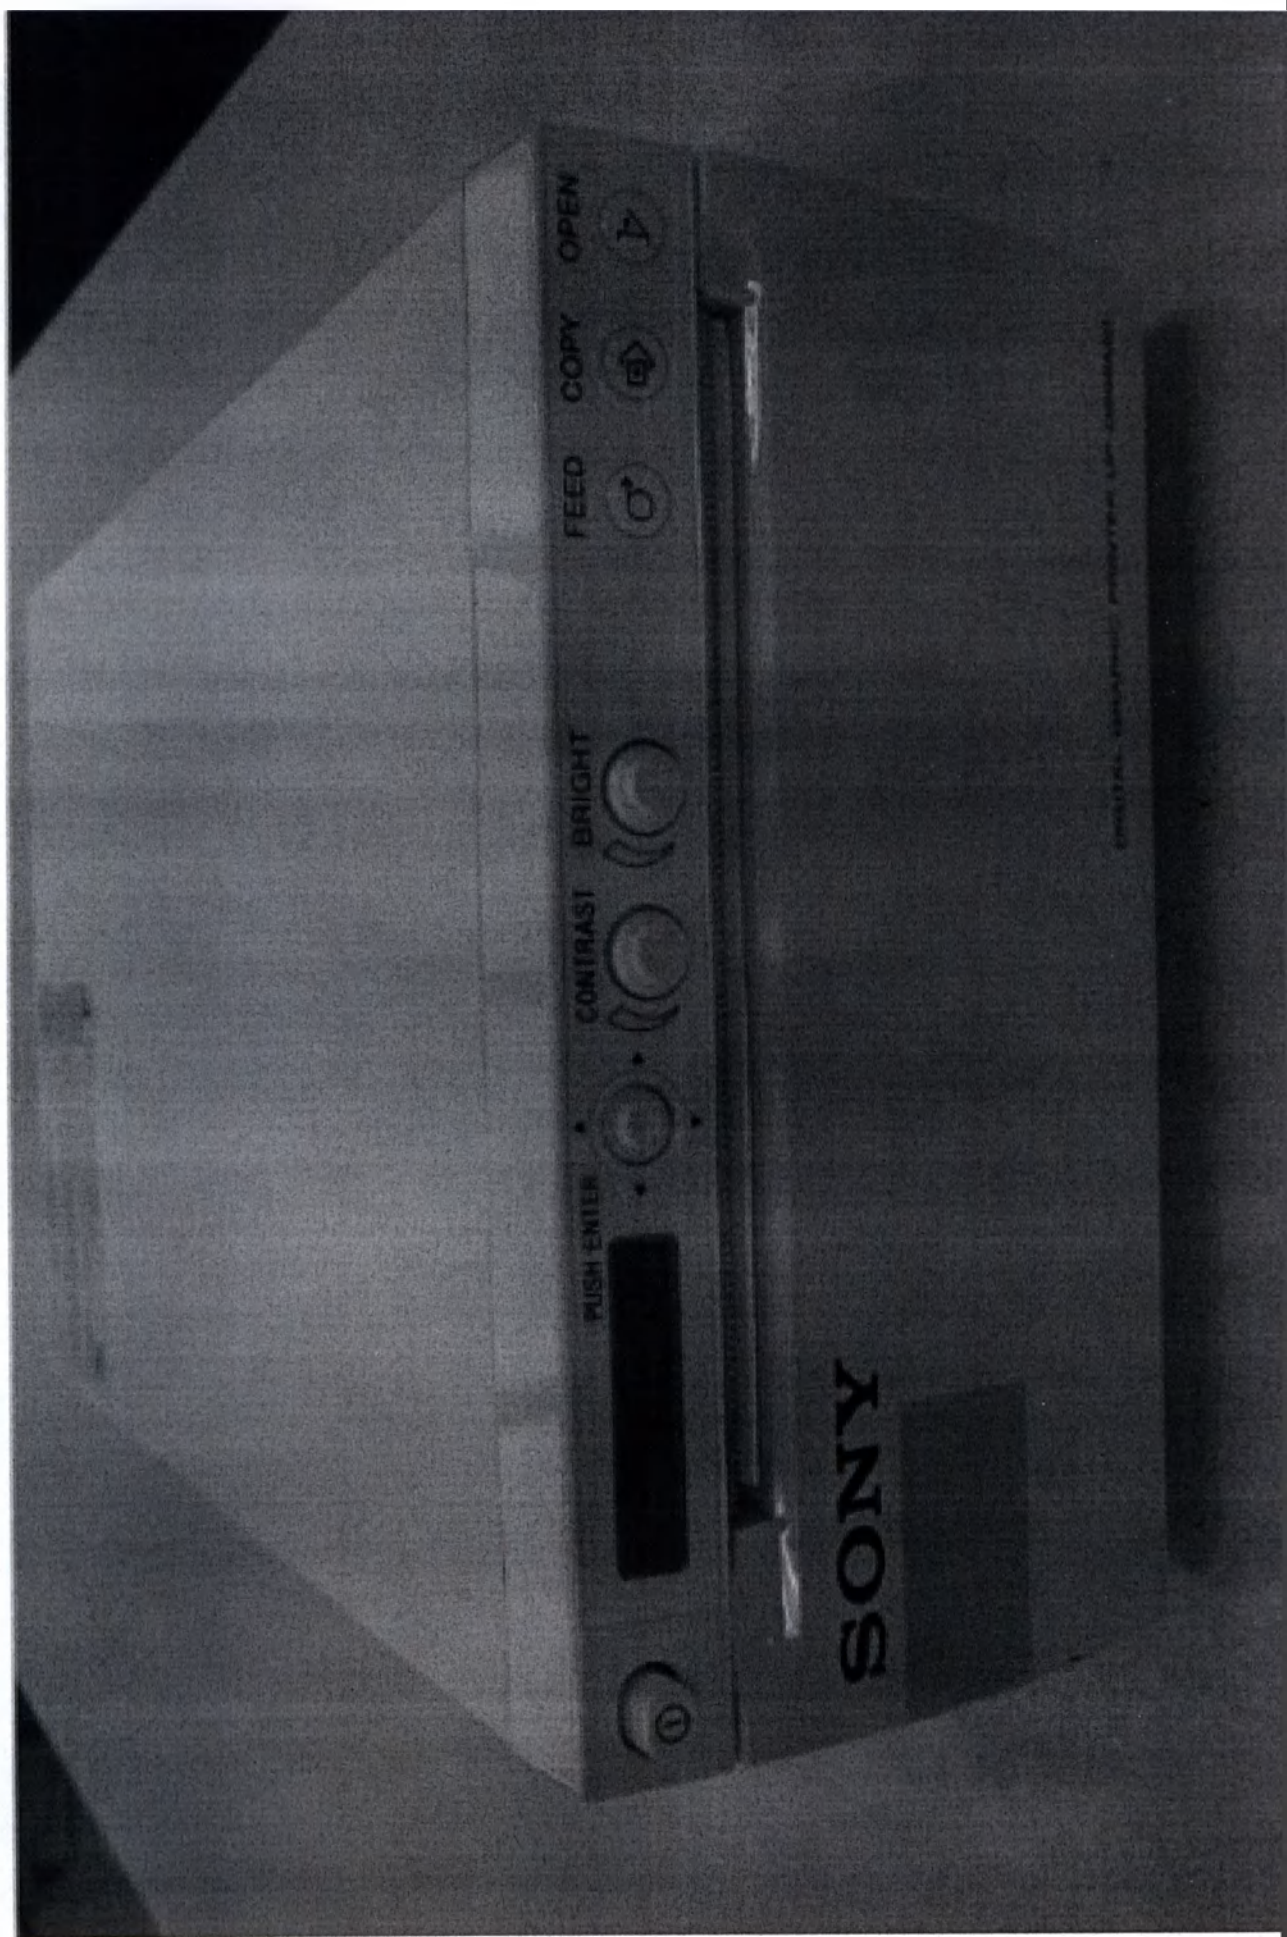


42.Крепеж для устройства, печатающего черно-белые ультразвуковые изображения Монтажный комплект принтера для установки черно-белого принтера

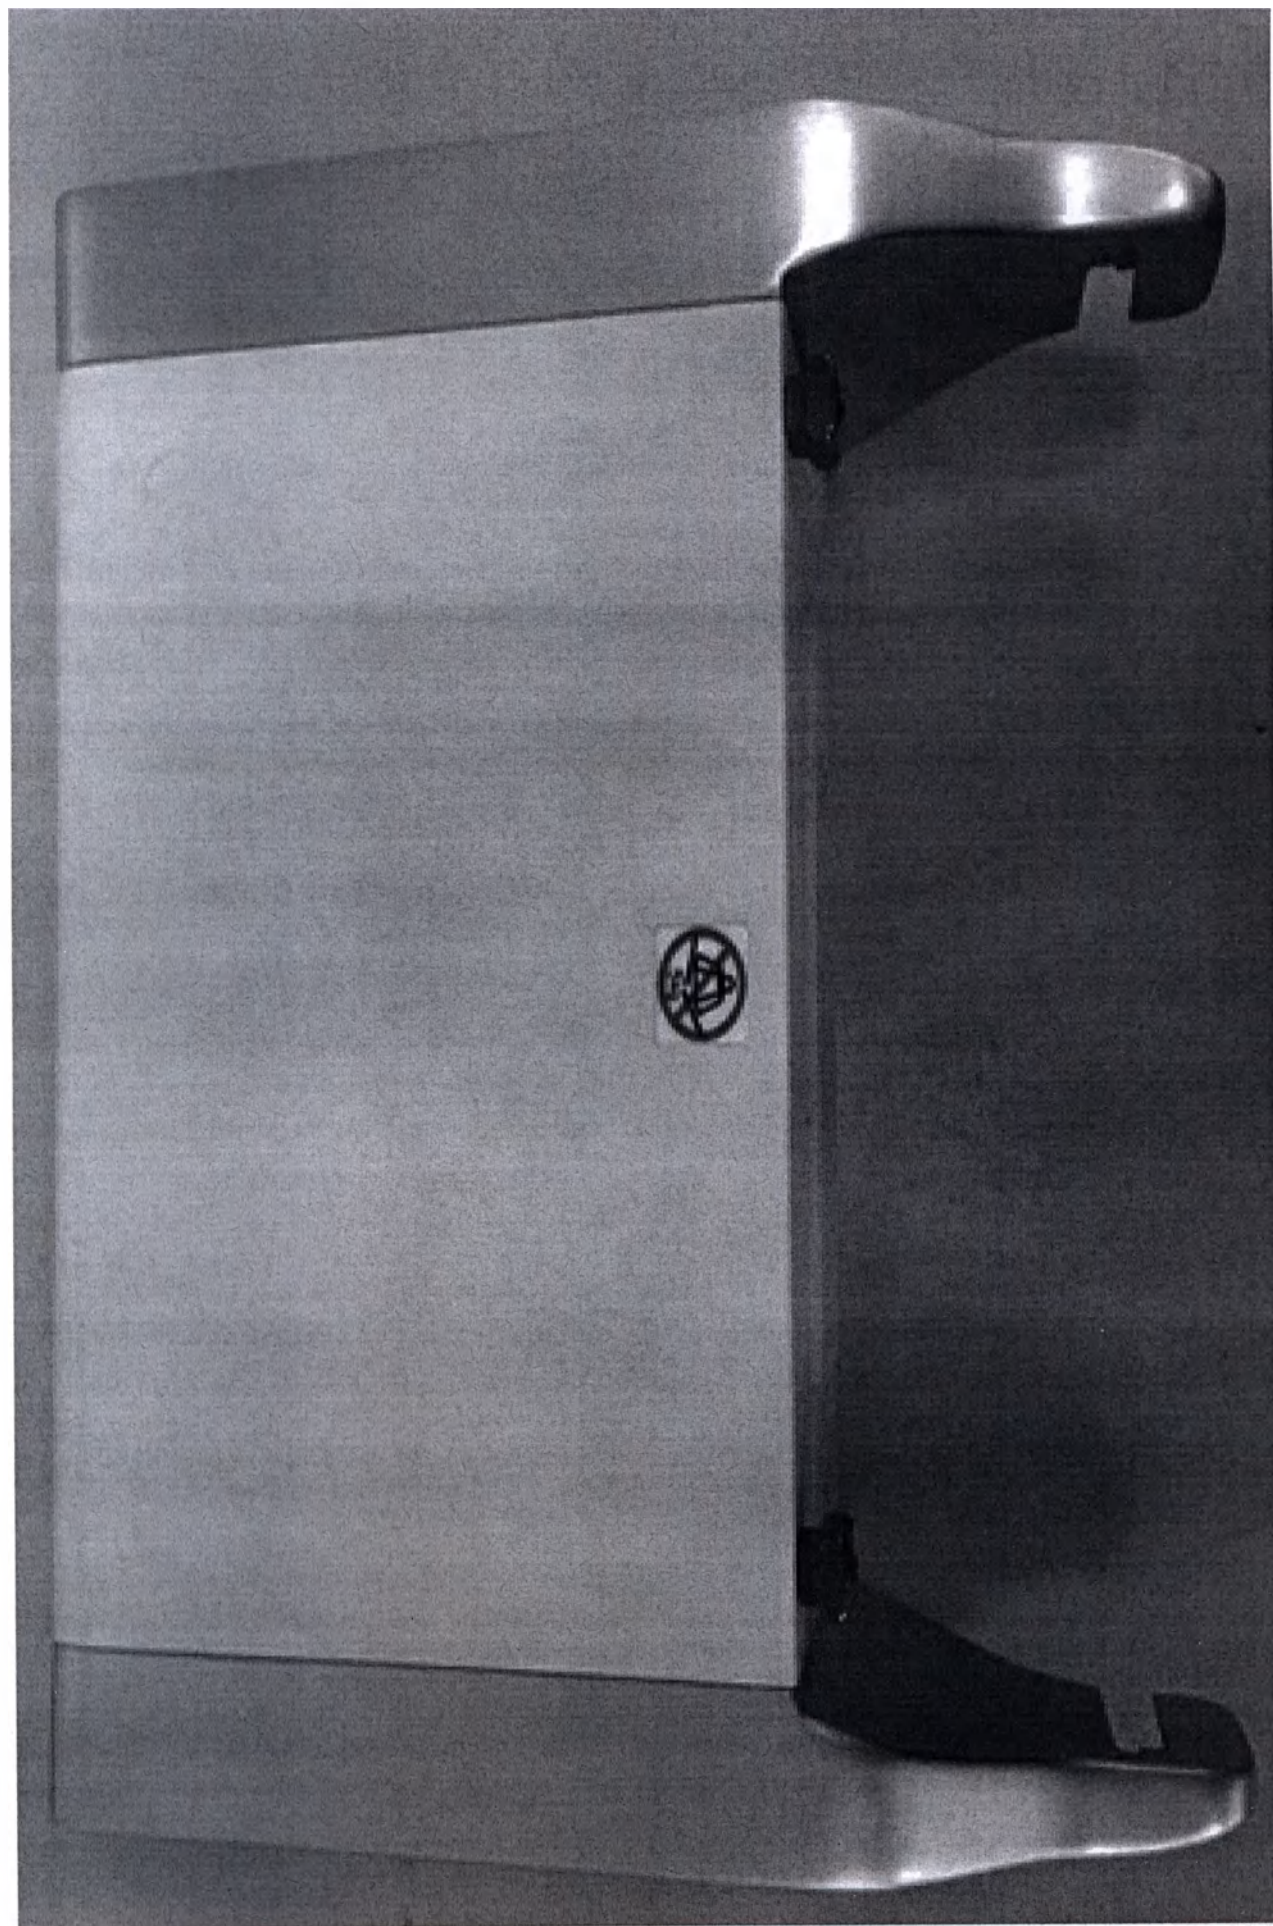


43.Бумага 110 мм для устройства, печатающего черно-белые ультразвуковые изображения. (не более 50 шт.)

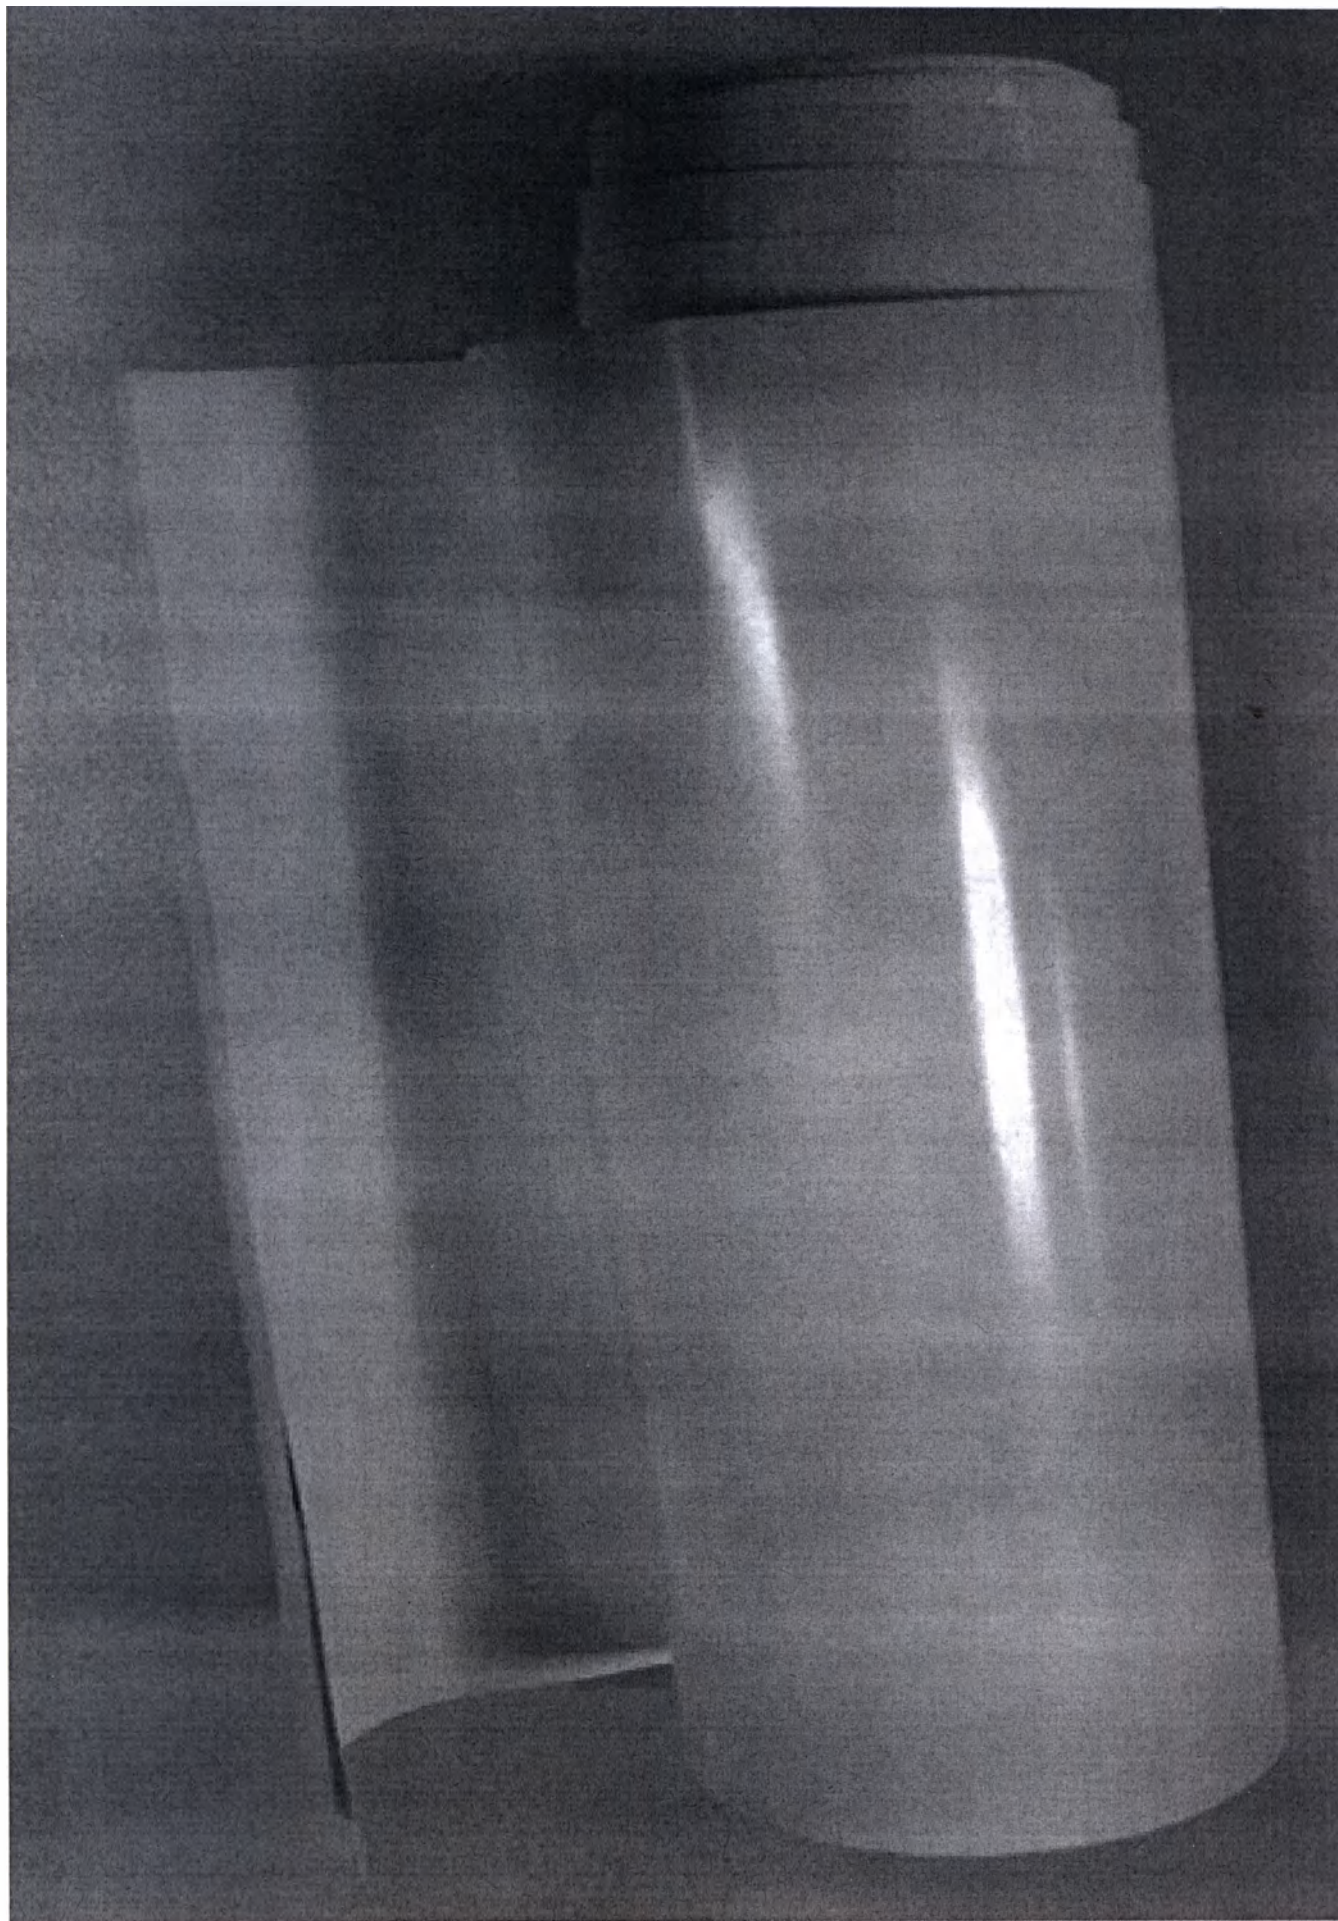

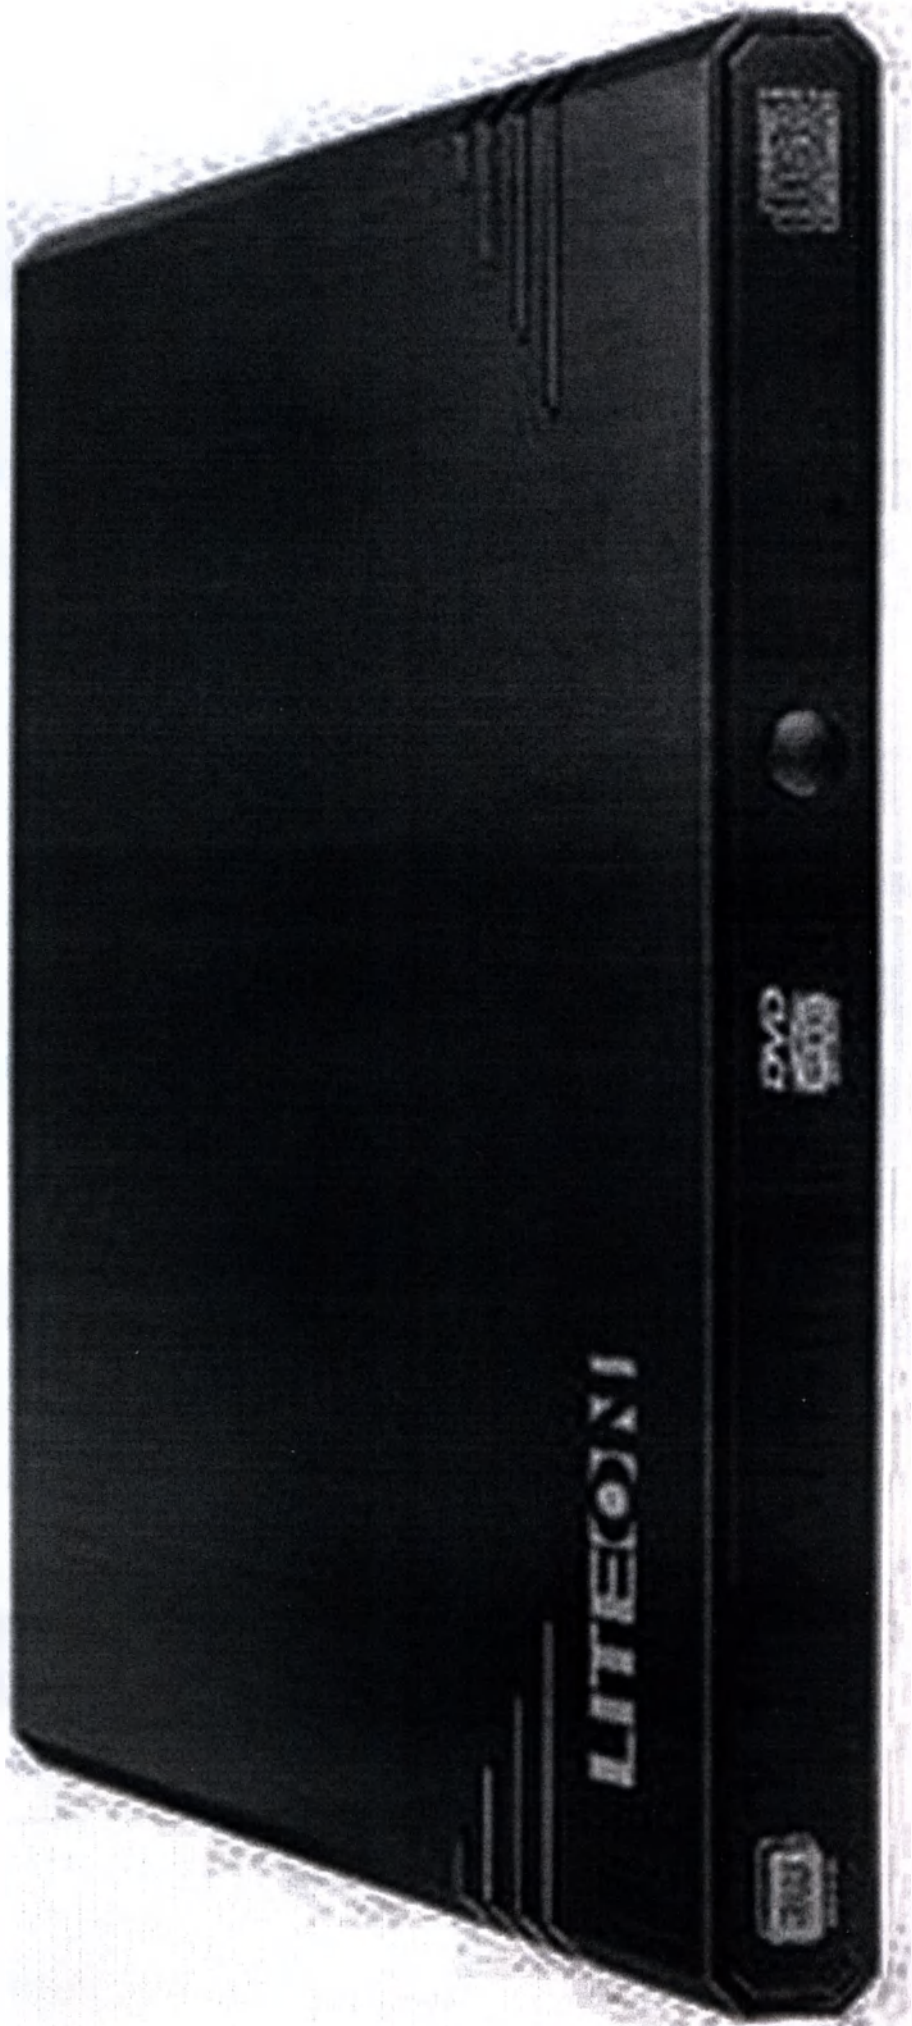

45. Программное обеспечение для модернизации ультразвуковой консоли на CD диске или USB флеш карте

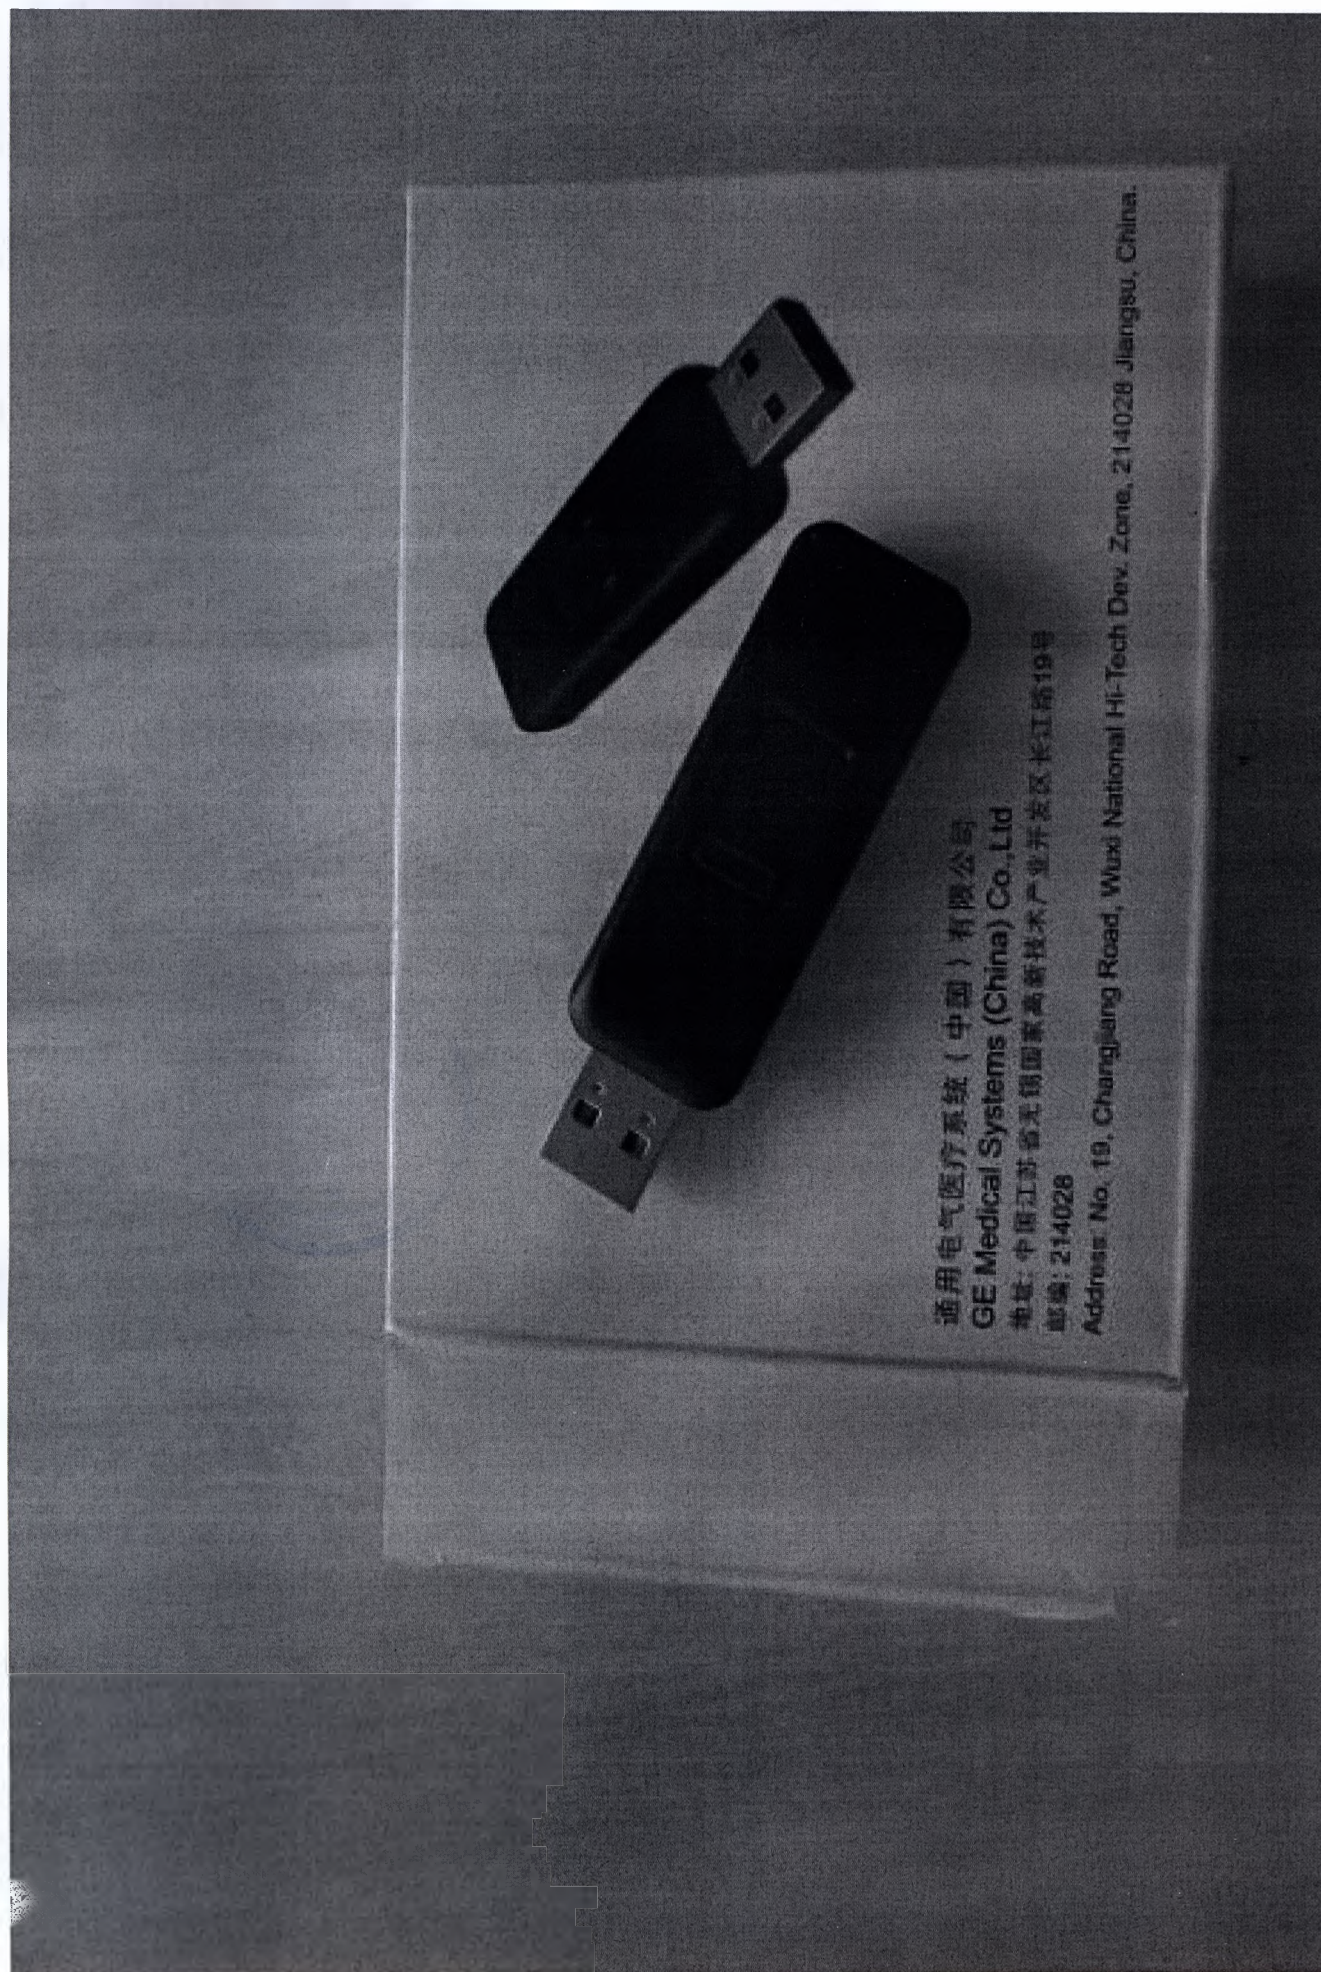

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

50 (подпись) лист(ов)

Суханова И.А.

