


ПОДТВЕРЖДАЮ

Директор Бизнес - подразделения
«Лабораторная диагностика»
Д.В. Юсупов

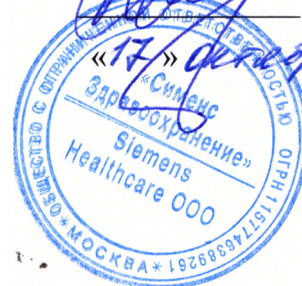

2017 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
ДИАГНОСТИКИ IN VITRO**


Аппарат для окрашивания мазков автоматический, настольный Nematek 3000, с
принадлежностями

производства Сименс Хелсха Диагностикс Продактс ГмбХ.", Германия (Siemens
Healthcare Diagnostics Products GmbH.)



Фото 1. Аппарат для окрашивания мазков автоматический, настольный Hematek 3000, с принадлежностями

Фото 2. Аппарат для окрашивания мазков автоматический, настольный Hematek 3000

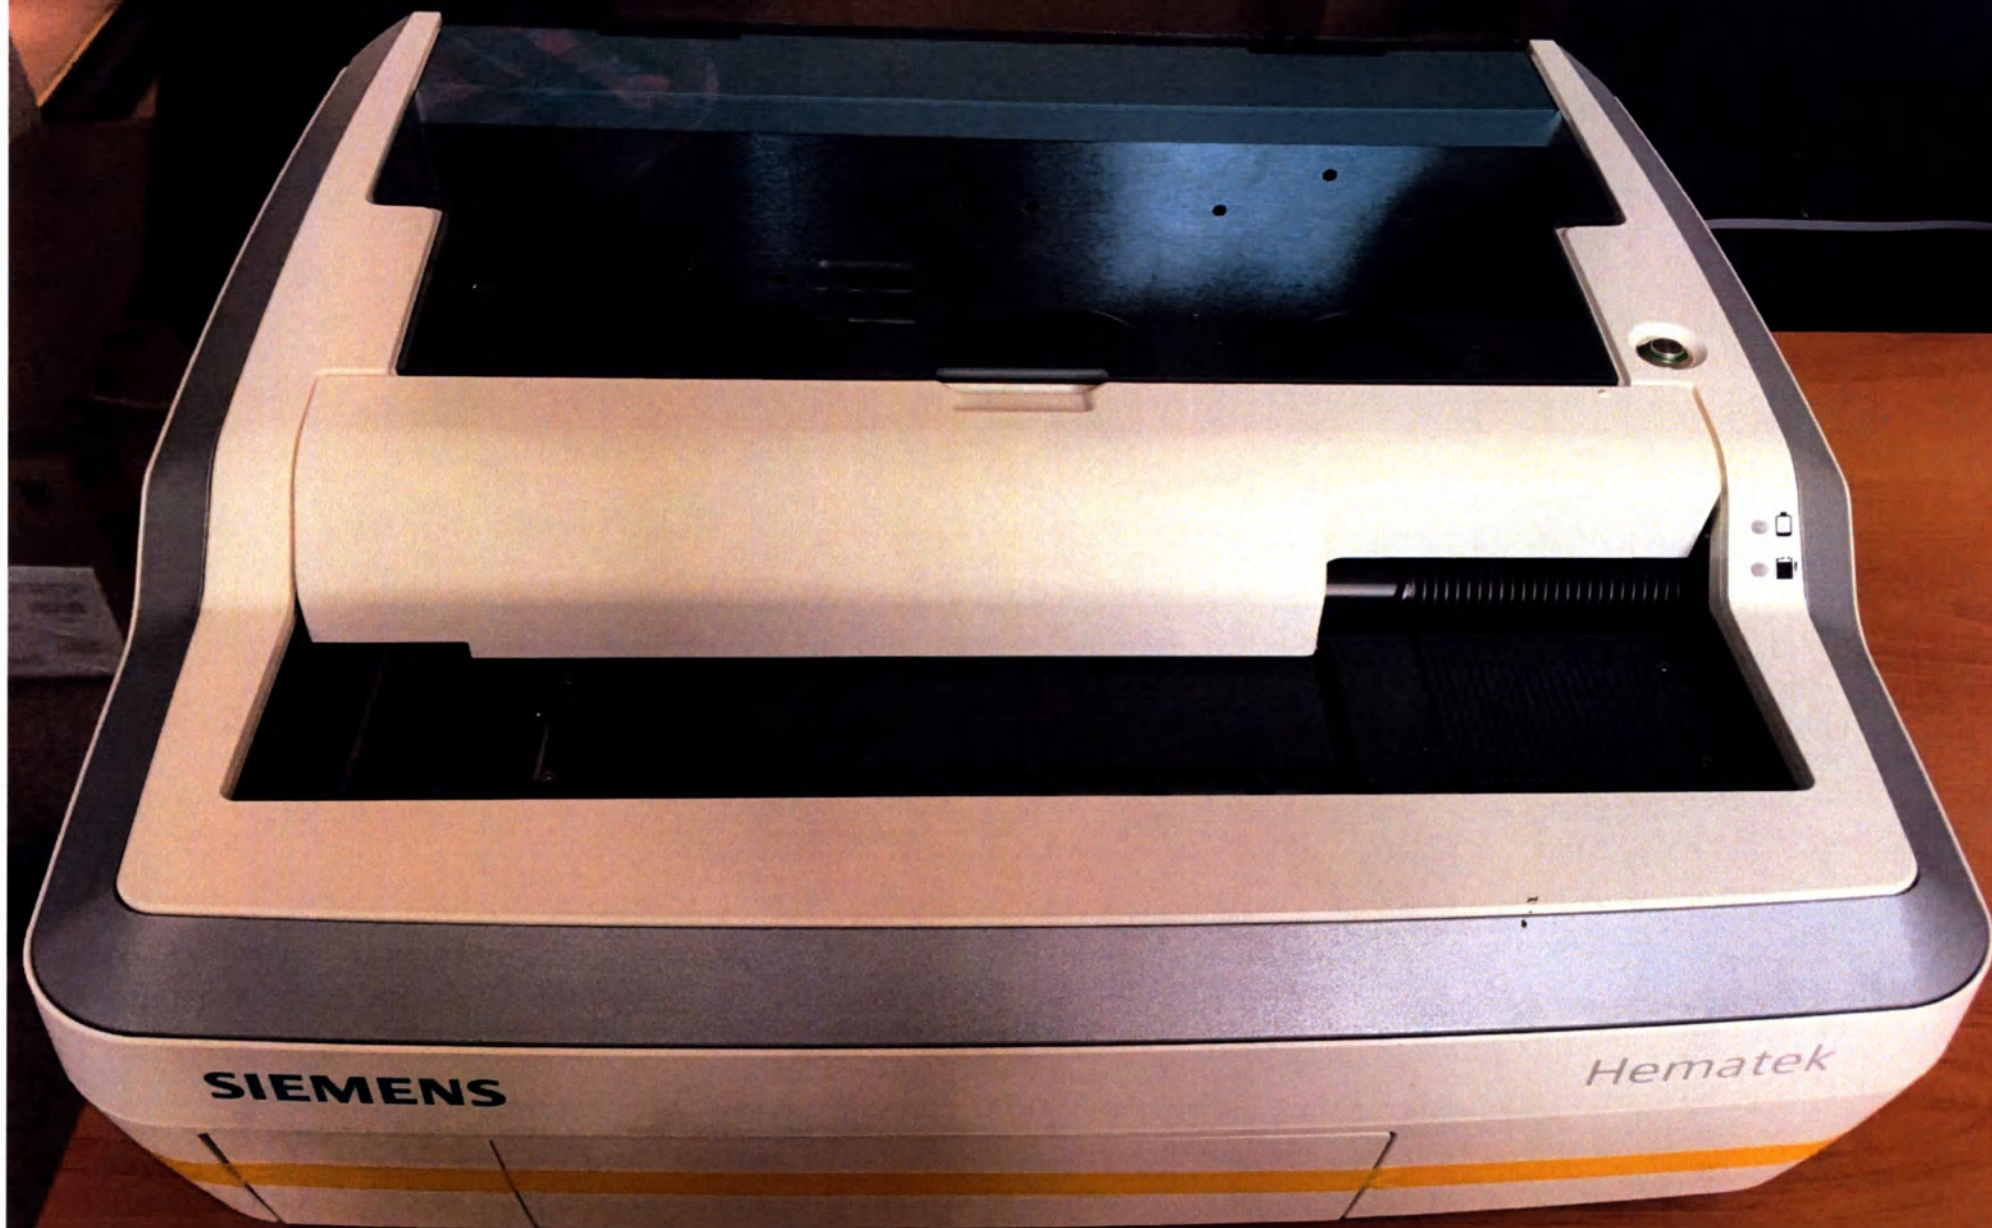



Система Hematek® 3000

Руководство по эксплуатации

– Инструкция по применению –

Редакция инструкции: 1.3
Дата выпуска: 2015-01



Мы оставляем за собой право на внесение изменений, обусловленных техническим развитием, без предварительного предупреждения.

© 2015 Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH. Все права защищены.

Emil-von-Behring-Str. 76
35041 Marburg
Германия

Не допускается копирование или распространение каким-либо образом данной инструкции без предварительного письменного согласия Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH.

11209646


SIEMENS


Принадлежности

Фото 5. Набор канюль (Cannula Set)



Фото 6. Набор трубок для насоса (Pump Tube Set)

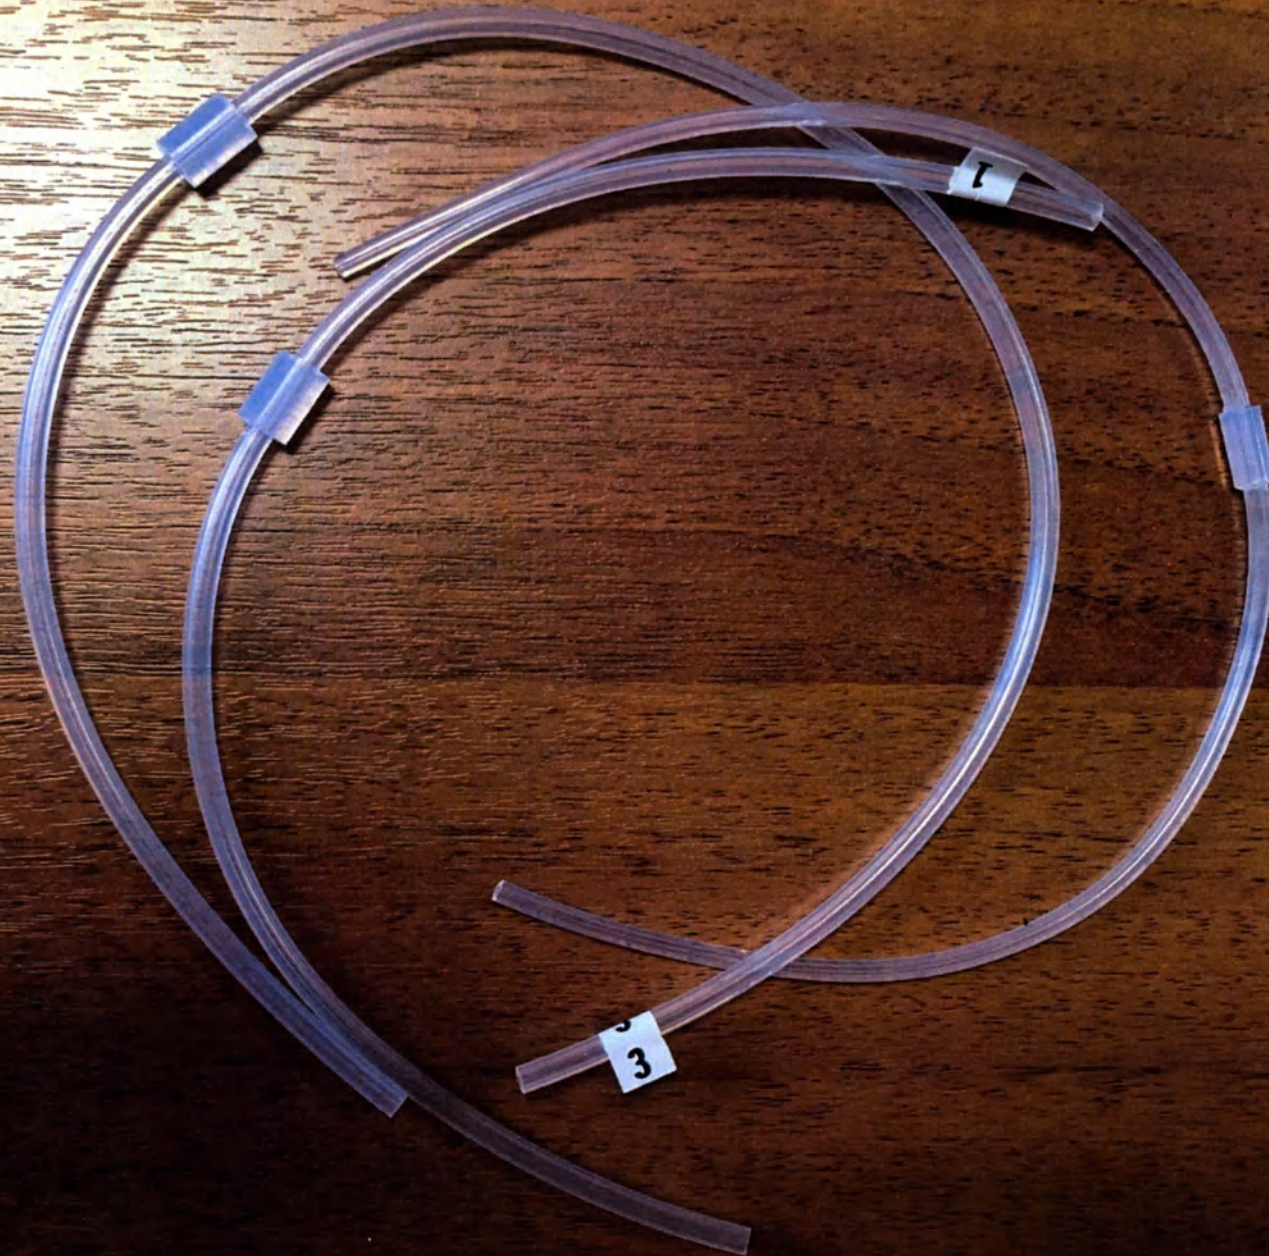

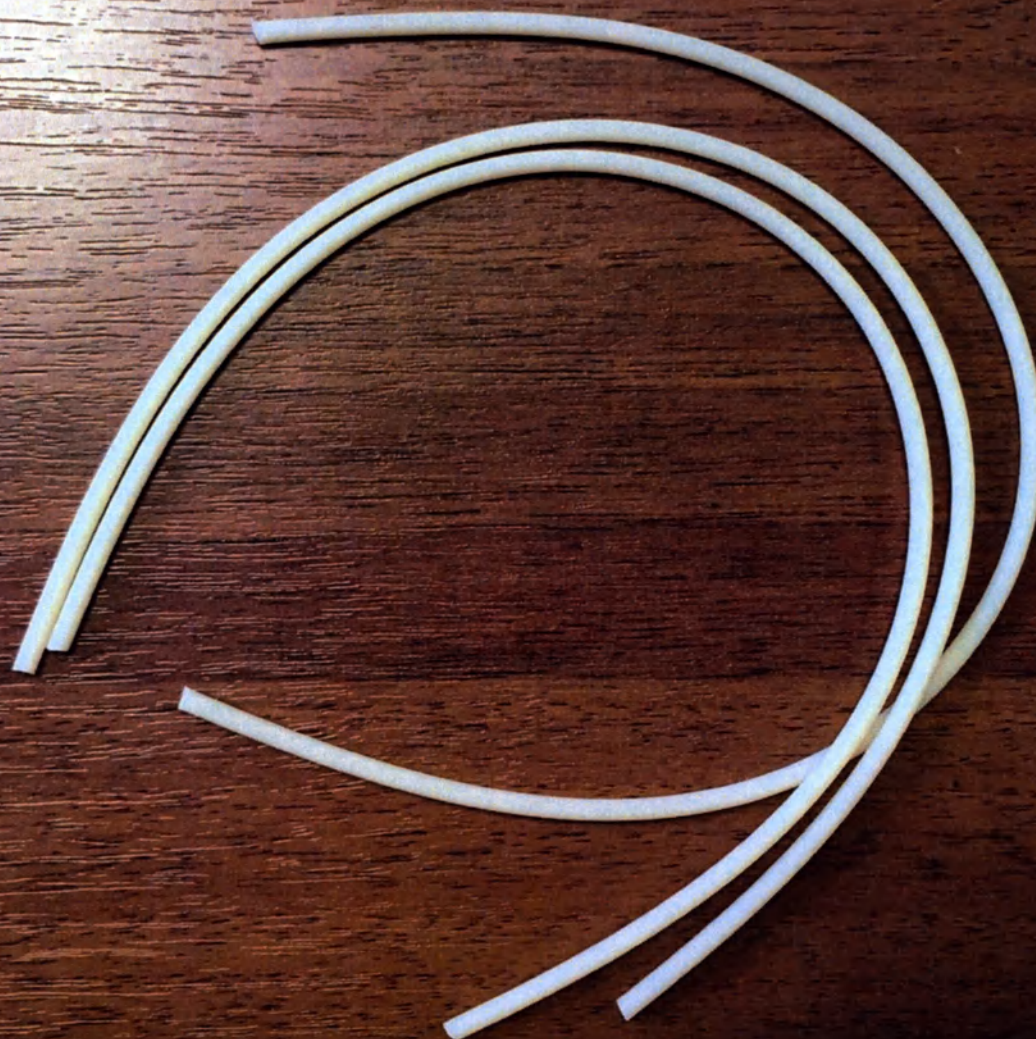



Всего прошито/пронумеровано

10 листа (ов)

[Signature]
Подпись

Д.В. Кучков
ФИО

