



Порт-система имплантируемая инфузионная, варианты исполнения:


1. T-Port Contrast (базовая комплектация).

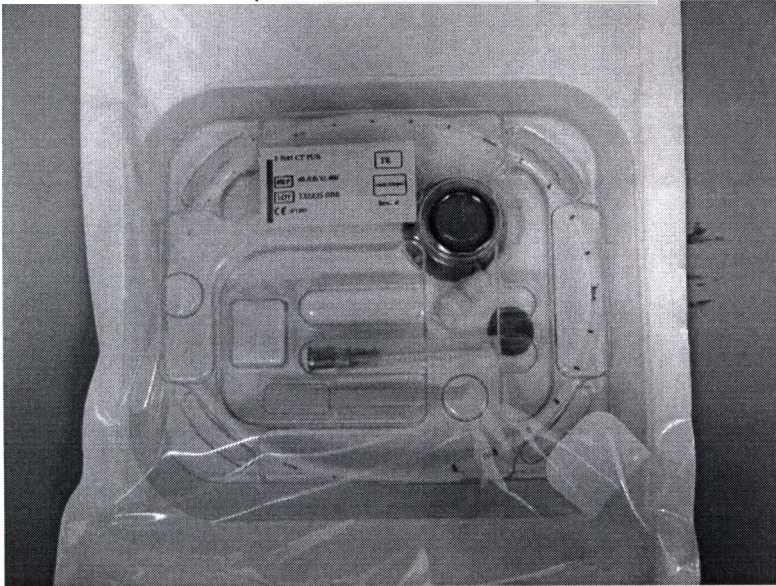


2. T-Port (полная Set комплектация).

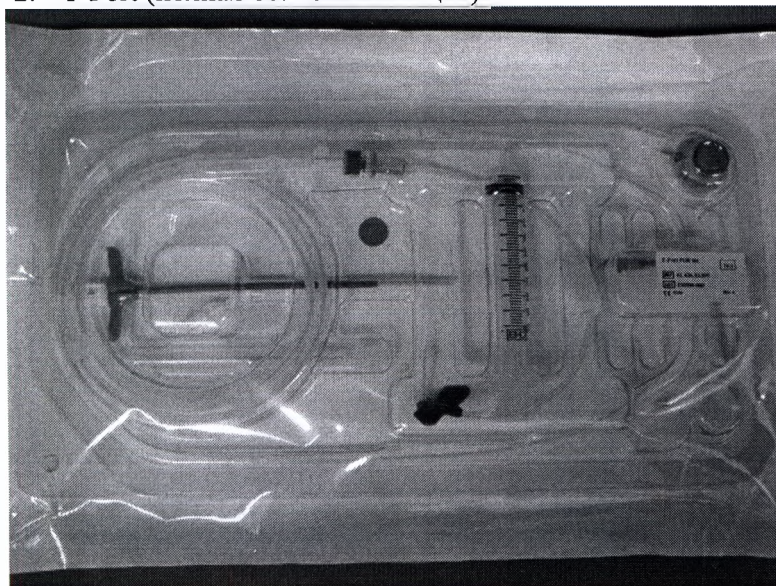


3. T-Port Low Profile Contrast (базовая комплектация).

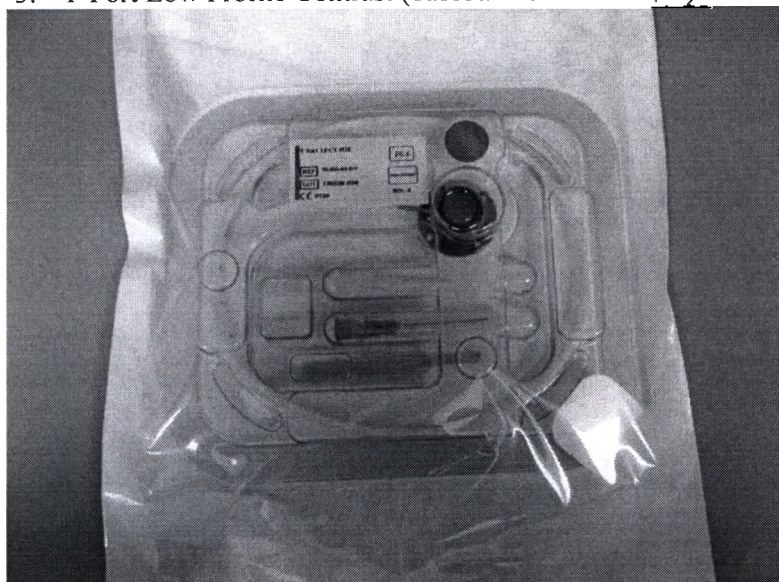

4. T-Port Low Profile (полная Set комплектация).

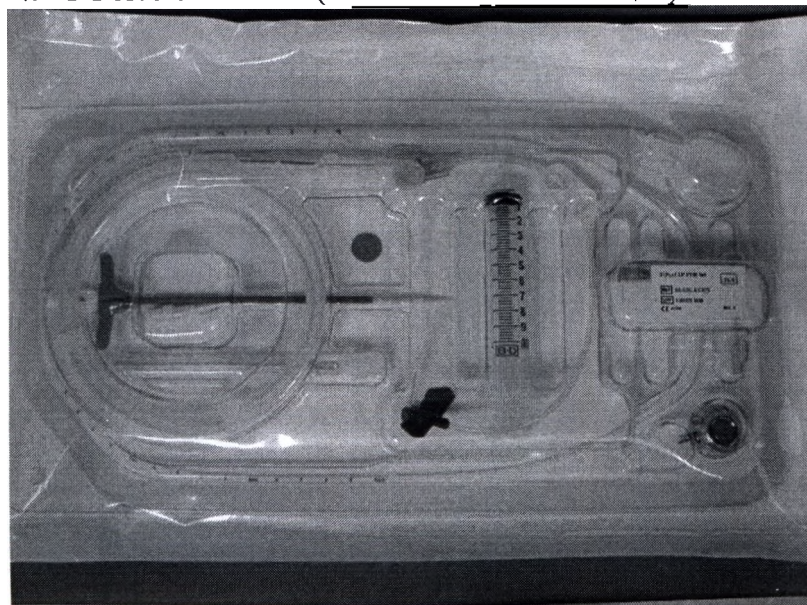


5. TitaJet Light (полная Set комплектация).

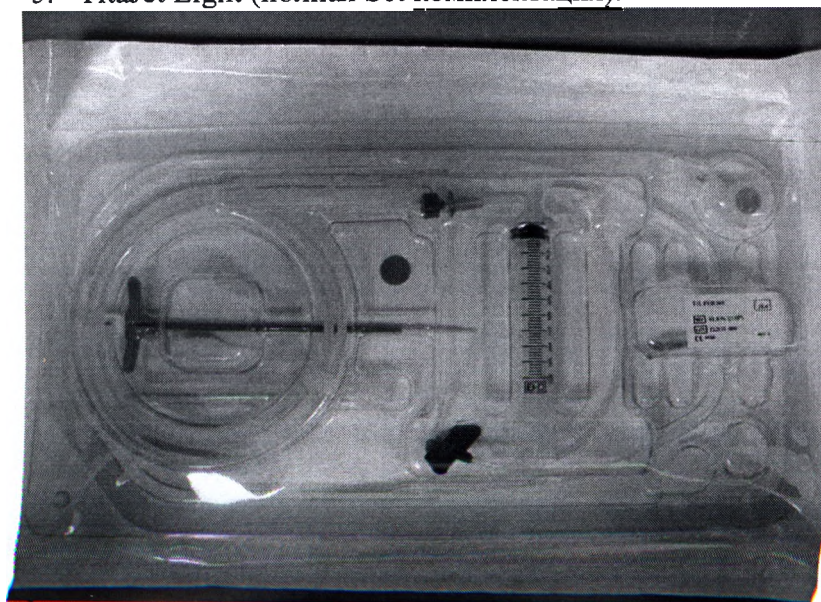


6. TitaJet Light II Contrast (TJL II contrast) (стандартная K-Set комплектация).




7. TitaJet Light Dual Contrast (DualPort Contrast) (полная Set комплектация).

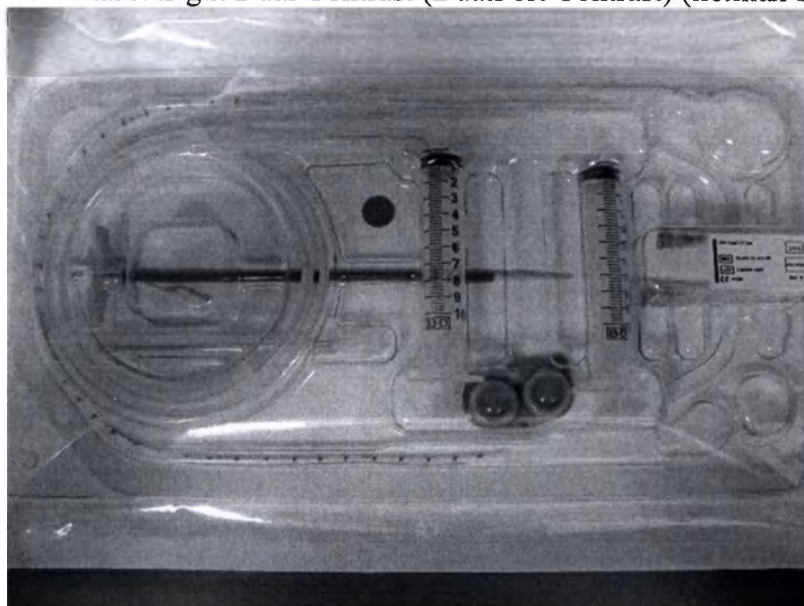


8. TitaJet Light Low Profile Contrast (TitaJet Light LP Contrast) (стандартная K-Set комплектация).

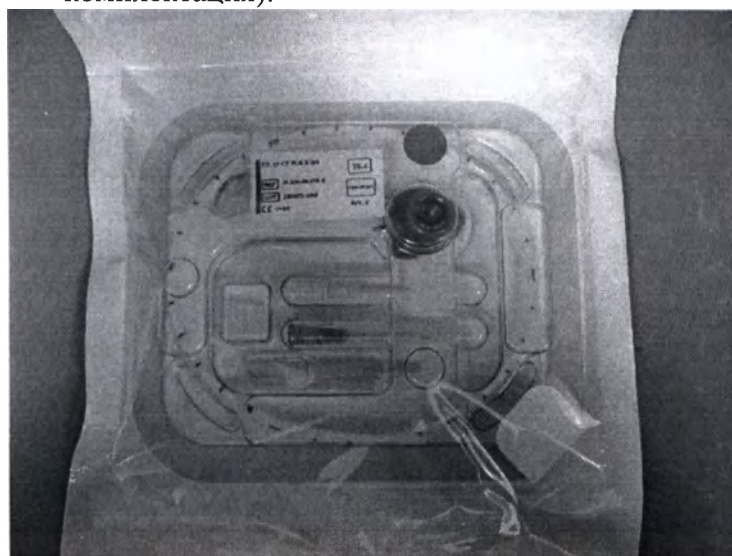


9. Jet Port Plus (базовая комплектация).

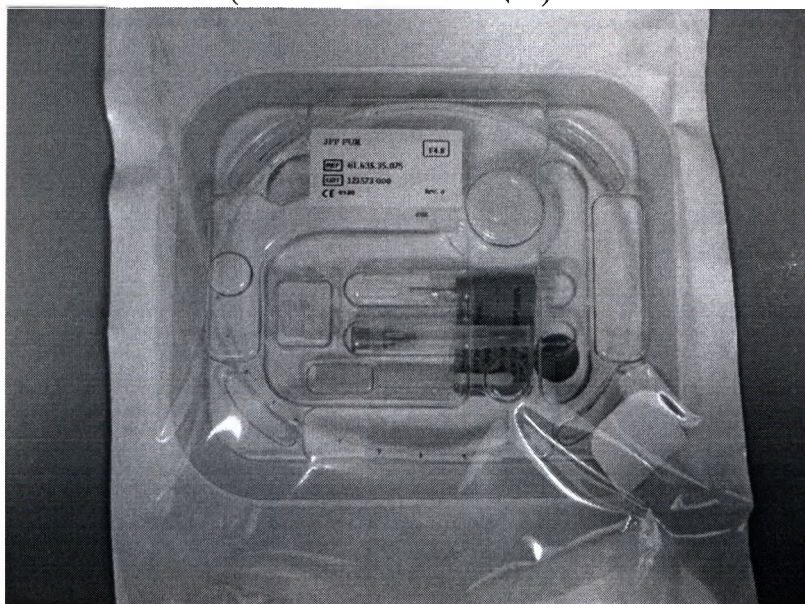

10. Jet Port Plus II Contrast (JPP II contrast) (базовая комплектация).

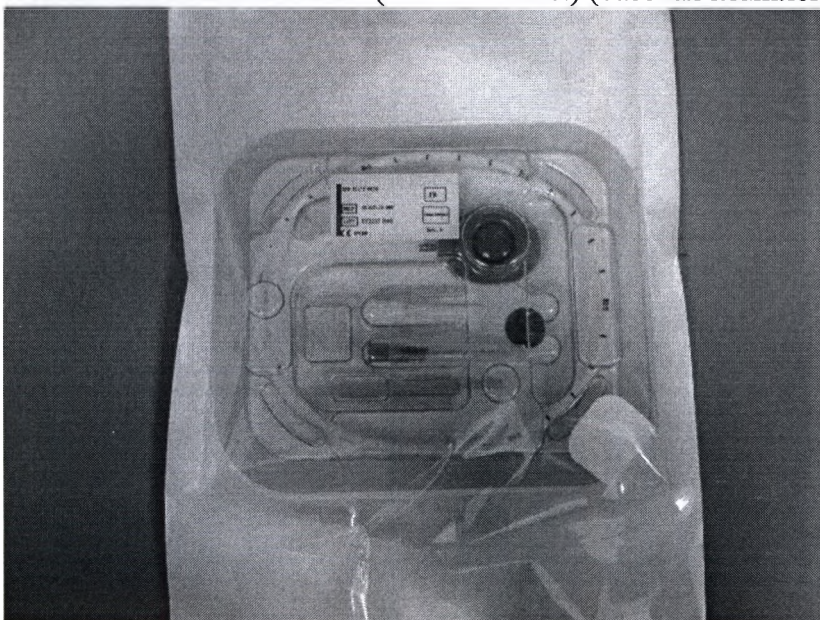


11. Jet Port Plus Arterial II (Jet Port Plus II) (базовая комплектация).

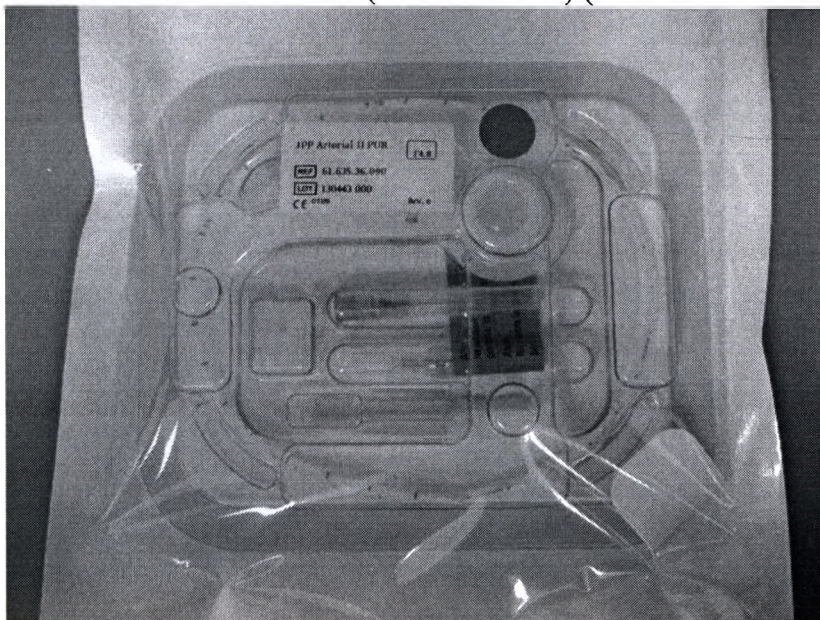


12. Jet Port Plus Allround (базовая комплектация).



13. Low Profile Peripheral (Jet Port Plus Low Profile) (полная Set комплектация).

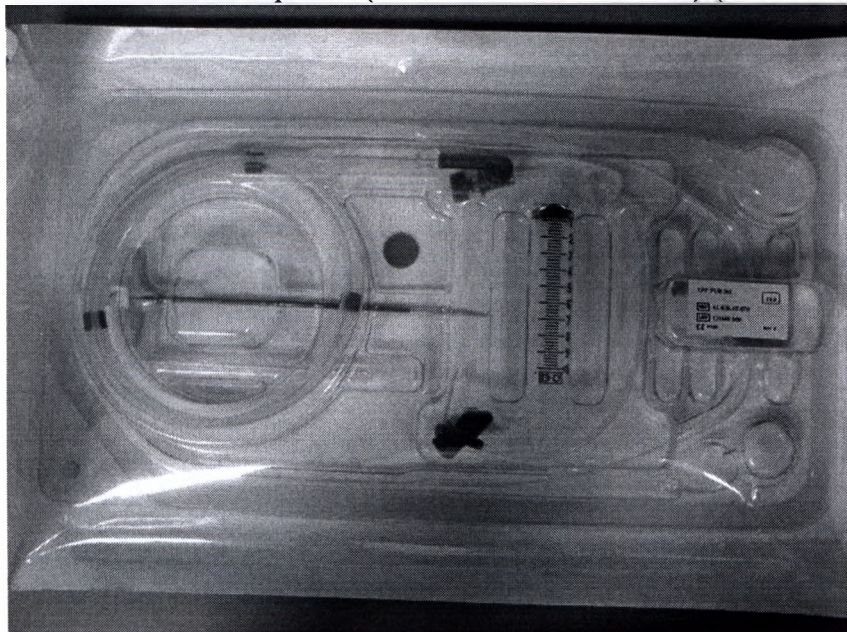


14. Portolino (базовая комплектация, катетер полиуретановый).

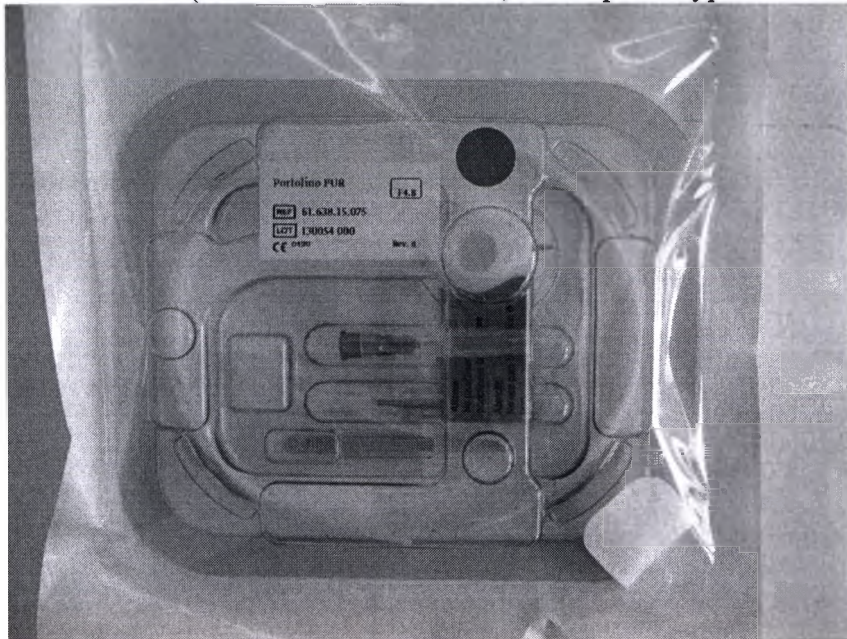

Принадлежности:


1. Игла Губера типа Jetcan прямая.

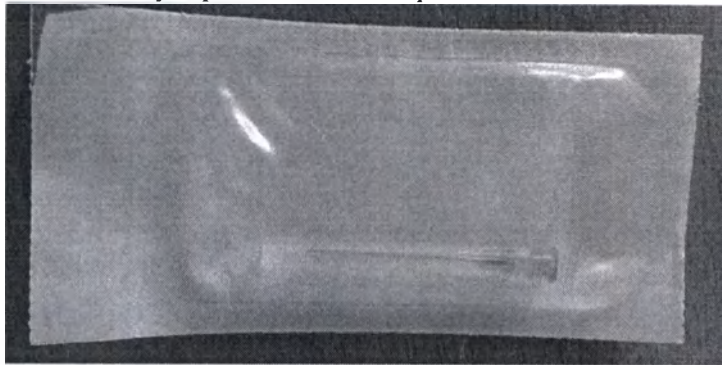


2. Игла Губера типа Jetcan изогнутая, с удлинителем.



- ### 3. Игла Губера типа OncoGrip.

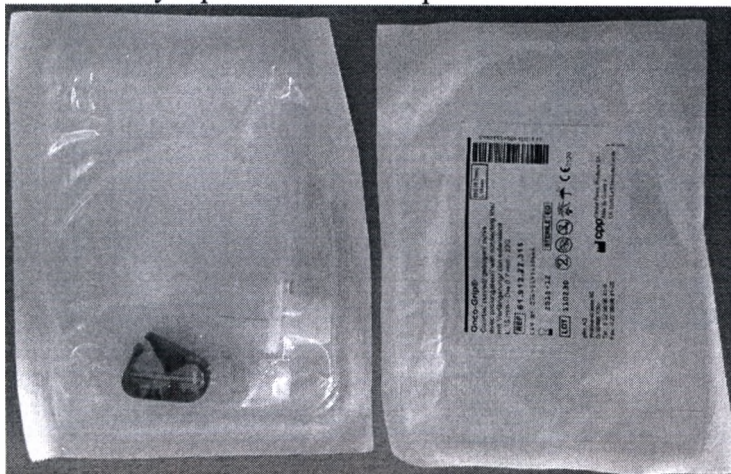

4. Игла Губера инфузионная типа EZ Huber, производства «Бард Эксесс Системс, Инк.» (Bard Access Systems, Inc.), США.

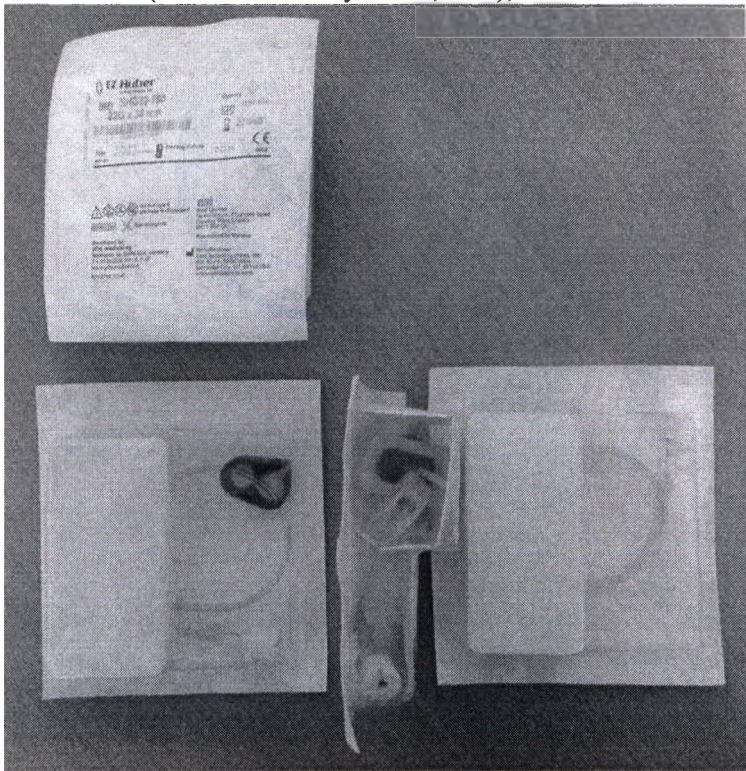

Председатель комиссии:
Заместитель Главного врача

Зверев К.В.



Здесь назначено, вышено
считать начало 18. июля
данный врач ЖБ №17. Москва
Мещеряков А.А.

