


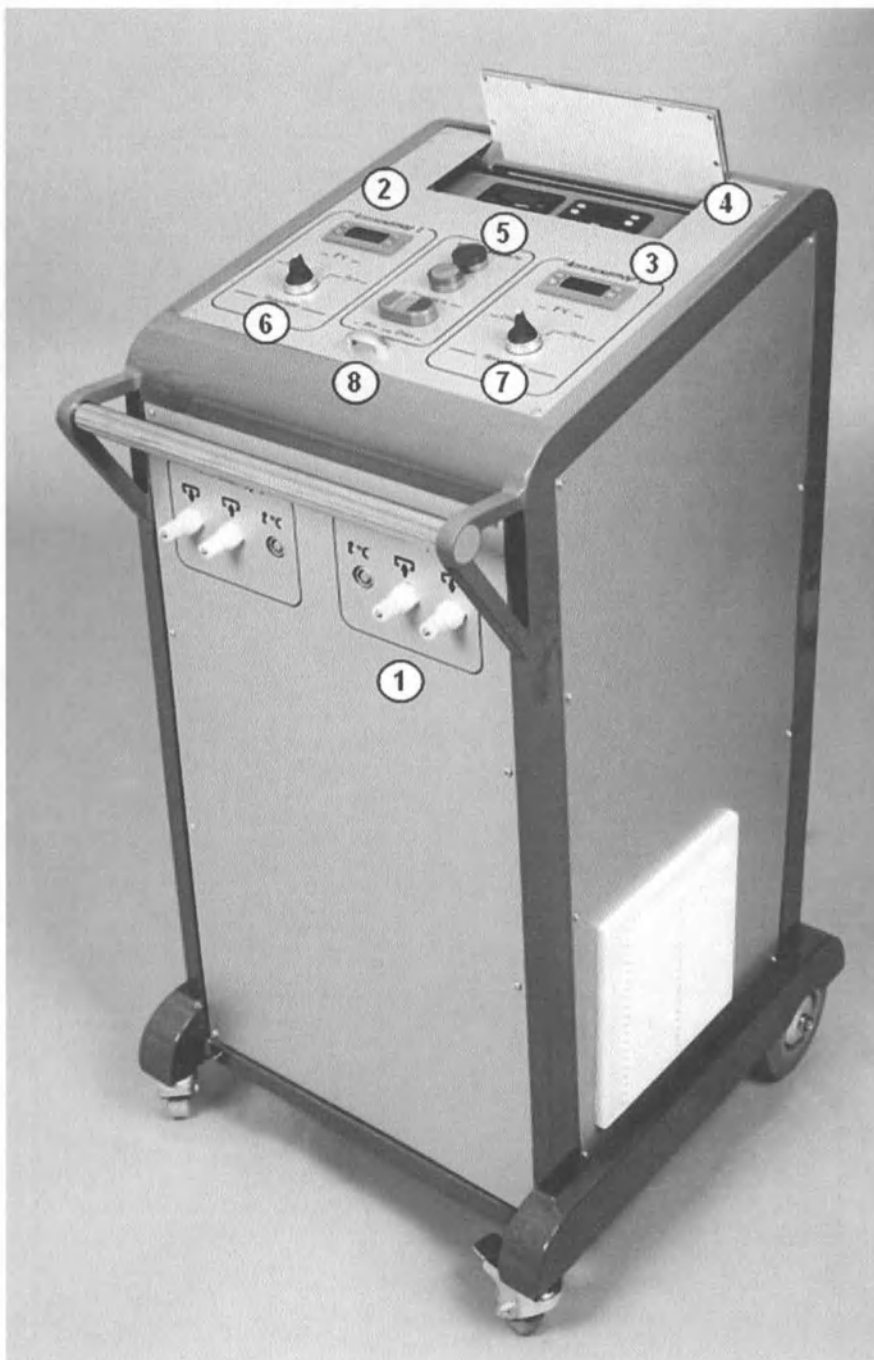

Аппарат терапевтической гипотермии АТГ-01

- 1 – панель подключения гидравлических и электрических соединений,
- 2 – термоконтроллер 1-го канала охлаждения,
- 3 – термоконтроллер 2-го канала охлаждения,
- 4 – фальш-панель в открытом состоянии с таймером и термоконтроллером температуры хладоносителя в баке,
- 5 – лампы индикации (сверху вниз): уровень жидкости хладоносителя, готовность аппарата к работе, кнопки вкл/выкл аппарата,
- 6 – тумблер включения процедуры 1-го канала,
- 7 – тумблер включения процедуры 2-го канала,
- 9 – ручка передней крышки.



Рис. 1. Выкрутите 2 болта передней крышки аппарата.



Рис. 2. Поднимите крышку за ручку.



Рис. 3. Откройте крышку.



Рис. 4. Включите тумблер лампы верхнего уровня хладоносителя в баке.



Рис. 5. Подготовьтесь к выкручиванию горловины бака.



Рис. 6. Аккуратно выверните горловину бака и извлеките крышку с датчиком нижнего уровня хладоносителя

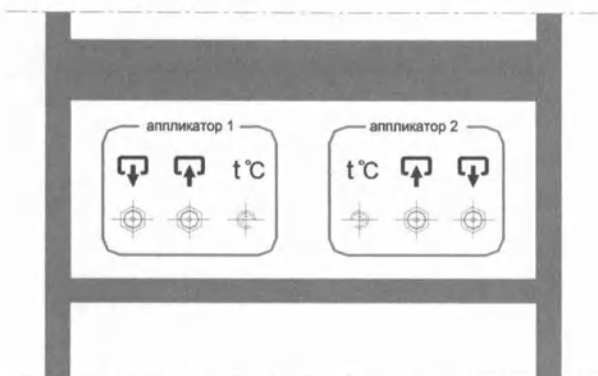


Рис. 7. Панель подключения шлемов-криоаппликаторов и термодатчиков.

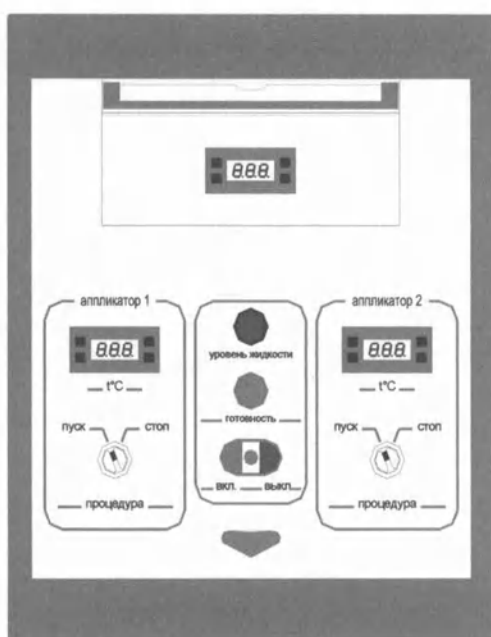


Рис. 8. Общий вид панели управления АЛГ-01



Рис. 9. Включение аппарата.



Рис. 10. Снимаем заднюю панель.



Рис. 11. Включаем



Рис. 12. Корректировка температуры
уставки хладоносителя в баке.

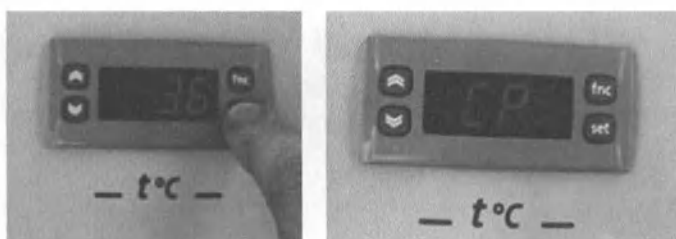


Рис. 13. Корректировка температуры готовности (1).



Рис. 14. Корректировка температуры готовности аппарата (2).



Рис. 15. Корректировка температуры готовности (достижение уставки, 3).