


ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

I. Модельный ряд станций медицинских вакуумных mVAC

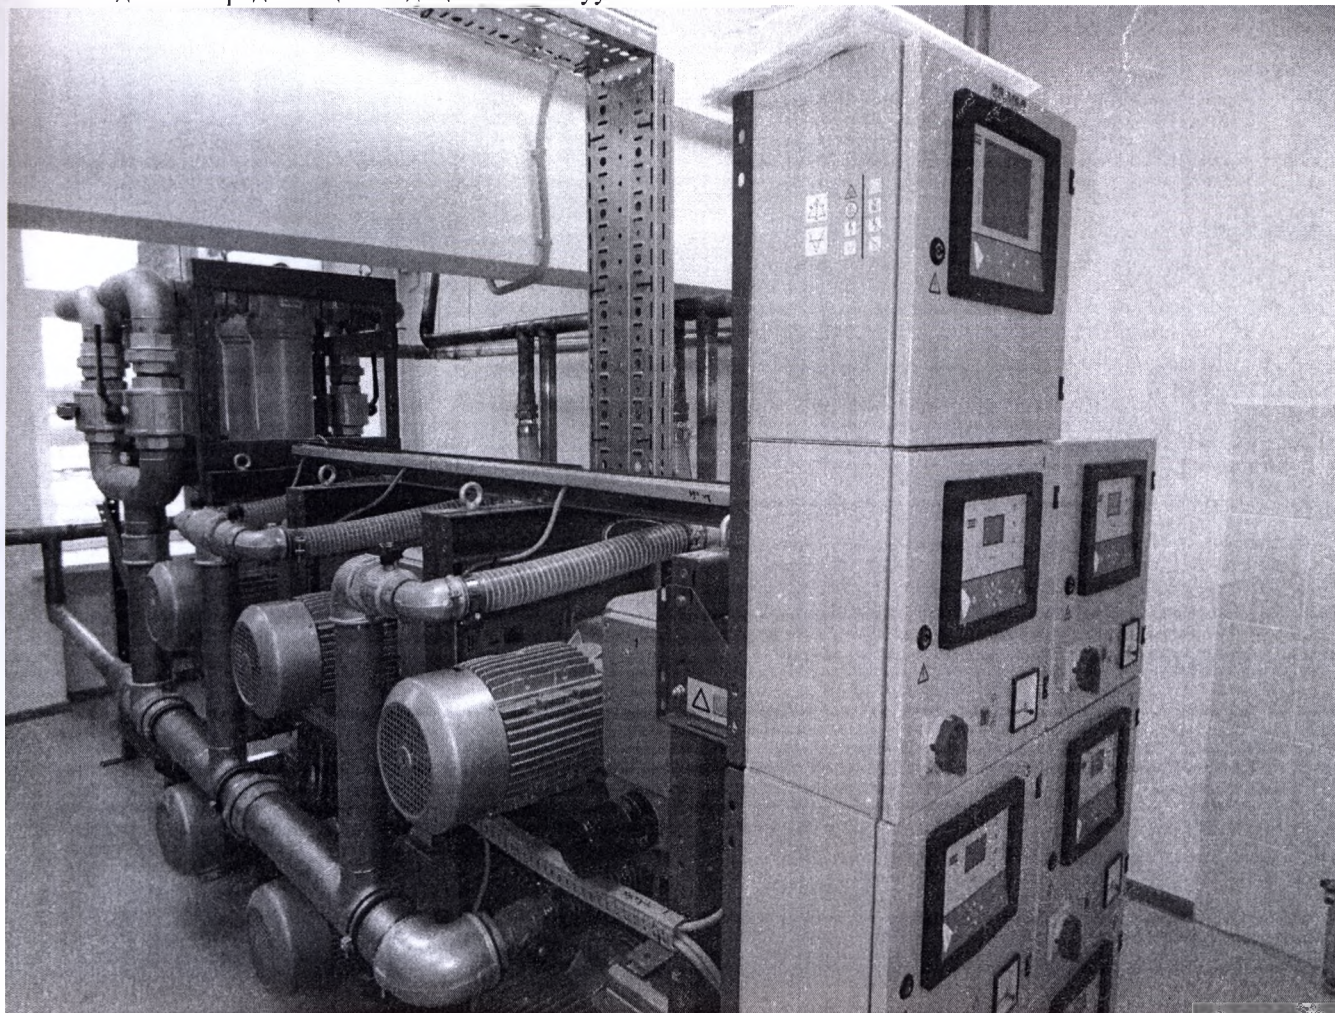

1. mVAC-XXXX-D, где X - цифры от 0 до 9.
2. mVAC-XXXX-D NV, где X - цифры от 0 до 9.
3. mVAC-XXXX-DH, где X - цифры от 0 до 9.
4. mVAC-XXXX-T, где X - цифры от 0 до 9.
5. mVAC-XXXX-T NV, где X - цифры от 0 до 9.
6. mVAC-XXXX-TH, где X - цифры от 0 до 9.
7. mVAC-XXXX-Q, где X - цифры от 0 до 9.
8. mVAC-XXXX-Q NV, где X - цифры от 0 до 9.
9. mVAC-XXXX-P, где X - цифры от 0 до 9.
10. mVAC-XXXX-P NV, где X - цифры от 0 до 9.
11. mVAC-XXXX-H, где X - цифры от 0 до 9.
12. mVAC-XXXX-H NV, где X - цифры от 0 до 9.


II. Состав станций медицинских вакуумных mVAC

1. Вакуумный насос(ы), от 1 до 6 шт.



81988D

2. Вакуумный ресивер(ы), от 1 до 4 шт.

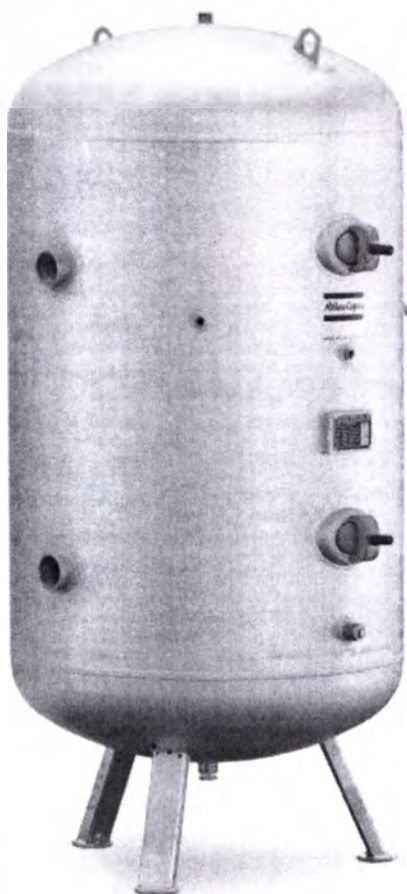


3. Бактериальный фильтр(ы), от 2 до 4 шт.



4. Центральная система управления, 1 шт.


шкаф центральной системы управления

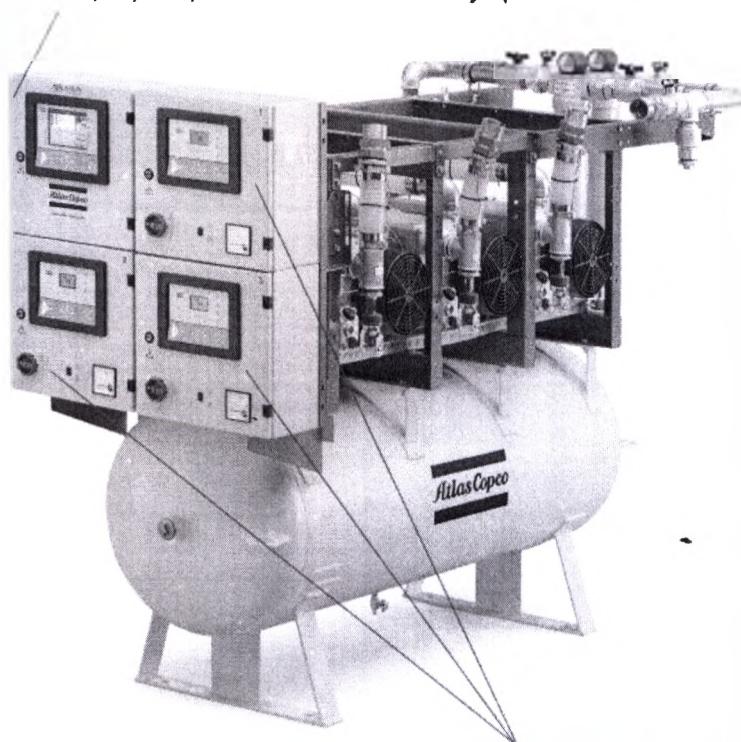

шкаф управления насосом


5. Панель управления насосом, от 1 до 6 шт.

шкаф центральной системы управления

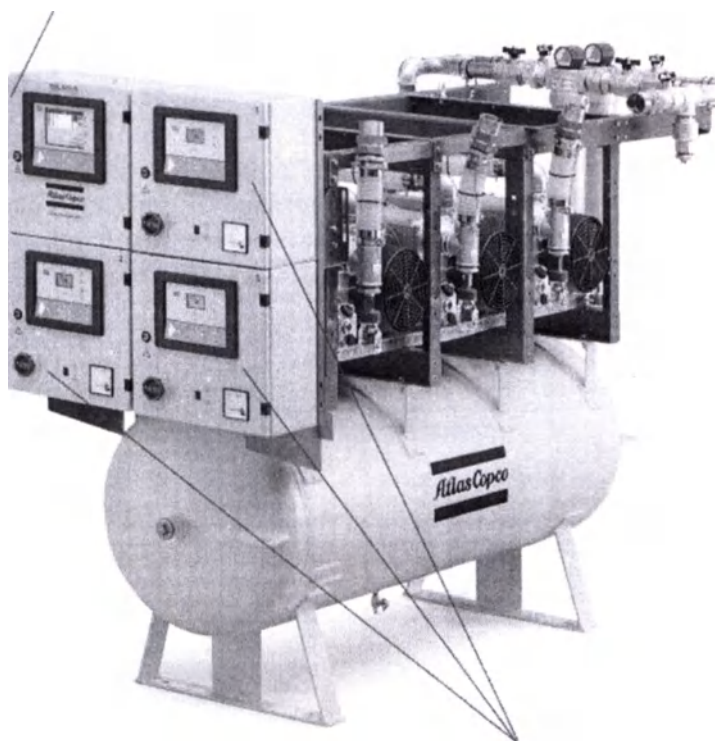

шкаф управления насосом

6. Инструкция по эксплуатации, 1 шт.

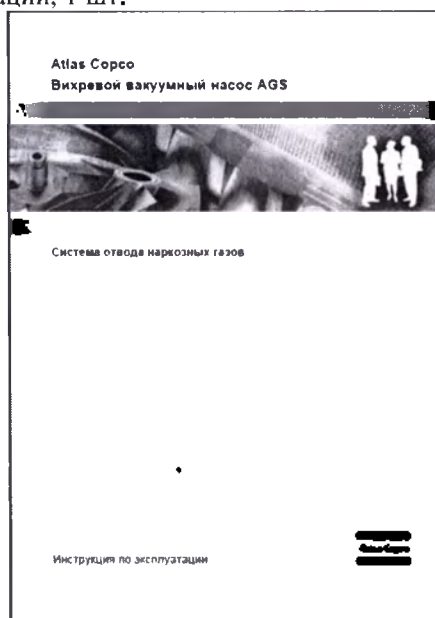

Принадлежности:


1. Насос(ы) G(Z/A)V(H/L/W/R)S(D)XXXX, где X - цифры от 0 до 9, указывающие производительность насоса, где:
 - 1-ая буква указывает категорию насоса:
 - G: масляный,
 - Z: безмасляный,
 - A: с водяным уплотнением
 - 2-ая буква указывает тип насоса:
 - V: пластинчато-роторный,

- H: винтовой,
 - L: поршневой,
 - W: жидкостно-кольцевой,
 - R: кулачковый
- 3я буква указывает количество ступеней насоса:
- S: одноступенчатый,
 - D: двухступенчатый

Например: GVS-150 – пластинчато-роторный с масляным уплотнением, одноступенчатый, скорость откачки 150 м³/час @ P_{атм} или GHS 350 VSD+ винтовой с масляным уплотнением и технологией частотно-регулируемого привода



81988D

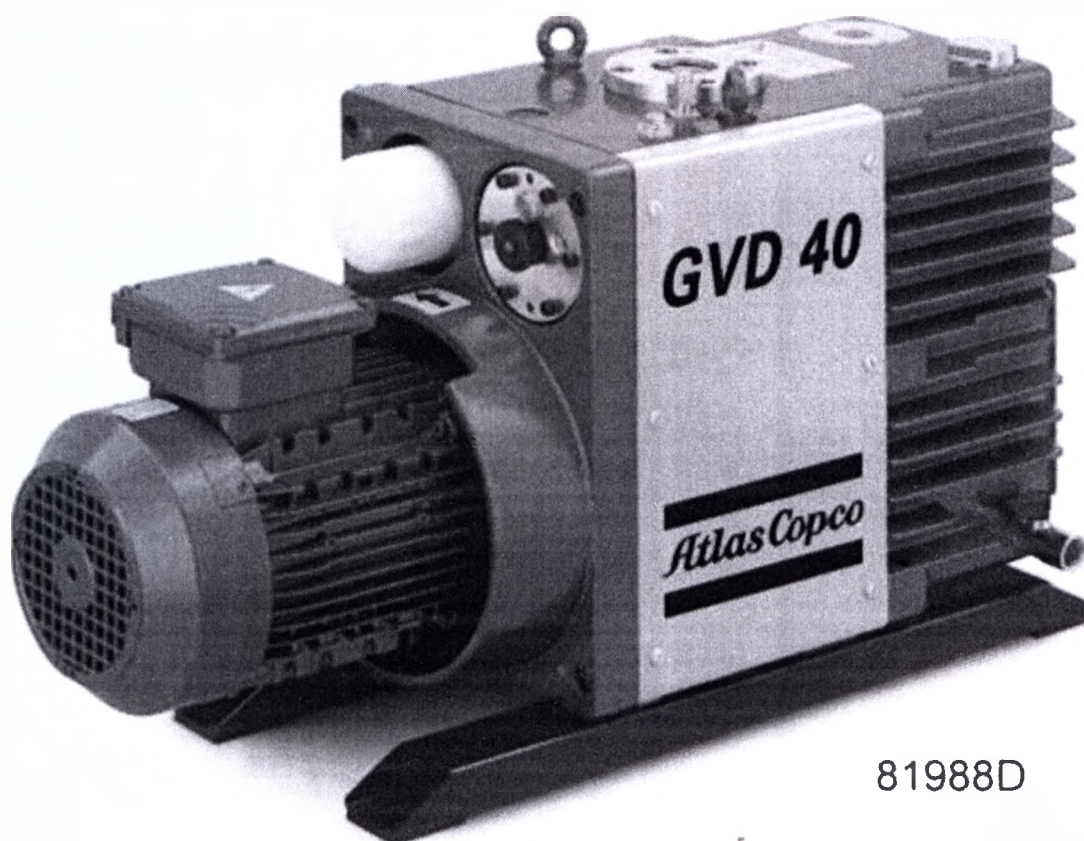


81988D




81988D


2. Насос(ы) RAXXXX, где X - цифры от 0 до 9 указывающие производительность насоса, тип пластинчато-роторный.

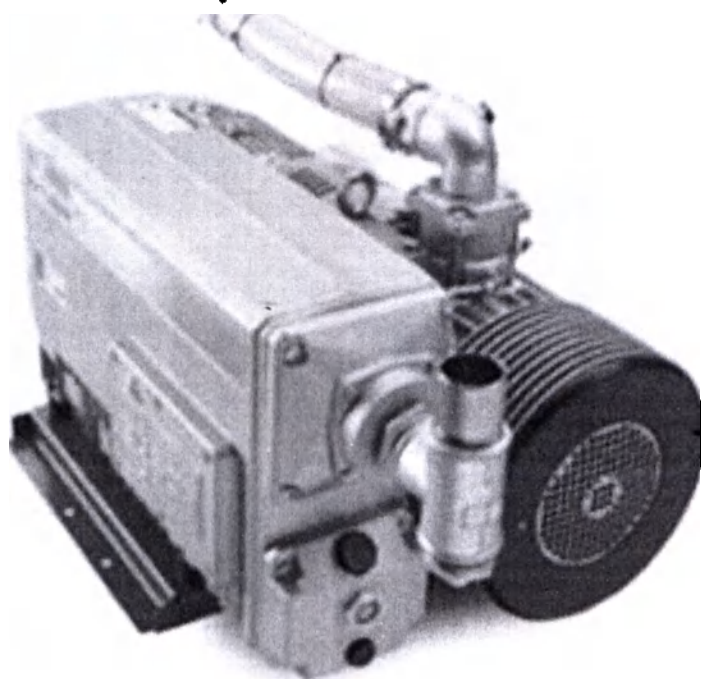

3. Насос(ы) AGSXXXXS/D, где X - цифры от 0 до 9 указывающие производительность насоса, тип вихревой.

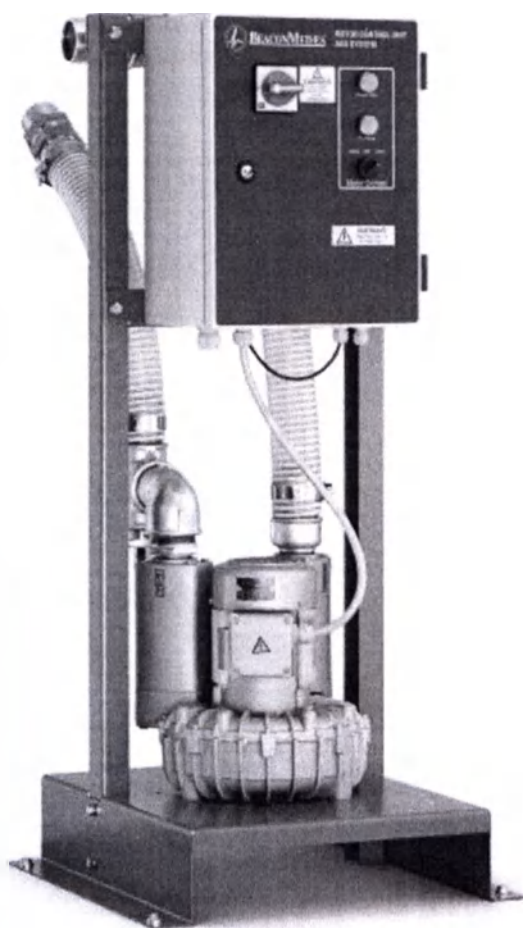


4. Насос(ы) DZSXXXX, где X - цифры от 0 до 9 указывающие производительность насоса, тип кулачковый безмасляный.

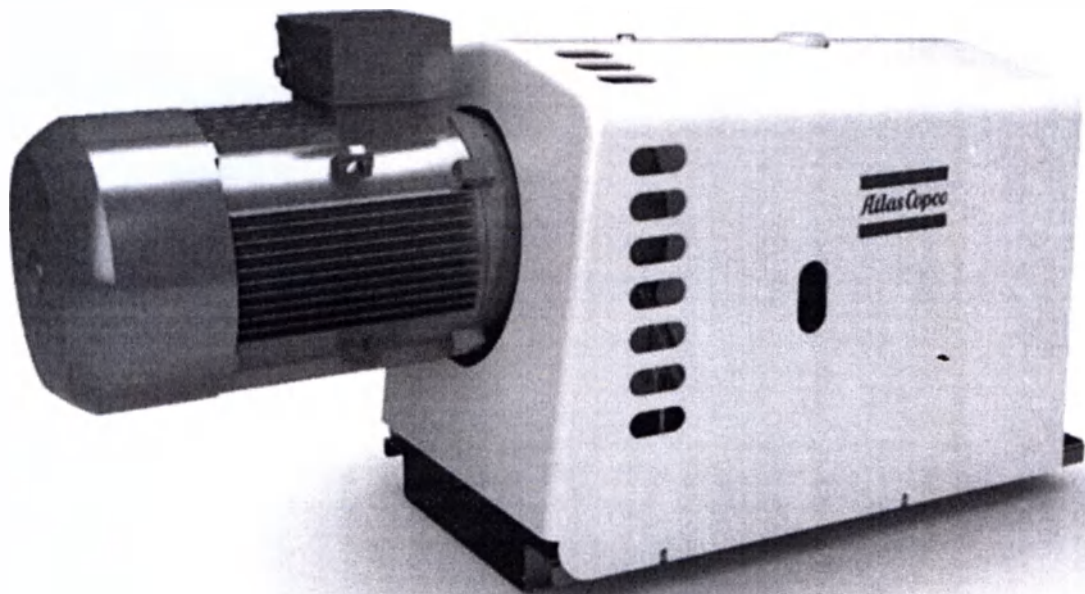

81988D


5. Воздушный ресивер(ы) (500 л, 1000 л, 1500 л, 2000 л).

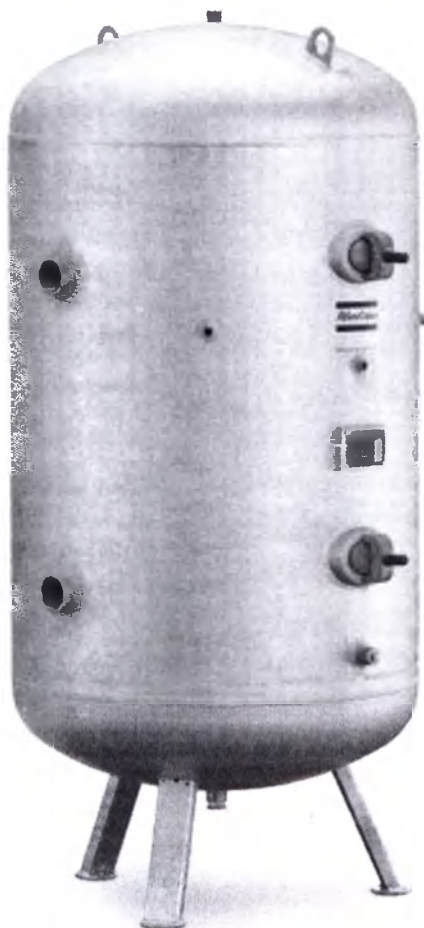


6. Монтажный набор ресивера (заглушки, переходники, шаровые краны, стрелочный индикатор, соединительные трубки).




7. Индикатор(ы) давления.

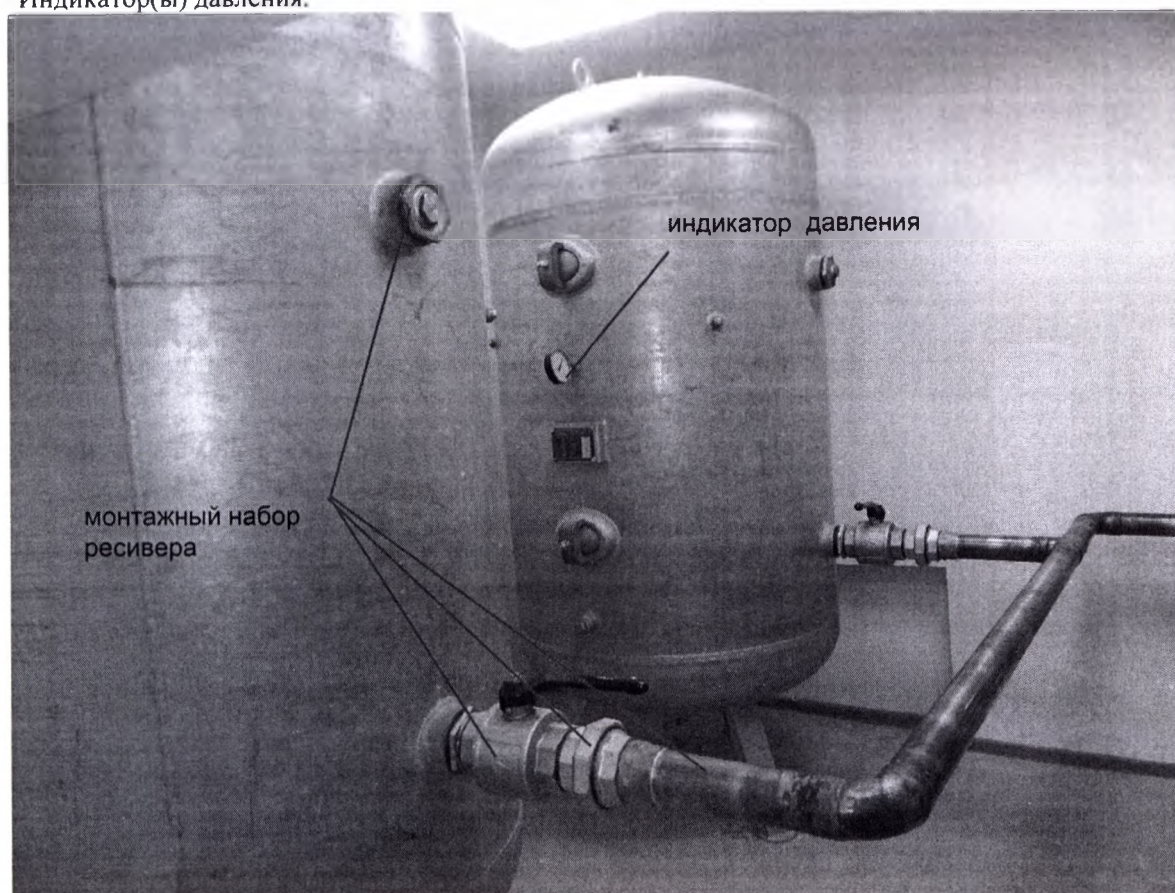


8. Бактериальный фильтр(ы).

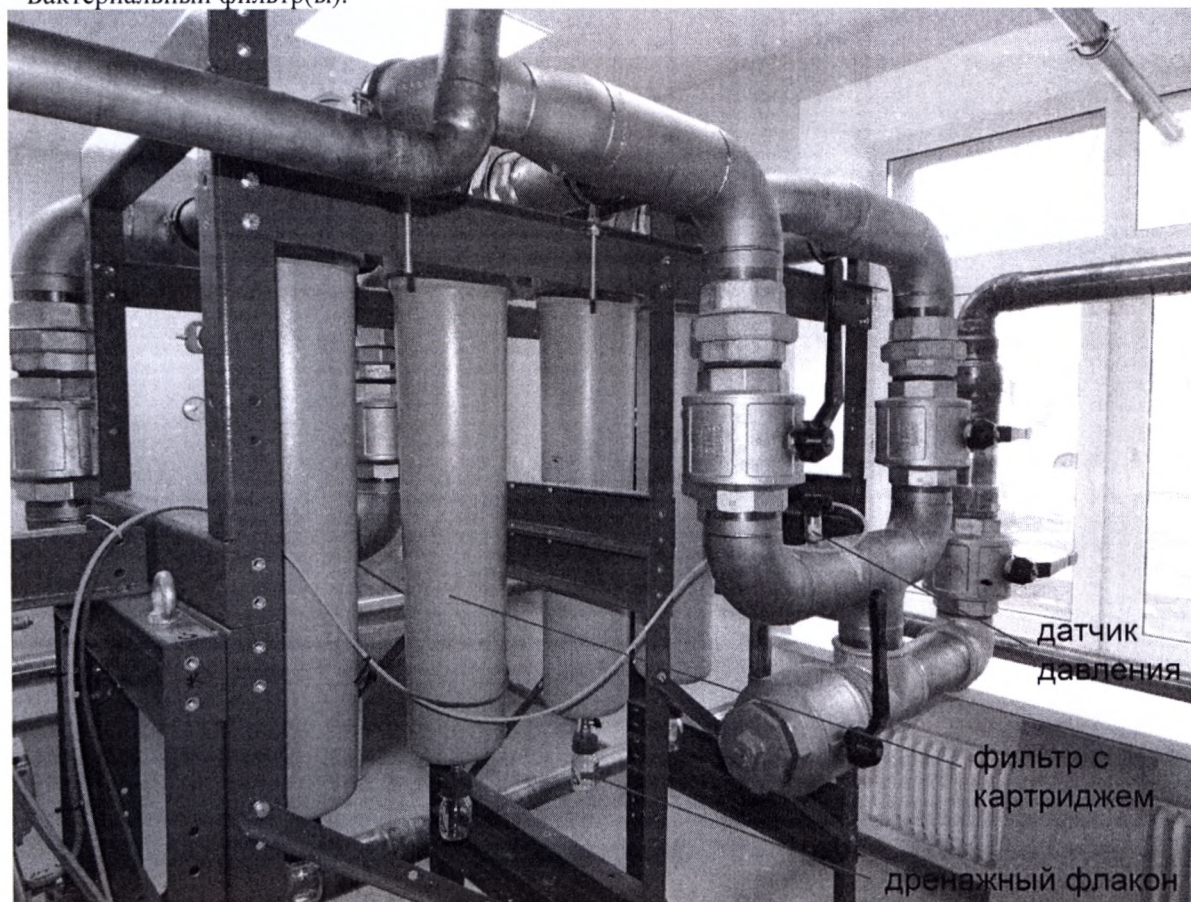

9. Картридж(и) бактериального фильтра.

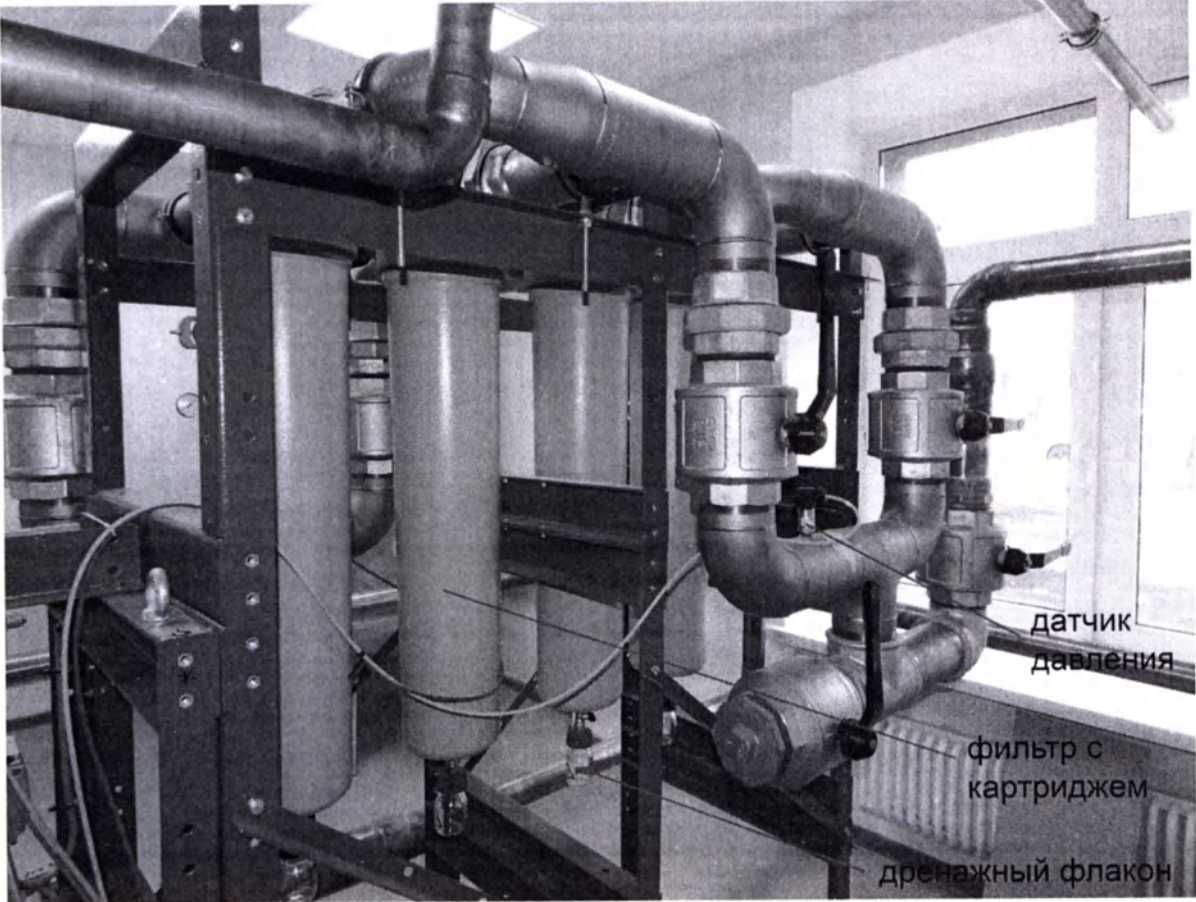


10. Дренажный флякон(ы)

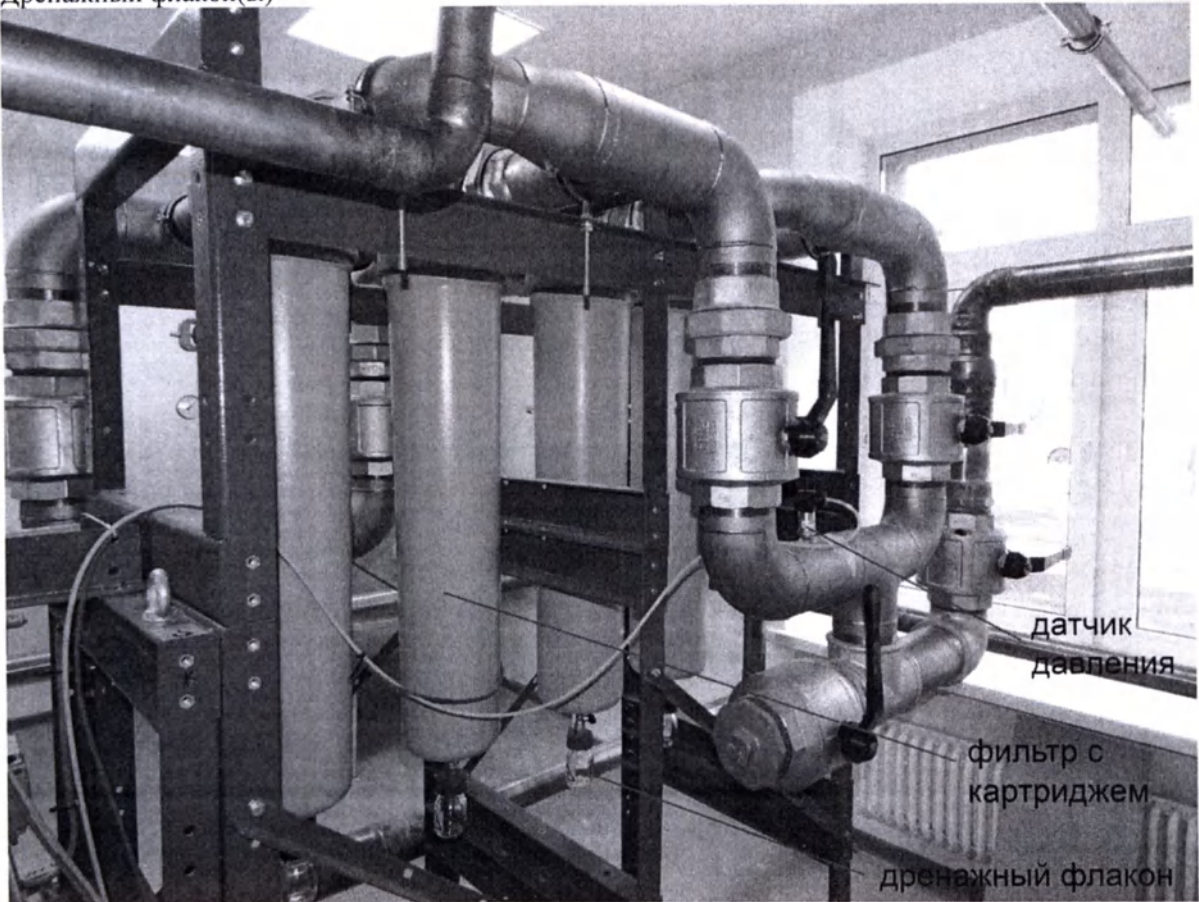

11. Шкаф центральной системы управления.


шкаф центральной системы управления

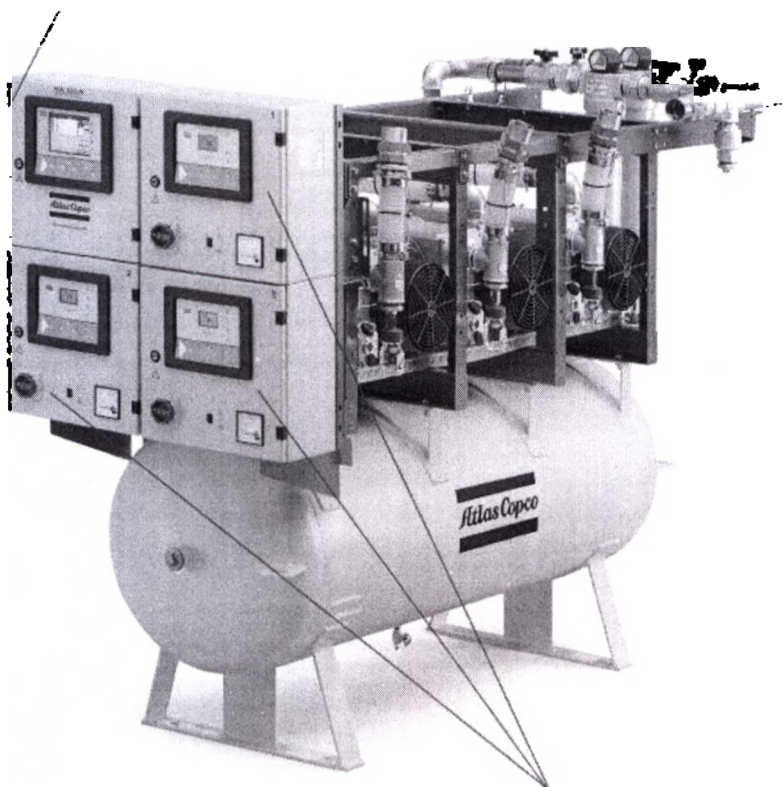

шкаф управления насосом


12. Шкафы управления насосами.

шкаф центральной системы управления

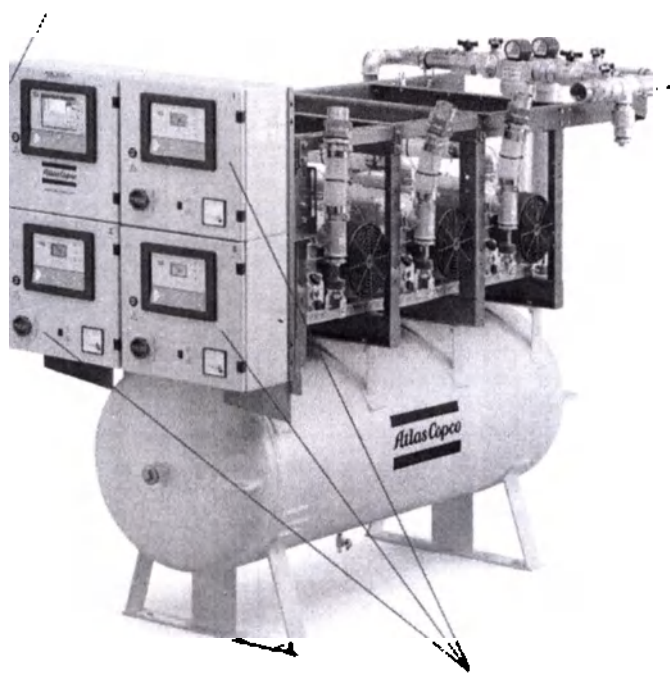



шкаф управления насосом

13. CAN кабель(и).

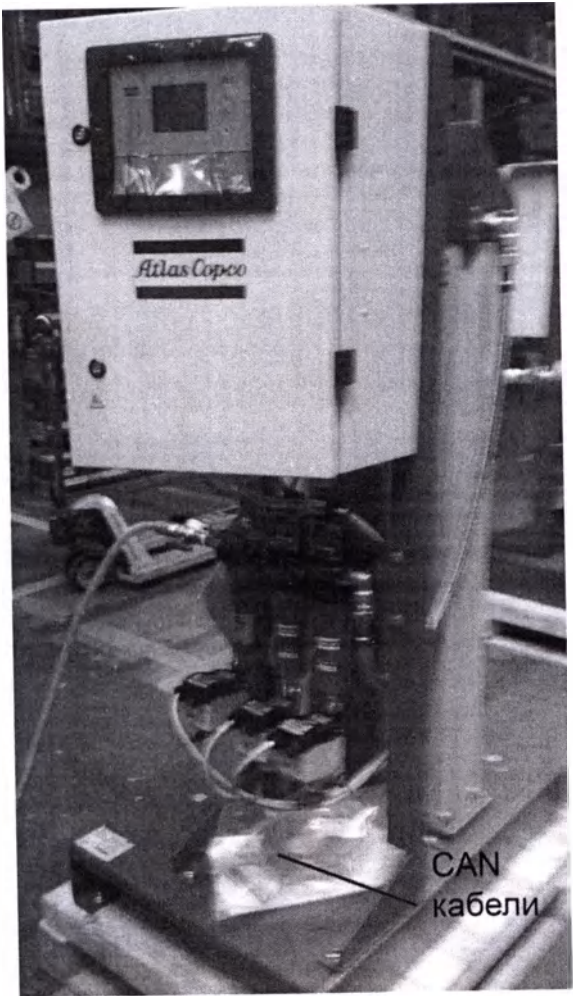


14. Датчик(и) давления.

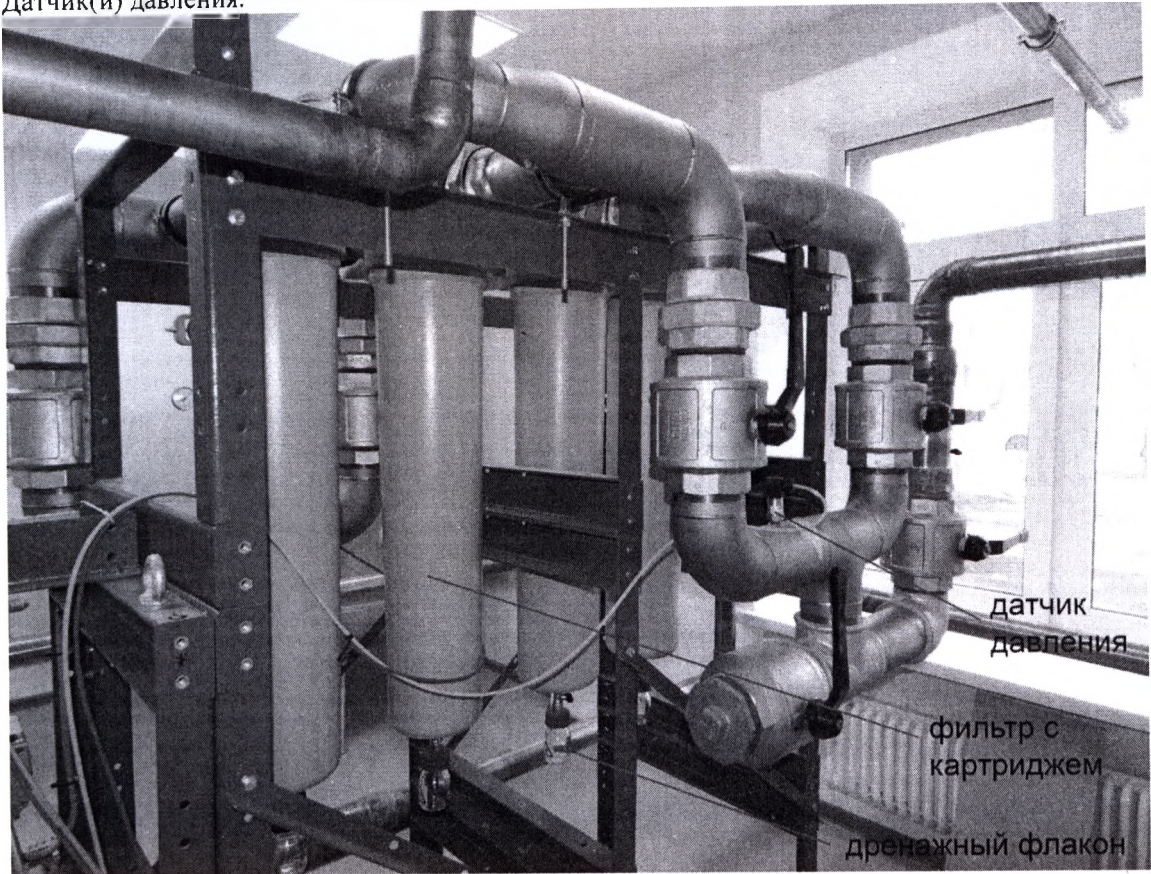


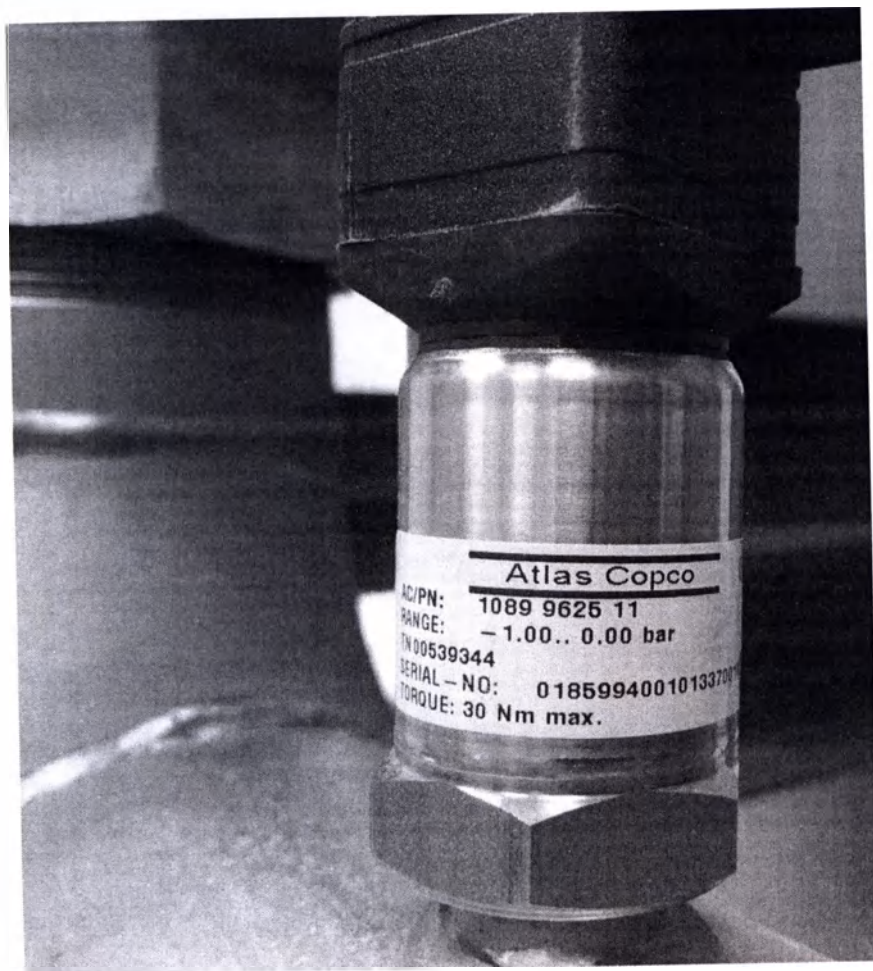


15. Преобразователь(и) давления.

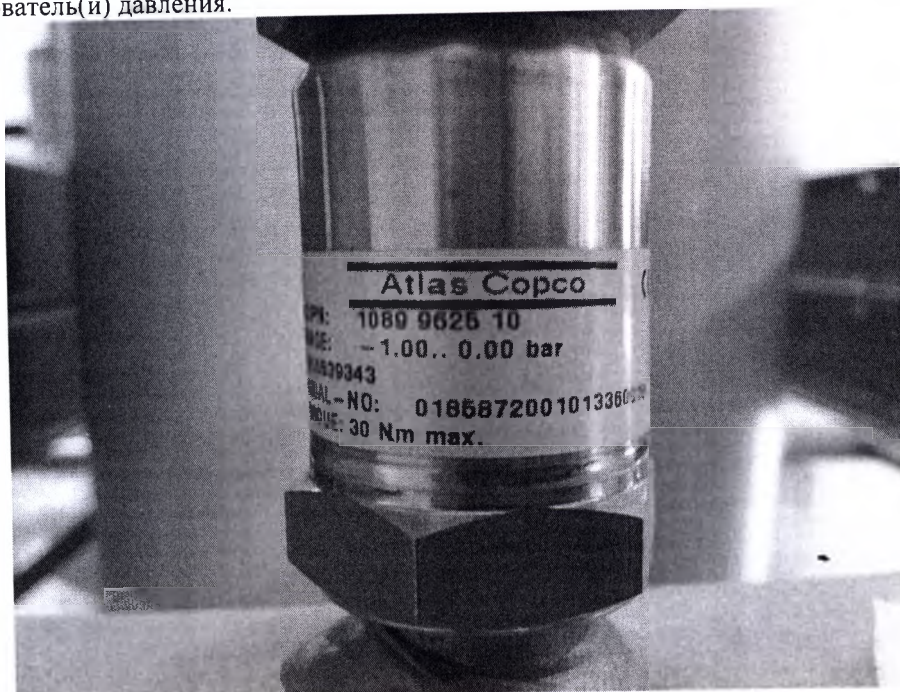


16. Реле давления.

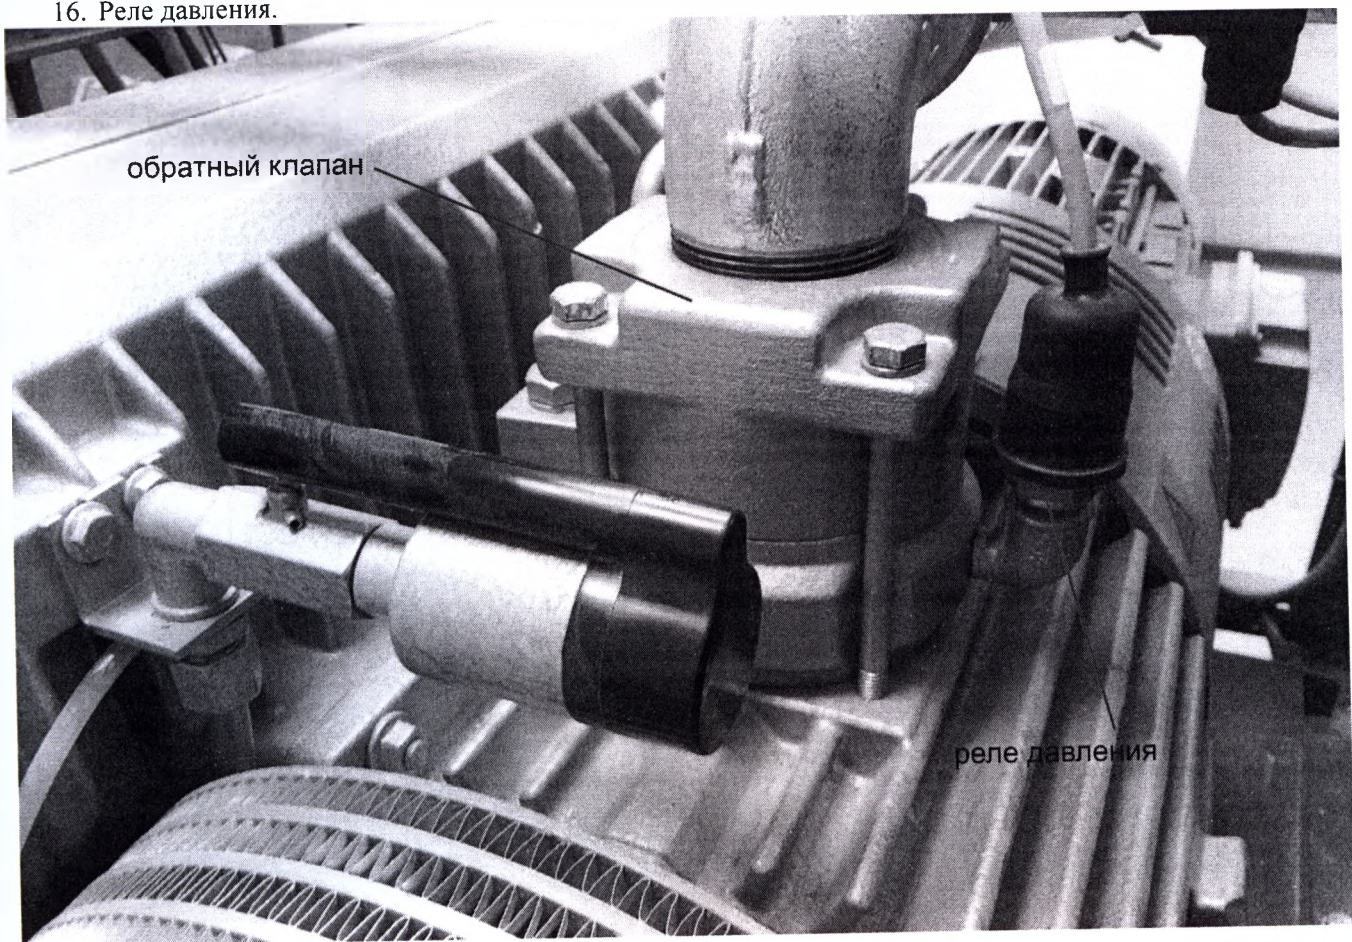


17. Обратный клапан(ы).

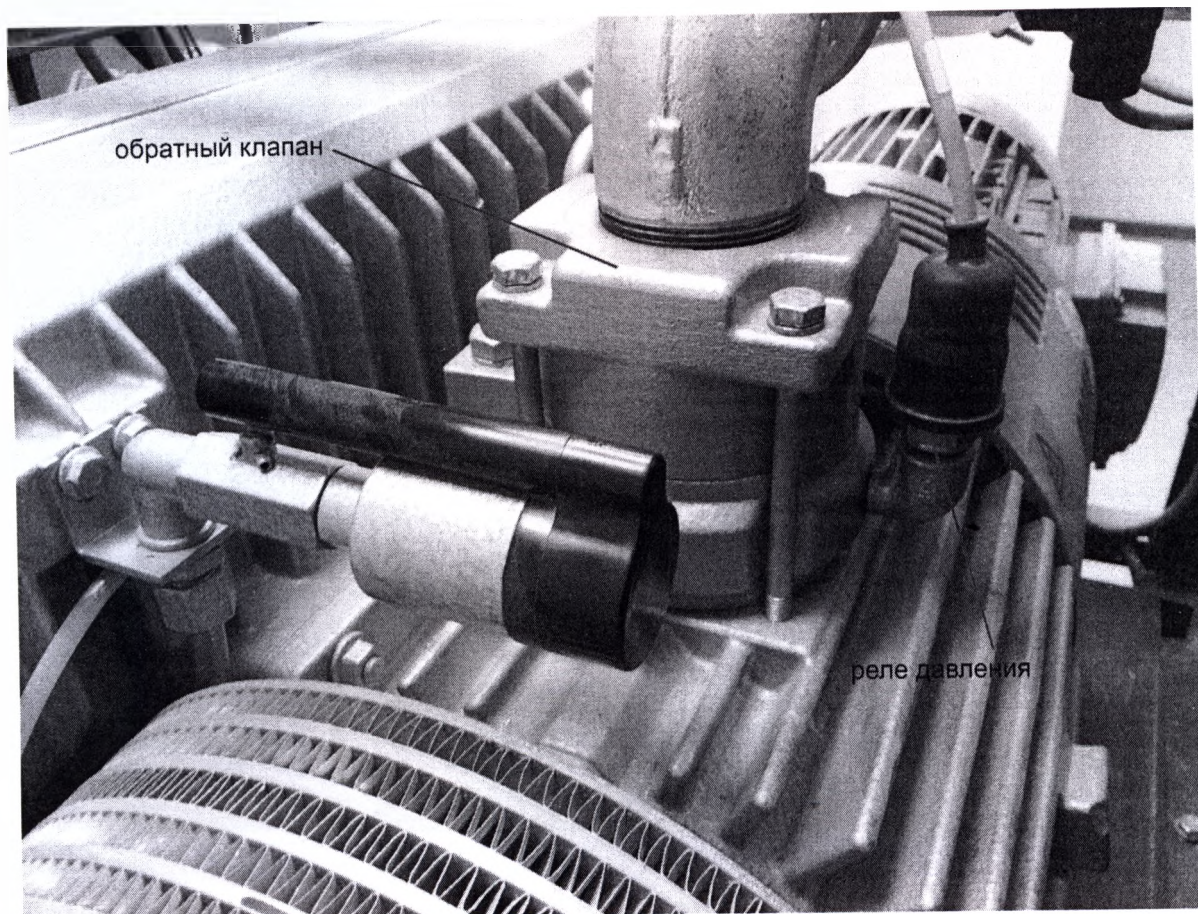


18. Гибкий шланг(и).

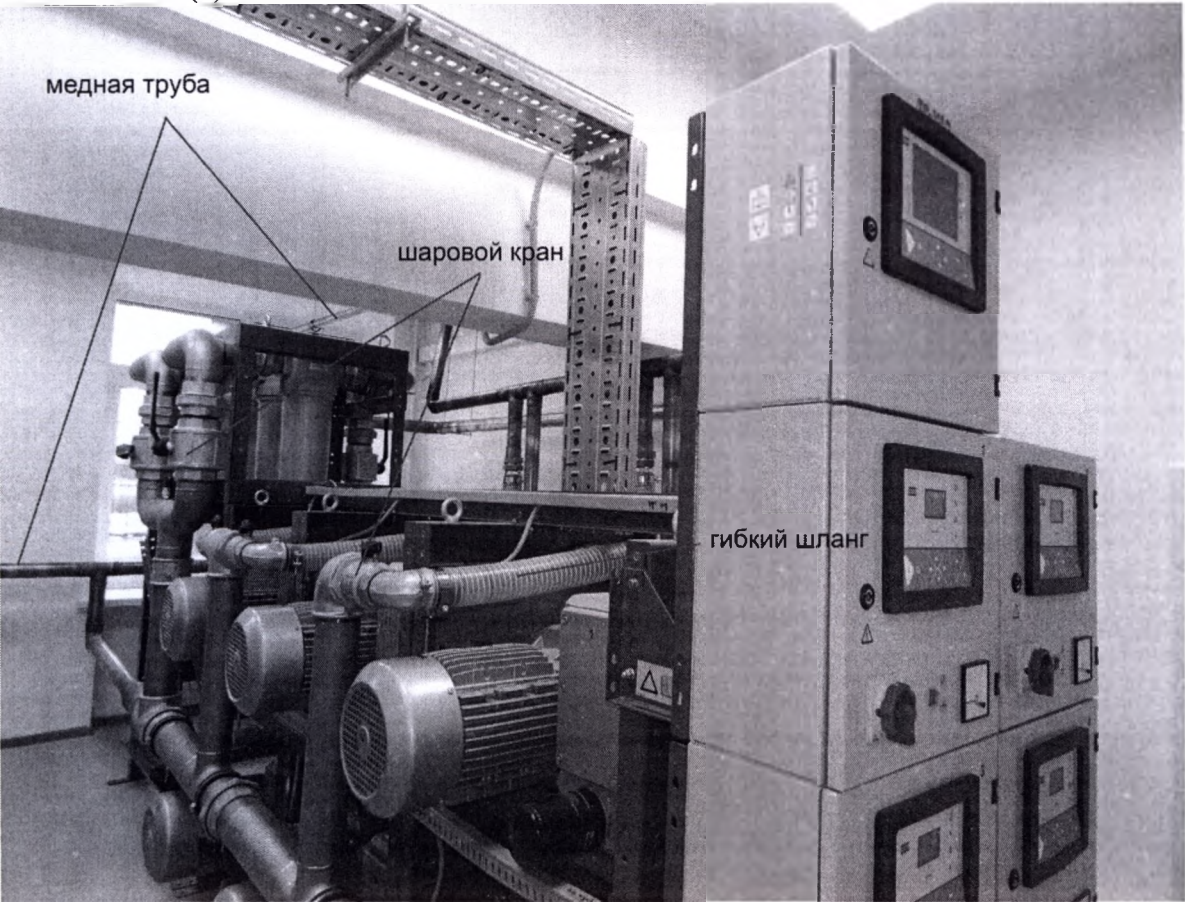


19. Медная труба(ы).

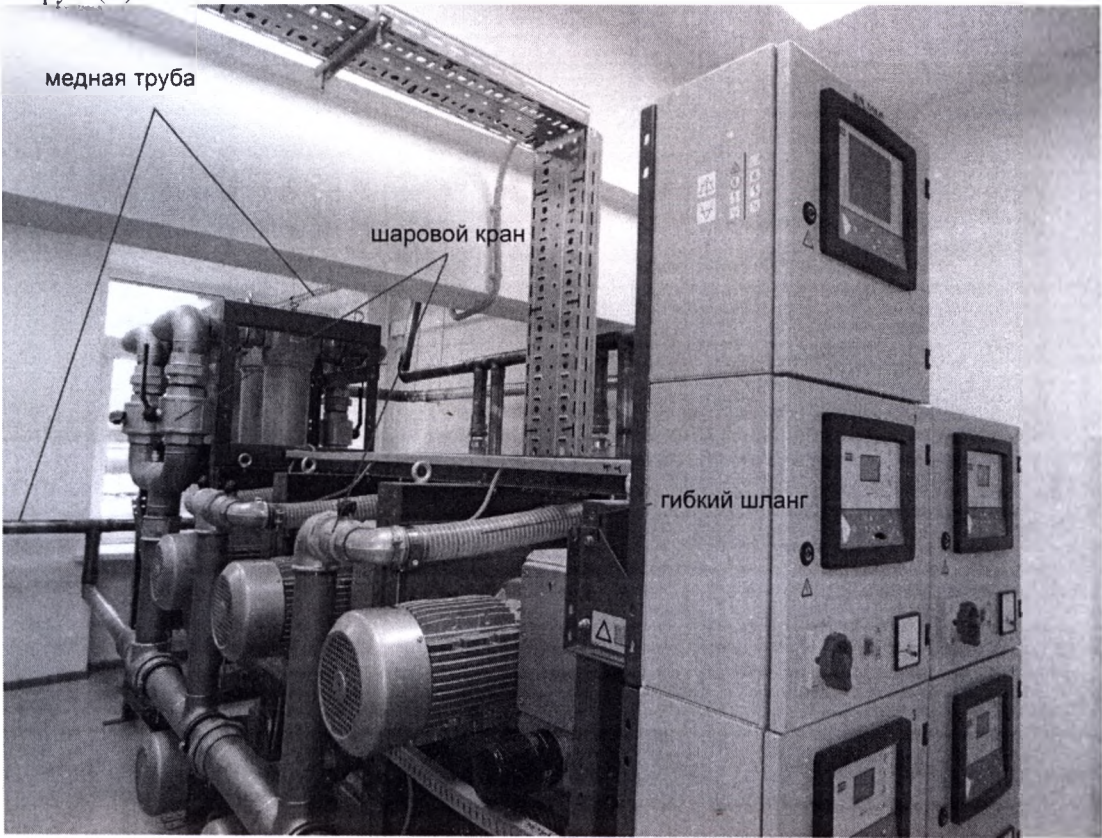


20. Клапан(ы) вакуумный (розетка)

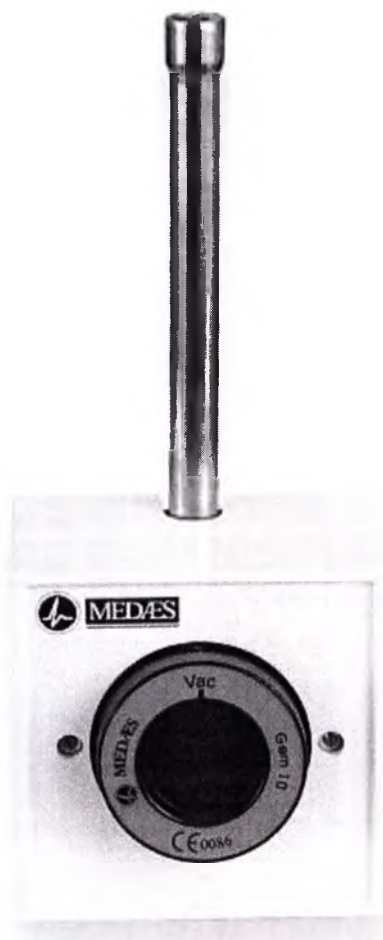


21. Штекер(ы) клапана вакуумного

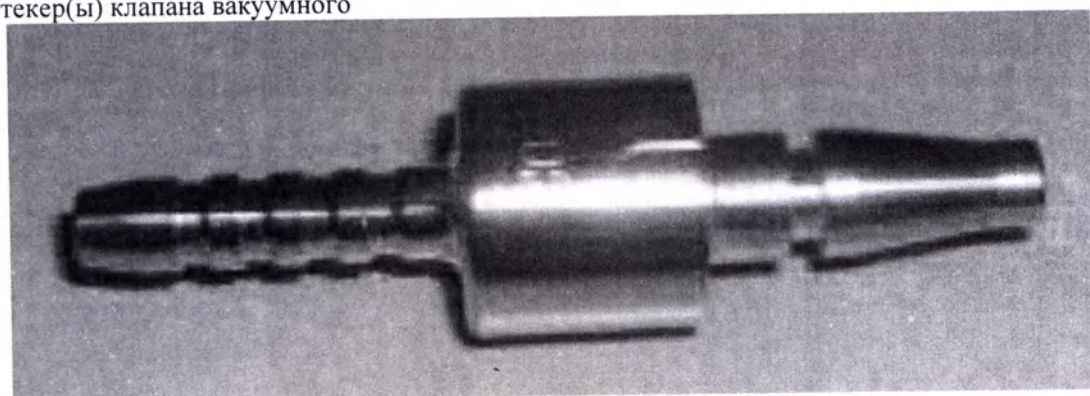


22. Устройство(а) соединения с наркозным аппаратом.

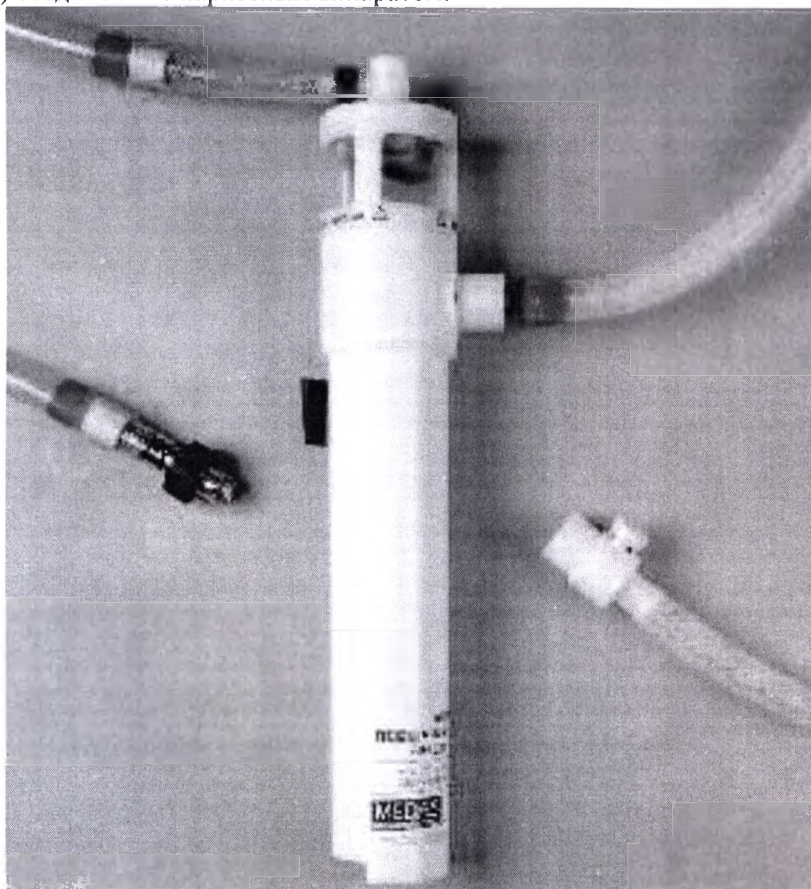

23. Крепление(я).

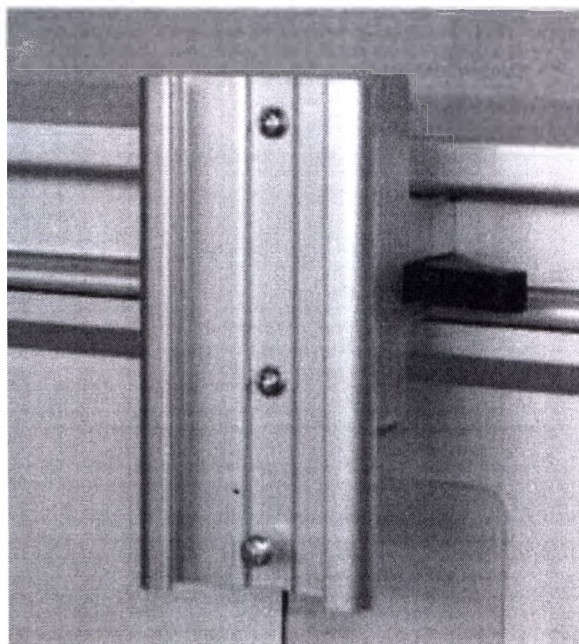


24. Регулируемый вакуумный клапан.

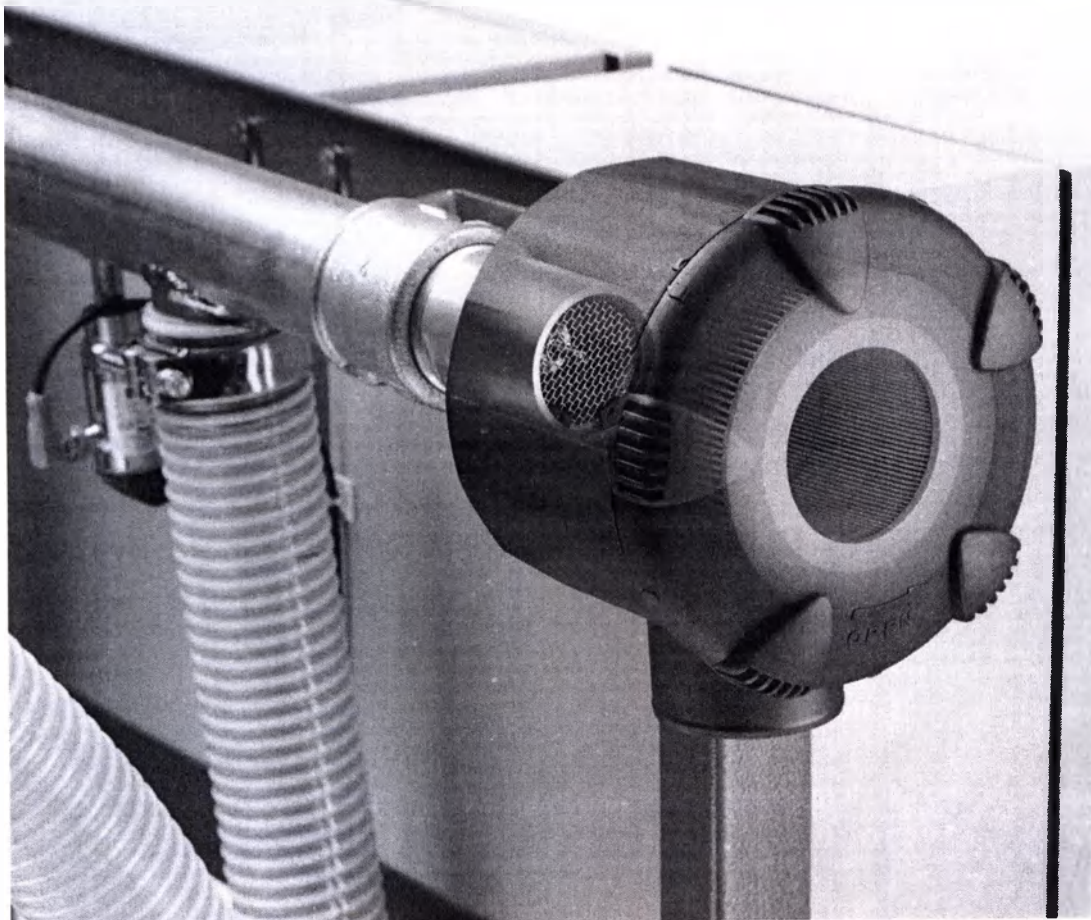


25. Выносной выключатель насосов.




26. Шаровой кран(ы).

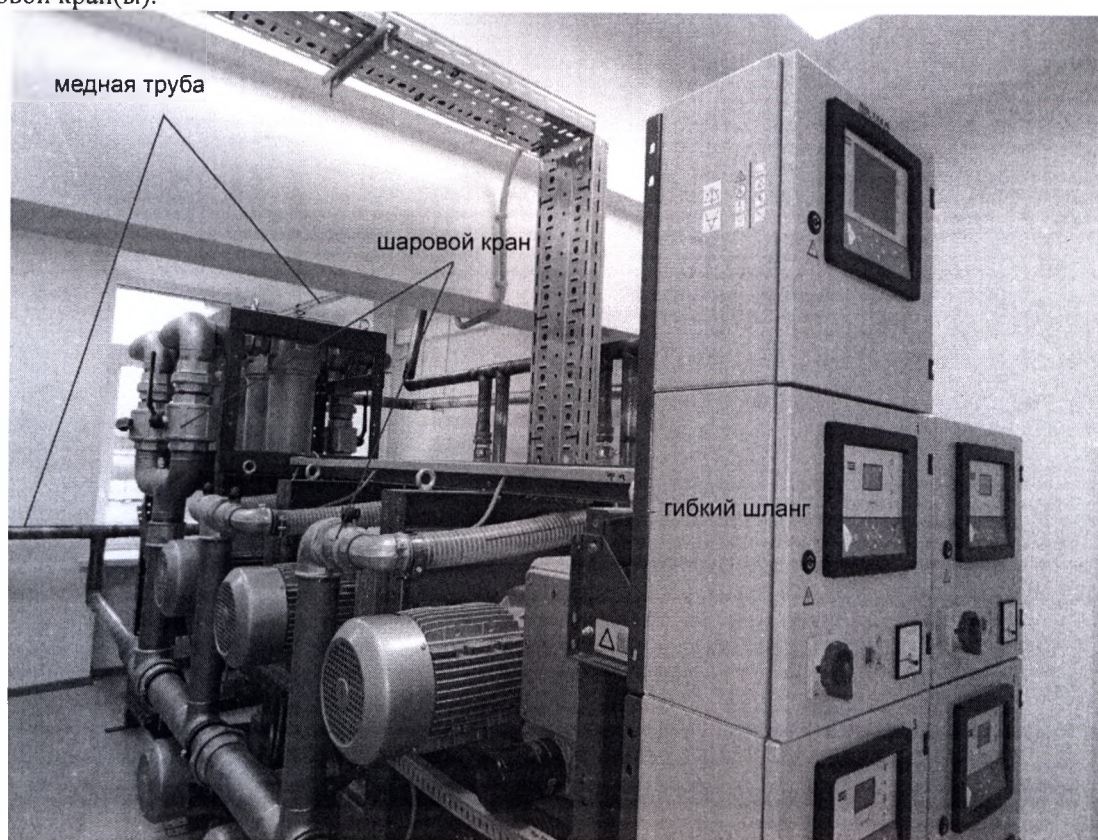

27. Контрольно-отключающая коробка(и).

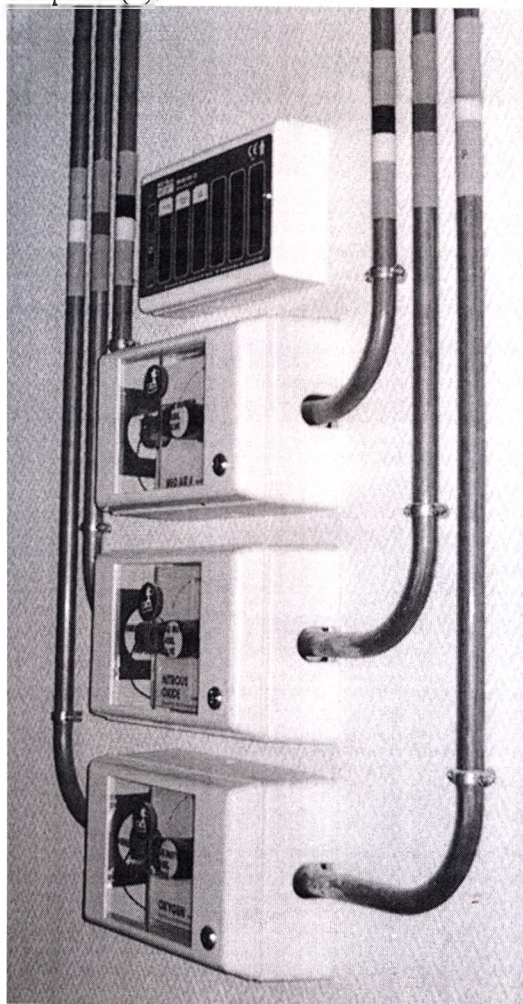

28. Панель(и) алармов.

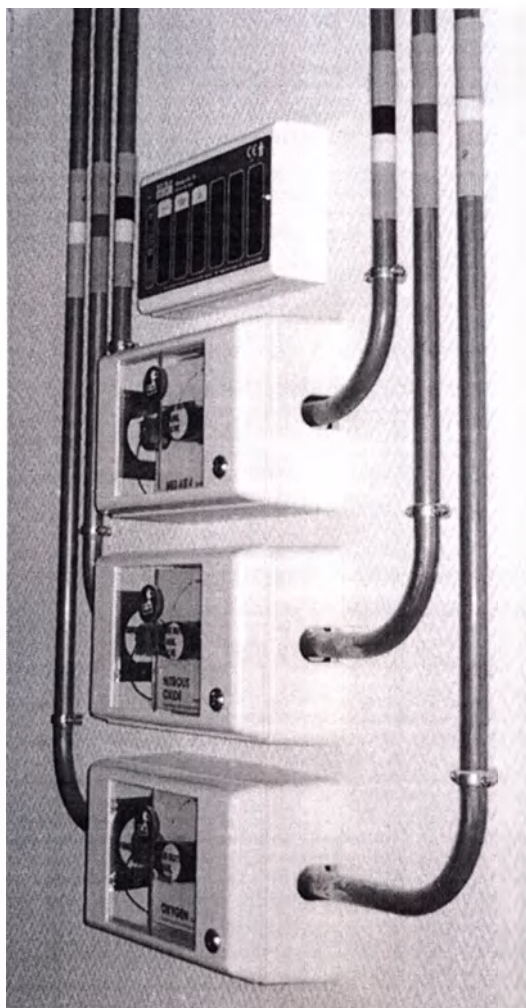

Генеральный директор



Радомир М.

Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 20 листов

