

УТВЕРЖДАЮ
Директор Федерального
бюджетного учреждения науки
«Центральный научно-
исследовательский институт
эпидемиологии» Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека

В.Г. Акимкин
«» 2018 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор реагентов для диагностики in vitro

АмплиСенс® ВИЧ-Монитор-Duo-FL

2018

Набор реагентов АмплиСенс® ВИЧ-Монитор-Duo-FL, форма 1

Общий вид

Коробка с комплектом
"РИБО-преп" вариант 100

Маркировка
набор реагентов

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора

Набор реагентов для диагностики in vitro
АмплиСенс® ВИЧ-Монитор-Duo-FL
ТУ 21.20.23-344-01897593-2017
Форма 1

Комплект 1 из 2
«РИБО-преп» вариант 100

Состав комплекта:

Идентификационный код: 100
Пакет для хранения: 100

ИВД

100

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора

Набор реагентов для диагностики in vitro
АмплиСенс® ВИЧ-Монитор-Duo-FL
ТУ 21.20.23-344-01897593-2017
Форма 1

«РИБО-преп» вариант 100;

«ПЦР-комплект» вариант FRT-LA

При получении разукладывать в соответствии с указанными температурами хранения

REF НК1-3441-1-14
Свидетельство на товарный знак № 212724

LOT 27.08.18
Регистрационный номер:

2018-08-27

2019-03-16

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора

Набор реагентов для диагностики in vitro
АмплиСенс® ВИЧ-Монитор-Duo-FL
ТУ 21.20.23-344-01897593-2017
Форма 1

Комплект 2 из 2
«ПЦР-комплект» вариант FRT-LA

Состав комплекта:

ПЦР-смесь-FL ВИЧ-Duo	0,4 мл x 4
ПЦР-буфер-В	0,3 мл x 4
Смесь ОТ-ПЦР-ферментов	- x 4 шт
Восстановитель ферментов	0,1 мл x 4
K1L ВИЧ-Duo	- x 4 шт
K2L ВИЧ-Duo	- x 4 шт
PKO1L ВИЧ-Duo	- x 4 шт
PKO2L ВИЧ-Duo	- x 4 шт
ВКОЛ	- x 4 шт
Растворитель	5,0 мл x 5

ИВД

110

При получении разукладывать в соответствии с указанными температурами хранения

REF НК1-3441-1-14
Свидетельство на товарный знак № 212724


LOT 27.08.18
Регистрационный номер:

2018-08-27

2019-03-16

Коробка с комплектом
«ПЦР-комплект» вариант FRT-LA

Набор реагентов АмплиСенс® ВИЧ-Монитор-Duo-FL, форма 1 после вскрытия упаковки

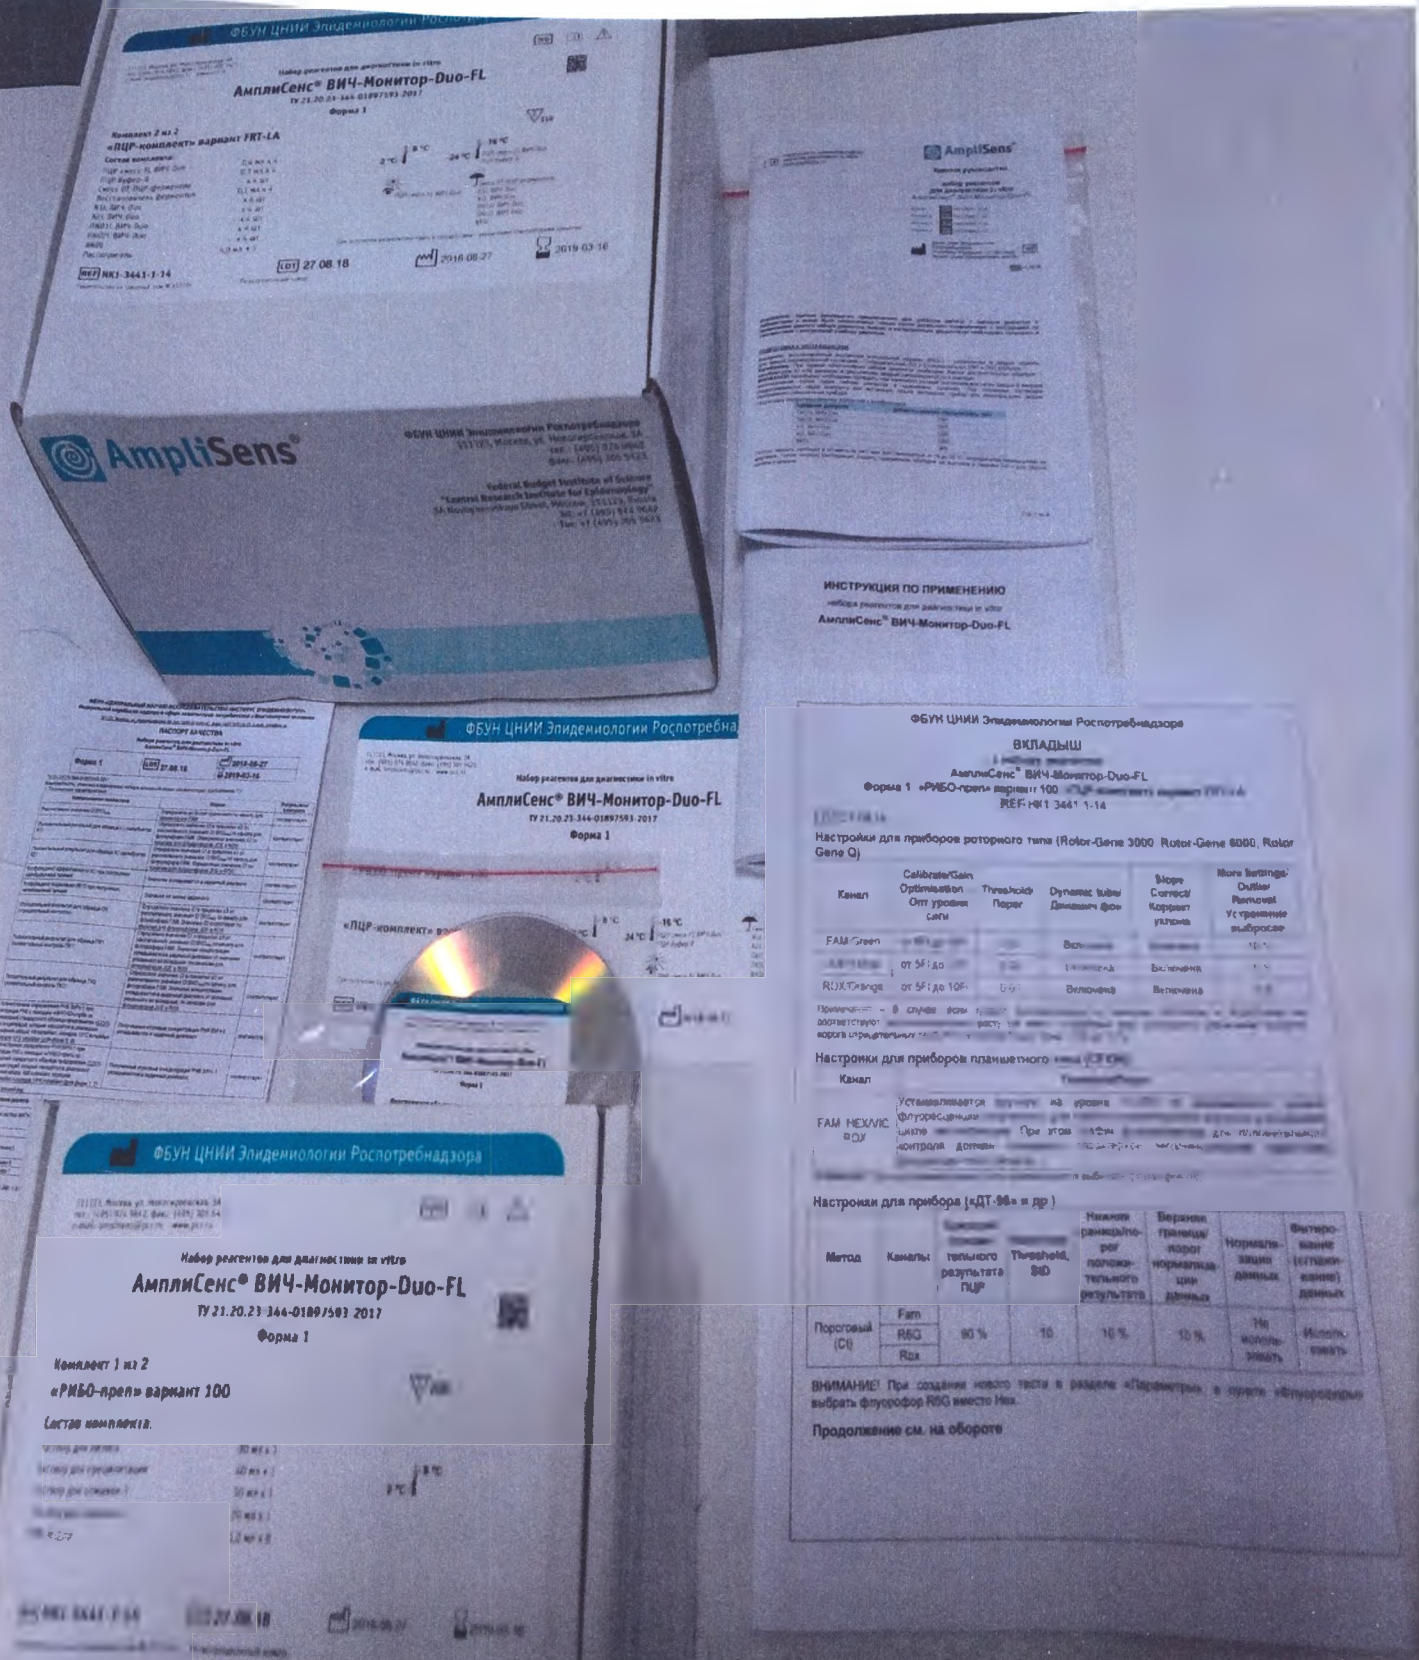

«ІЦР-комплект» вариант FRT-LA после вскрытия упаковки



«ПЦР-комплект» вариант FRT-LA после вскрытия цефленовых пакетов

ПКО1L ВИЧ-Duo - 4 пробирки

ПКО2L ВИЧ-Duo - 4 пробирки

Восстановитель ферментов -
4 пробирки

Смесь ОТ-ПЦР-ферментов
- 4 пробирки

ВКОЛ - 4 пробирки

Растворитель -
5 пробирок


L ВИЧ-Duo - 4 пробирки

K2L ВИЧ-Duo - 4 пробирки

ПЦР-буфер-В - 4 пробирки


ПЦР-смесь-FL ВИЧ-Duo - 4 пробирки

Набор реагентов АмплиСенс® ВИЧ-Монитор-Duo-FL, форма 1
Комплект реагентов «РИБО-преп» вариант 100
после вскрытия упаковки

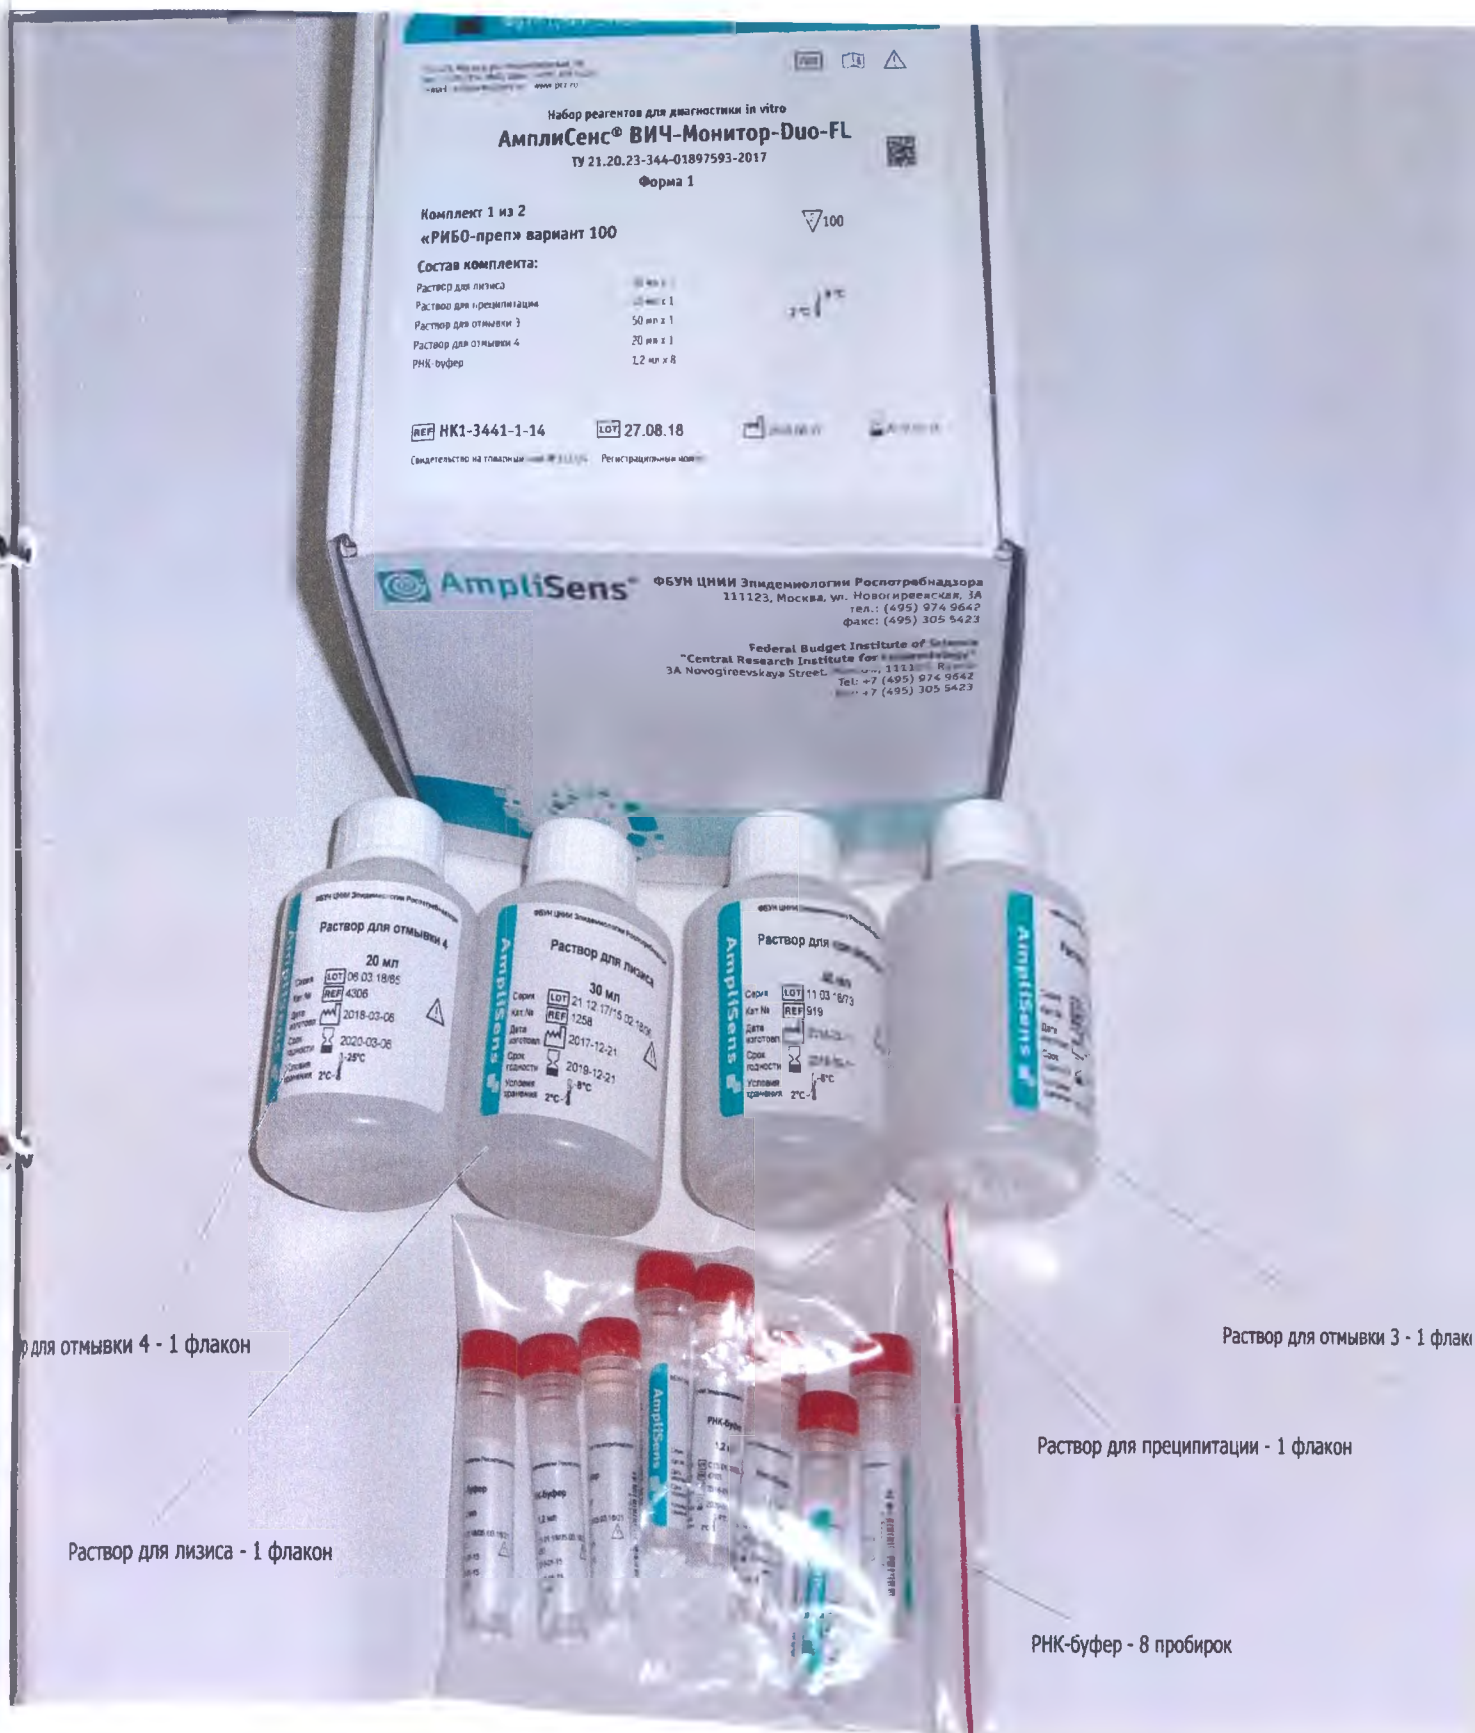


Набор реагентов АмплиСенс® ВИЧ-Монитор-Duo-FL, форма 2

Общий вид

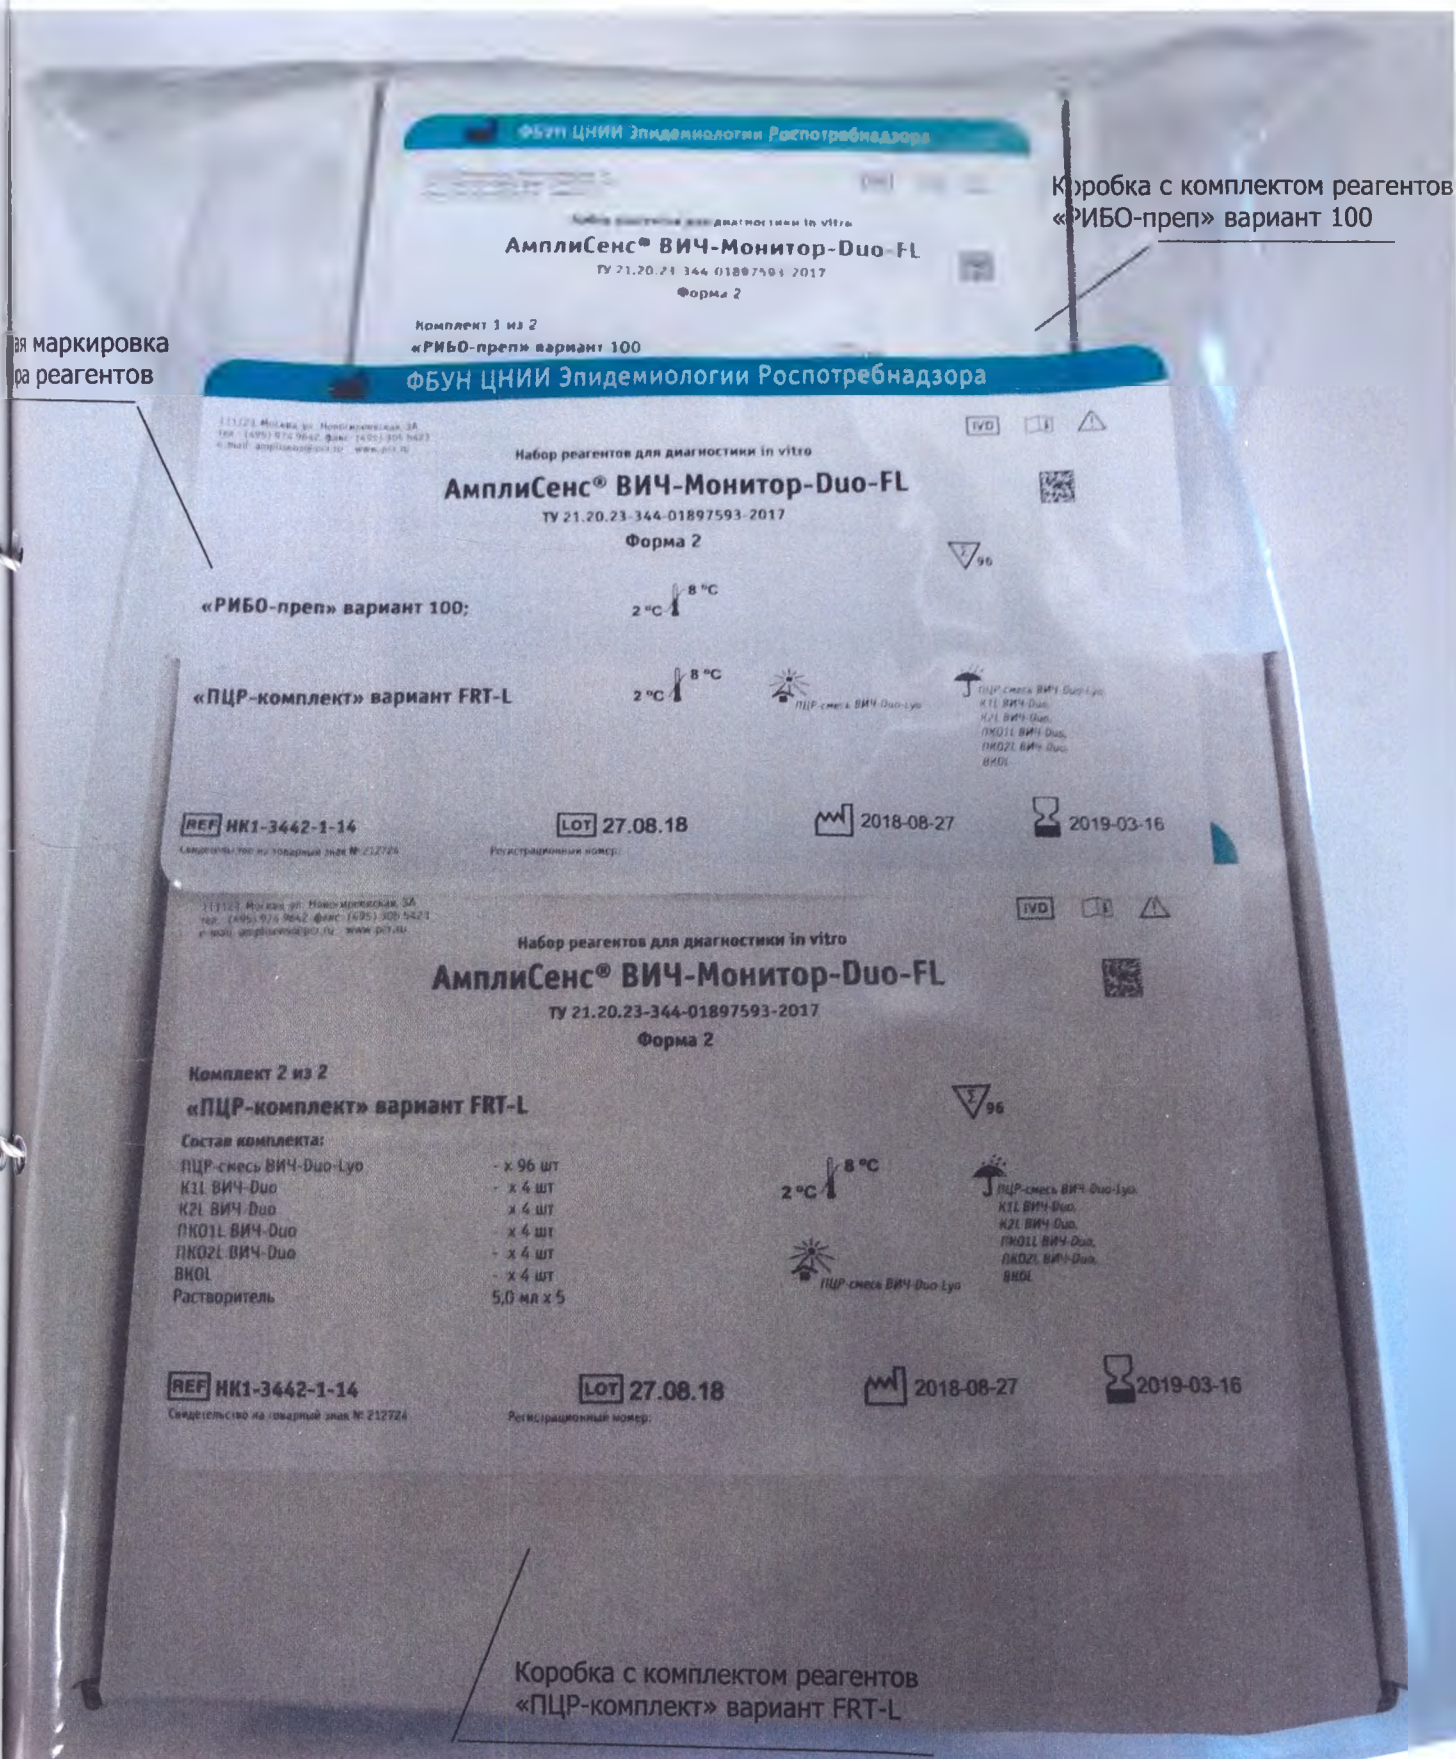

после вскрытия упаковки

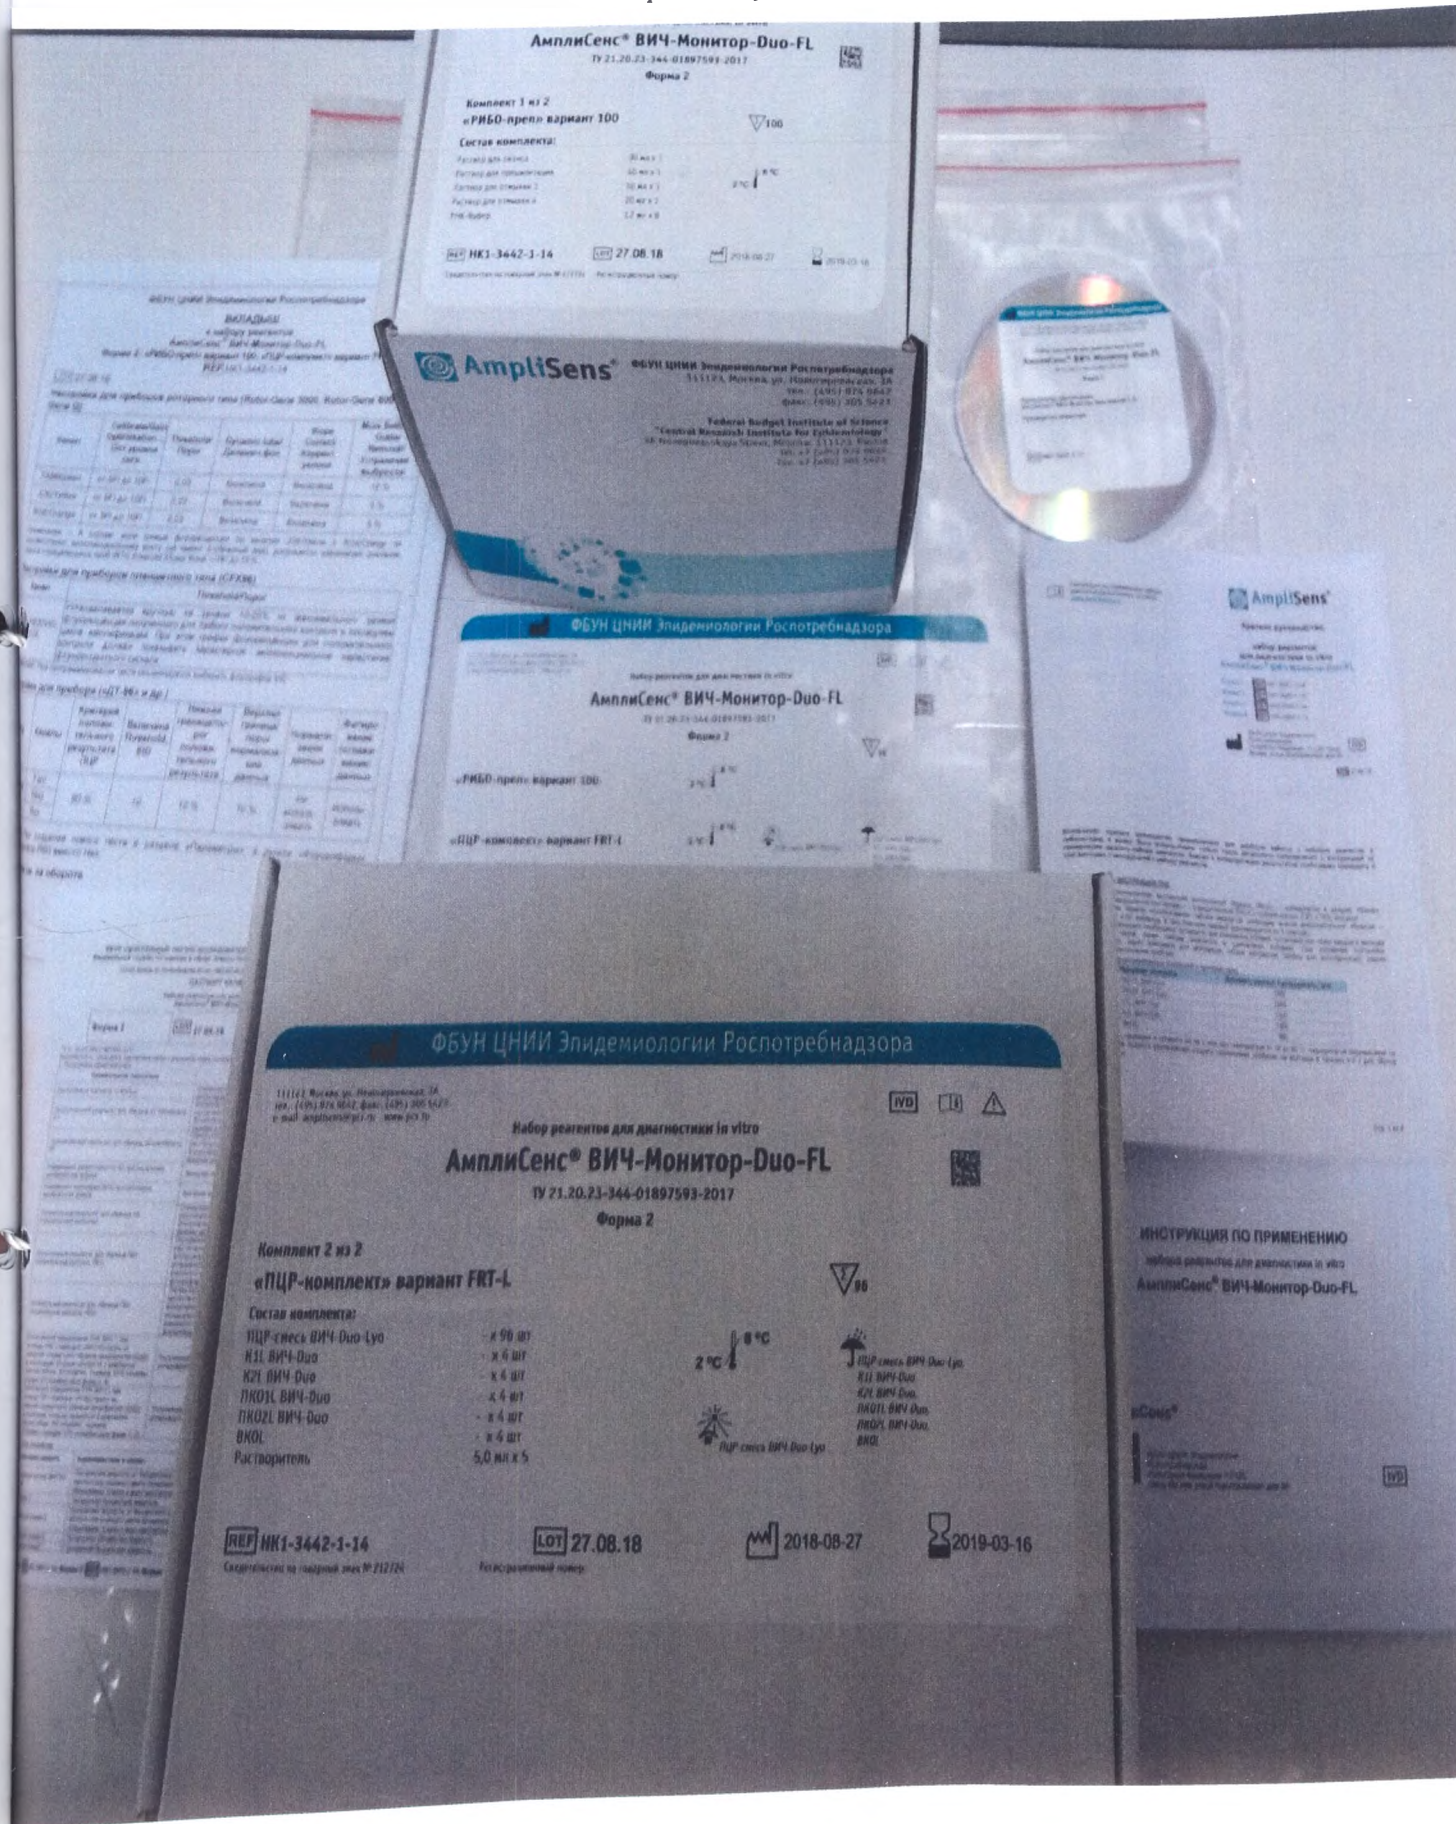

Набор реагентов АмплиСенс® ВИЧ-Монитор-Duo-FL, форма 2

«ПЦР-комплект» вариант FRT-L после вскрытия упаковки

K1L ВИЧ-Duo

K2L ВИЧ-Duo

Растворитель - 5 пробирок

BKOL

ПЦР-смесь ВИЧ-Duo-Lyo

PKO1L ВИЧ-Duo

PKO2L ВИЧ-Duo

Q2L ВИЧ-Duo- 4 пробирки

K1L ВИЧ-Duo- 4 пробирки

BKOL - 4 пробирки



PKO1L ВИЧ-Duo - 4 пробирки

PKO2L ВИЧ-Duo - 4 пробирки


ПЦР-смесь ВИЧ-Duo-Lyo -
96 пробирок

Растворитель
5 пробирок


Набор реагентов АмплиСенс[®] ВИЧ-Монитор-Duo-FL, форма 2
Комплект реагентов «РИБО-преп» вариант 100
после вскрытия упаковки

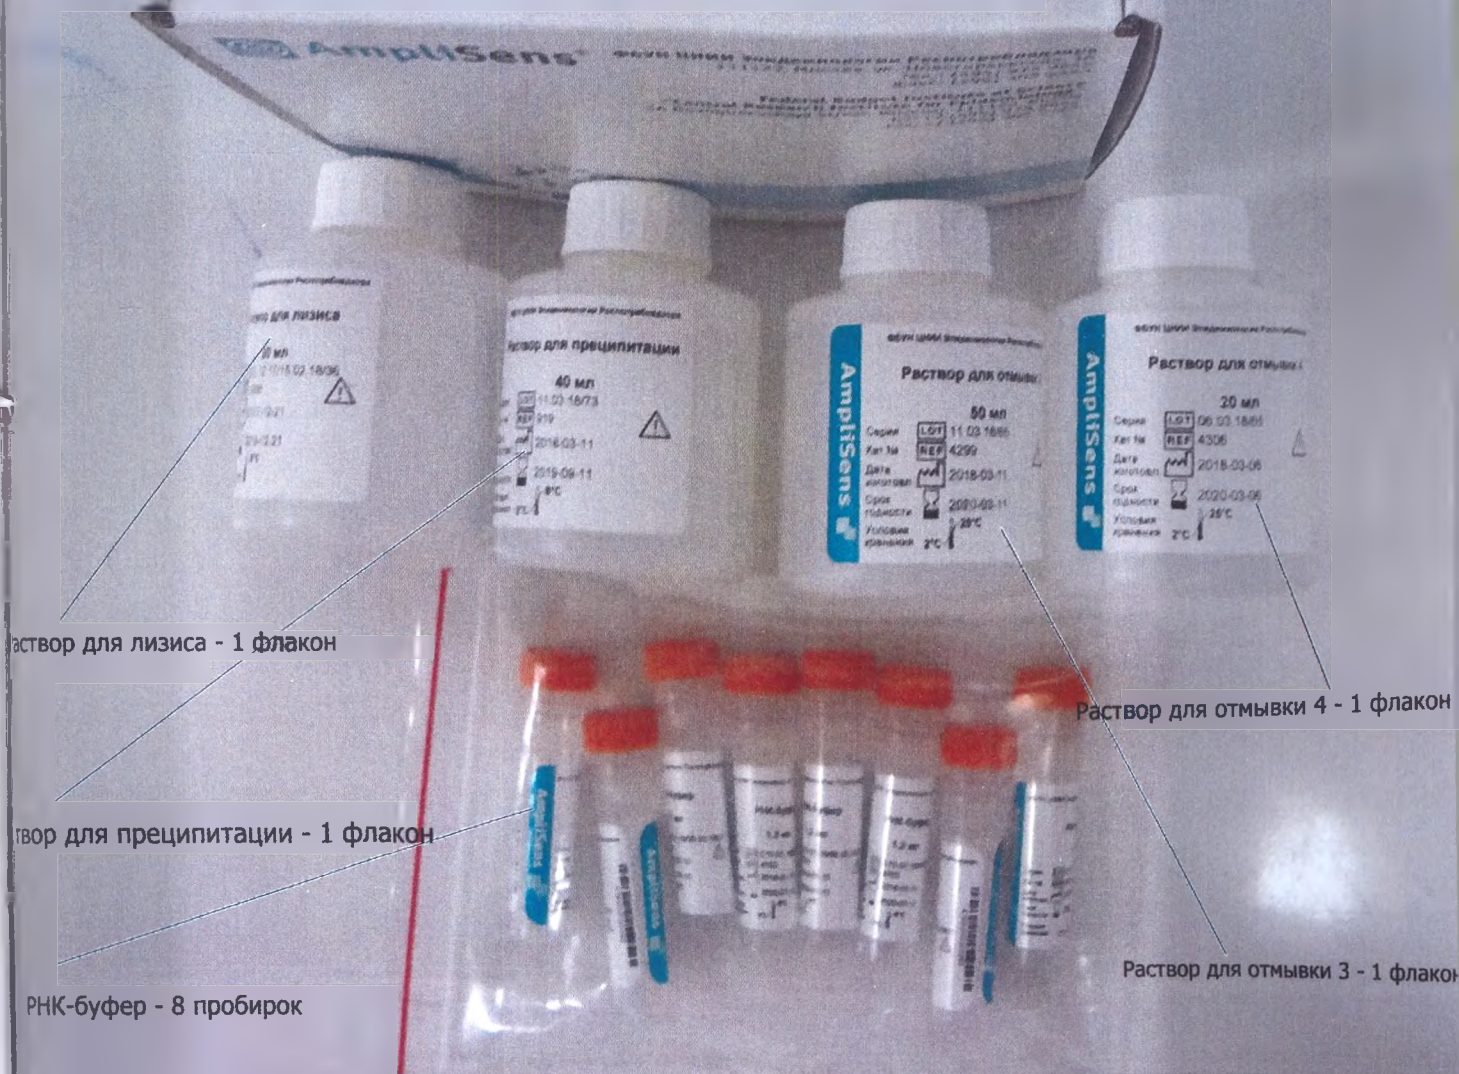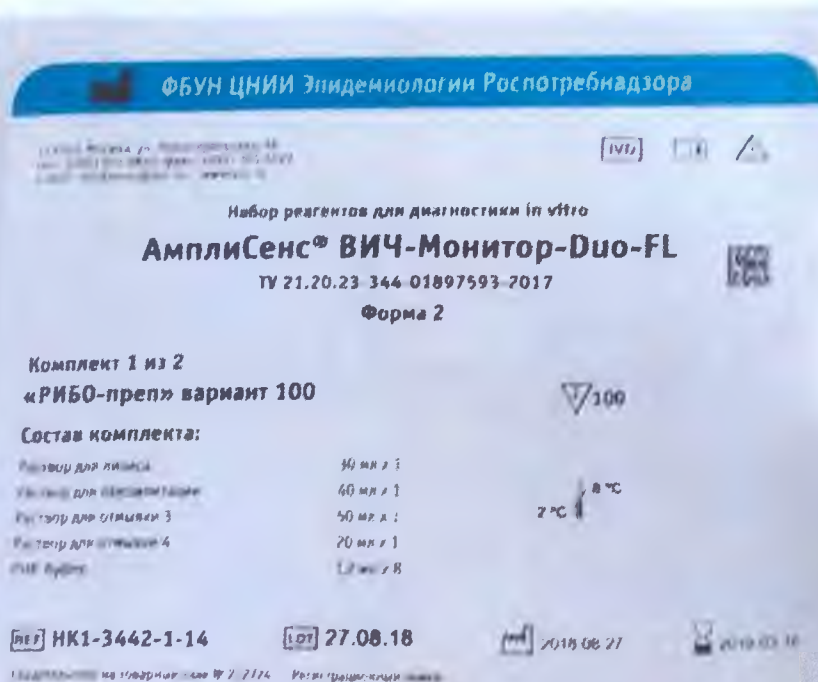

Набор реагентов АмплиСенс® ВИЧ-Монитор-Duo-FL, форма 3
Общий вид

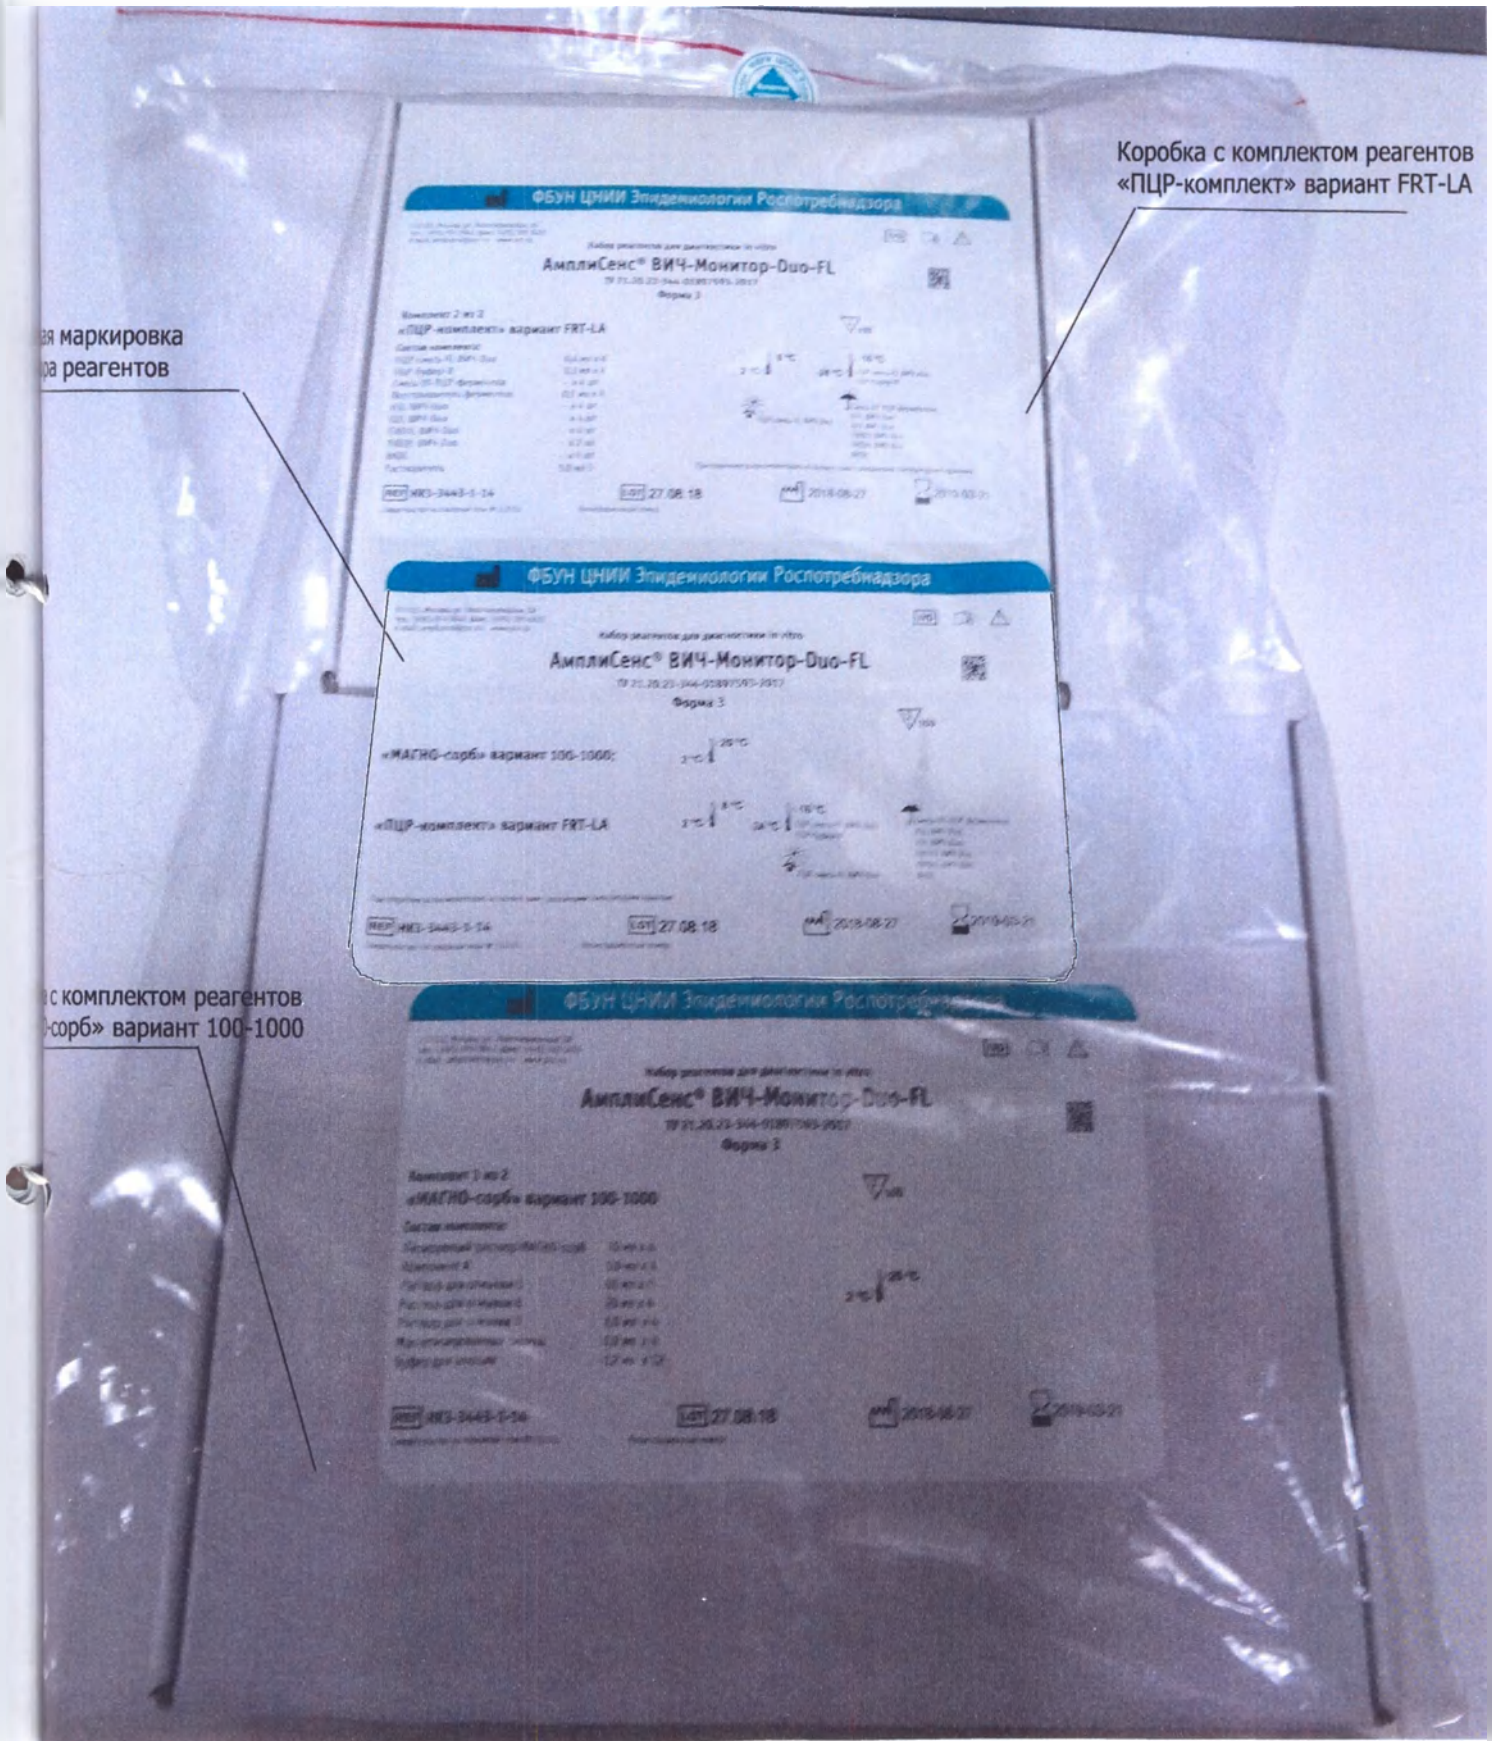

Набор реагентов АмплиСенс® ВИЧ-Монитор-Duo-FL, форма 3
после вскрытия упаковки

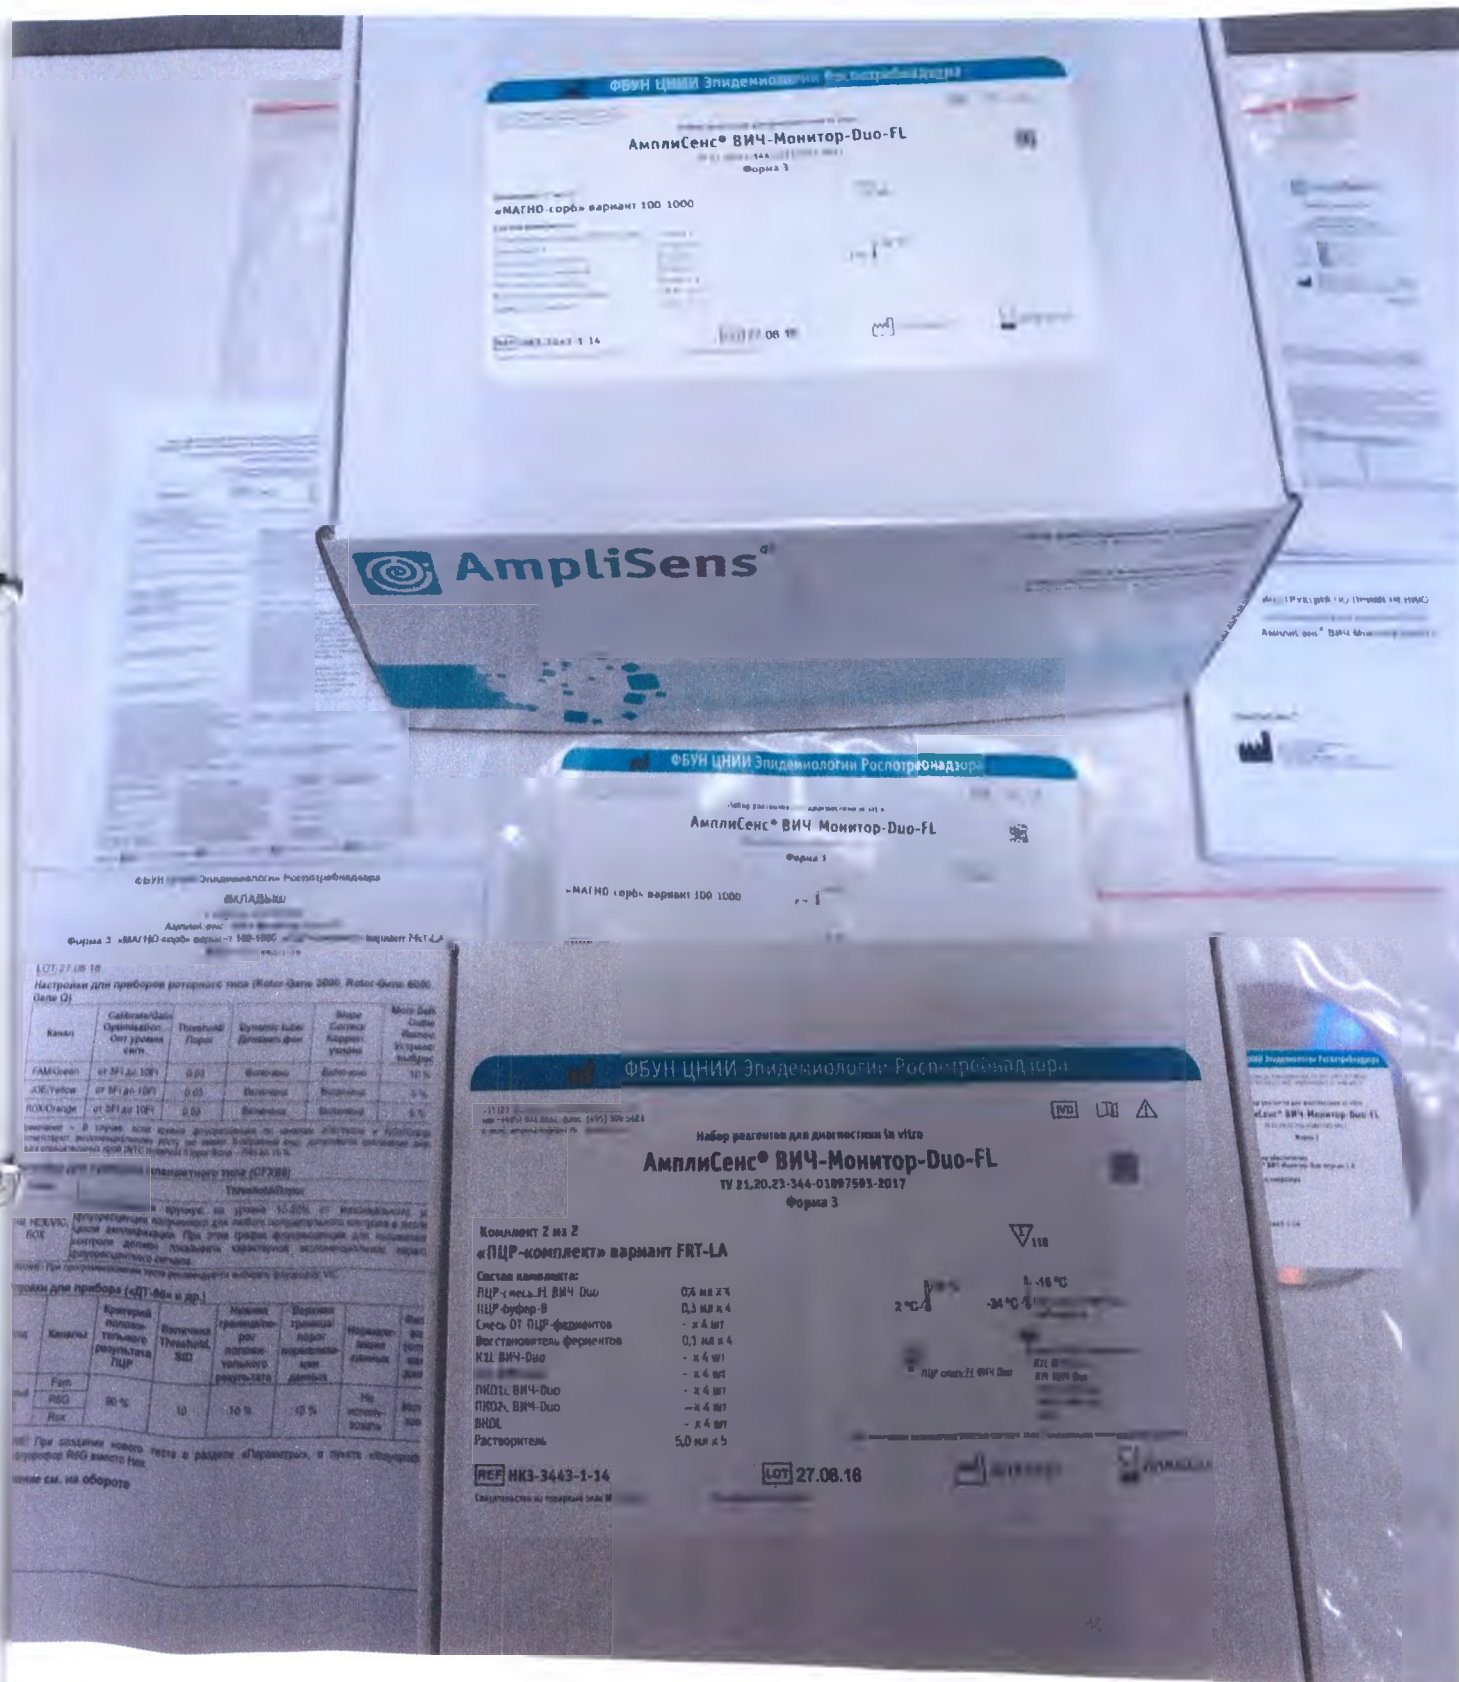

Набор реагентов АмплиСенс® ВИЧ-Монитор-Duo-FL, форма 3

«ПЦР-комплект» вариант FRT-LA после вскрытия упаковки





Набор реагентов АмплиСенс® ВИЧ-Монитор-Duo-FL, форма 3

Комплект реагентов «МАГНО-сорб» вариант 100-1000

после вскрытия упаковки



1 - Лизирующий раствор
МАГНО-сорб - 4 флакона;

2 - Раствор для отмытки 5
- 4 флакона;

3 - Раствор для отмытки 6
- 4 флакона;

4 - Раствор для отмытки 7
- 4 флакона;


5 - Магнетизированная
силика - 4 пробирки;

6 - Компонент А
- 4 пробирки;

7 - Буфер для элюции
- 12 пробирок;

Набор реагентов АмплиСенс® ВИЧ-Монитор-Duo-FL, форма 4


Общий вид

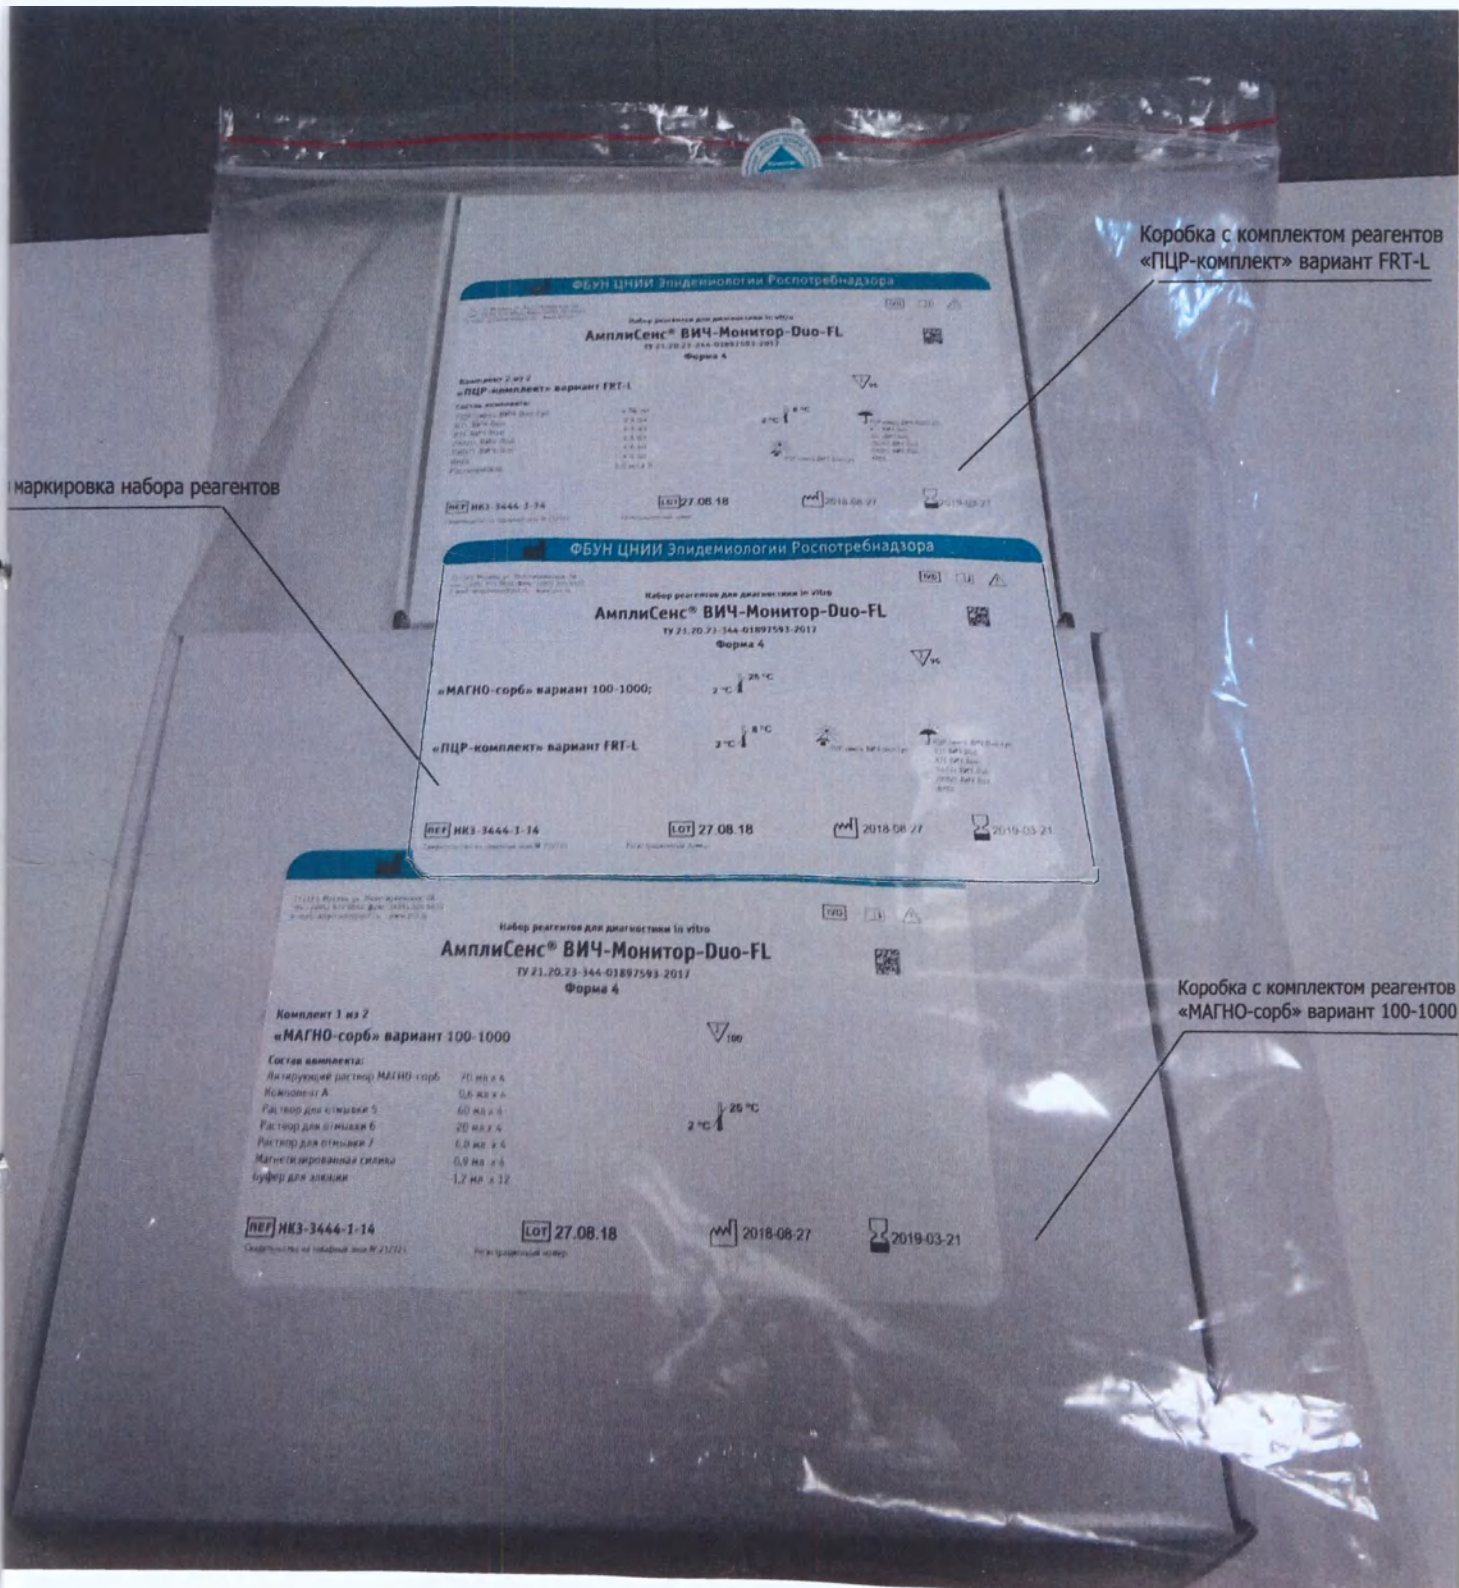

The collage displays the AmpliSens HIV-Monitor Duo-FL diagnostic kit packaging and components. The top image shows the outer box with the AmpliSens logo and Russian text. Below it, the inner box is shown with detailed Russian instructions and diagrams. The bottom part shows the kit components, including a PCR kit and a control kit, with a list of contents and a table of reagents.

«ІЦР-комплект» вариант FRT-L после вскрытия упаковки

«ІЦР-комплект» вариант FRT-L после вскрытия упаковки

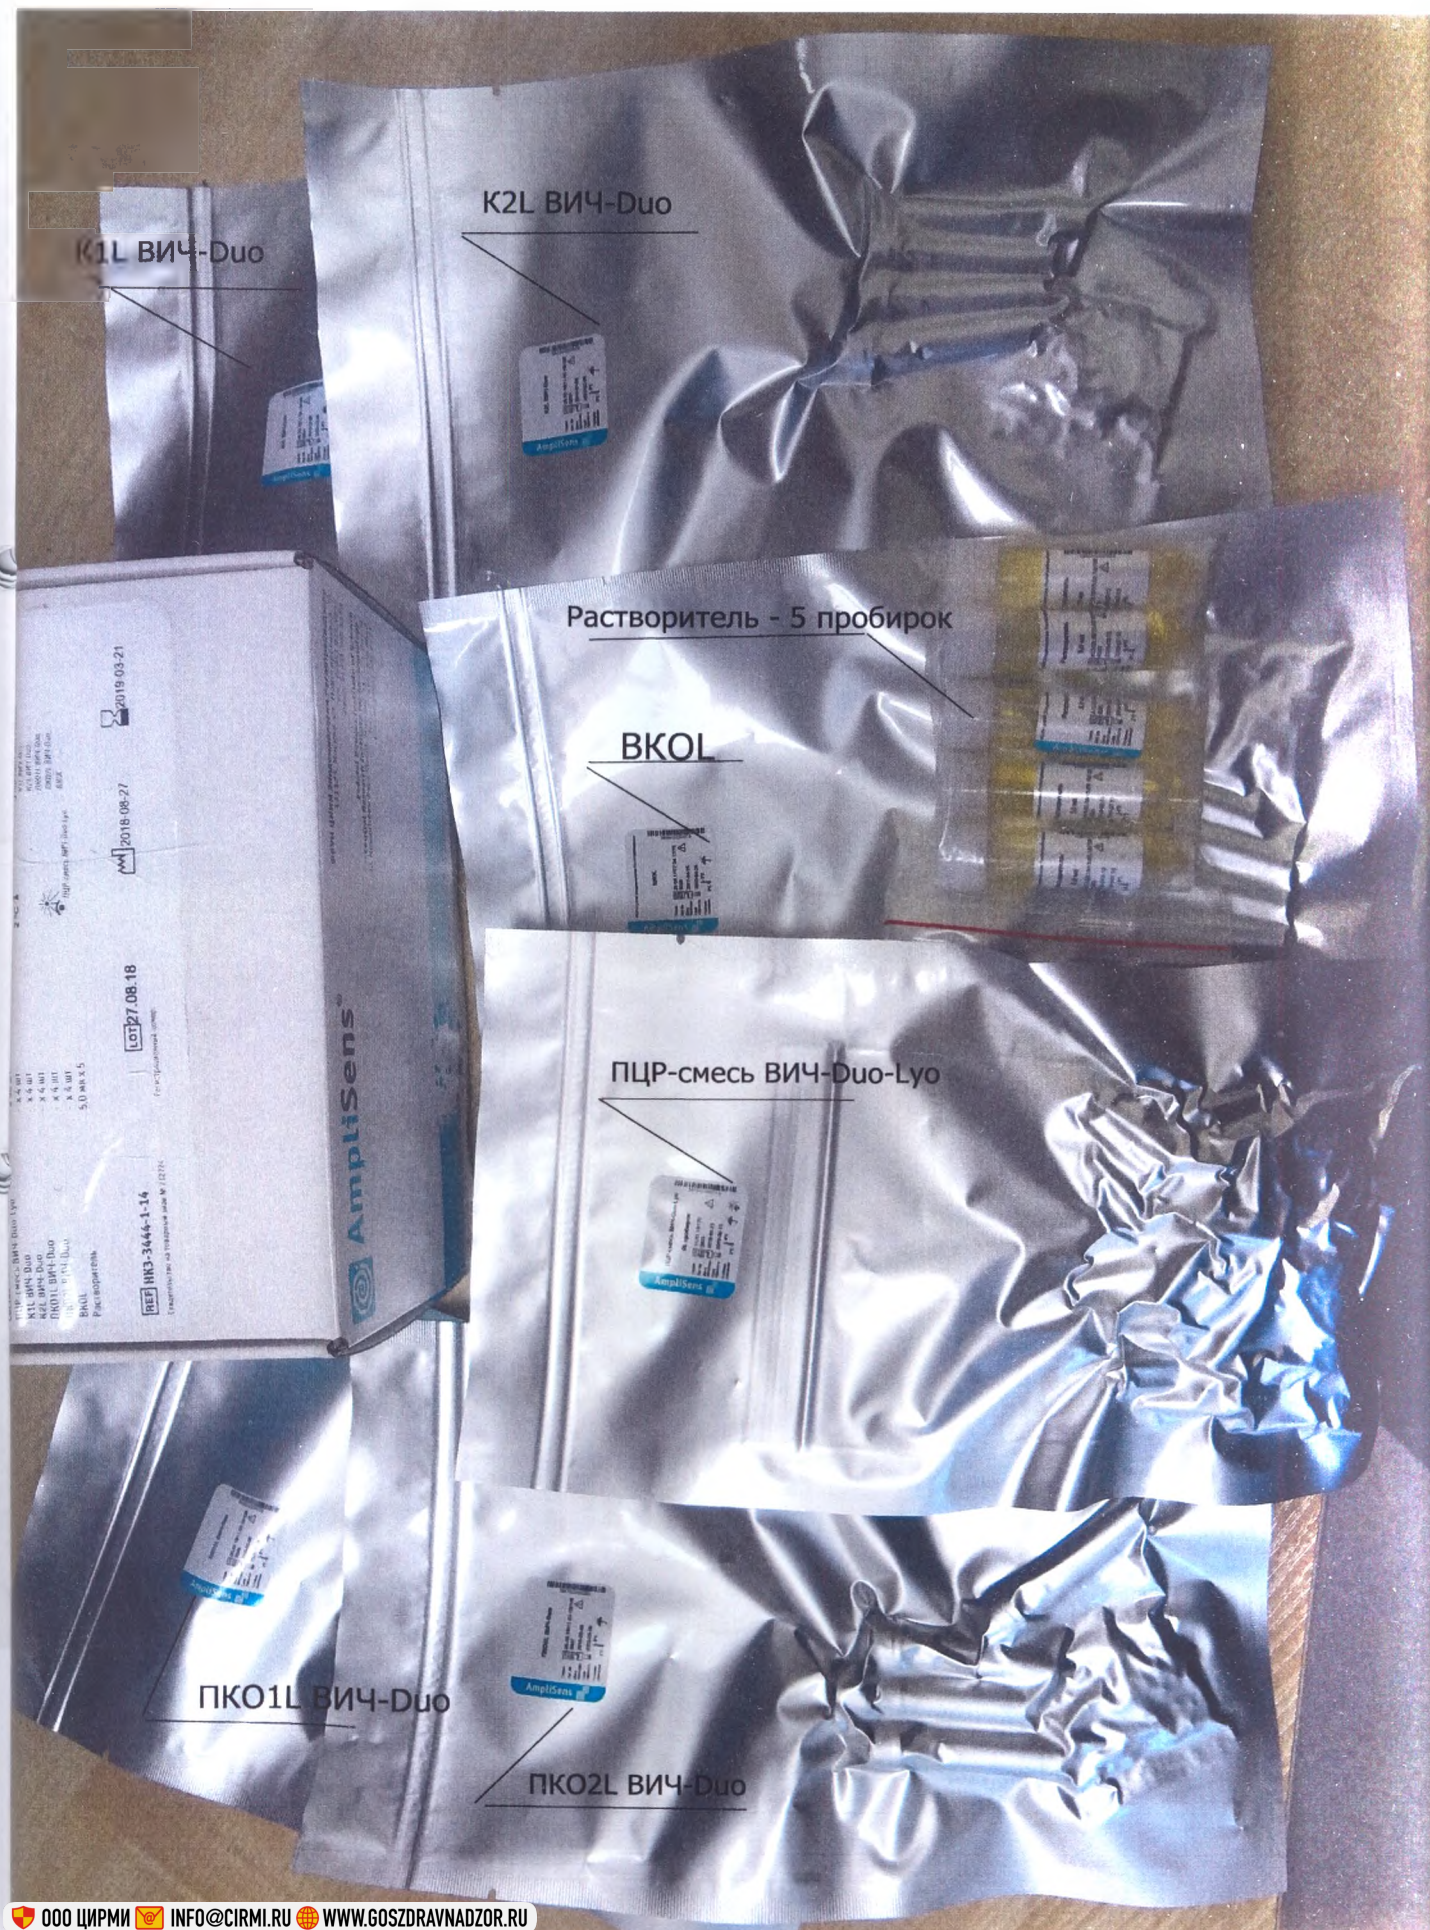

Набор реагентов АмплиСенс® ВИЧ-Монитор-Duo-FL, форма 4
«ПЦР-комплект» вариант FRT-L после вскрытия цефленовых пакетов

K2L ВИЧ-Duo - 4 пробирки

K1L ВИЧ-Duo - 4 пробирки

ВКОЛ - 4 пробирки

ПКО1L ВИЧ-Duo - 4 пробирки

ПКО2L ВИЧ-Duo - 4 пробирки

ПЦР-смесь ВИЧ-Duo-Lyo - 96 пробирок

Растворитель - 5 пробирок

Набор реагентов АмплиСенс® ВИЧ-Монитор-Duo-FL, форма 4
Комплект реагентов «МАГНО-сорб» вариант 100-1000
после вскрытия упаковки



1 - Лизирующий раствор
МАГНО-сорб - 4 флакона;
2 - Раствор для
отмывки 5 - 4 флакона;
3 - Раствор для

4 - Раствор для
отмывки 7 - 4 флакона;
5 - Магнетизированная
силика - 4 пробирки;
6 - Компонент А
- 4 пробирки;
7 - Буфер для элюции
- 12 пробирок

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью 21 лист

Директор ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии
Роспотребнадзора




В.Г. Акимкин