


Наборы для энтерального питания стерильные, с принадлежностями.

Варианты исполнения:

Набор Jejunal Feeding Set PEGJ-12-24-95-S:

- трубка для кормления, диаметр 12 Fr, длина 95 см - 1 шт.;- проводник, диаметр 0.035 дюйм, длина 200 см – 1 шт.;- петля крепежная -- 1 шт.;- петля удавка – 1 шт.

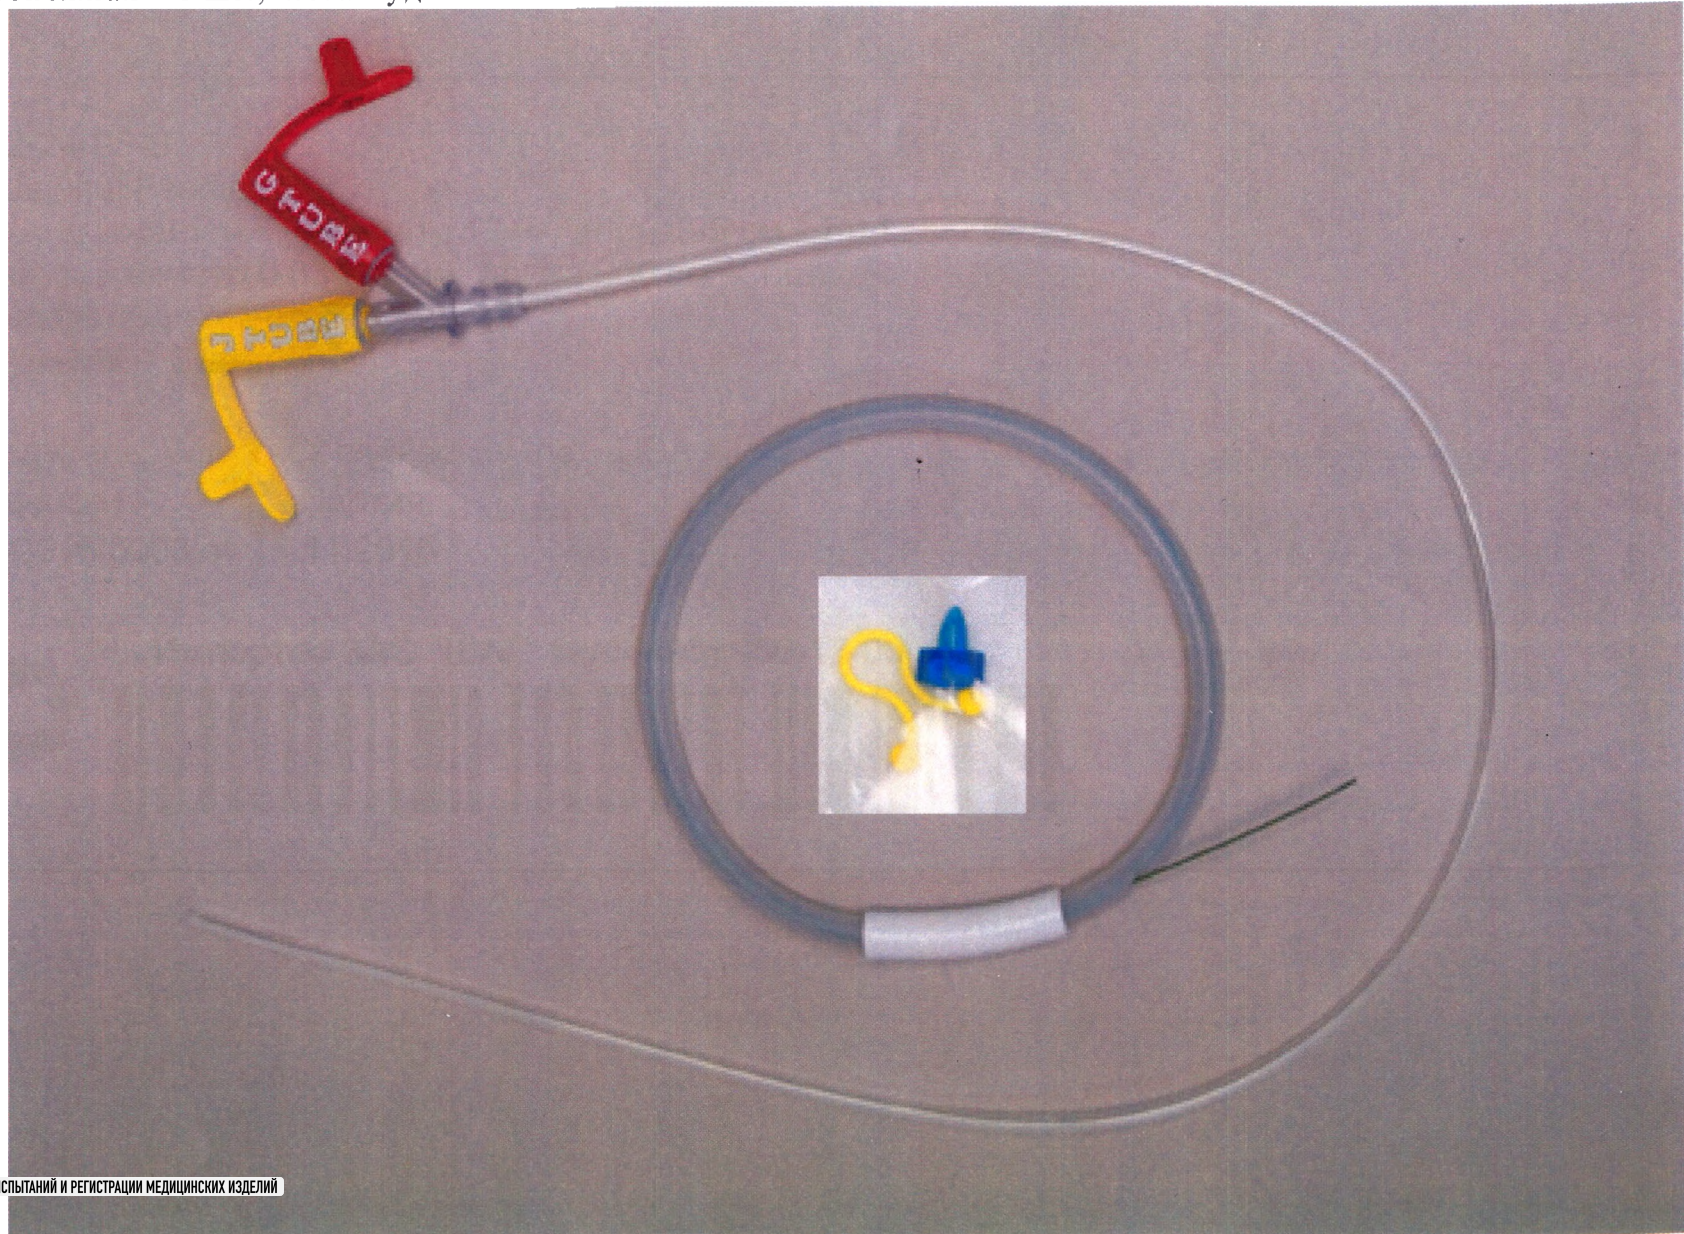

Макет маркировки:

---

PEGJ-12-24-95-S

Набор Jejunal Feeding Set

- трубка для кормления, диаметр 12 Fr, длина 95 см - 1 шт.;
- проводник, диаметр 0.035 дюйм, длина 200 см – 1 шт.;
- петля крепежная – 1 шт.;
- петля удавка – 1 шт.

Производитель: Wilson-Cook Medical Inc., USA

Срок годности: \_\_\_\_\_ Партия: \_\_\_\_\_

Рег.уд.: 2016/5003 от 15.11.2016



Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09




Наборы для энтерального питания стерильные, с принадлежностями.

Варианты исполнения:

Набор Jejunal Feeding Set PEGJ-12-24-I-S:

- трубка для кормления, диаметр 12 Fr, длина 66 см - 1 шт.;- проводник, диаметр 0.035 дюйм, длина 200 см – 1 шт.;- петля крепежная – 1 шт.;- петля удавка – 1 шт.

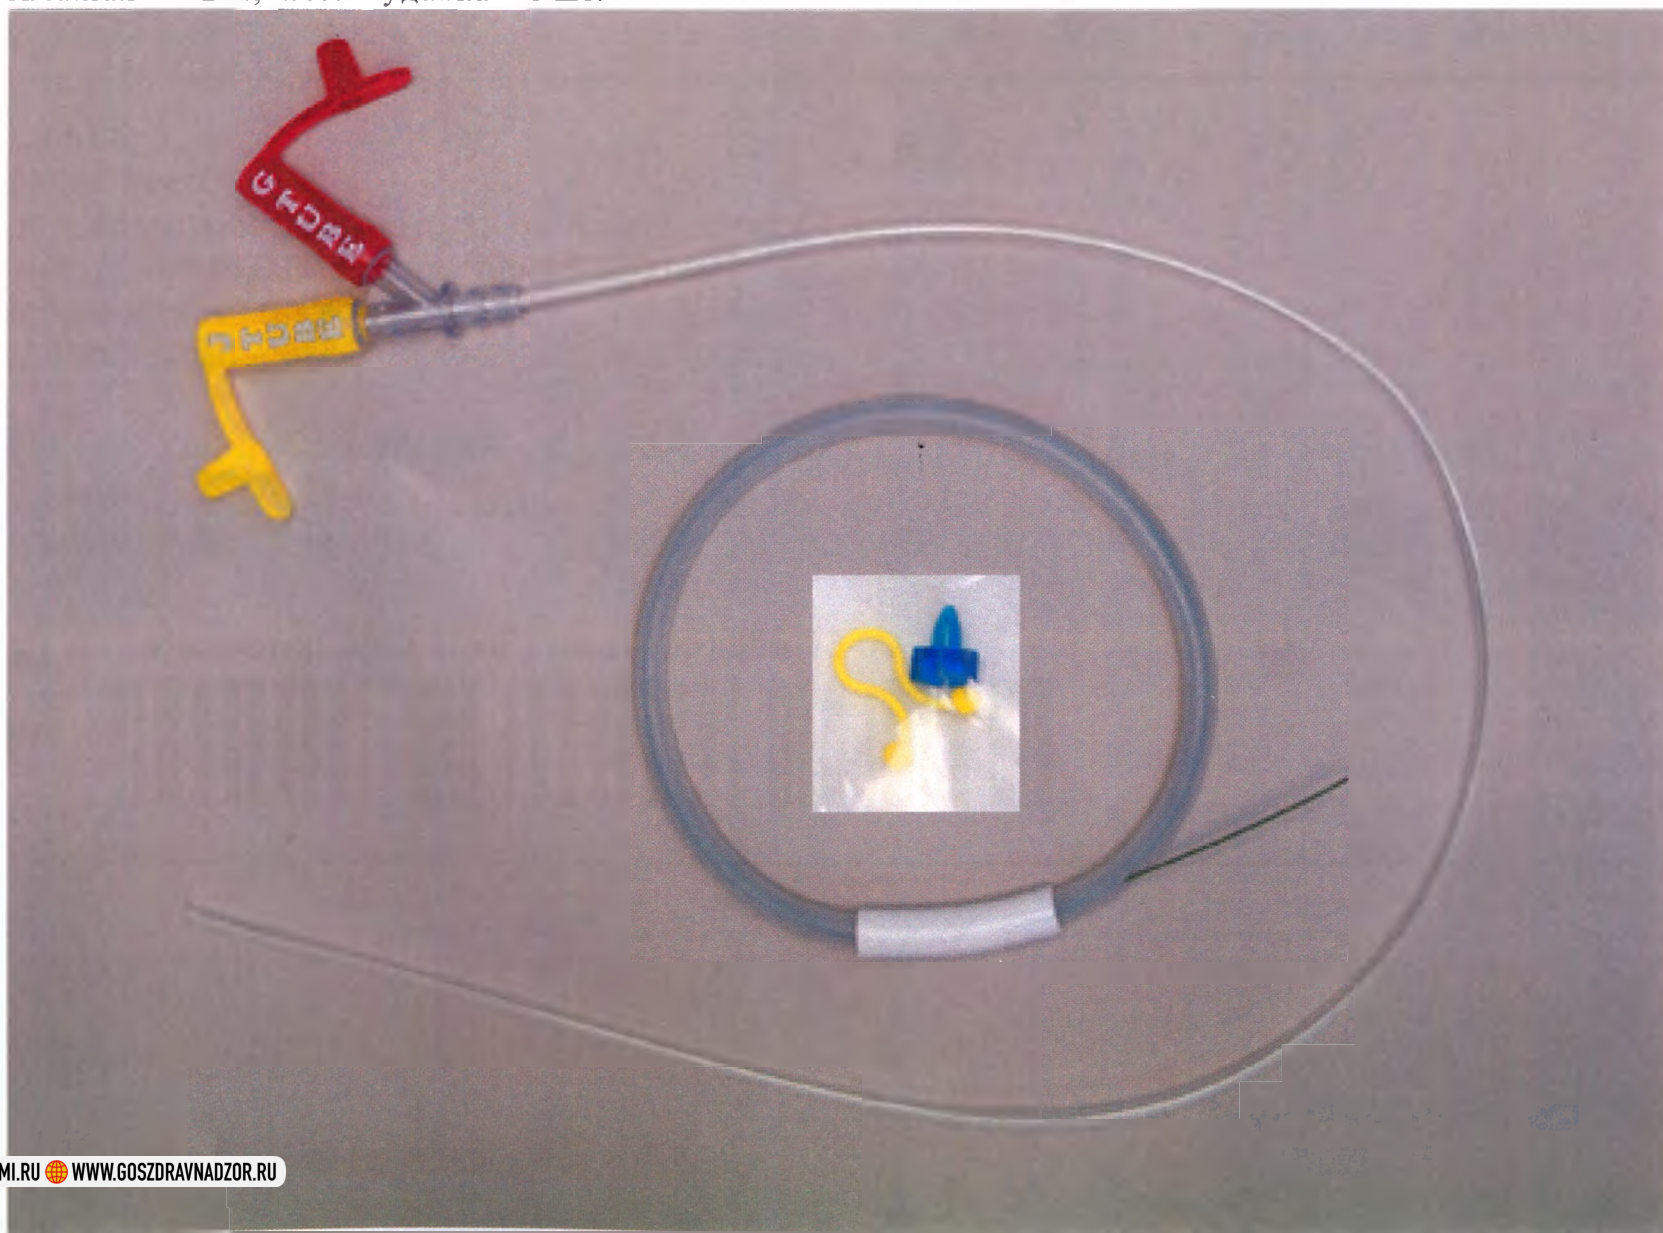

Макет маркировки:

PEGJ-12-24-I-S

Набор Jejunal Feeding Set:

- трубка для кормления, диаметр 12 Fr, длина 66 см - 1 шт.;
- проводник, диаметр 0.035 дюйм, длина 200 см – 1 шт.;
- петля крепежная – 1 шт.;
- петля удавка – 1 шт.

Производитель: Wilson-Cook Medical Inc., USA

Срок годности: \_\_\_\_\_ Партия: \_\_\_\_\_

Рег.уд.: 2016/5003 от 15.11.2016



Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09




Набор Jejunum Feeding Set PEGJ-12-24-S: с принадлежностями.

Варианты исполнения:

Набор Jejunum Feeding Set PEGJ-12-24-S:

- трубка для кормления, диаметр 12 Fr, длина 66 см - 1 шт.;- проводник, диаметр 0.035 дюйм, длина 200 см - 1 шт.;- петля крепежная - 1 шт.;- петля удавка - 1 шт.

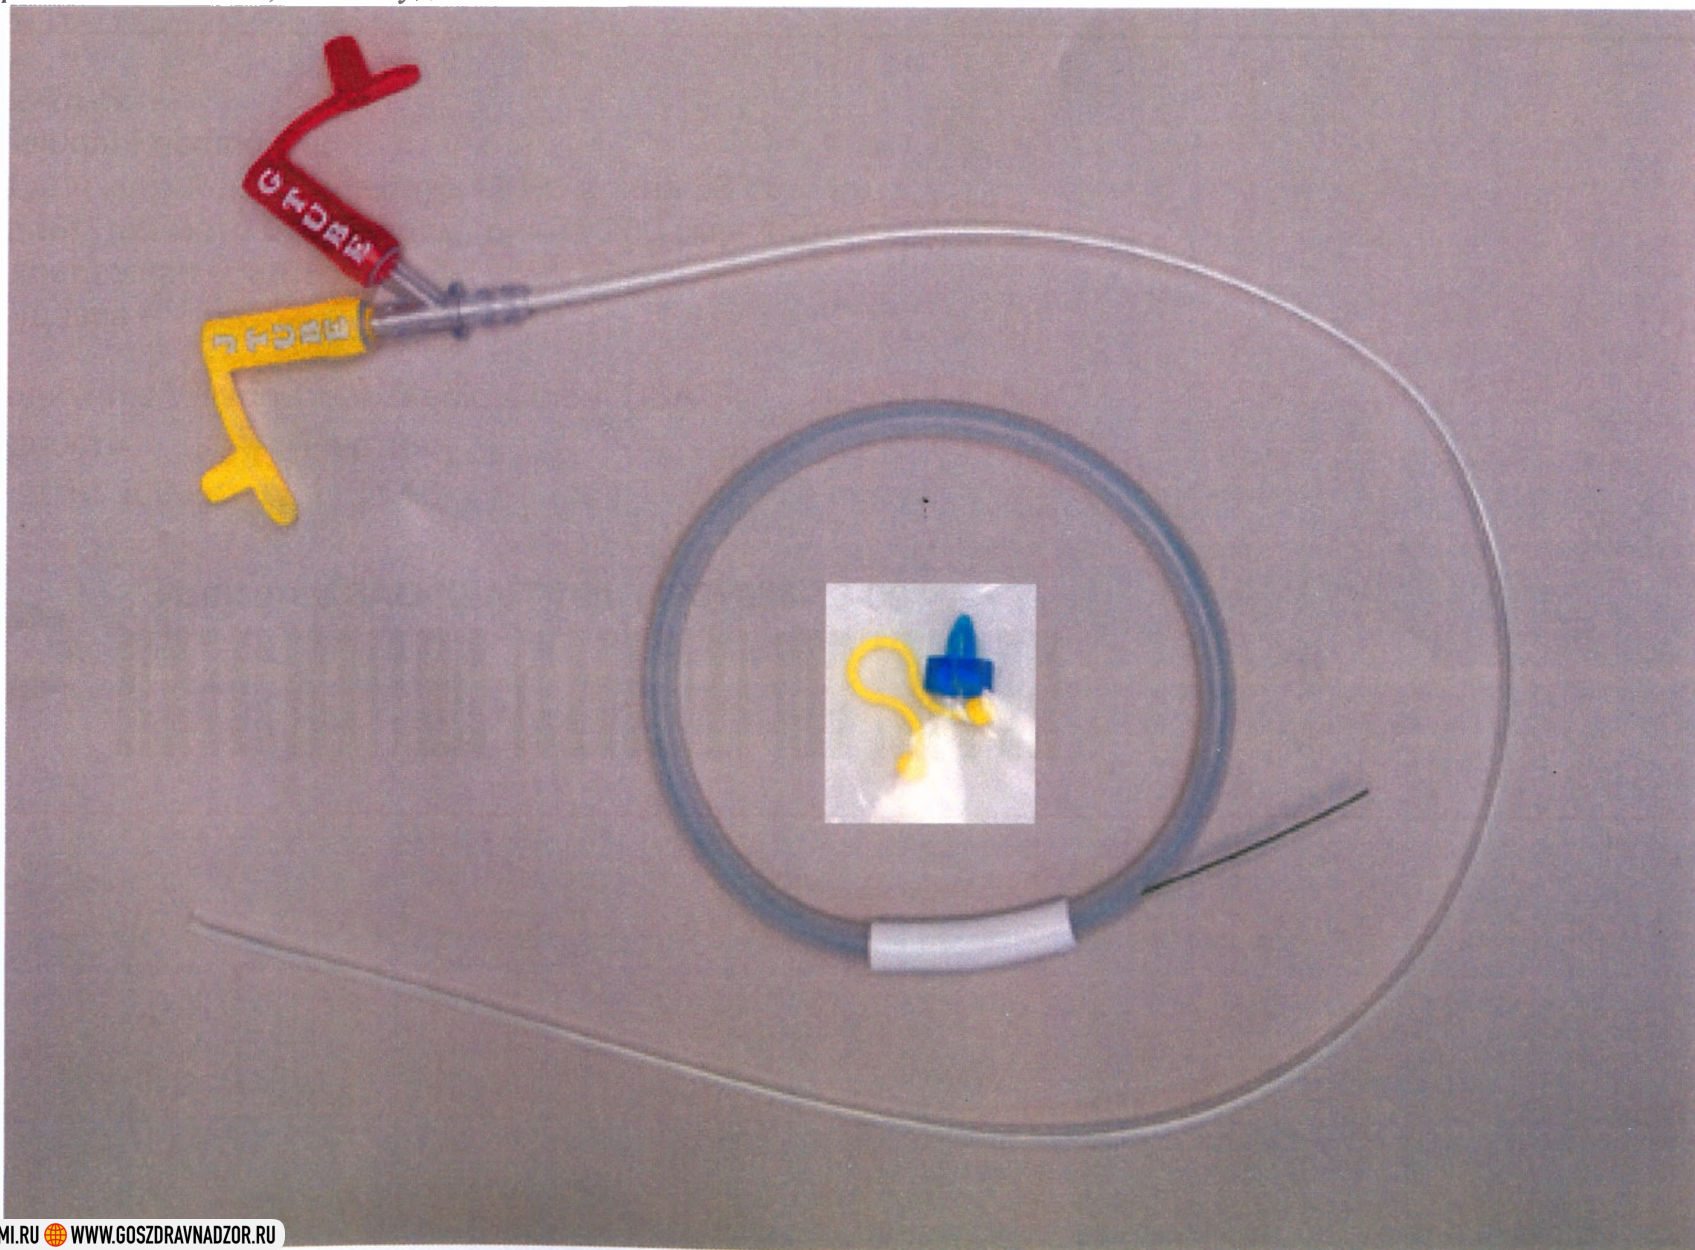

Макет маркировки:

---

PEGJ-12-24-S:

Набор Jejunal Feeding Set

- трубка для кормления, диаметр 12 Fr, длина 66 см - 1 шт.;
- проводник, диаметр 0.035 дюйм, длина 200 см – 1 шт.;
- петля крепежная – 1 шт.;
- петля удавка – 1 шт.

Производитель: Wilson-Cook Medical Inc., USA

Срок годности: \_\_\_\_\_ Партия: \_\_\_\_\_

Рег.уд.: 2016/5003 от 15.11.2016



Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09




Наборы для энтерального питания стерильные, с принадлежностями.

Варианты исполнения:

Набор Jejunal Feeding Set FLOWJ-9-20-S:

- трубка для кормления, диаметр 9 Fr, длина 60 см - 1 шт.;- проводник, диаметр 0.028 дюйм, длина 200 см - 1 шт.;- петля крепежная - 1 шт.;- петля удавка - 1 шт.

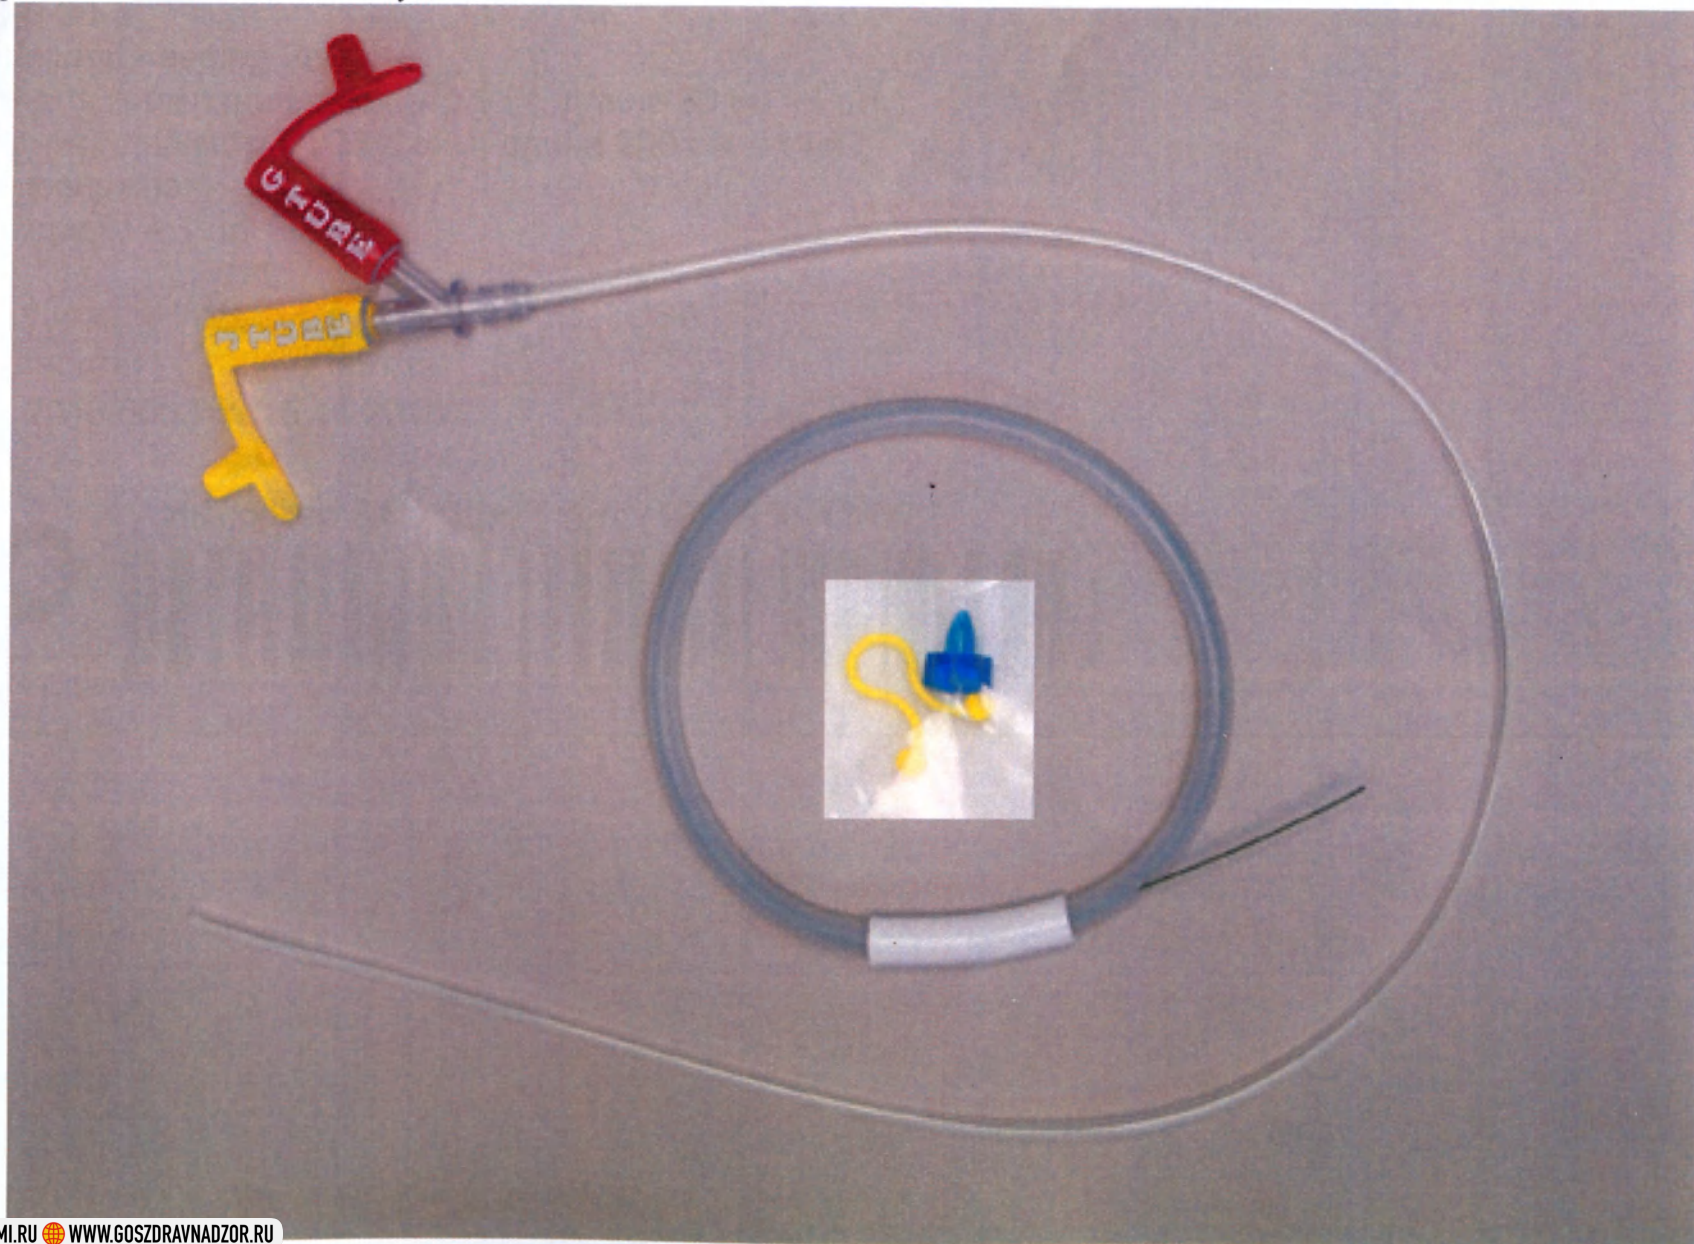

Макет маркировки:

FLOWJ-9-20-S

Набор Jejunal Feeding Set:

- трубка для кормления, диаметр 9 Fr, длина 60 см - 1 шт.;
- проводник, диаметр 0.028 дюйм, длина 200 см – 1 шт.;
- петля крепежная – 1 шт.;
- петля удавка – 1 шт.

Производитель: Wilson-Cook Medical Inc., USA

Срок годности: \_\_\_\_\_ Партия: \_\_\_\_\_

Рег.уд.: 2016/5003 от 15.11.2016



Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09




Наборы для энтерального питания стерильные, с принадлежностями.

Варианты исполнения:

Набор Jejunal Feeding Set FLOWJ-9-20-I-S:

- трубка для кормления, диаметр 9 Fr, длина 60 см - 1 шт.;- проводник, диаметр 0.028 дюйм, длина 200 см - 1 шт.;- петля крепежная - 1 шт.;- петля удавка - 1 шт.

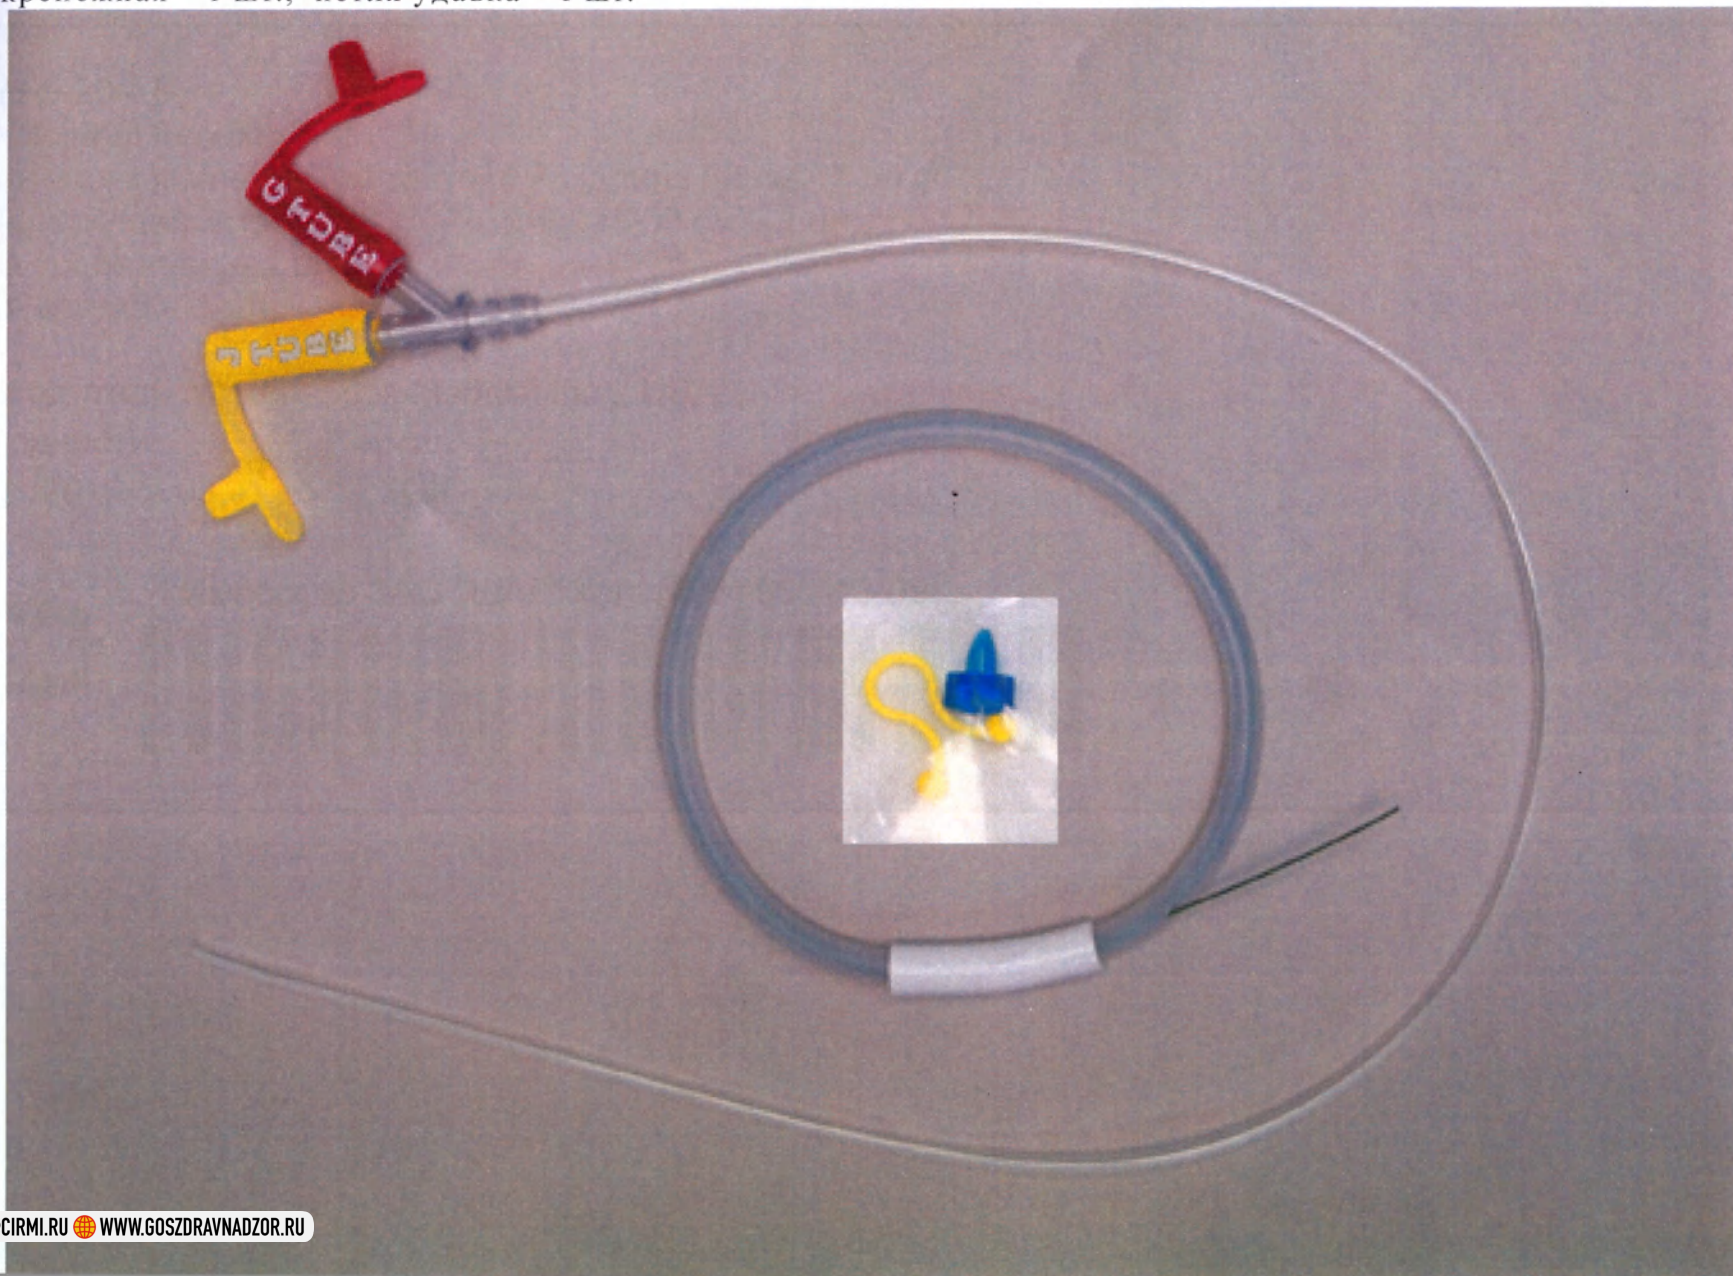

Макет маркировки:

---

FLOWJ-9-20-I-S

Набор Jejunal Feeding Set

- трубка для кормления, диаметр 9 Fr, длина 60 см - 1 шт.;
- проводник, диаметр 0.028 дюйм, длина 200 см – 1 шт.;
- петля крепежная – 1 шт.;
- петля удавка – 1 шт.

Производитель: Wilson-Cook Medical Inc., USA

Срок годности: \_\_\_\_\_ Партия: \_\_\_\_\_

Рег.уд.: 2016/5003 от 15.11.2016




Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



Варианты исполнения: Набор Percutaneous Endoscopic Gastrostomy Sets PEG-24-PULL-I-S:

- трубка для кормления, диаметр 24 Гр, длина 76,2 см – 1 шт.;- проводник, диаметр 0.035 дюйм, длина 260 см – 1 шт.;
- крепежный комплект: калин крепежный – 1 шт., петля крепежная – 2шт., петля-удавка – 1 шт., ножницы – 1 шт.,
- адаптер универсальный – 1 шт., адаптер болюсный – 1 шт., адаптер для кормления – 1 шт.; зажим – 1 шт.;
- лоток: скальпель – 1 шт., канюля с иглой – 1 шт.;- тампоны марлевые – 5 шт.;- простыня одноразовая – 1 шт.;
- петля-захват – 1шт.

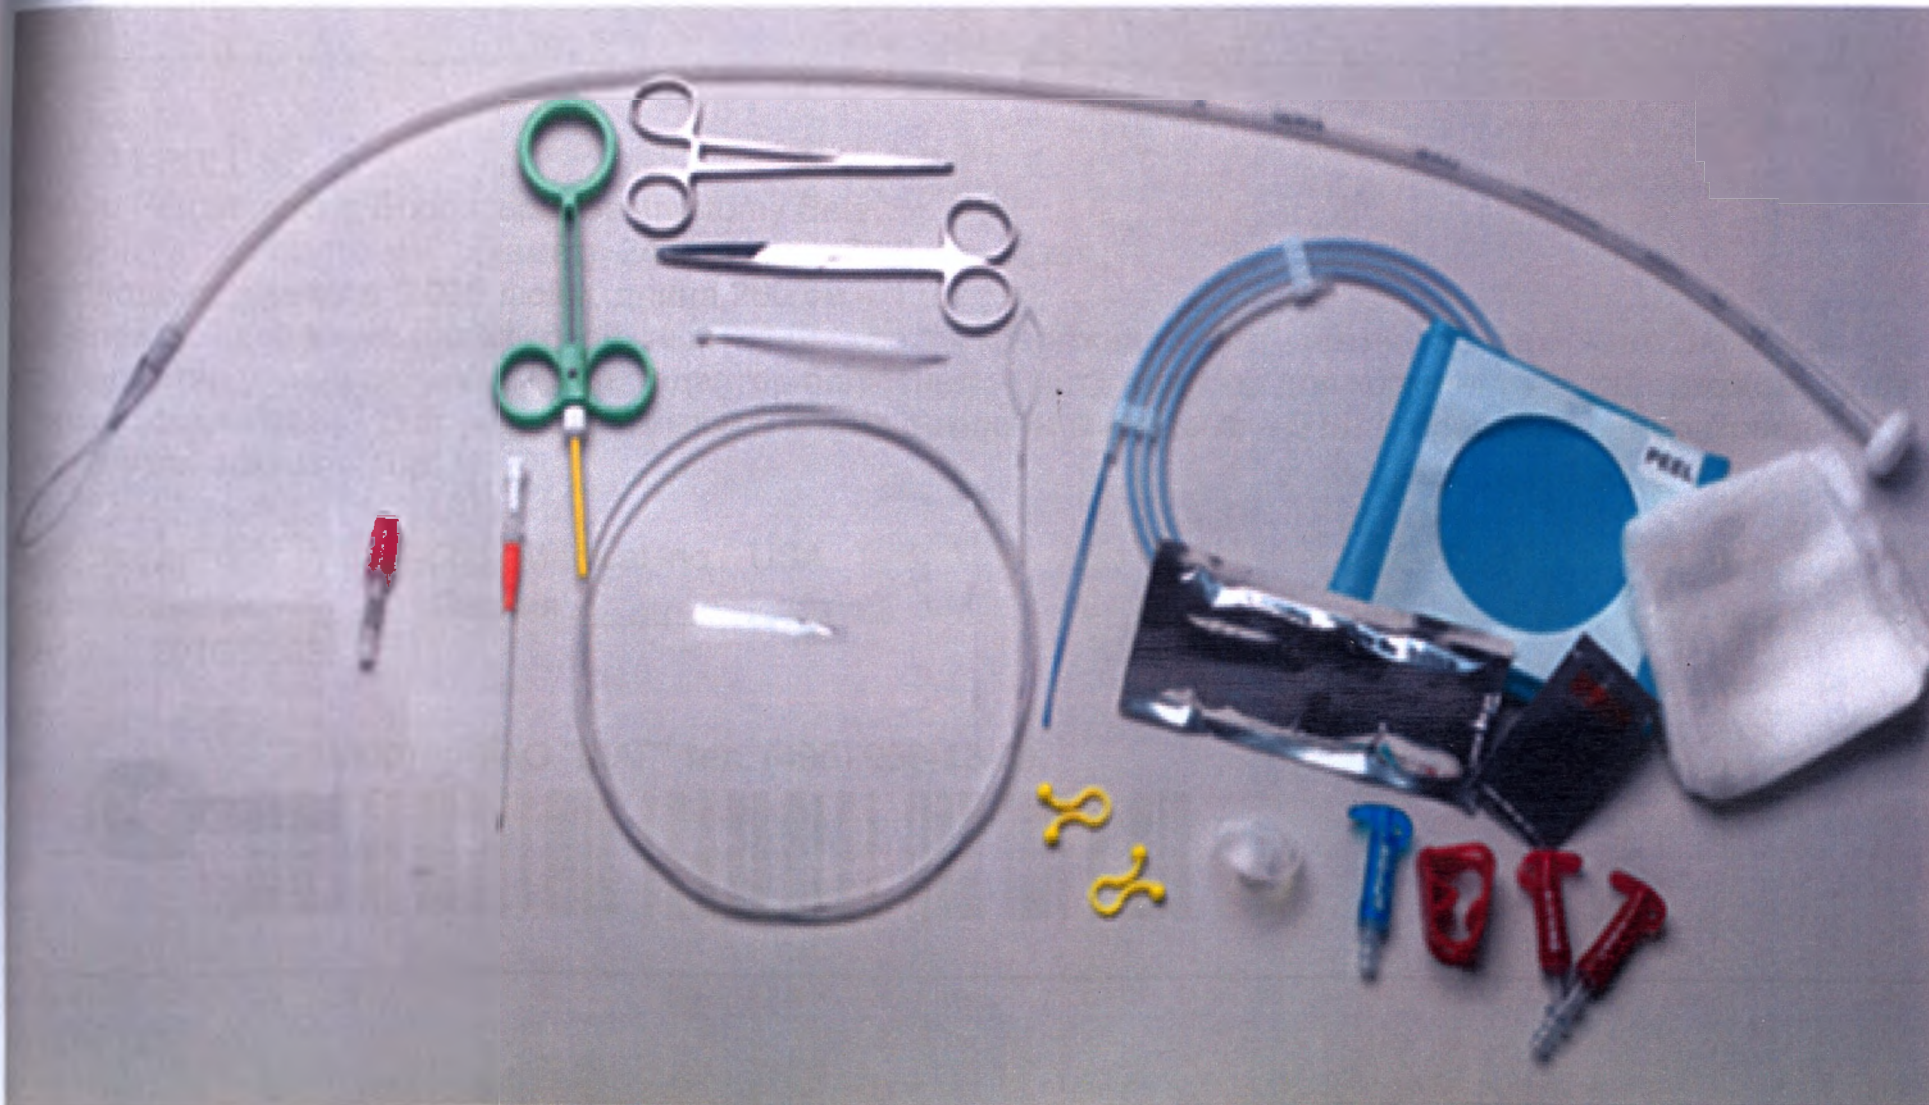

Макет маркировки:

PEG-24-PULL-I-S

Набор Percutaneous Endoscopic Gastrostomy Sets:

- трубка для кормления, диаметр 24 Fr, длина 76,2 см – 1 шт.;
- проводник, диаметр 0.035 дюйм, длина 260 см – 1 шт.;
- крепежный комплект: валик крепежный – 1 шт., петля крепежная – 2 шт., петля-удавка – 1 шт., ножницы – 1 шт., адаптер универсальный – 1 шт., адаптер болюсный – 1 шт., адаптер для кормления – 1 шт.; зажим – 1 шт.
- лоток: скальпель – 1 шт., канюля с иглой – 1 шт.; - тампоны марлевые – 5 шт.; - простыня одноразовая – 1 шт.;
- петля-захват – 1 шт.

Производитель: Wilson-Cook Medical Inc., USA

Срок годности: \_\_\_\_\_ Партия: \_\_\_\_\_

Рег.уд.: 2016/5003




Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



Наборы для энтерального питания стерильные, с принадлежностями.

Варианты исполнения: Набор Percutaneous Endoscopic Gastrostomy Sets PEG-24-PUSH-I-S:

- трубка для кормления, диаметр 24 Fr, длина 76,2 см – 1 шт.;
- проводник, диаметр 0.035 дюйм, длина 260 см – 1 шт.;
- крепежный комплект: валик крепежный – 1 шт., петля крепежная – 2 шт., петля-удавка – 1 шт., ножницы – 1 шт., адаптер универсальный – 1 шт., адаптер болюсный – 1 шт., адаптер для кормления – 1 шт.; зажим – 1 шт.;
- лоток: скальпель – 1 шт., канюля с иглой – 1 шт.;- тампоны марлевые – 5 шт.;- простыня одноразовая – 1 шт.;
- петля-захват – 1 шт.

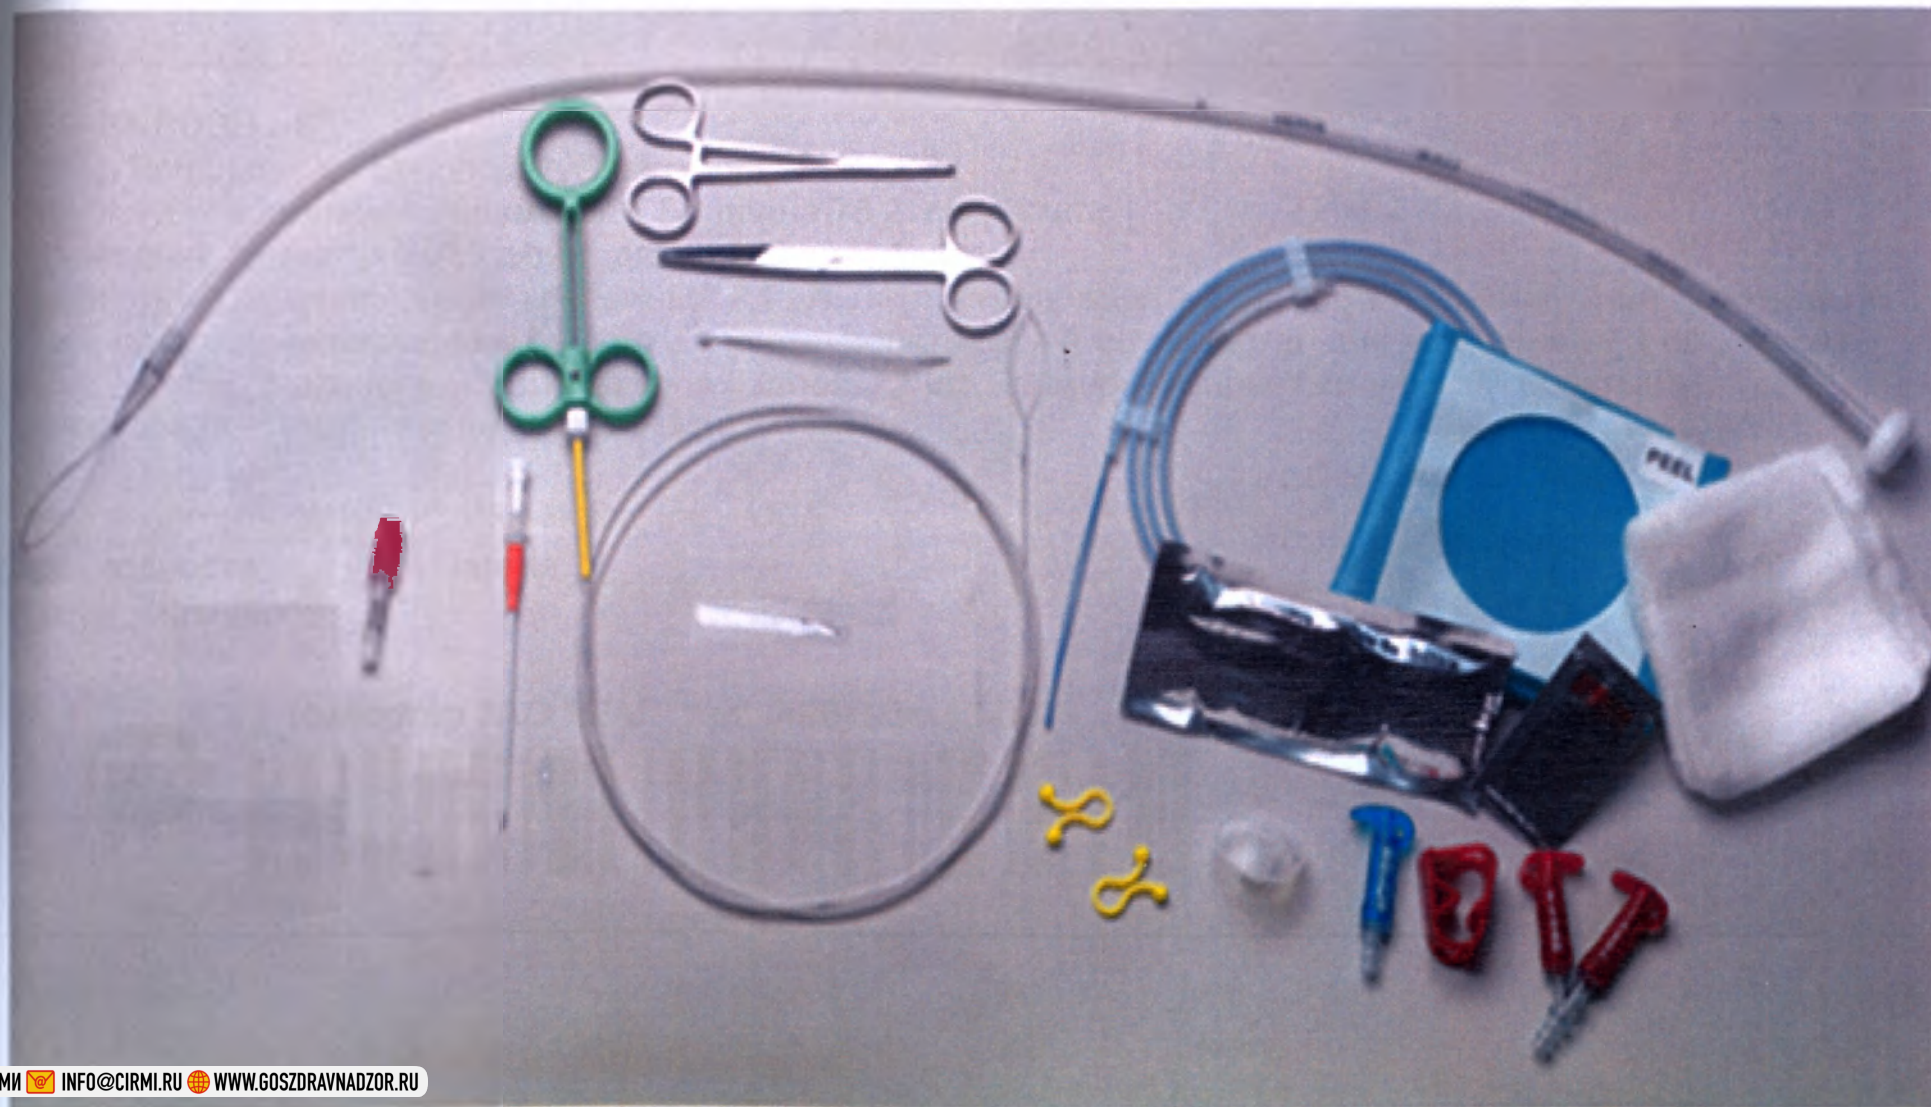

Макет маркировки:

PEG-24-PUSH-I-S

Набор Percutaneous Endoscopic Gastrostomy Sets

- трубка для кормления, диаметр 24 Fr, длина 76,2 см – 1 шт.;
- проводник, диаметр 0.035 дюйм, длина 260 см – 1 шт.;
- крепежный комплект: валик крепежный – 1 шт., петля крепежная – 2 шт., петля-удавка – 1 шт., ножницы – 1 шт., адаптер универсальный – 1 шт., адаптер болюсный – 1 шт., адаптер для кормления – 1 шт.; зажим – 1 шт.; - лоток: скальпель – 1 шт., канюля с иглой – 1 шт.; - тампоны марлевые – 5 шт.; - простыня одноразовая – 1 шт.; - петля-захват – 1 шт.

Производитель: Wilson-Cook Medical Inc., USA

Срок годности: \_\_\_\_\_ Партия: \_\_\_\_\_

Рег.уд.: 2016/5003



Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



Наборы для энтерального питания стерильные, с принадлежностями.

Варианты исполнения: Набор Percutaneous Endoscopic Gastrostomy Sets FLOW-20-PULL-I-S:

- трубка для кормления, диаметр 20 Fr, длина 76,2 см – 1 шт.;
- проводник, диаметр 0.035 дюйм, длина 260 см – 1 шт.;
- крепежный комплект: валик крепежный – 1 шт., петля крепежная – 2 шт., петля-удавка – 1 шт., ножницы – 1 шт.,
- адаптер универсальный – 1 шт., адаптер болюсный – 1 шт., адаптер для кормления – 1 шт.; зажим – 1 шт.;
- блок: скальпель – 1 шт., канюля с иглой – 1 шт.; тампоны марлевые – 5 шт.; простыня одноразовая – 1 шт.;
- петля-захват – 1 шт.



Макет маркировки:

### FLOW-20-PULL-I-S

Набор Percutaneous Endoscopic Gastrostomy Sets

- трубка для кормления, диаметр 20 Fr, длина 76,2 см – 1 шт.;
- проводник, диаметр 0.035 дюйм, длина 260 см – 1 шт.;
- крепежный комплект: валик крепежный – 1 шт., петля крепежная – 2 шт., петля-удавка – 1 шт., ножницы – 1 шт., адаптер универсальный – 1 шт., адаптер болюсный – 1 шт., адаптер для кормления – 1 шт.; зажим – 1 шт.;
- лоток: скальпель – 1 шт., канюля с иглой – 1 шт.;
- тампоны марлевые – 5 шт.;
- простыня одноразовая – 1 шт.;
- петля-захват – 1 шт.

Производитель: Wilson-Cook Medical Inc., USA

Срок годности: \_\_\_\_\_ Партия: \_\_\_\_\_

Рег.уд.: 2016/5003




Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



Наборы для энтерального питания стерильные, с принадлежностями.

Варианты исполнения: Набор Percutaneous Endoscopic Gastrostomy Sets FLOW-20-PUSH-I-S:

трубка для кормления, диаметр 20 Fr, длина 76,2 см – 1 шт.;- проводник, диаметр 0.035 дюйм, длина 260 см – 1 шт.;  
крепежный комплект: валик крепежный – 1 шт., петля крепежная – 2 шт., петля-удавка – 1 шт., ножницы – 1 шт.,  
адаптер универсальный – 1 шт., адаптер болюсный – 1 шт., адаптер для кормления – 1 шт.; зажим – 1 шт.;  
доток: скальпель – 1 шт., канюля с иглой – 1 шт.;- тампоны марлевые – 5 шт.;- простыня одноразовая – 1 шт.;-  
петля-захват – 1 шт.

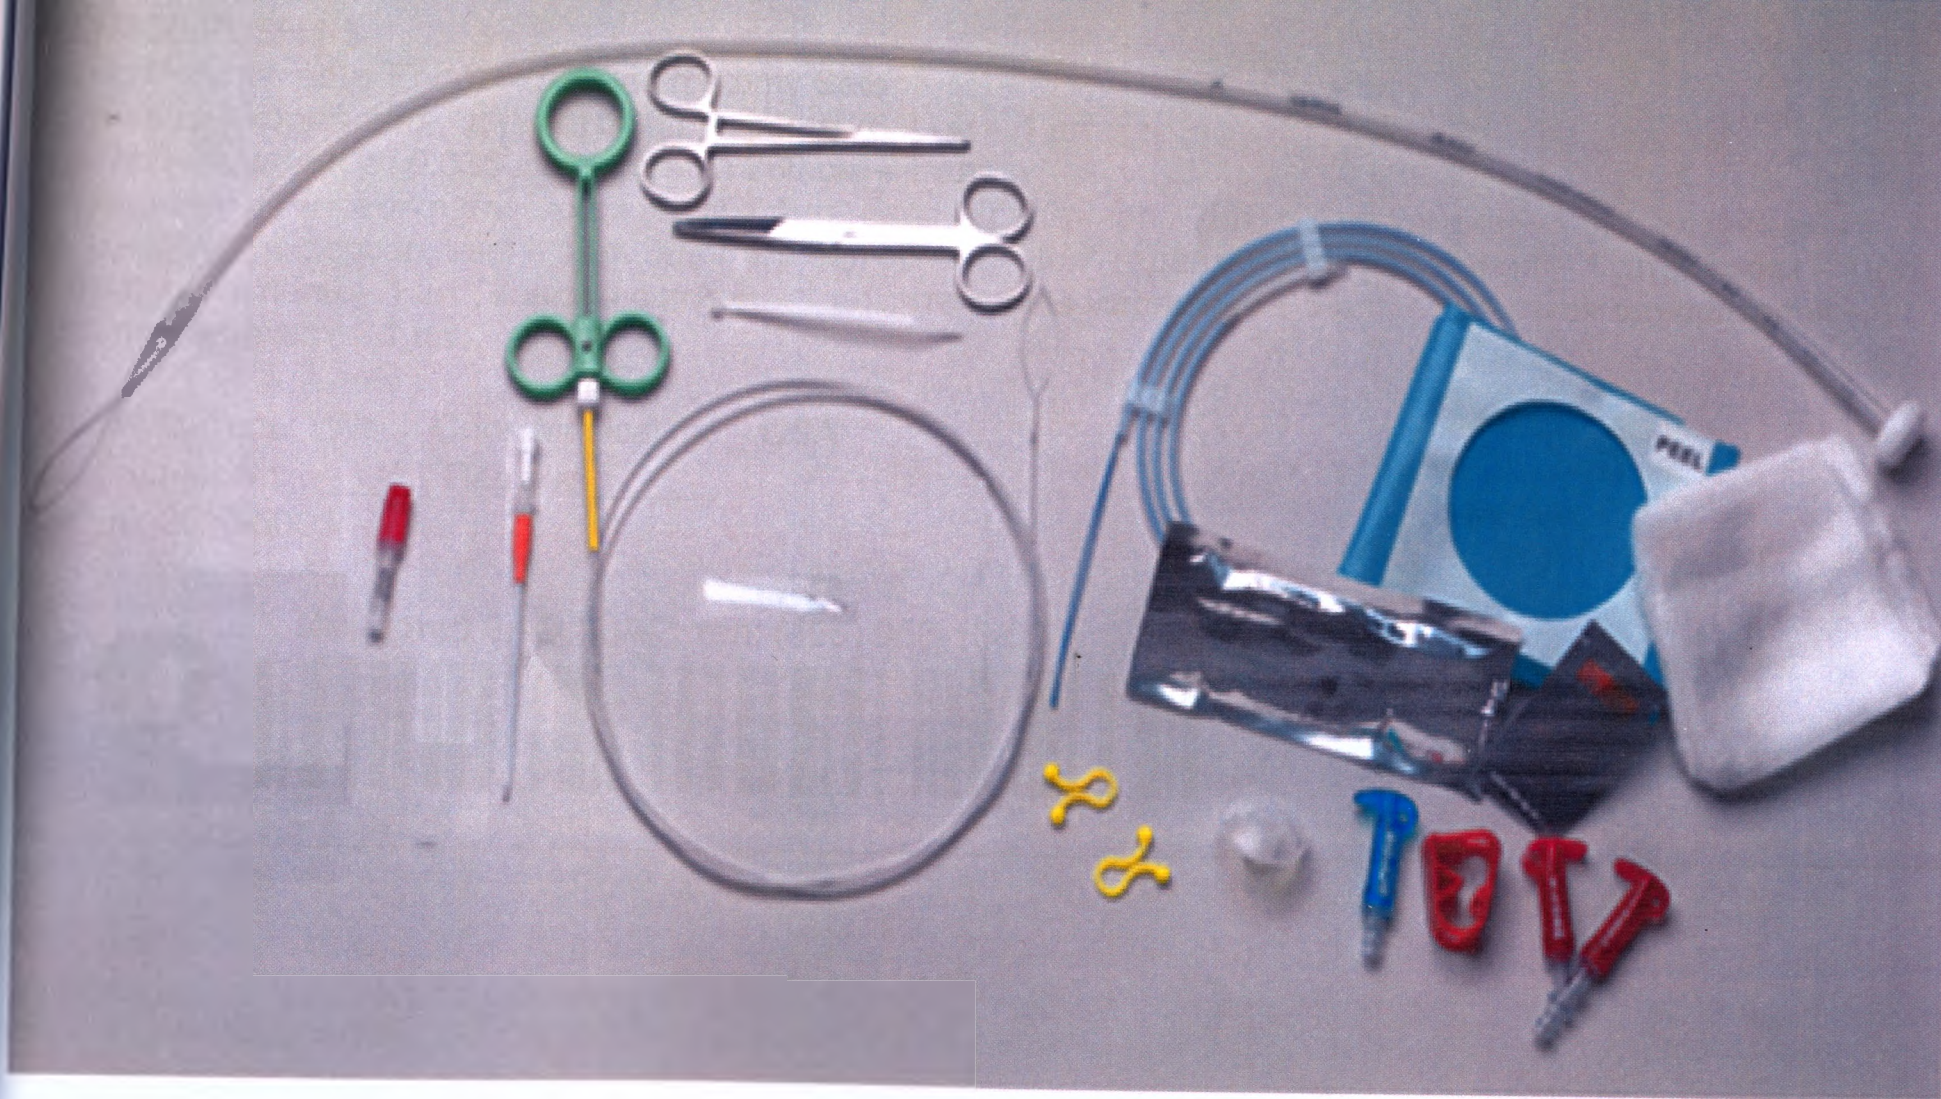

Макет маркировки:

FLOW-20-PUSH-I-S

Набор Percutaneous Endoscopic Gastrostomy Sets

- трубка для кормления, диаметр 20 Fr, длина 76,2 см – 1 шт.;
- проводник, диаметр 0.035 дюйм, длина 260 см – 1 шт.;
- крепежный комплект: валик крепежный – 1шт, петля крепежная – 2шт, петля-удавка – 1 шт., ножницы – 1 шт, адаптер универсальный – 1шт., адаптер болюсный – 1шт., адаптер для кормления – 1 шт.; зажим – 1шт;
- лоток: скальпель – 1 шт., канюля с иглой – 1 шт.; - тампоны марлевые – 5 шт.; - простыня одноразовая – 1 шт.; - петля-захват – 1 шт.

Производитель: Wilson-Cook Medical Inc., USA

Срок годности: \_\_\_\_\_ Партия: \_\_\_\_\_

Рег.уд.: 2016/5003



Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



Принадлежность к наборам Percutaneous Endoscopic Gastrostomy Sets PEG-24-PULL-I-S; PEG-24-PUSH-I-S; FLOW-20-PULL-I-S; FLOW-20-PUSH-I-S; Наборам Jejunal Feeding Set PEGJ-12-24-95-S; PEGJ-12-24-I-S; PEGJ-12-24-S; FLOWJ-9-20-S; FLOWJ-9-20-I-S.

Адаптер для питания универсальный Universal Feeding Adapter. Варианты исполнения: UFA-24-S



Макет маркировки:

UFA-24-S

Адаптер для питания универсальный Universal Feeding Adapter

Производитель: Wilson-Cook Medical Inc., USA

Срок годности: \_\_\_\_\_ Партия: \_\_\_\_\_

Рег.уд.: 2016/5003



Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



Принадлежность к наборам Percutaneous Endoscopic Gastrostomy Sets PEG-24-PULL-I-S; PEG-24-PUSH-I-S; FLOW-20-PULL-I-S; FLOW-20-PUSH-I-S; Наборам Jejunal Feeding Set PEGJ-12-24-95-S; PEGJ-12-24-I-S; PEGJ-12-24-S; FLOWJ-9-20-S; FLOWJ-9-20-I-S.



Макет маркировки:

UFA-20-S

Адаптер для питания универсальный Universal Feeding Adapter

Производитель: Wilson-Cook Medical Inc., USA

Срок годности: \_\_\_\_\_ Партия: \_\_\_\_\_

Рег.уд.: 2016/5003



Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



Принадлежность к наборам Percutaneous Endoscopic Gastrostomy Sets PEG-24-PULL-I-S;PEG-24-PUSH-I-S; FLOW-20-PULL-I-S; FLOW-20-PUSH-I-S; Наборам Jejunal Feeding Set PEGJ-12-24-95-S;PEGJ-12-24-I-S; PEGJ-12-24-S; FLOWJ-9-20-S; FLOWJ-9-20-I-S.

Адаптер для питания болюсный Bolus Feeding Adapter  
Варианты исполнения: BFA-20-S



Макет маркировки:

---

BFA-20-S

Адаптер для питания болюсный Bolus Feeding Adapter

Производитель: Wilson-Cook Medical Inc., USA

Срок годности: \_\_\_\_\_ Партия: \_\_\_\_\_

Рег.уд.: 2016/5003



Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



Прошнуровано, пронумеровано и  
скреплено печатью 24 листов  
Генеральный директор

С.Н.Курин

