


Набор контрольных плазм для внутрилабораторного контроля качества методов оценки гемостаза
(КОНТРОЛЬНАЯ ПЛАЗМА ДДС)

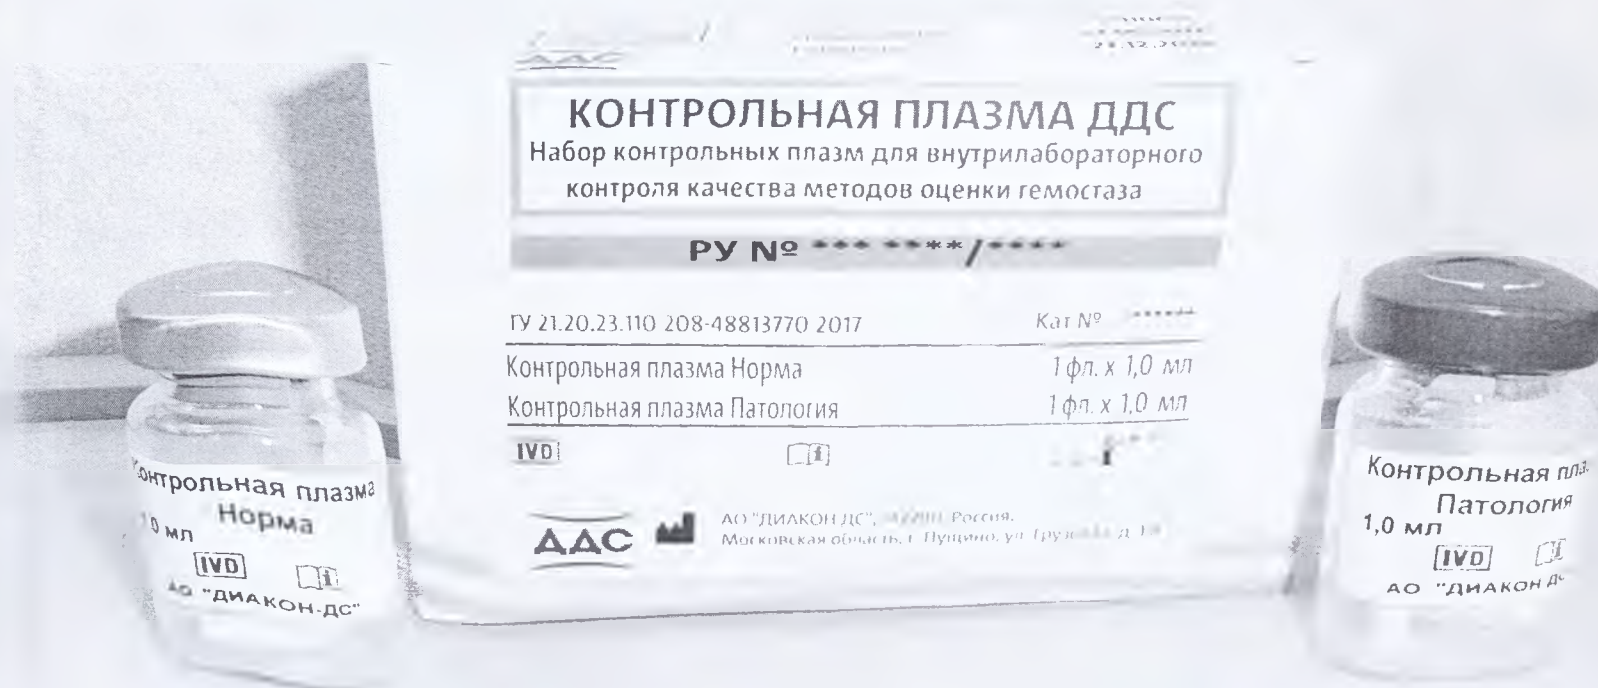

Серия
142290
Годен до
27.06.2018
27.12.2018

КОНТРОЛЬНАЯ ПЛАЗМА ДДС
Набор контрольных плазм для внутрилабораторного
контроля качества методов оценки гемостаза


РУ № * ***/******

ТУ 21.20.23.110 208-48813770-2017 Кат № *****

Контрольная плазма Норма	1 фл. х 1,0 мл
Контрольная плазма Патология	1 фл. х 1,0 мл

IVD  

ДДС  АО "ДИЛКОН ДС", 142290, Россия,
Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1А

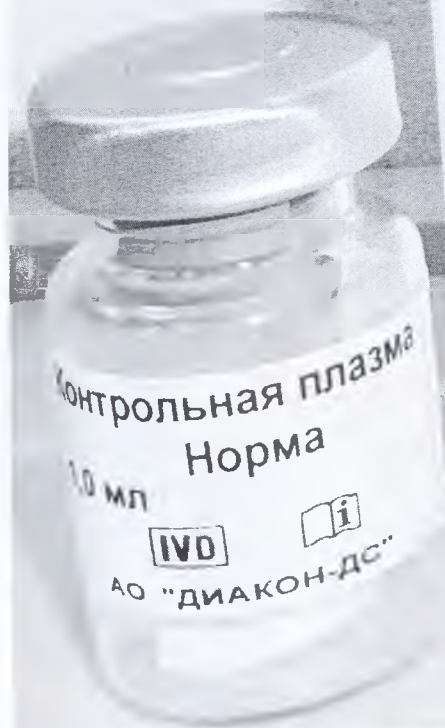



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 2 листа
Генеральный директор
АО «ДИАКОН-ДС»

А.В. Смирнов

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО "ДИАКОН-ДС"
А.В. Смирнов

« 26 » 01 2018 г.

Образец маркировки МИ:
Набор контрольных плазм для внутрилабораторного контроля качества методов оценки гемостаза
(КОНТРОЛЬНАЯ ПЛАЗМА ДДС)

КОНТРОЛЬНАЯ ПЛАЗМА ДДС

Антитела к ВИЧ 1, 2
и вирусу гепатита С
и HBsAg отсутствуют

Серия: 0020617
Изготовлено: 29.06.2017
Годен до: 29.12.2018



КОНТРОЛЬНАЯ ПЛАЗМА ДДС
Набор контрольных плазм для внутрилабораторного
контроля качества методов оценки гемостаза

ПУ № *** ***/****

ТУ 21.20.23.110-208-48813770 2017 Кат № *****

Контрольная плазма Норма 1 фл. х 1,0 мл

Контрольная плазма Патология 1 фл. х 1,0 мл

IVD 2 °C 8 °C

АО "ДИАКОН ДС", 142290, Россия,
Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1А

Контрольная плазма
Норма
1,0 мл
IVD
АО "ДИАКОН-ДС"

Контрольная плазма
Патология
1,0 мл
IVD
АО "ДИАКОН-ДС"

Начальник отдела новых проектов

А.А. Тимченко

А.А. Тимченко

Начальник отдела регистрации и сертификации

Н.С. Ржевская

Н.С. Ржевская