

## Фотографические изображения медицинских изделий

### Аппараты физиотерапевтические электроимпульсные «ЭСМА-12» в вариантах исполнения с принадлежностями по ТУ 26.60.13-011-52120251-2017

Генеральный директор  
ООО «ЭСМА»  
Карев А.Г.



"22" июня 20 18 г.

Рис. 1 Аппарат «ЭСМА 12.02»:

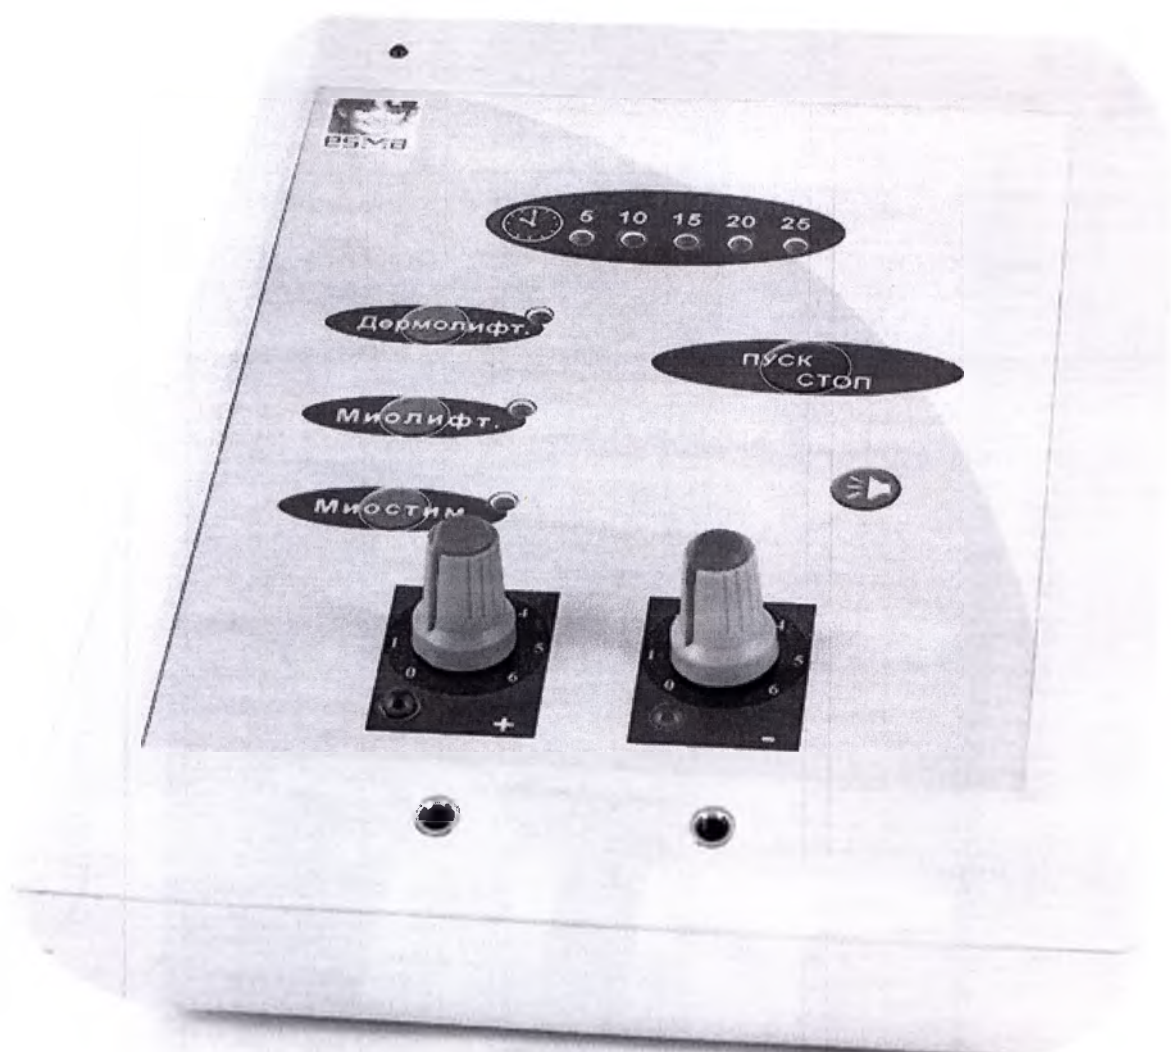


Рис.2 Аппарат «ЭСМА 12.08»:

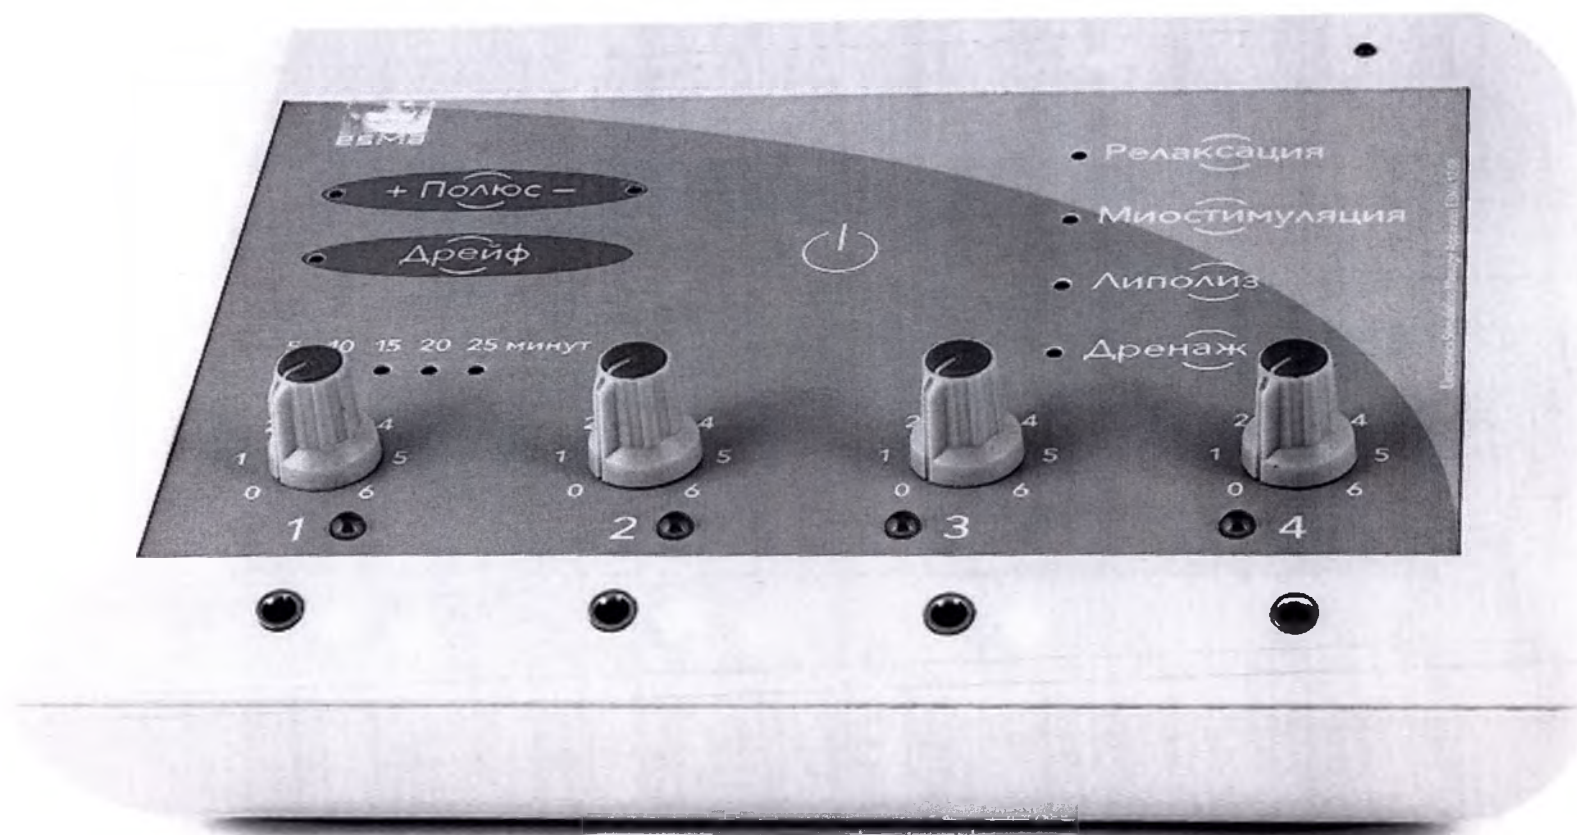


Рис.3 Аппарат «ЭСМА 12.16»:


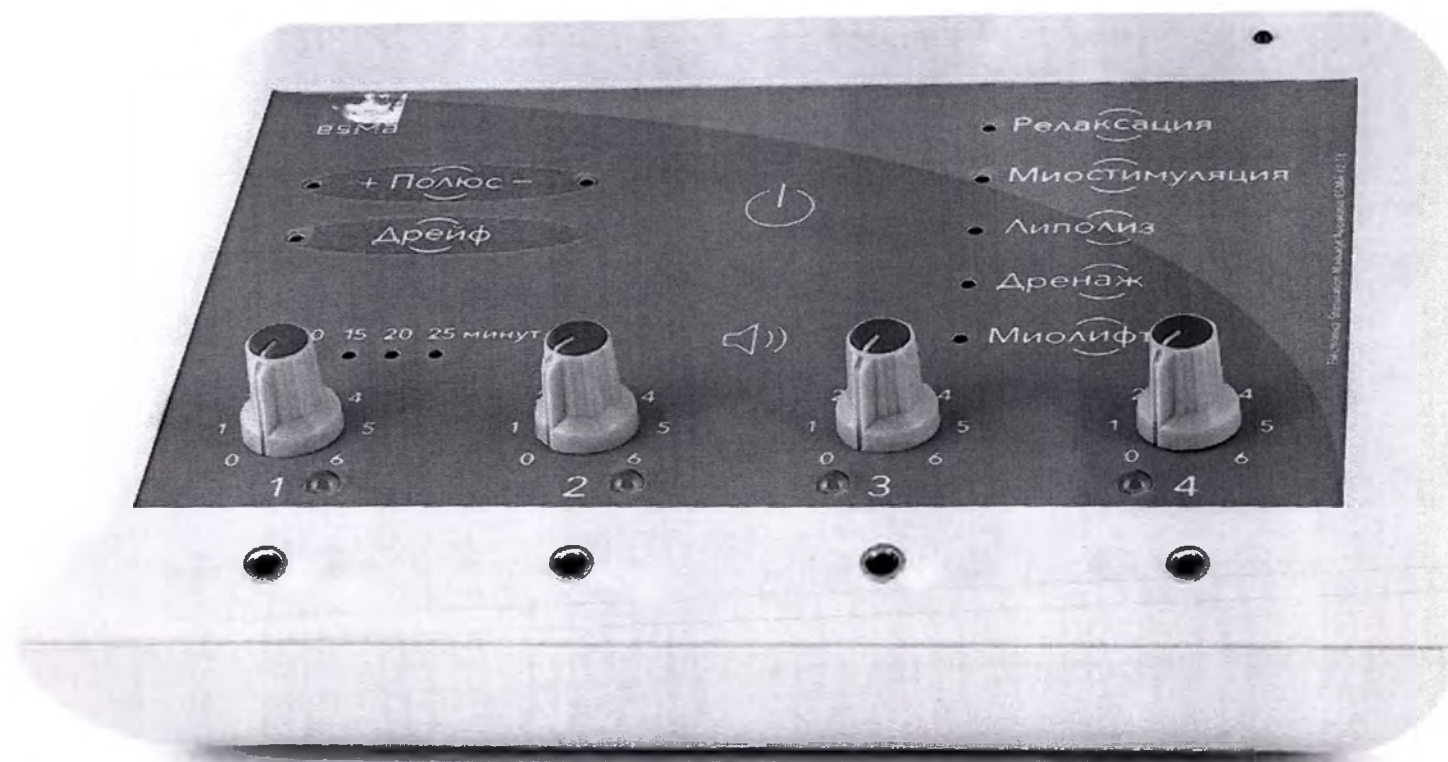


Рис.4 Аппарат «ЭСМА 12.20»:

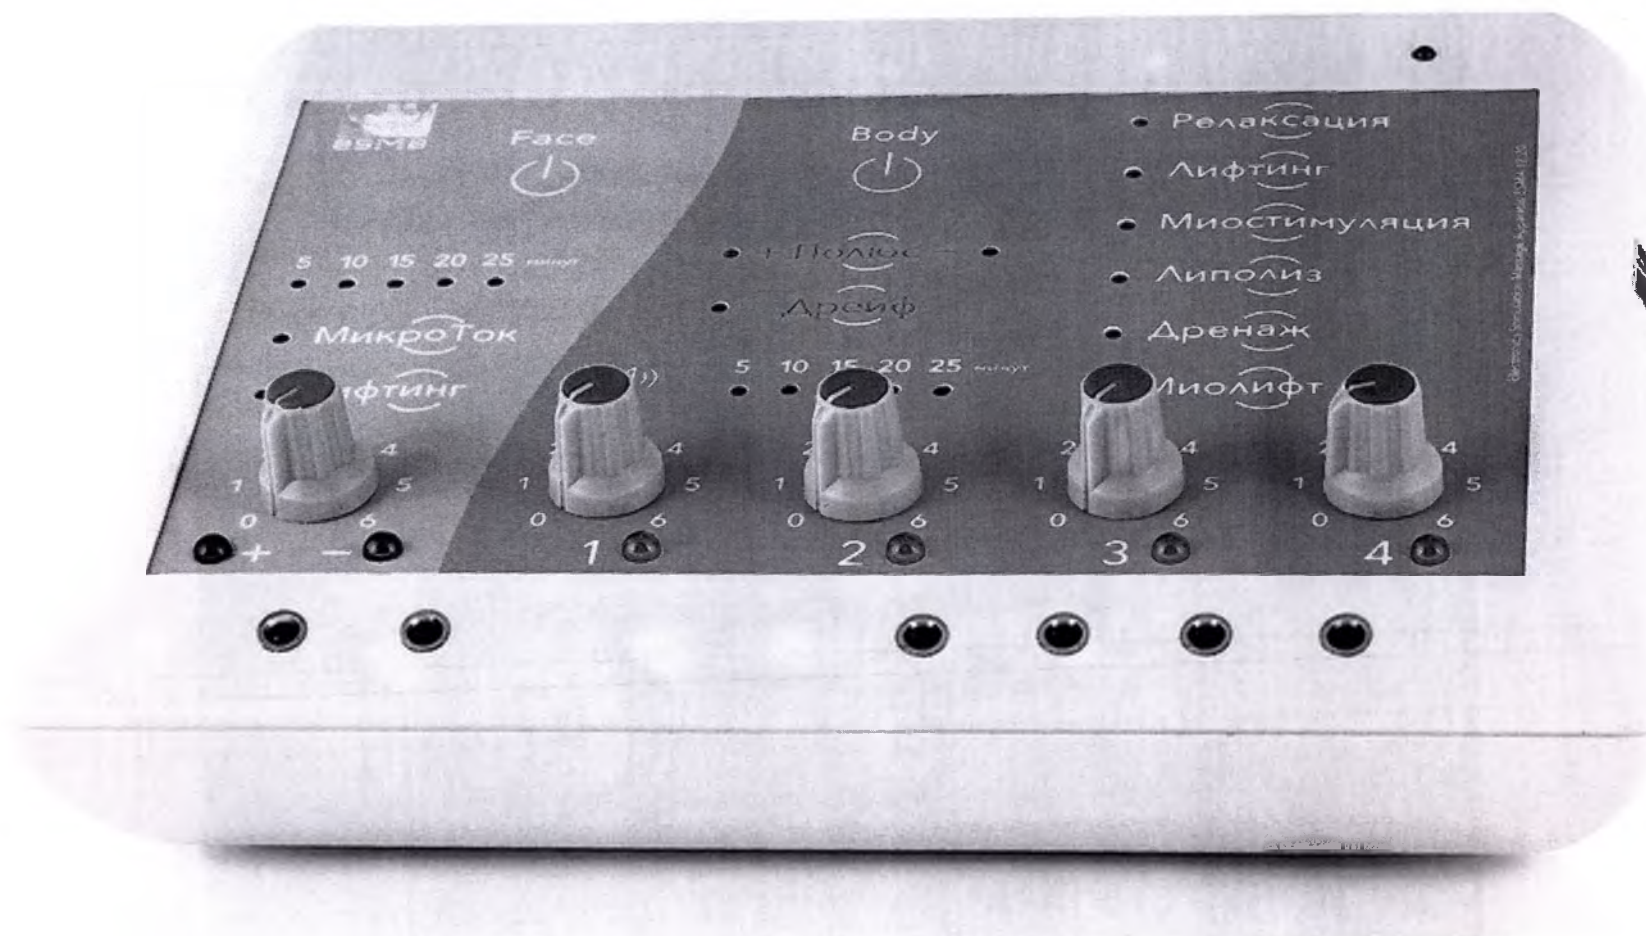

Принадлежности к аппаратам «ЭСМА»:

Рис.5 Адаптер питания от сети

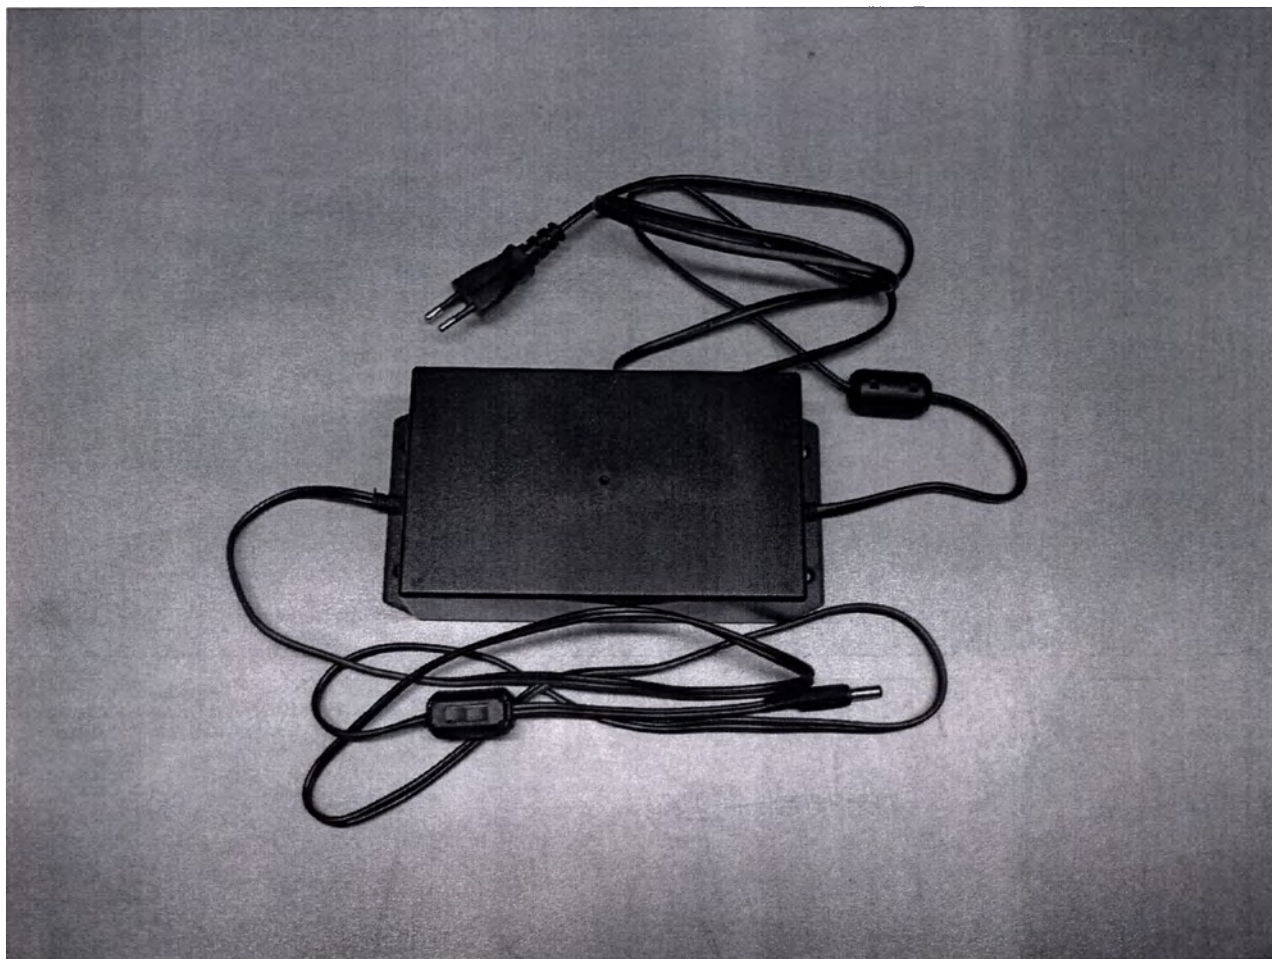


Рис. 6 Контактный провод ×2 и Контактный провод ×4



Рис..7 Комплект липких электродов для лица и Контактный провод ×2



Рис.8 Комплект электродов для тела

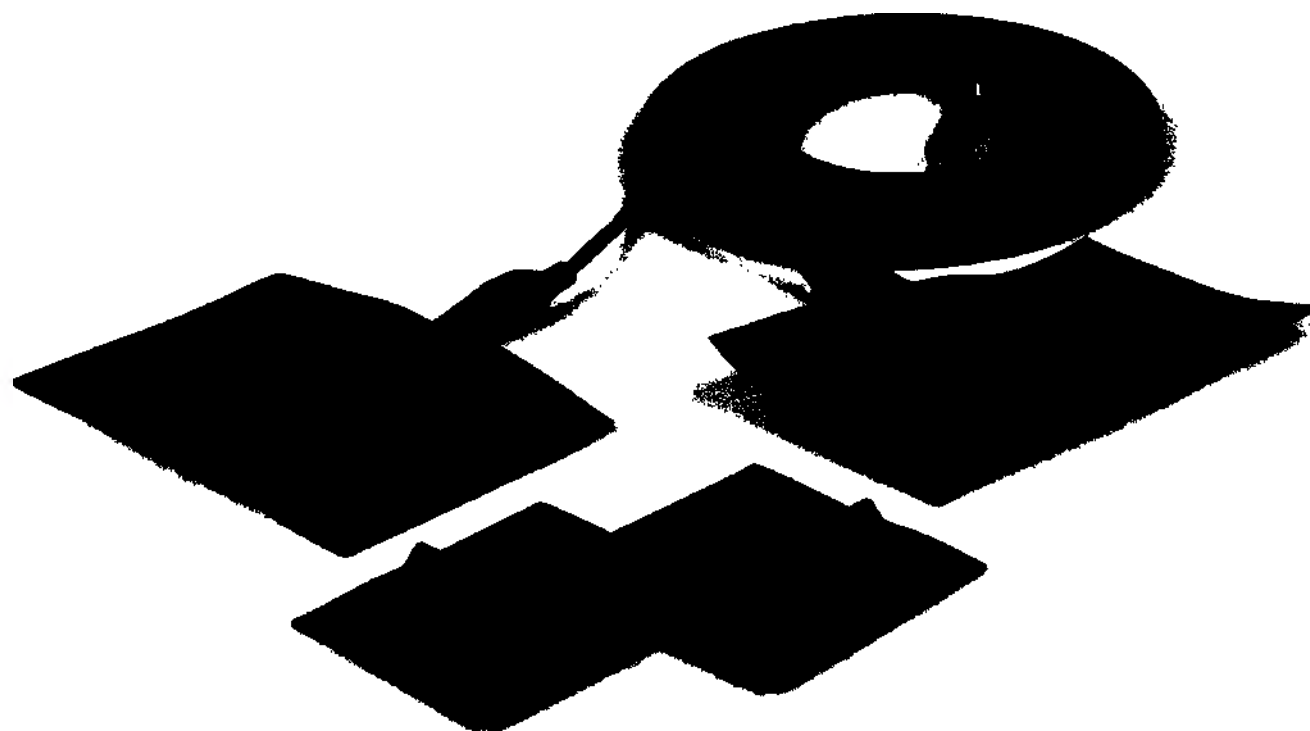


Рис.9 Пара электродов-проб П4 МИКРОТОК

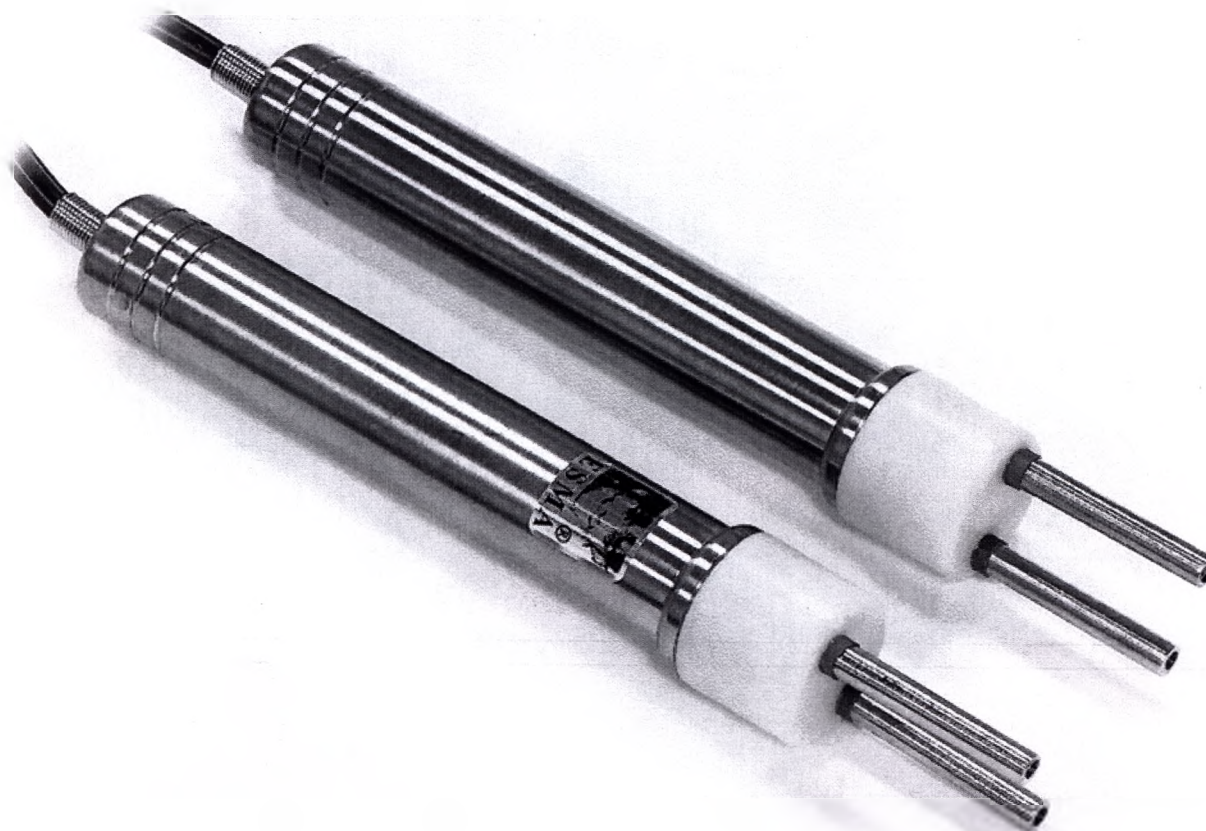


Рис.10 Эластичные крепления



Рис. 11 Фотографическое изображение маркировки (этикетки) аппарата «ЭСМА 12.20»


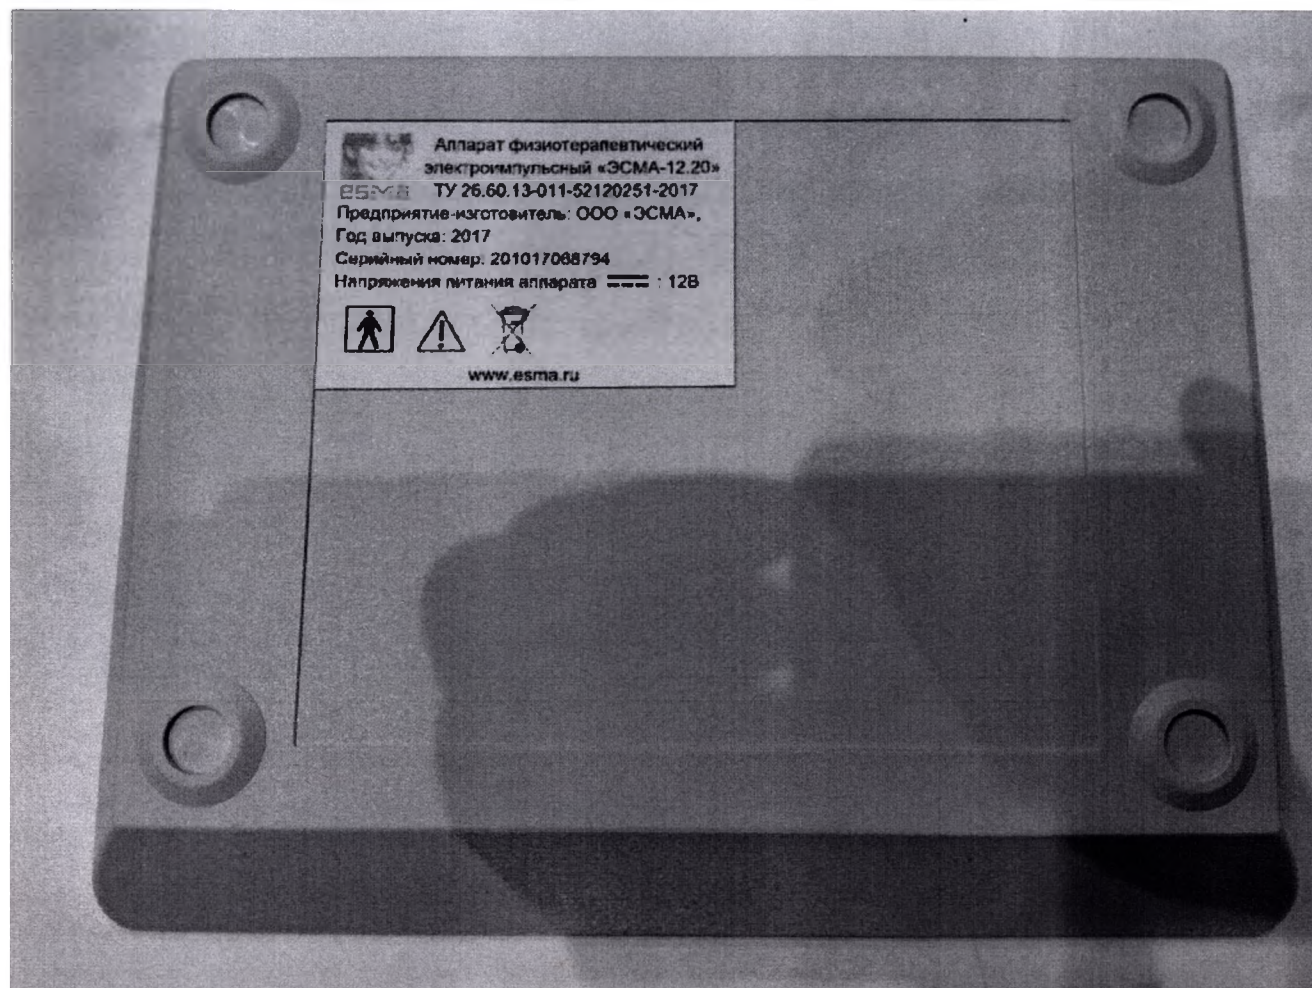


Рис. 12 Фотографическое изображение маркировки (этикетки) адаптера питания аппаратов «ЭСМА»:



Генеральный директор ООО «ЭСМА»

А.Г. Карев

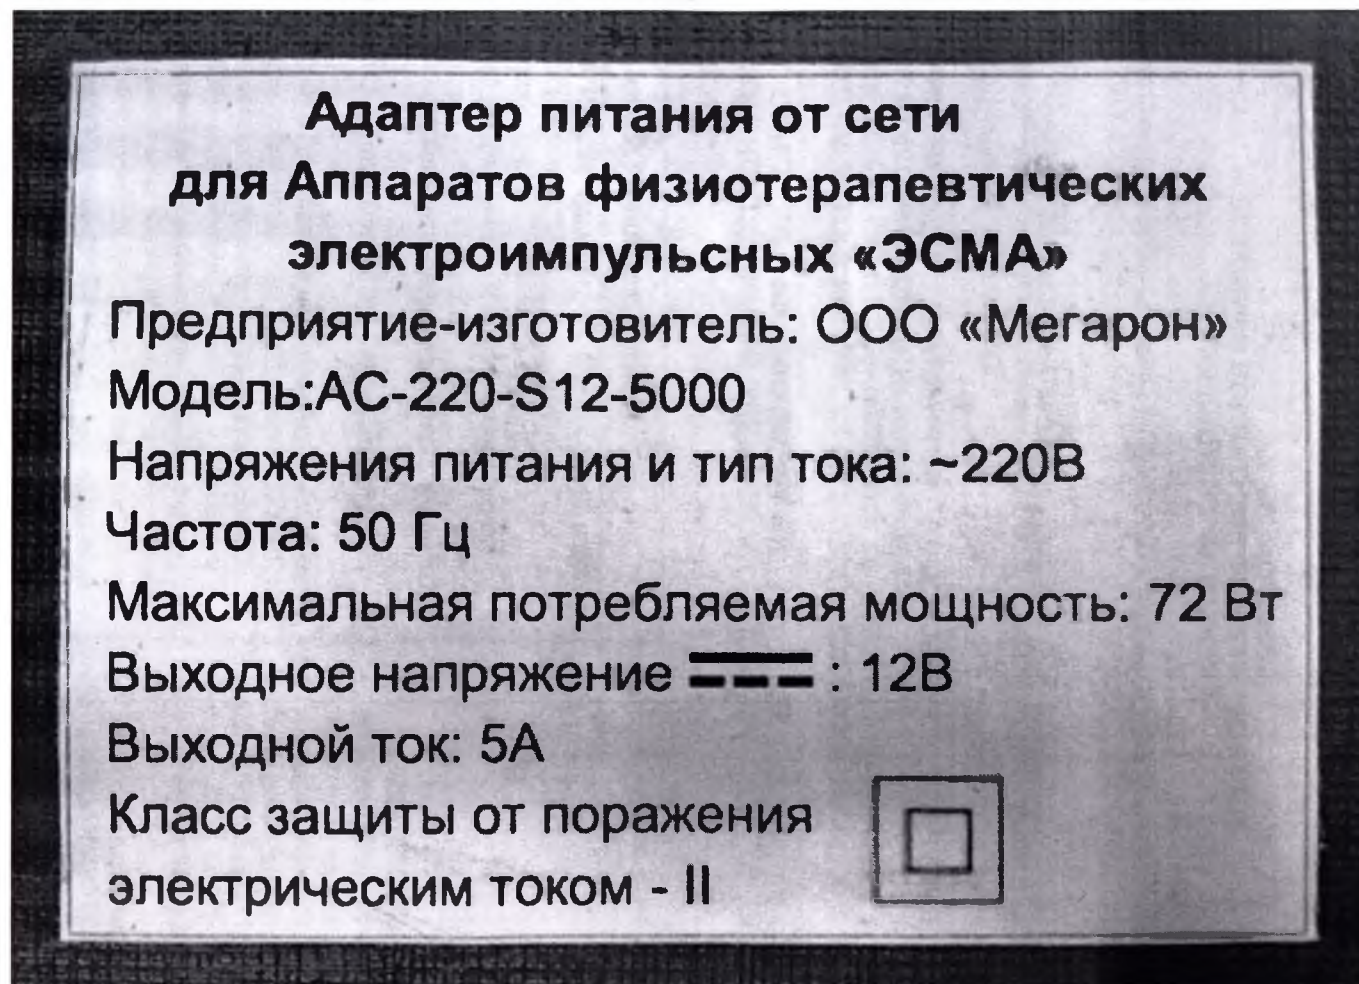