

Фотографические изображения медицинских изделий

Аппараты физиотерапевтические электроимпульсные «ЭСМА-12» в вариантах исполнения с принадлежностями по ТУ 26.60.13-012-52120251-2017

Генеральный директор
ООО «ЭСМА»
Карев А.Г.



"10" марта 2017 г.

Рис.1 Аппарат «ЭСМА 12.19»

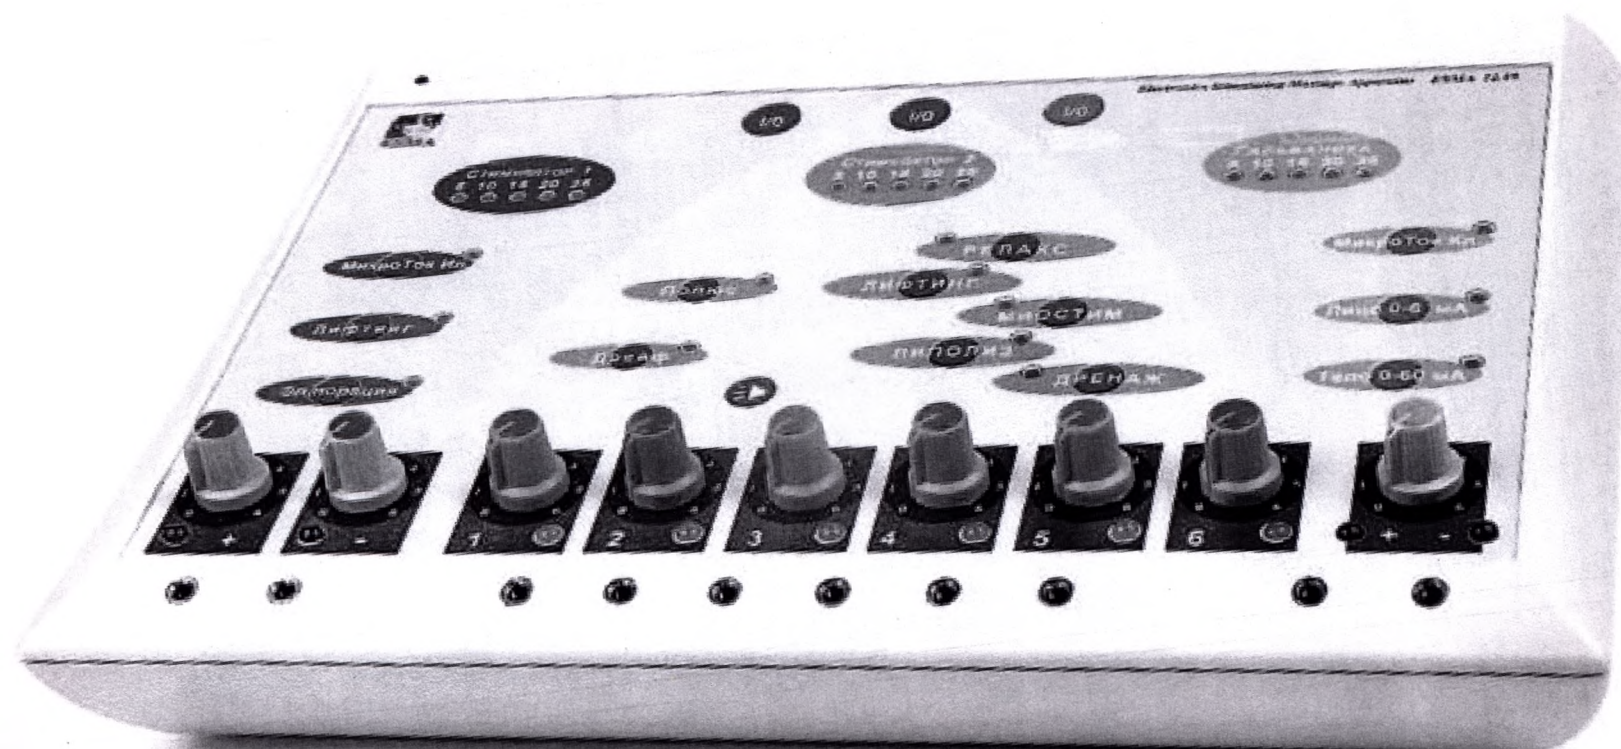


Рис.2 Аппарат «ЭСМА 12.21», «ЭСМА 12.21У»

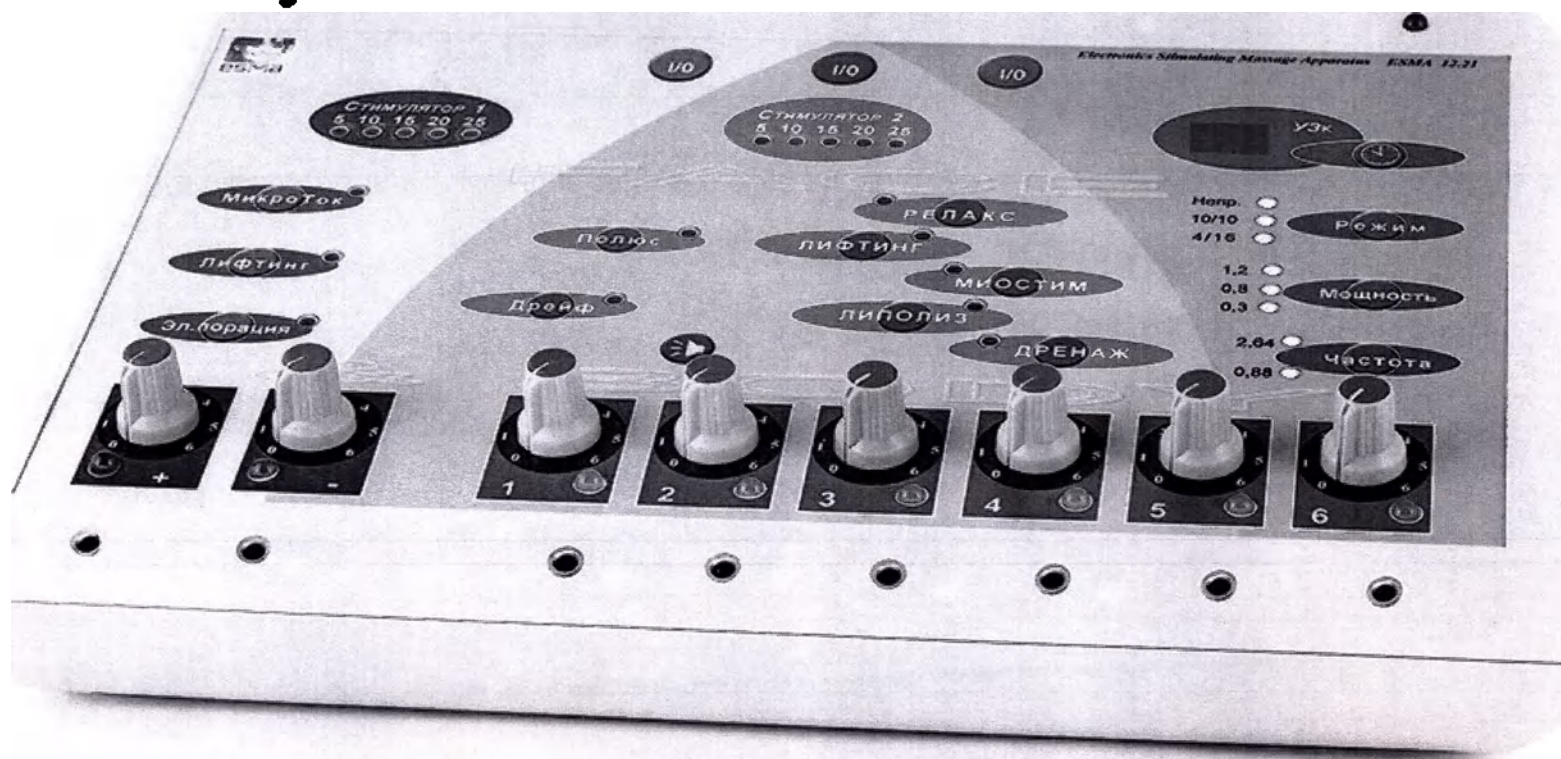


Рис.3 Аппарат «ЭСМА 12.25»


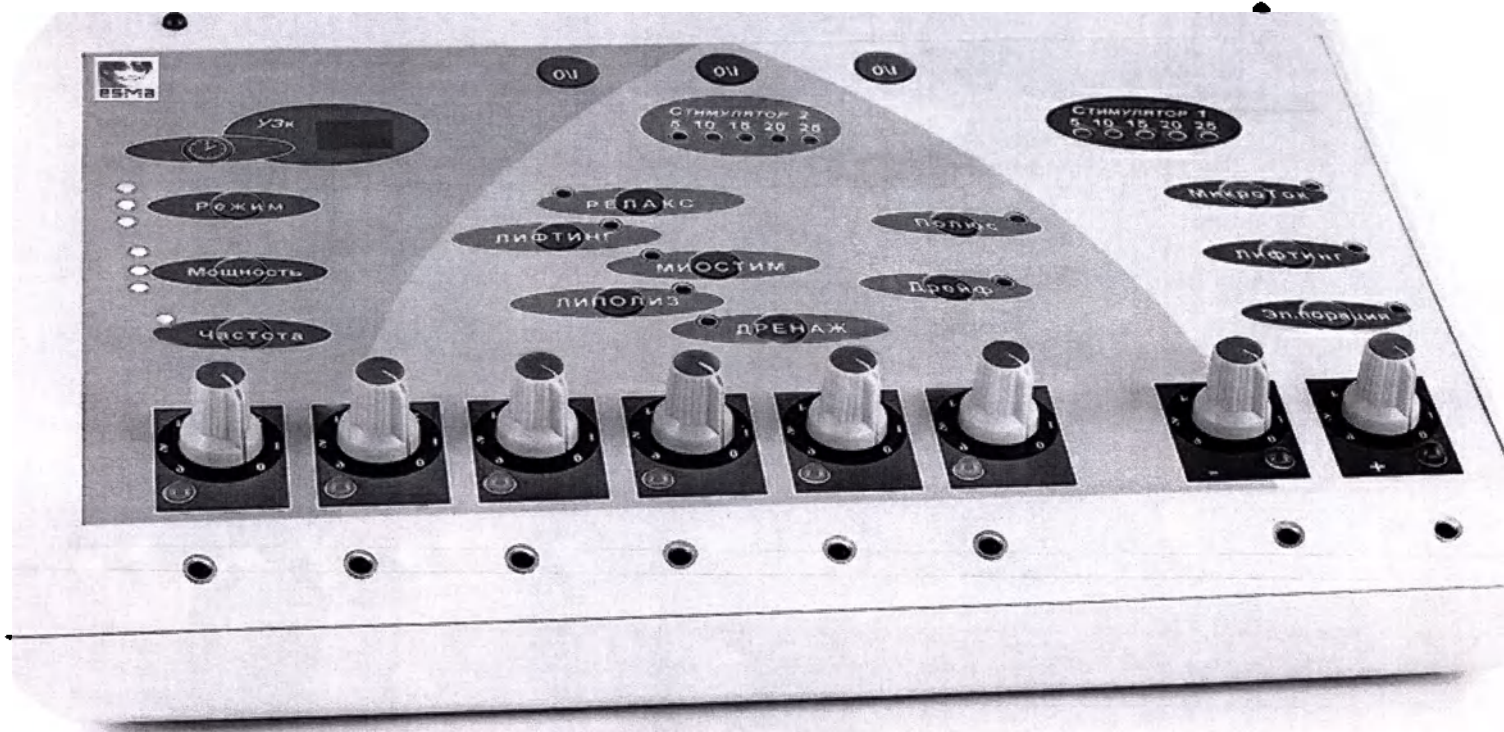


Рис.4 Аппарат «ЭСМА 12.05»

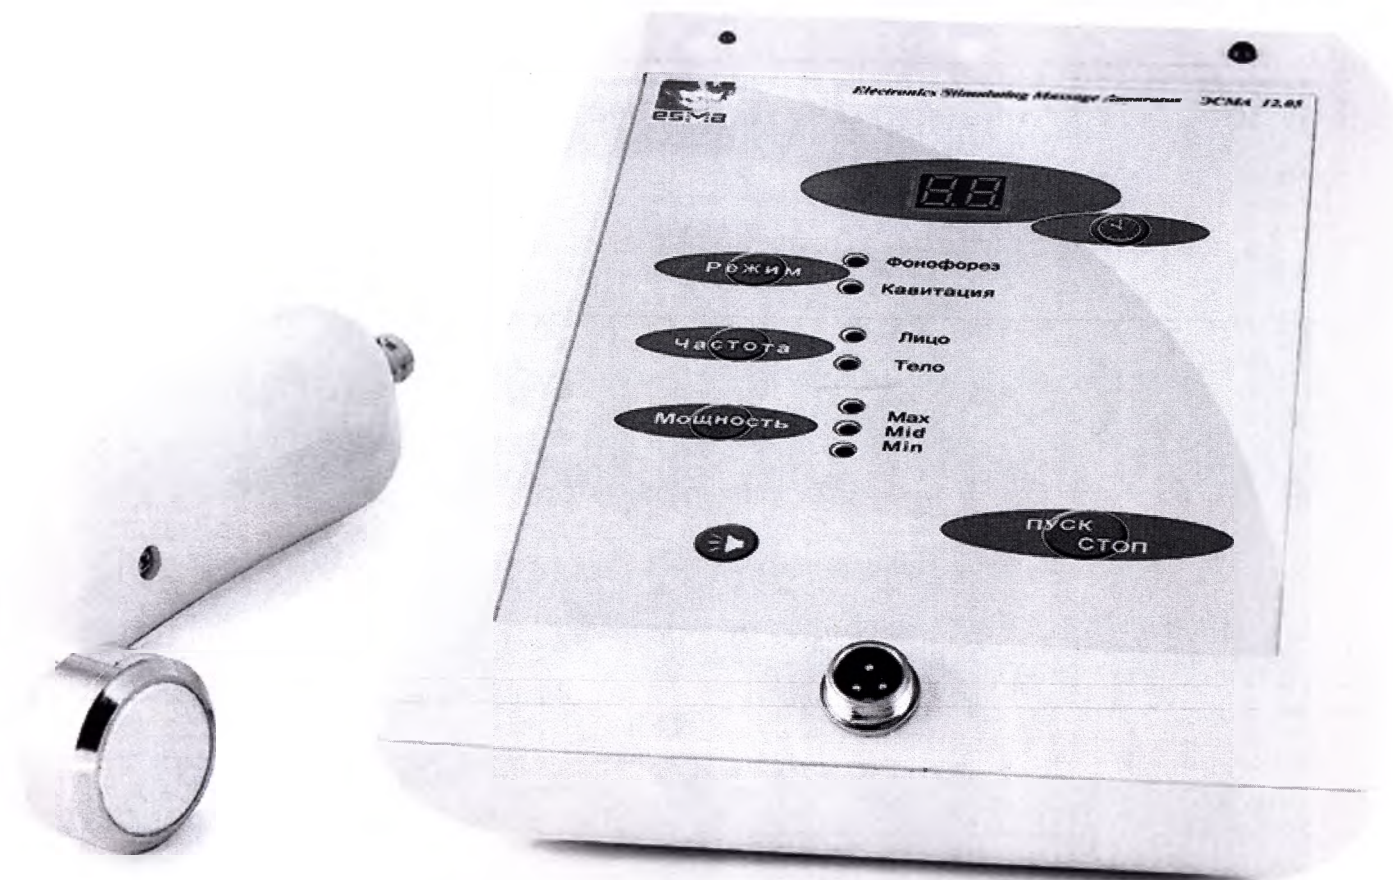

Принадлежности к аппаратам «ЭСМА»:

Рис.5 Адаптер питания от сети

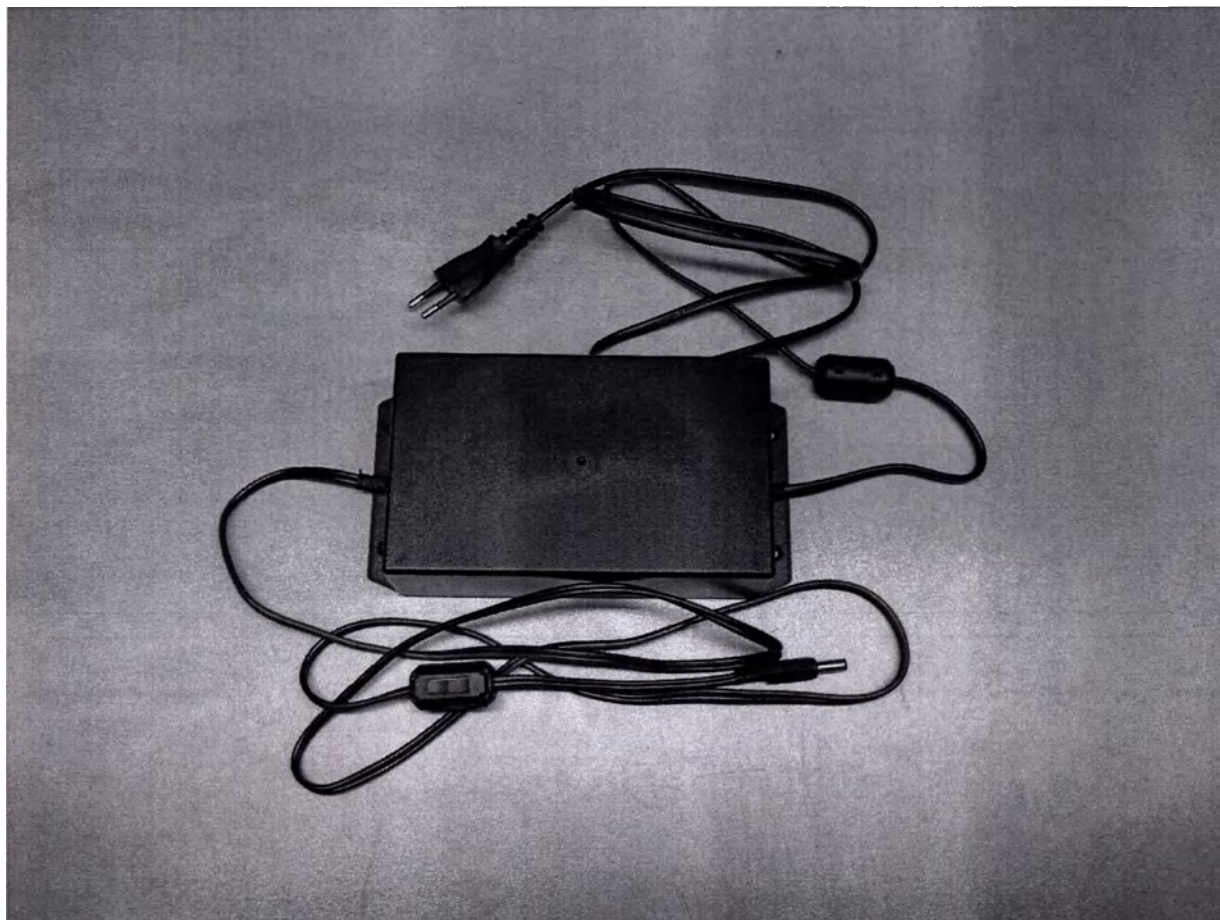


Рис.6 Контактный провод $\times 2$ и Контактный провод $\times 4$

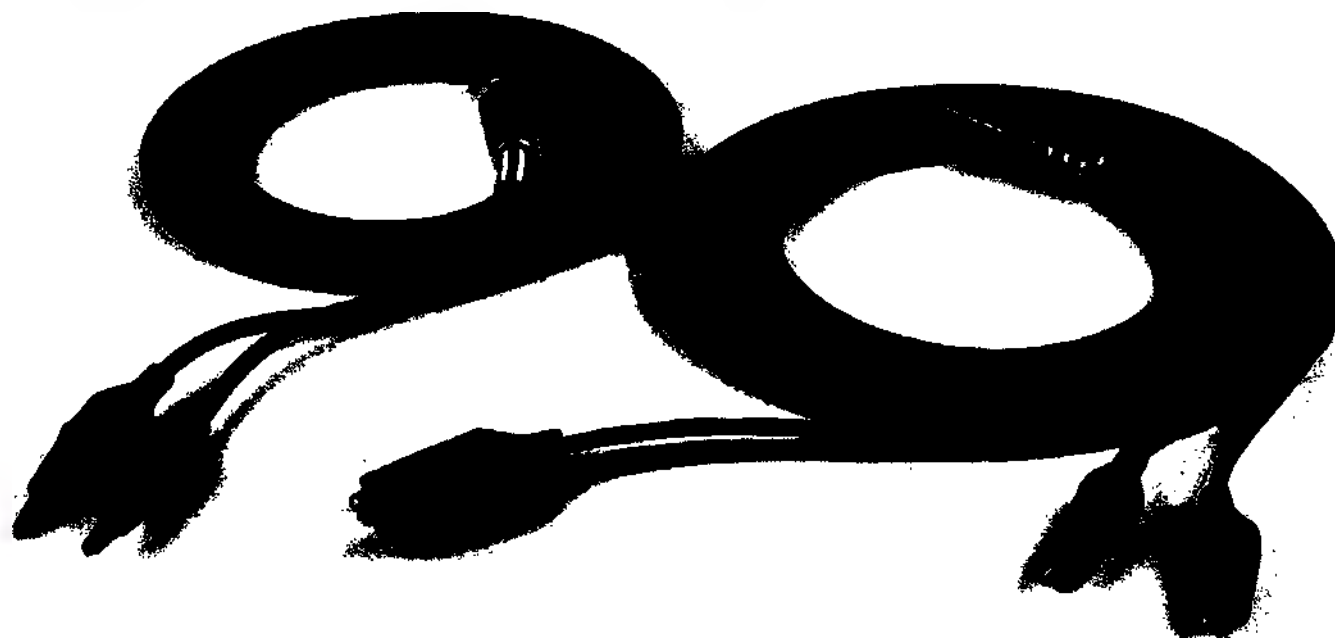


Рис. 7 Комплект электродов для тела

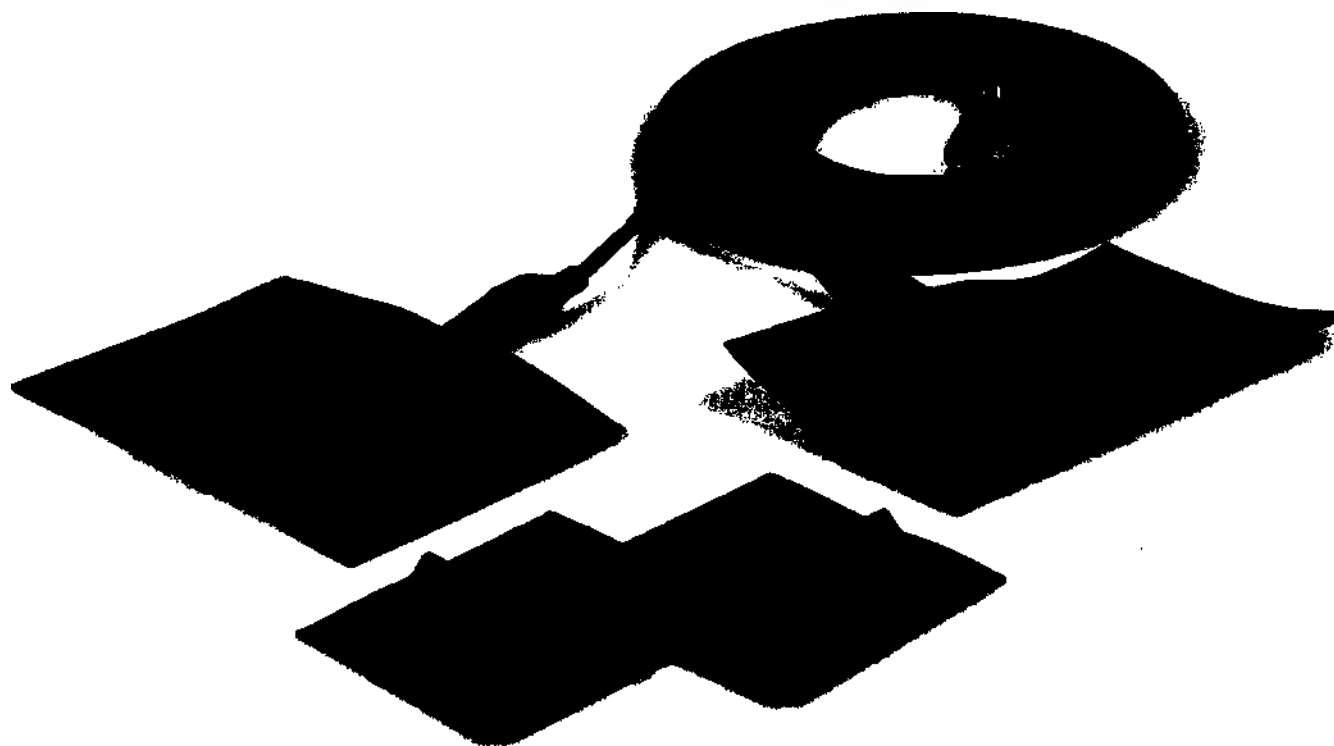


Рис.8 Комплект электродов для лица и Контактный провод ×2



Рис.9 Эластичные крепления

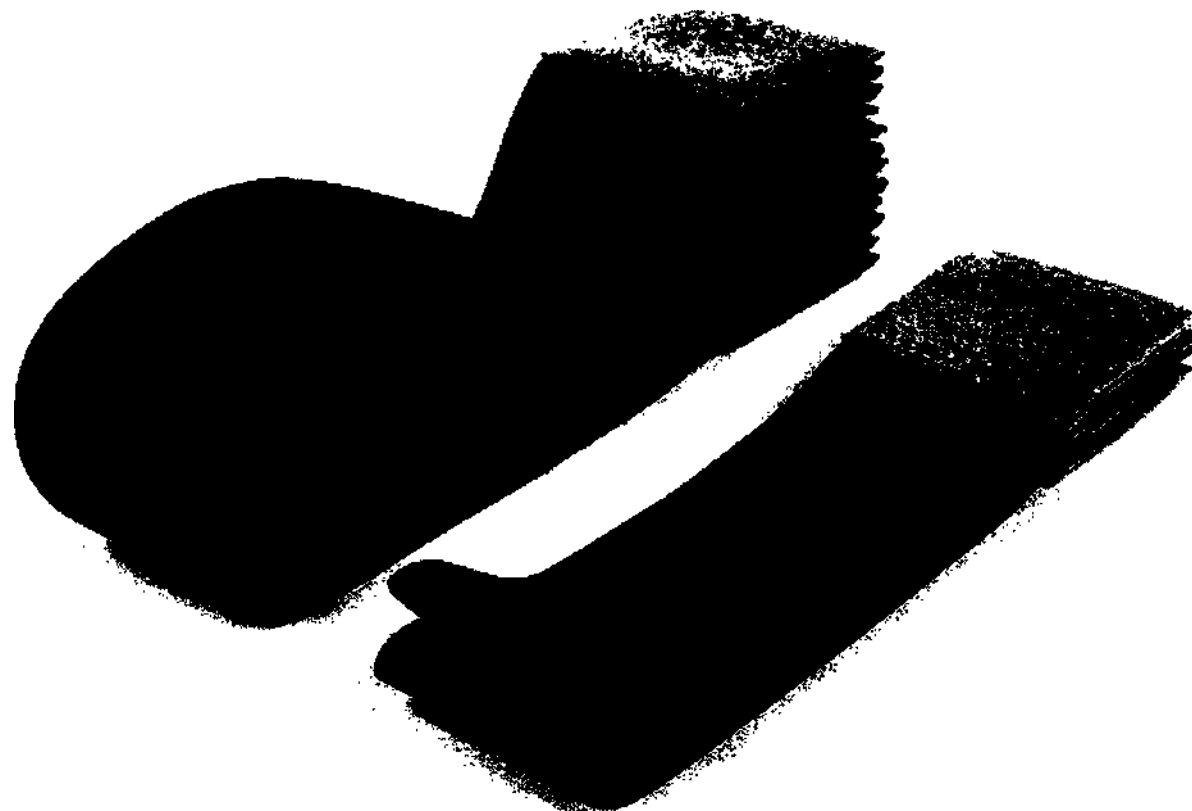


Рис. 10 Излучатель УЗк 2-х частотный (0.88, 2.64)

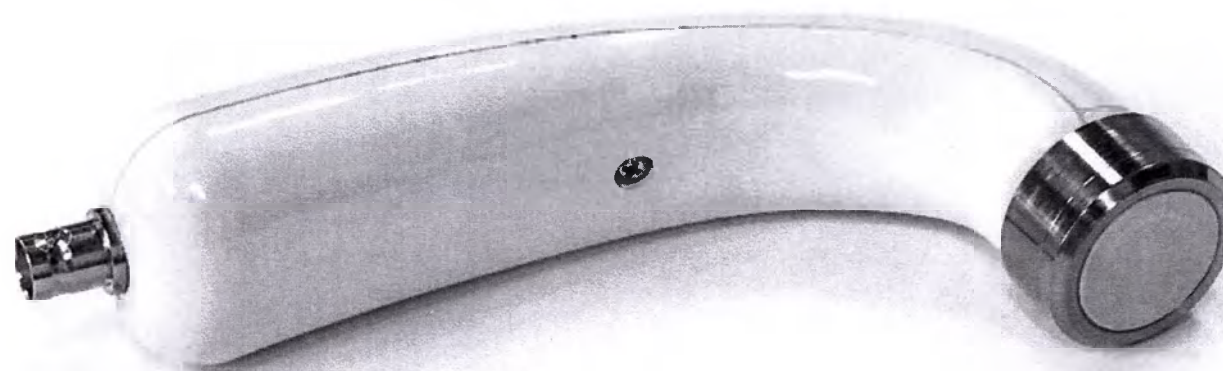


Рис. 11 Фотографическое изображение маркировки (этикетки) аппарата «ЭСМА 12.25»


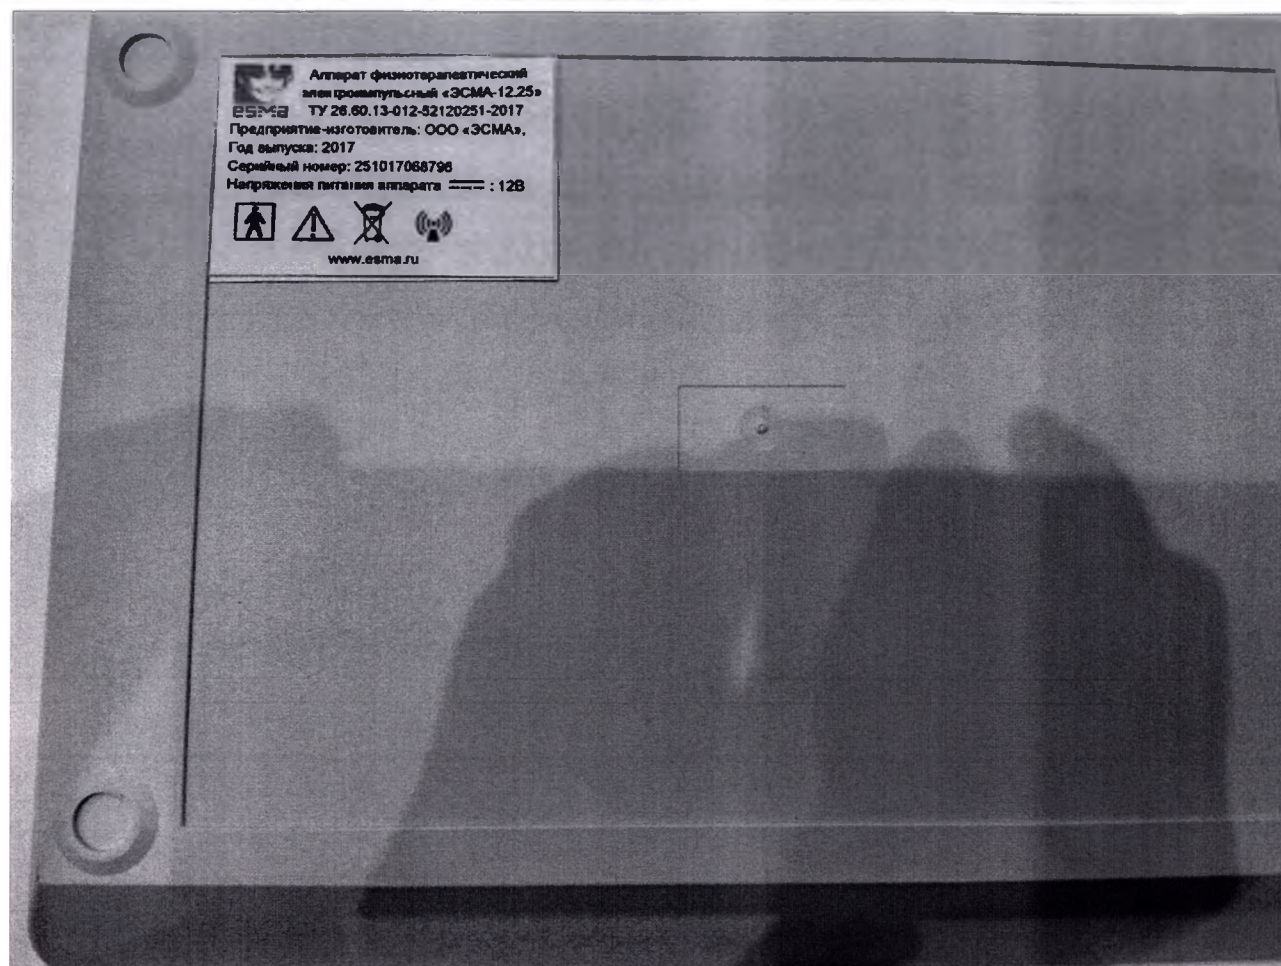


Рис. 12 Фотографическое изображение маркировки (этикетки) адаптера питания аппаратов «ЭСМА»



Генеральный директор ООО «ЭСМА»

А.Г. Карев

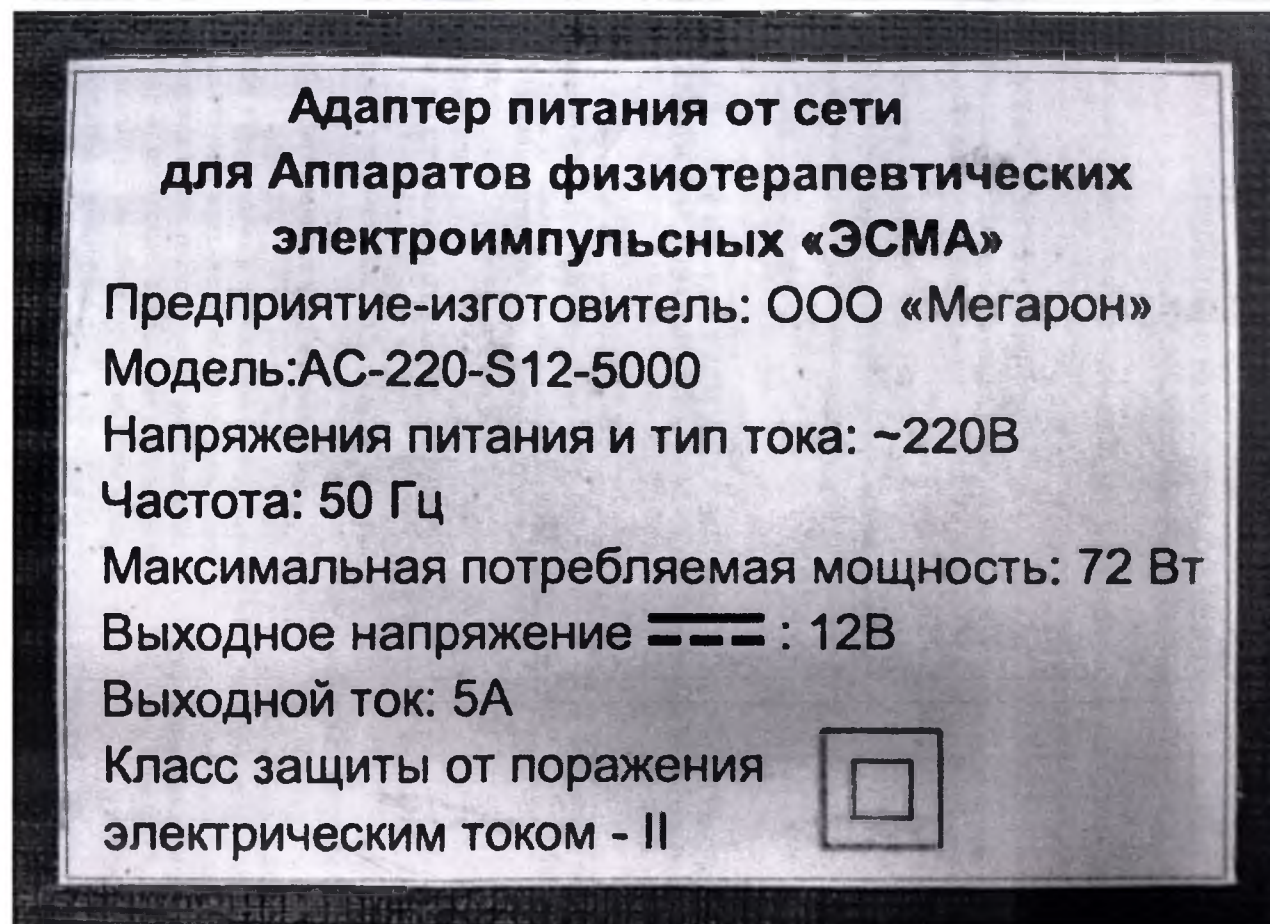