

Фотографические изображения медицинских изделий

Аппараты физиотерапевтические электроимпульсные «ЭСМА-12» в вариантах исполнения с принадлежностями по ТУ 26.60.13-013-52120251-2017

Генеральный директор
ООО «ЭСМА»
Карев А.Г.



"24" ноября 2017 г.

Рис.1 Аппарат «ЭСМА 12.18»



Рис.2 Аппарат «ЭСМА 12.52»

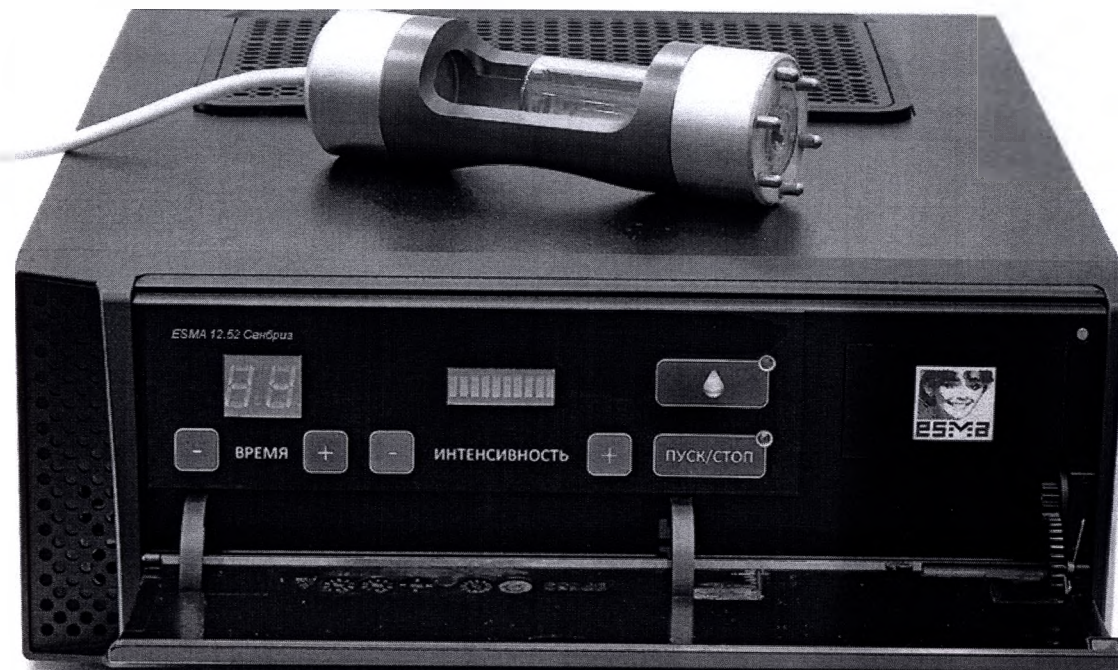


Рис.3 Аппарат «ЭСМА 12.50»

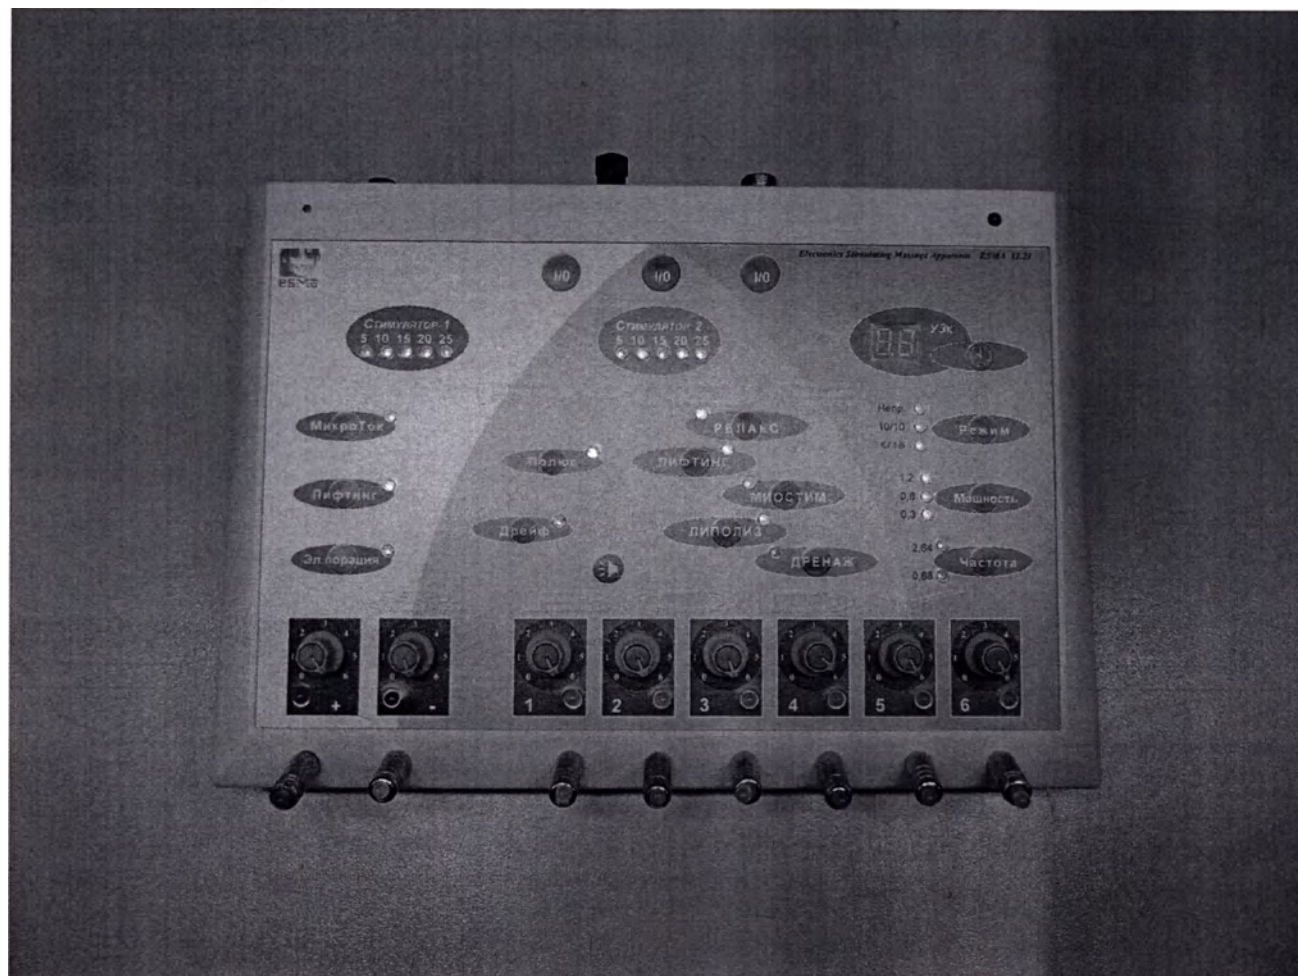


Рис.4 Адаптер питания от сети

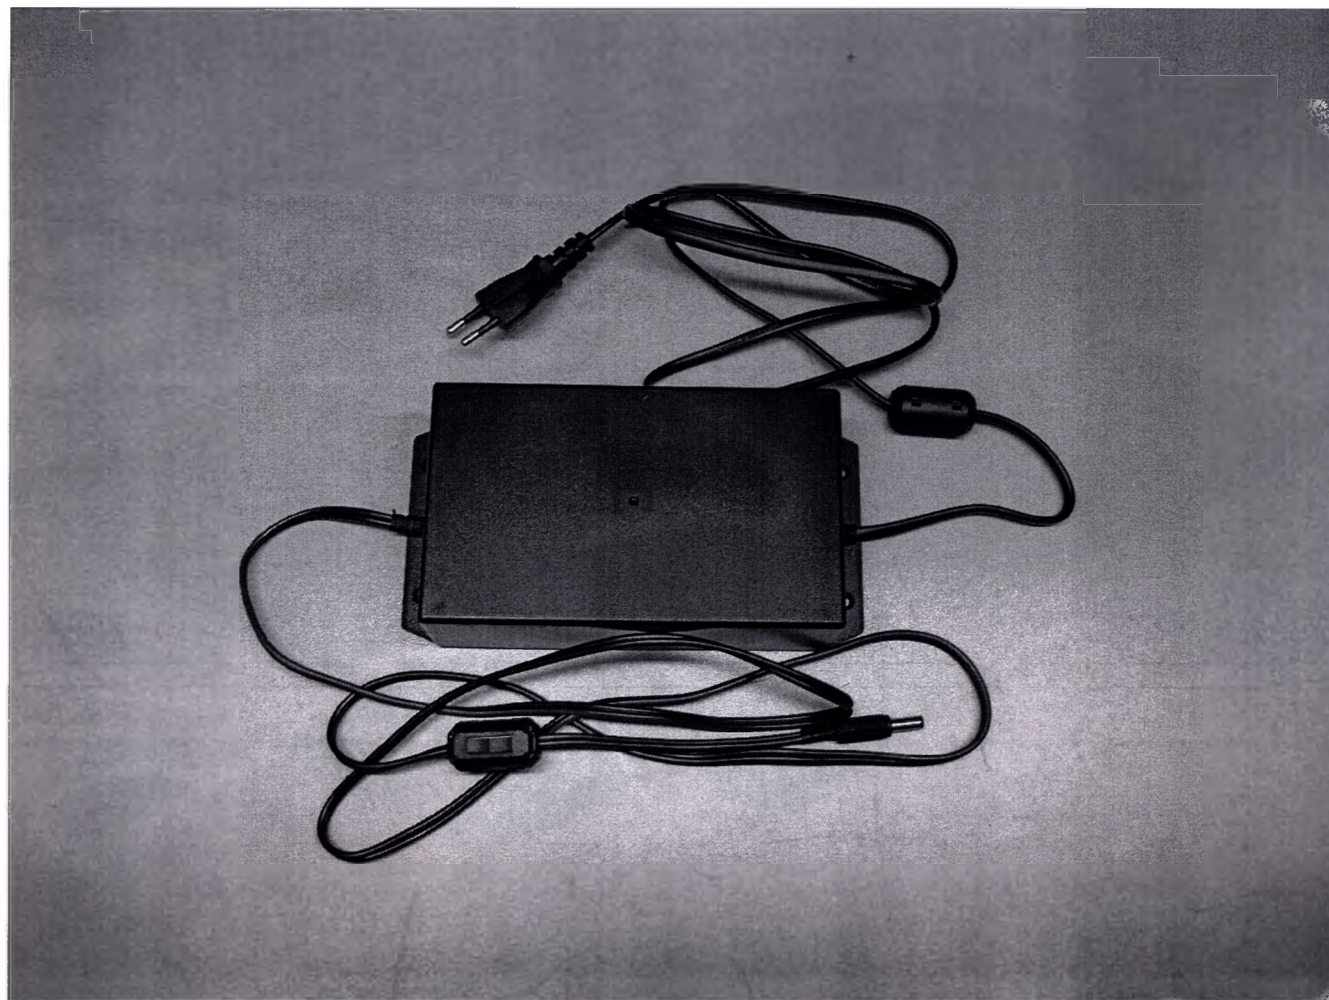


Рис.5 Комплект электродов для тела

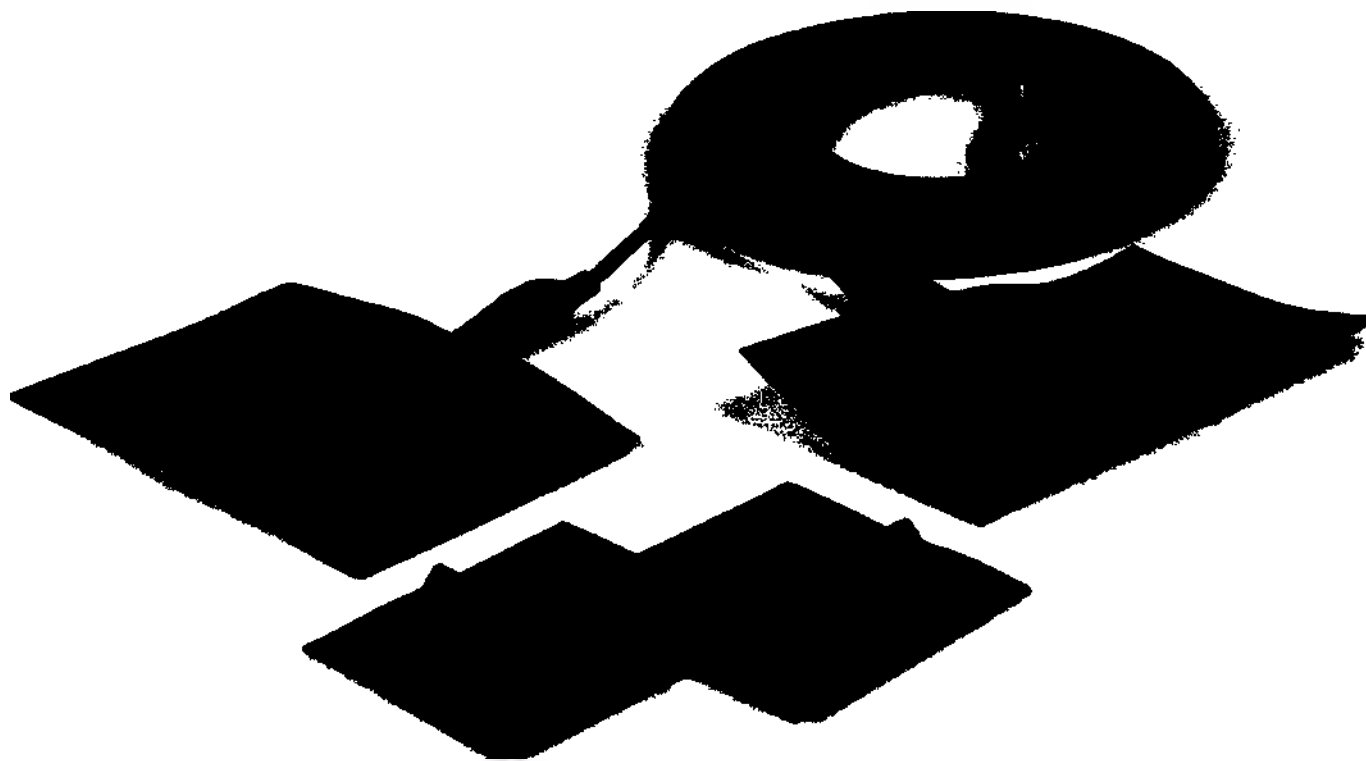


Рис.6 Комплект электродов для лица и Контактный провод ×4



Рис.7 Эластичные крепления

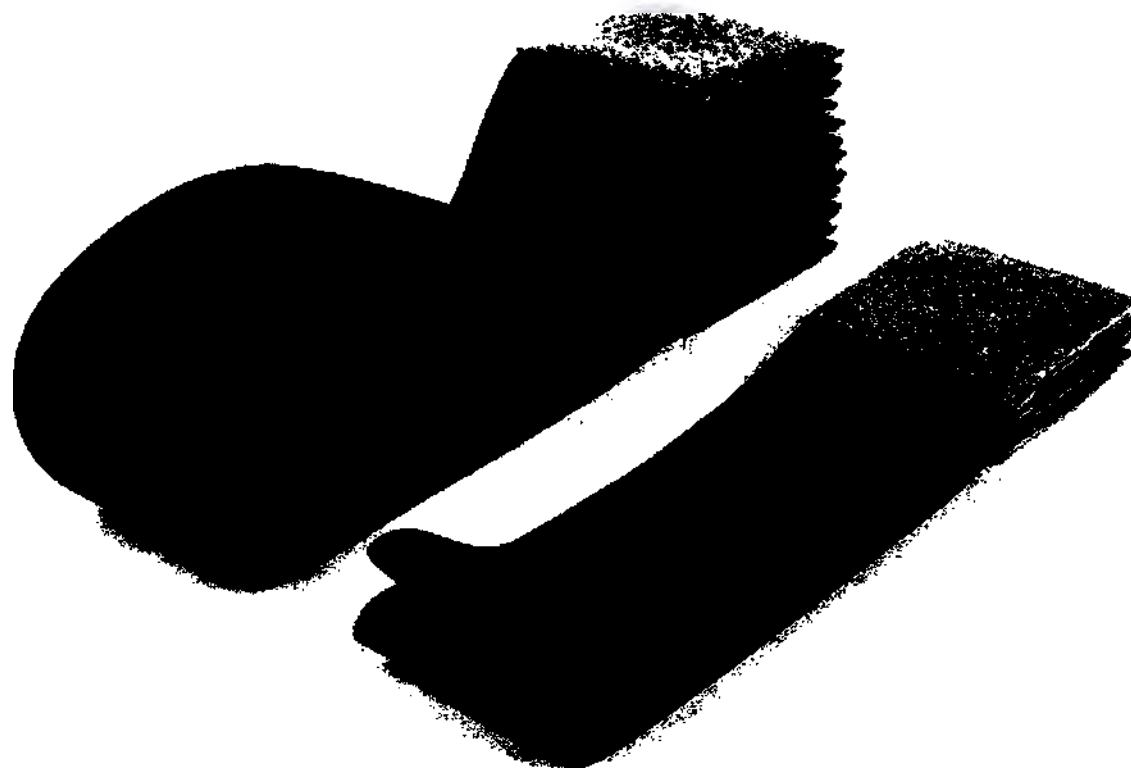


Рис.8 Электрод-проба П-2



Рис.9 Электрод-проба П-4



Рис.10 Излучатель Кавитации 2-х частотный (0.88, 2.64)

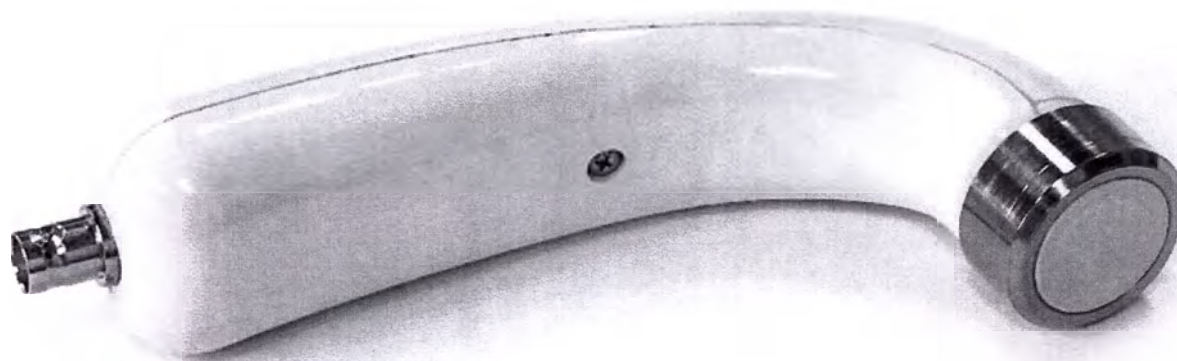


Рис.11 Излучатель Биоревитализации (Лазер+ИК)



Рис.12 Скрабер



Рис.13 Излучатель Кавитации низкочастотный

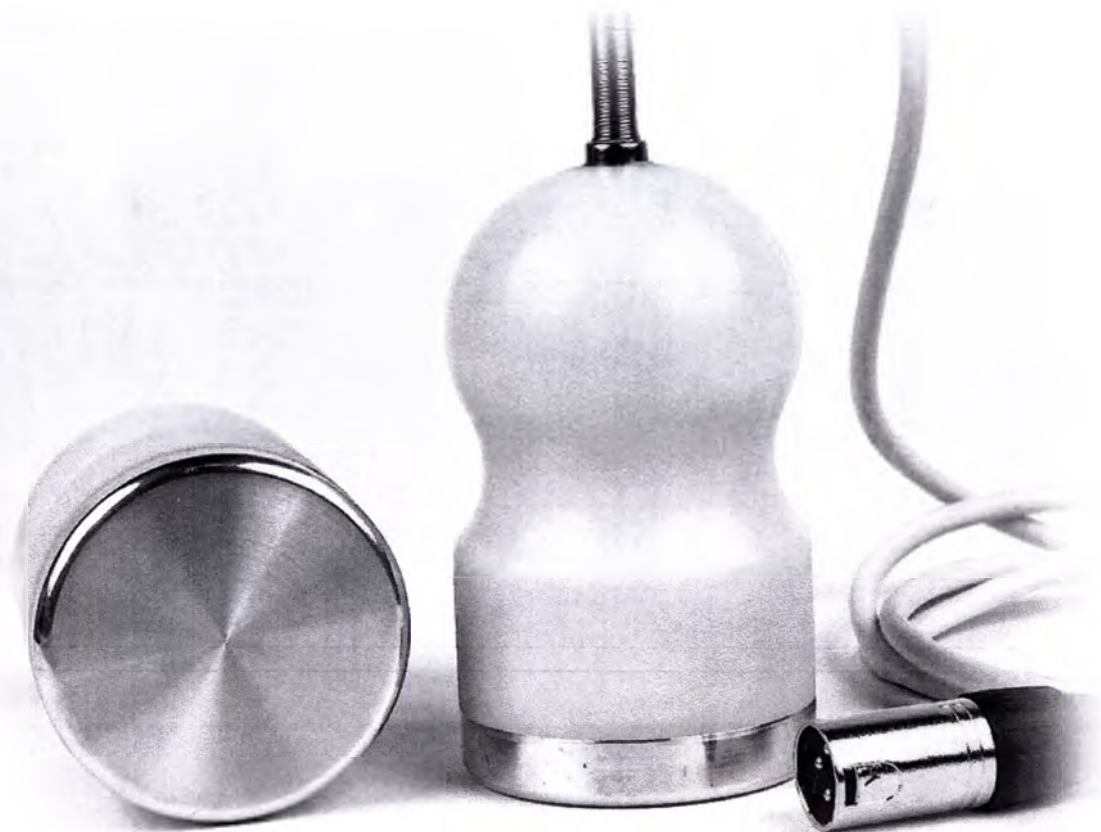


Рис.14 Запасная ёмкость

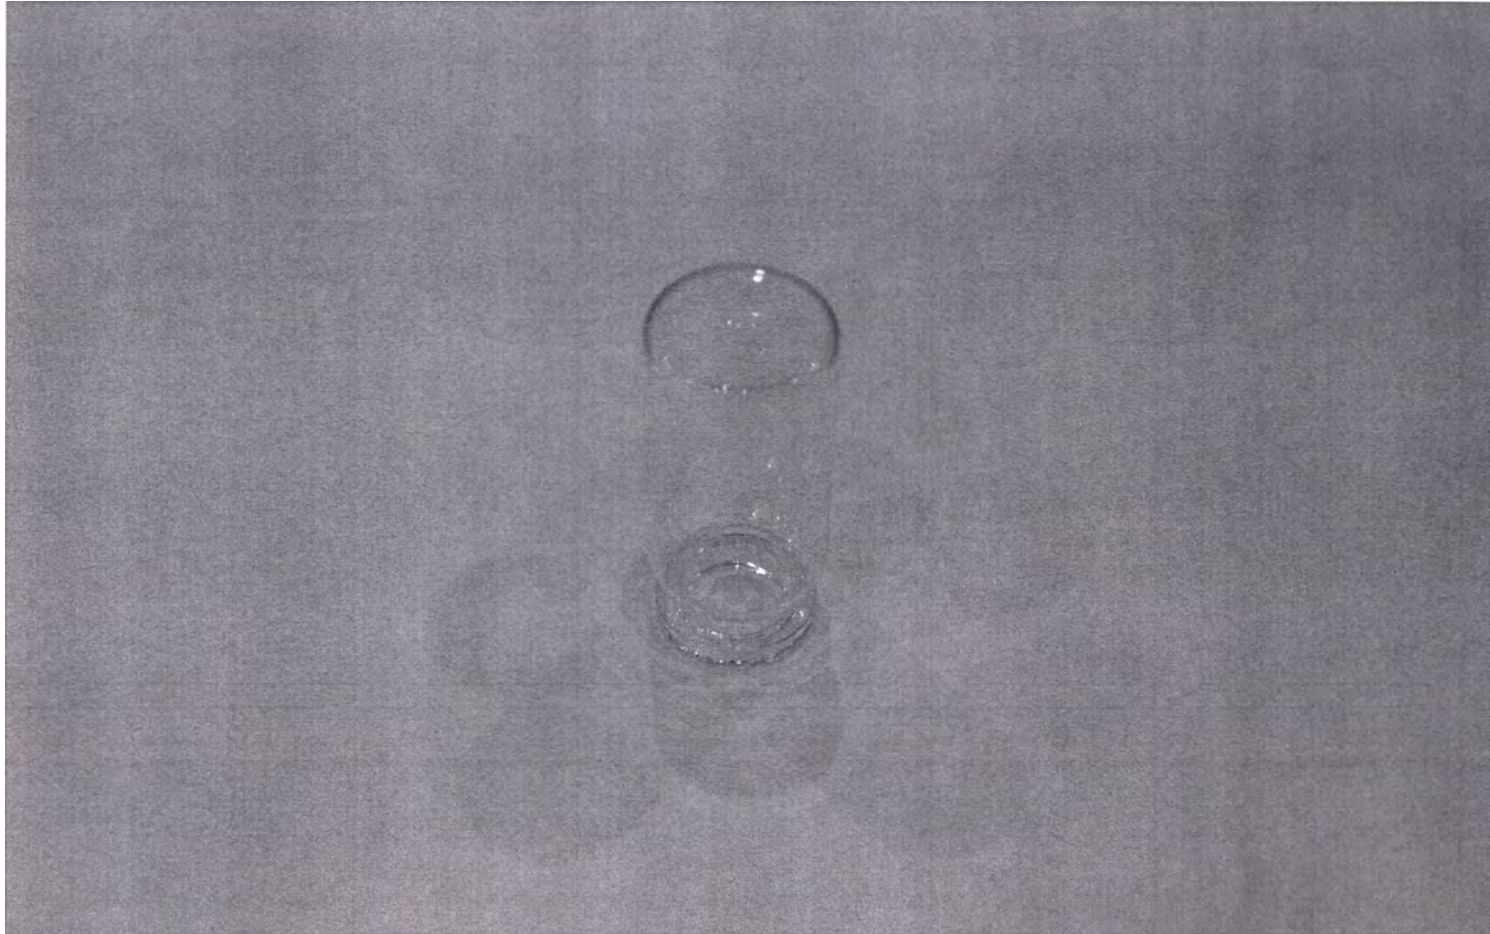


Рис.15. Рабочая манипула



Рис.16 Педаль управления



Рис. 17 Фотографическое изображение маркировки (этикетки) аппарата «ЭСМА 12.50»


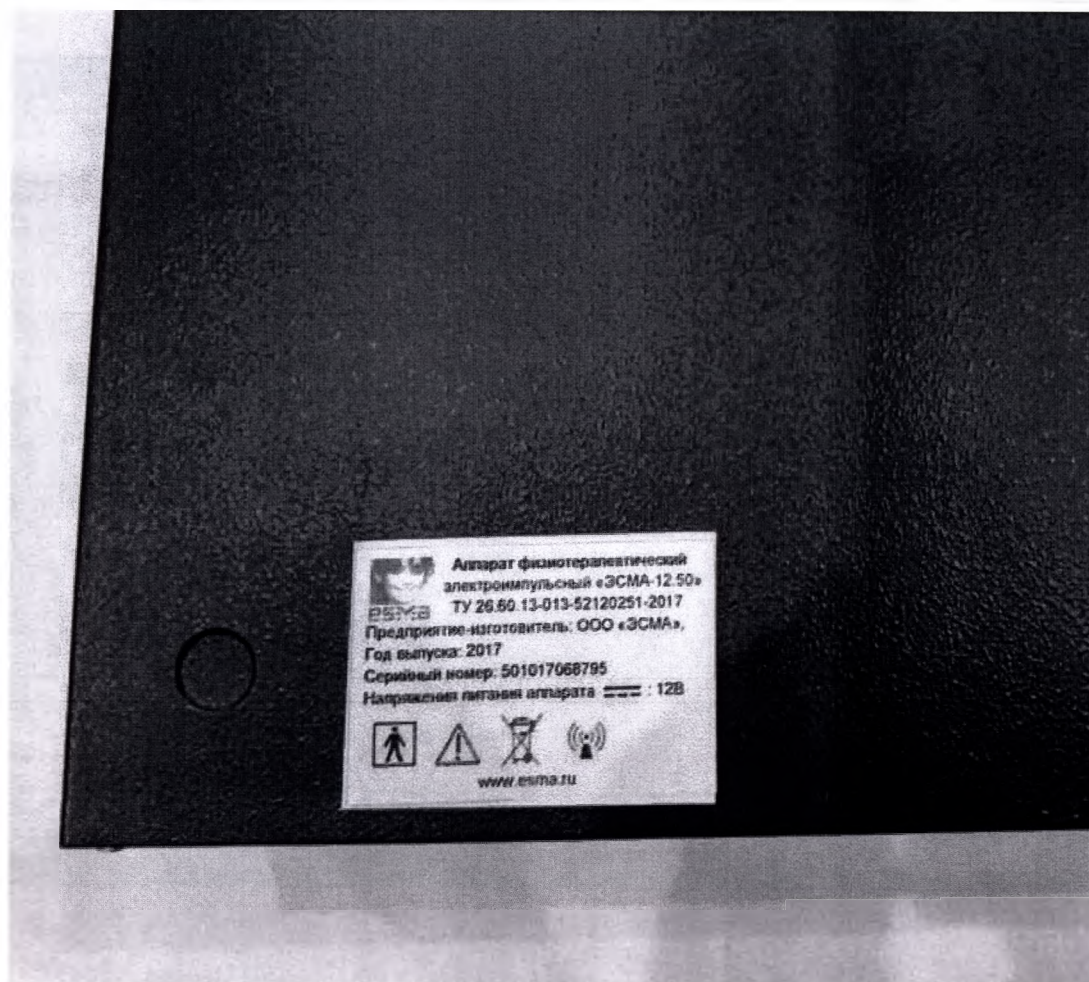


Рис. 18. Фотографическое изображение маркировки (этикетки) адаптера питания аппаратов «ЭСМА»

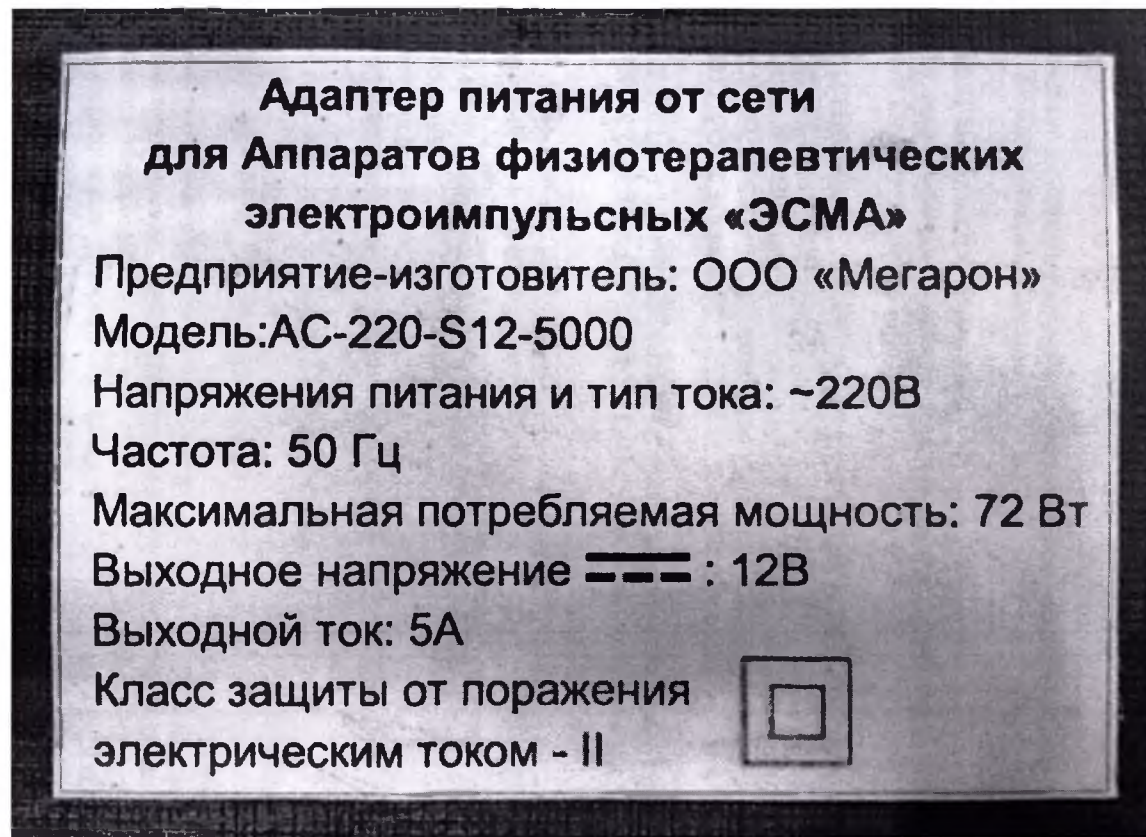

Прошито и пронумеровано на 19 листах

Генеральный директор ООО «ЭСМА» _____

А.Г. Карев

