



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия:

**Ширма-перегородка медицинская для клинико-диагностических лабораторий по ТУ 32.50.30-002-14692415-2017
в следующих исполнениях**


Ширма-перегородка медицинская для клинико-диагностических лабораторий по ТУ 32.50.30-002-14692415-2017 в следующих исполнениях:
ШПн-ТС 01

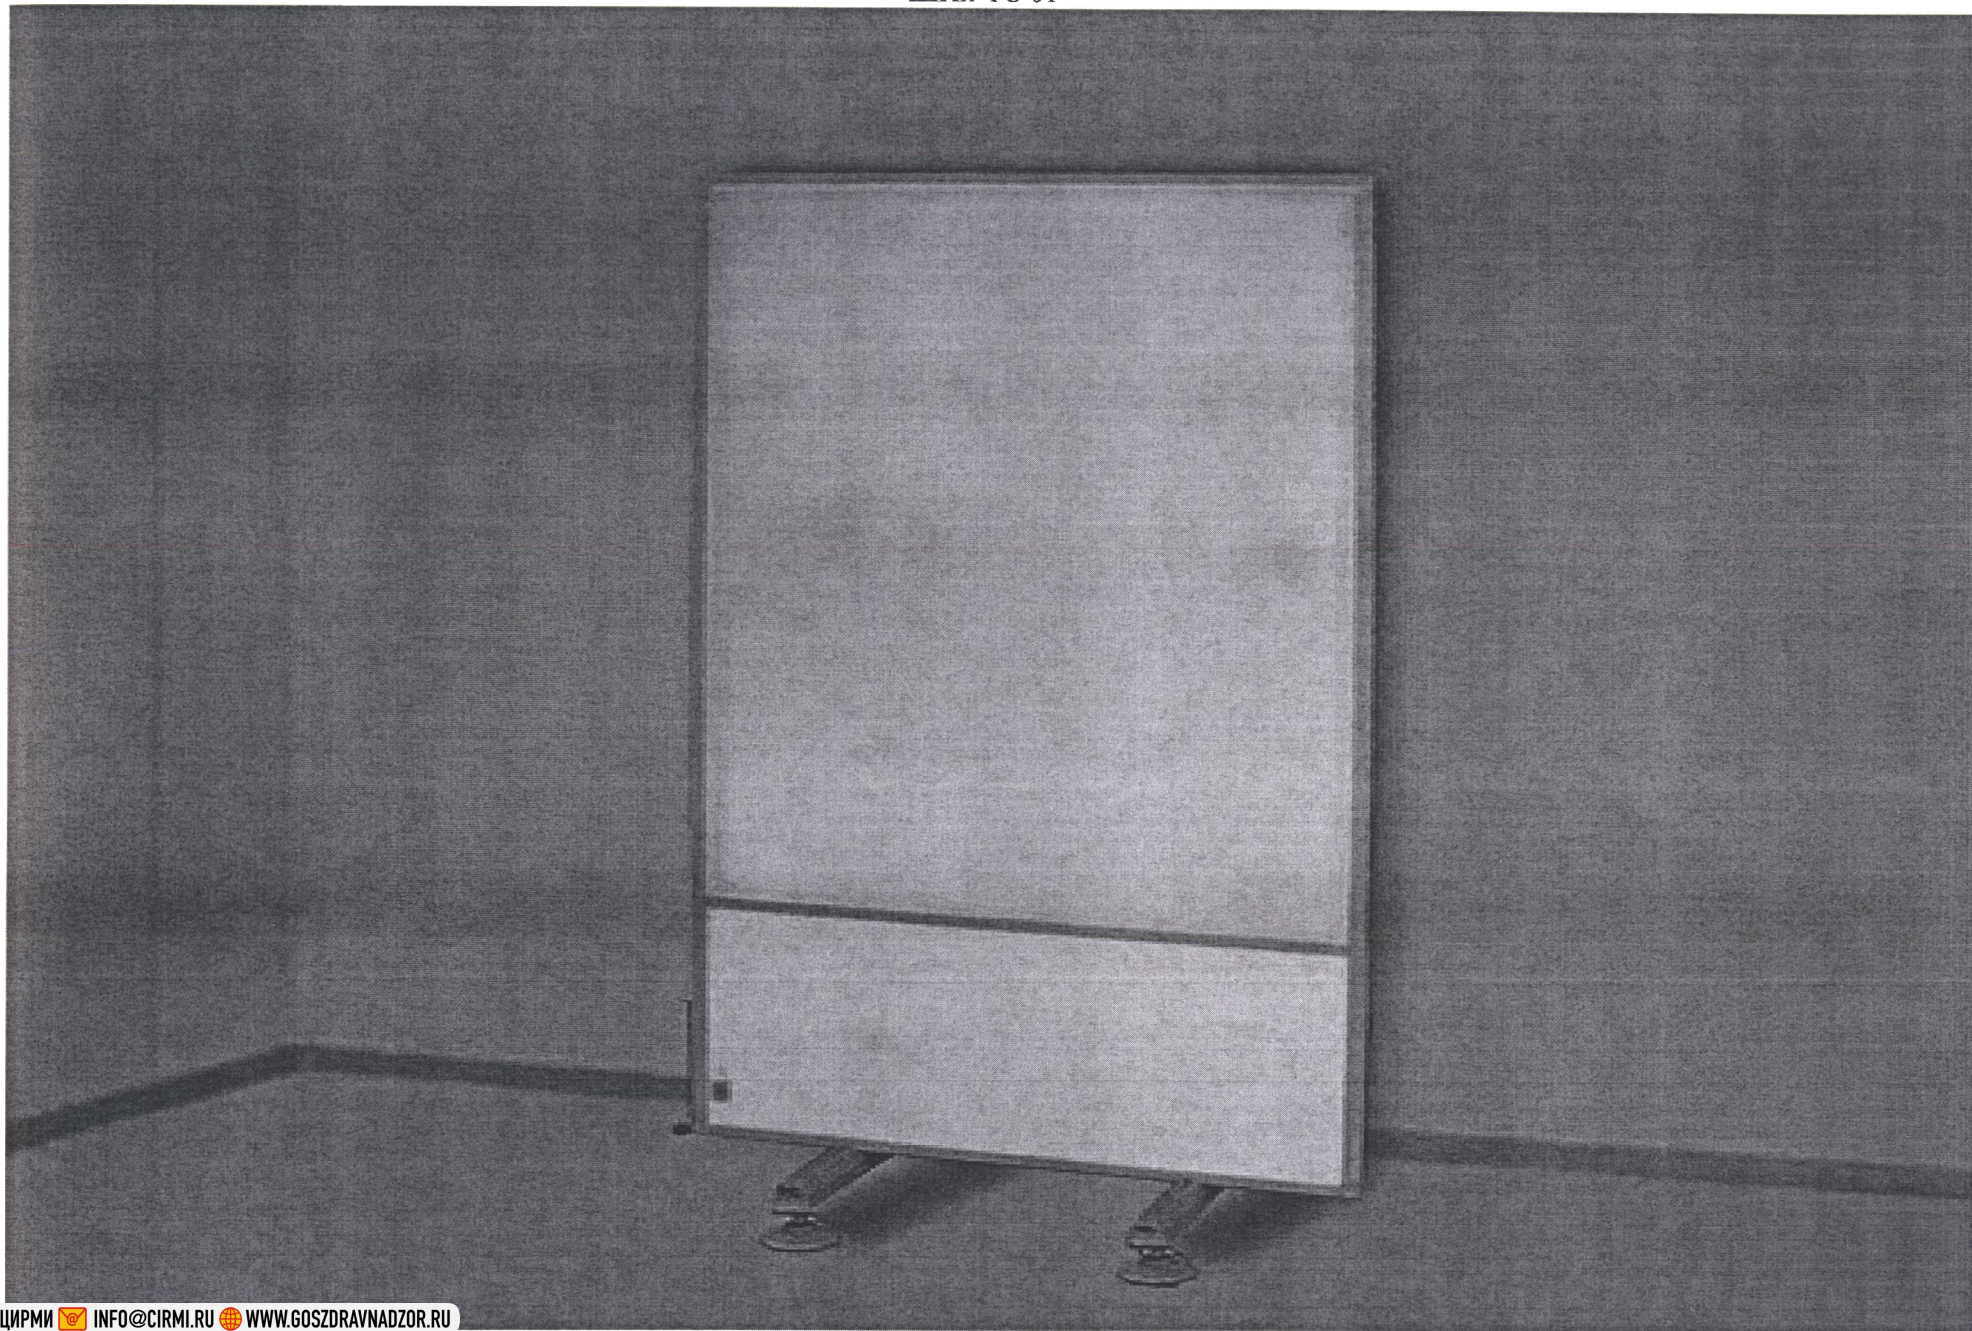


Ширма-перегородка медицинская для клиничко-диагностических лабораторий по ТУ 32.50.30-002-14692415-2017 в следующих исполнениях:
ШПк-ТС 01

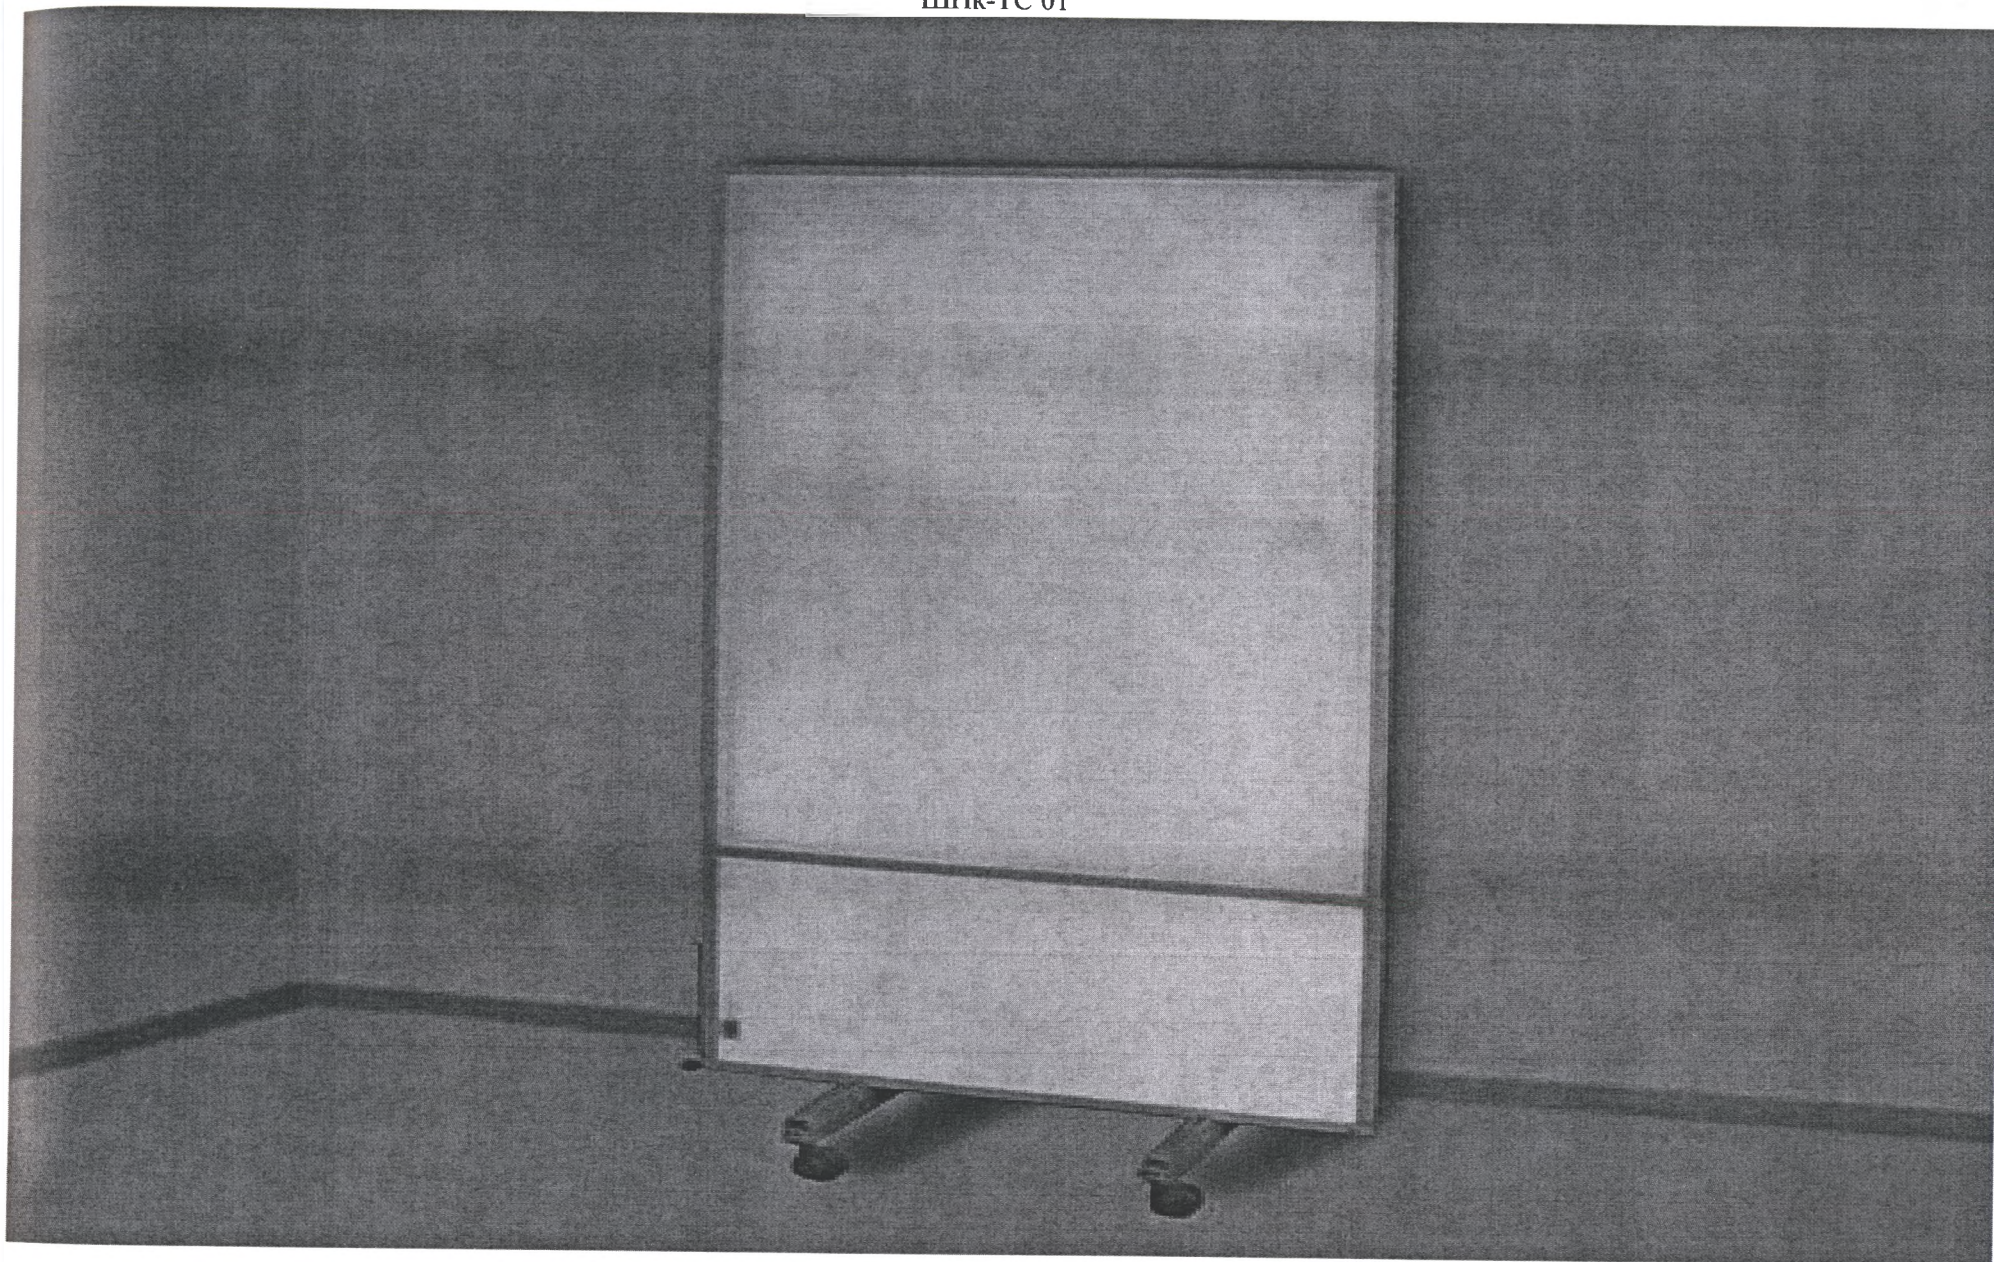


Ширма-перегородка медицинская для клинко-диагностических лабораторий по ТУ 32.50.30-002-14692415-2017 в следующих исполнениях:
ШПн-ТС 02

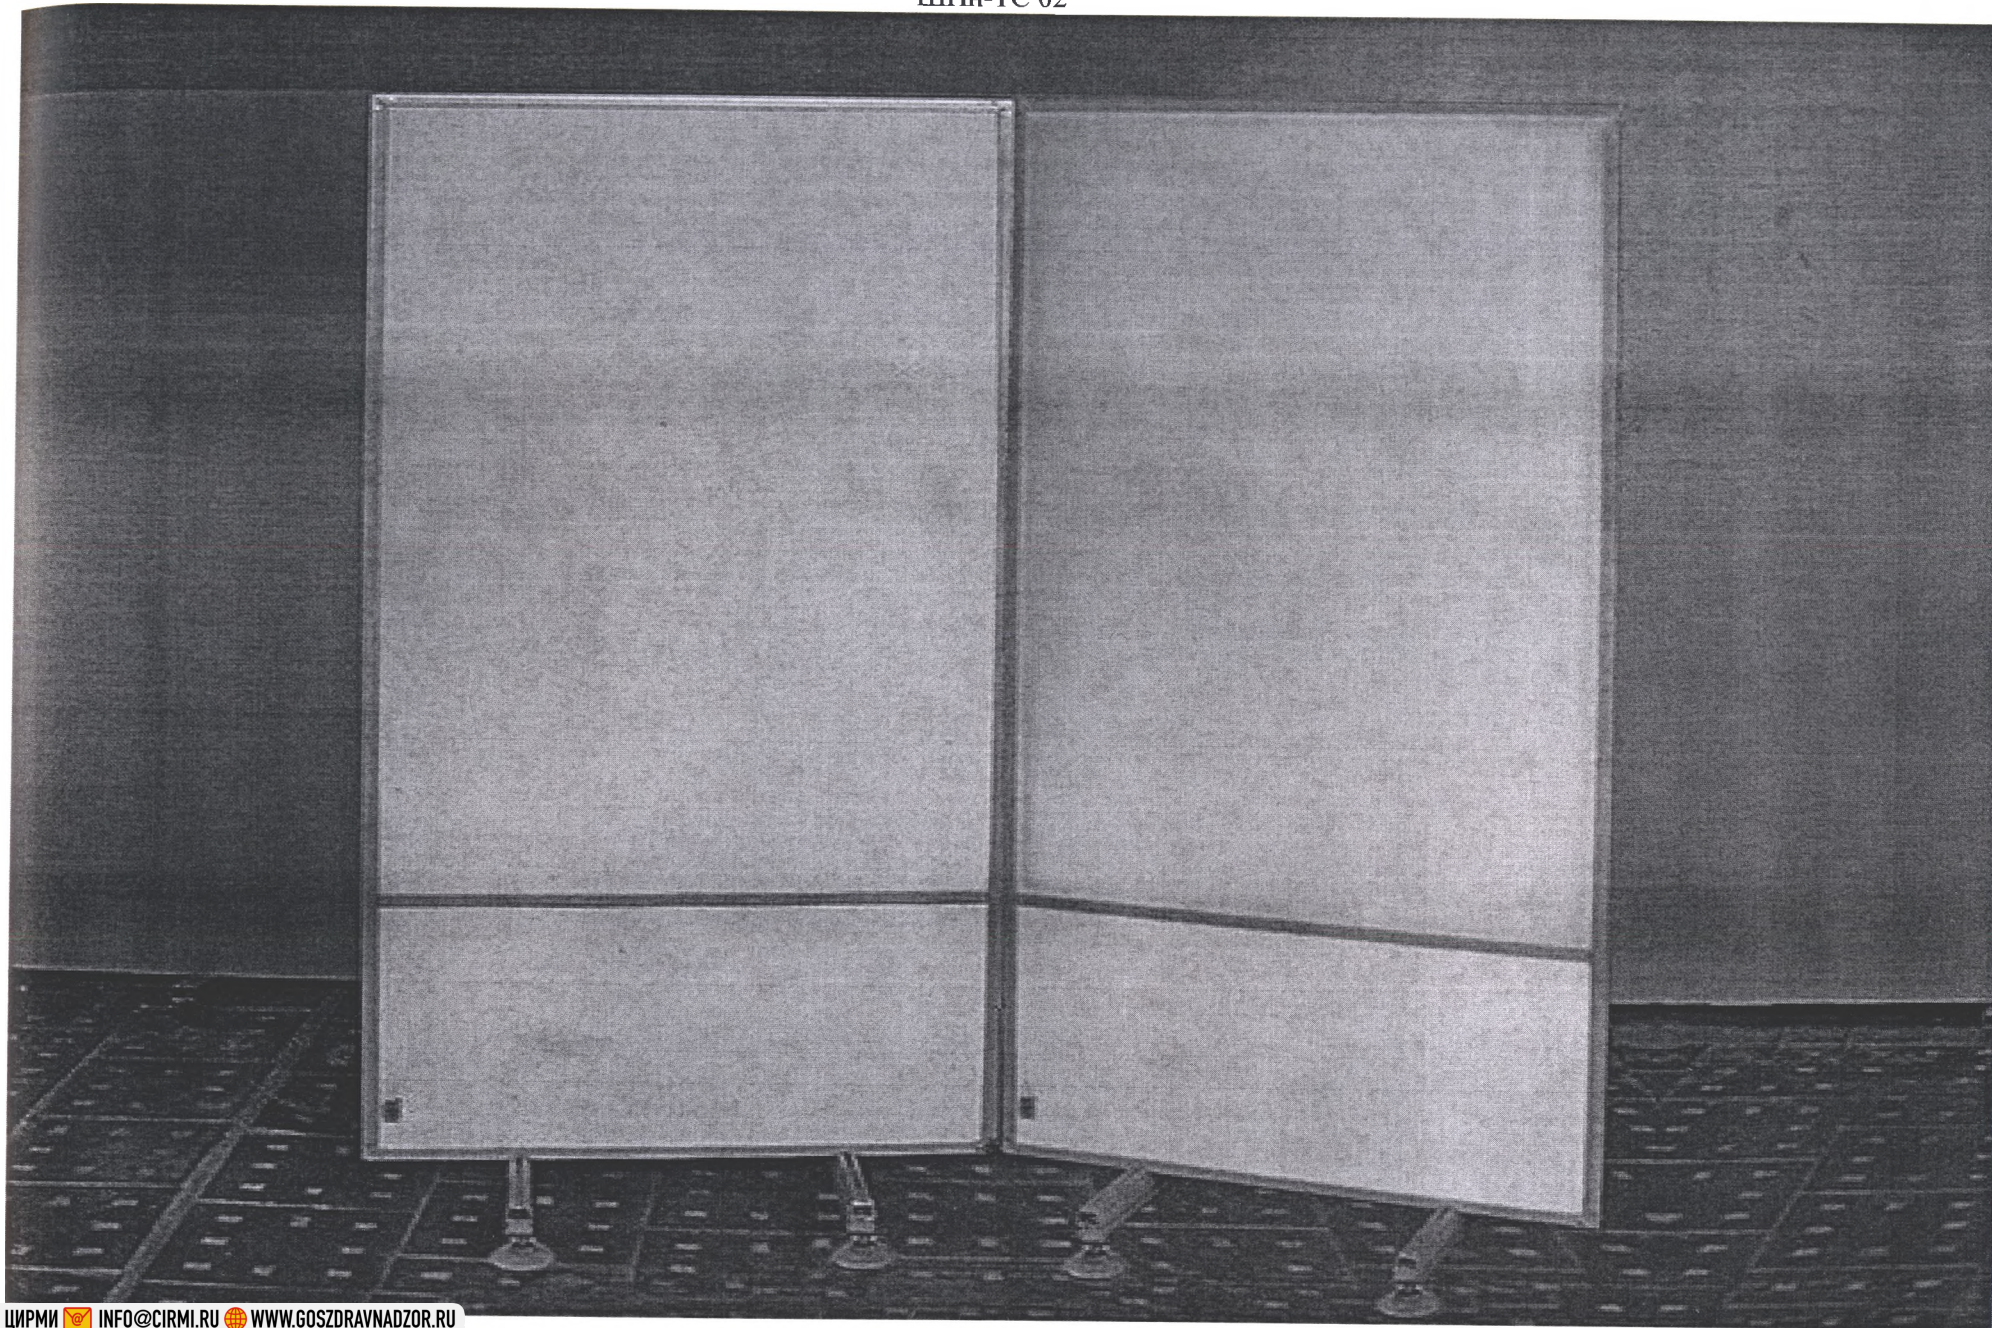


Ширма-перегородка медицинская для клинико-диагностических лабораторий по ТУ 32.50.30-002-14692415-2017 в следующих исполнениях:
ШПк-ТС 02

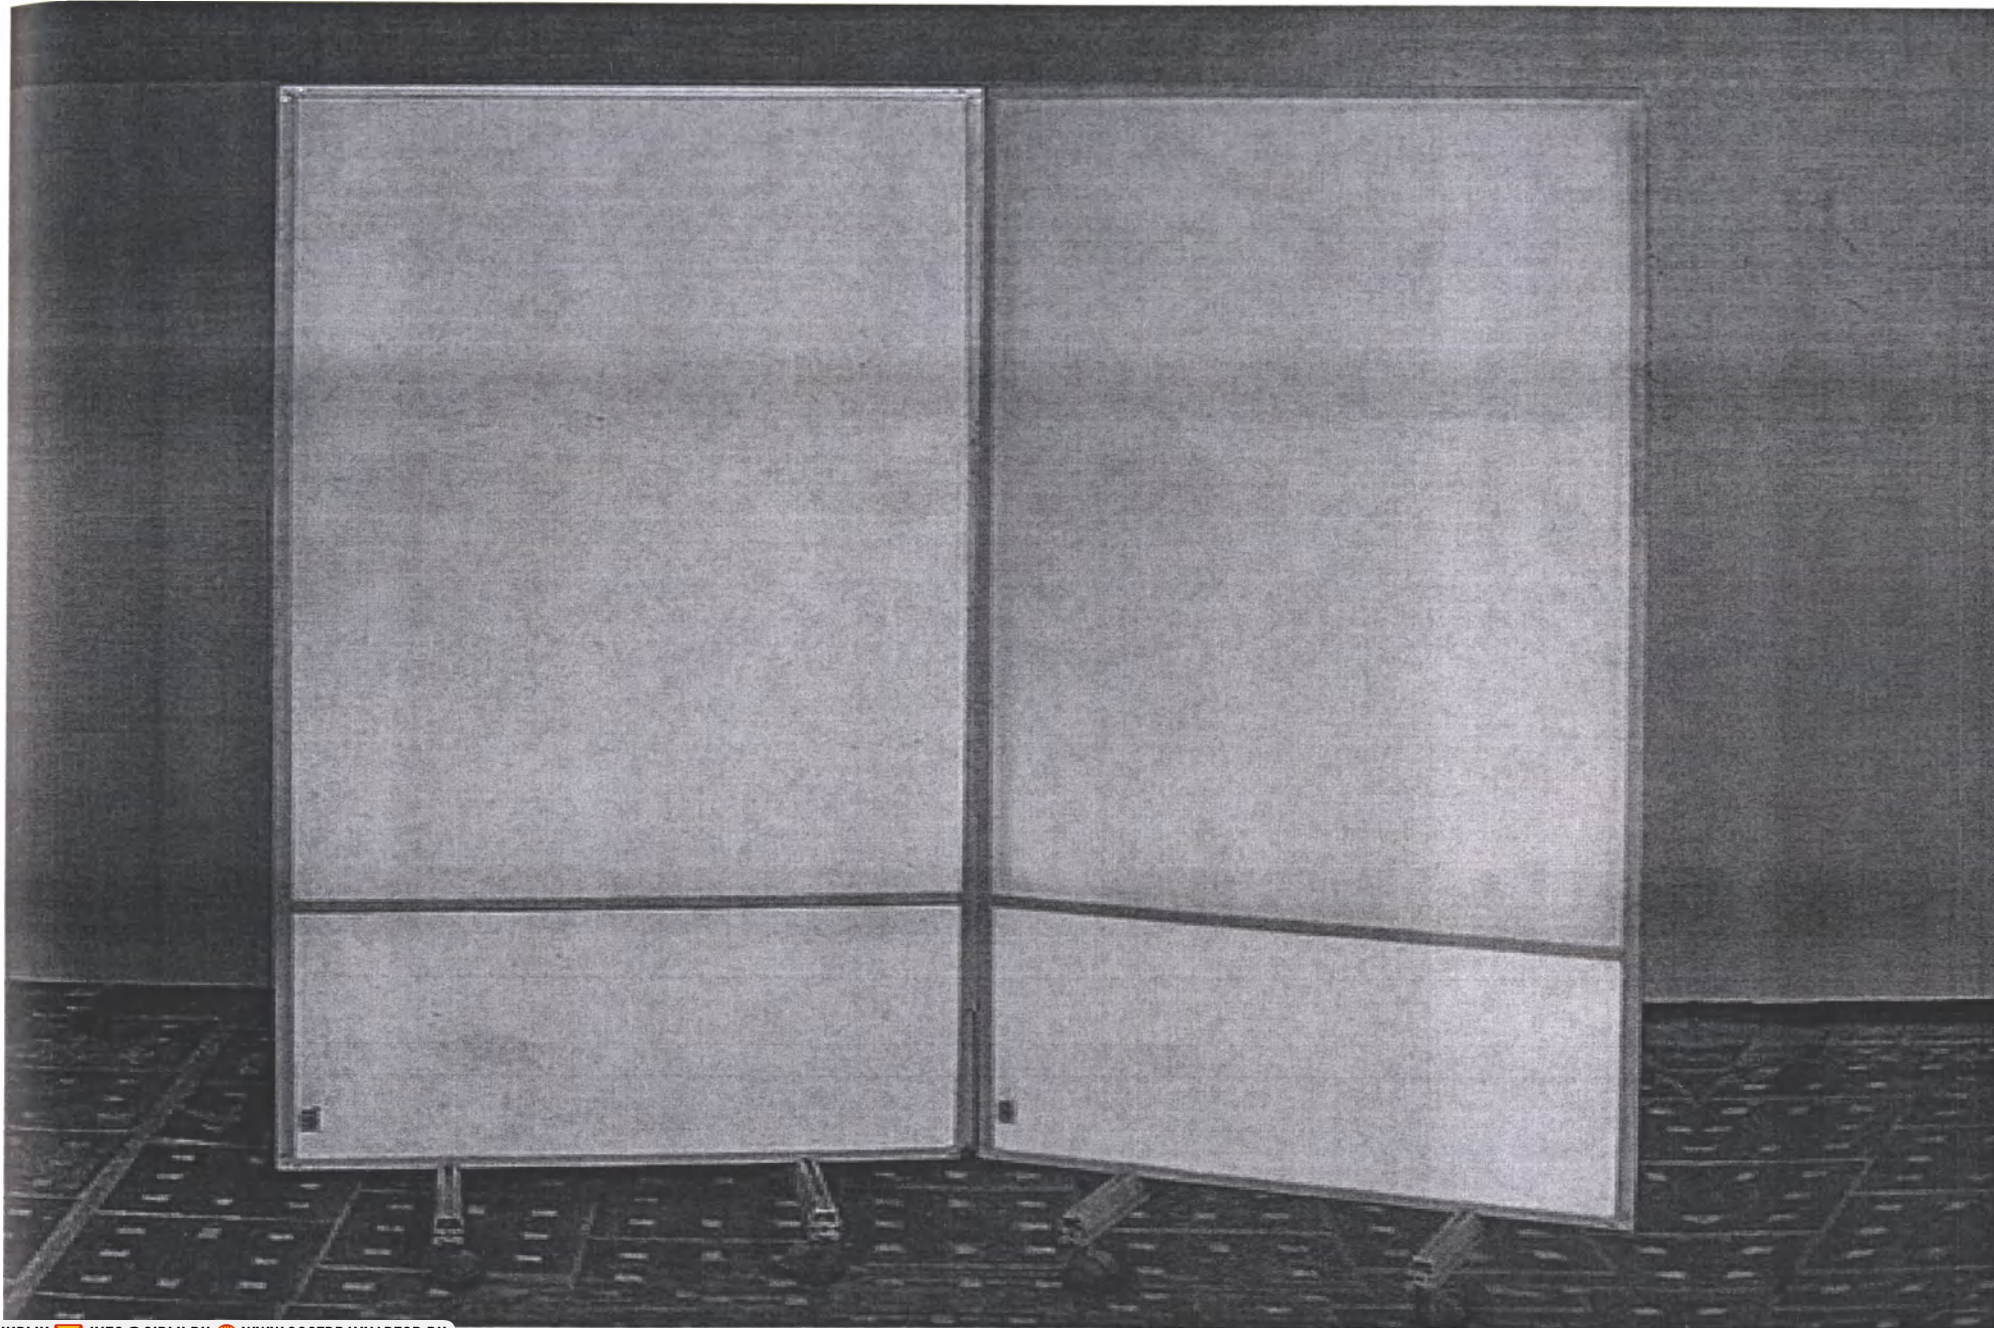


Ширма-перегородка медицинская для клинко-диагностических лабораторий по ТУ 32.50.30-002-14692415-2017 в следующих исполнениях:
ШПн-ТС 03

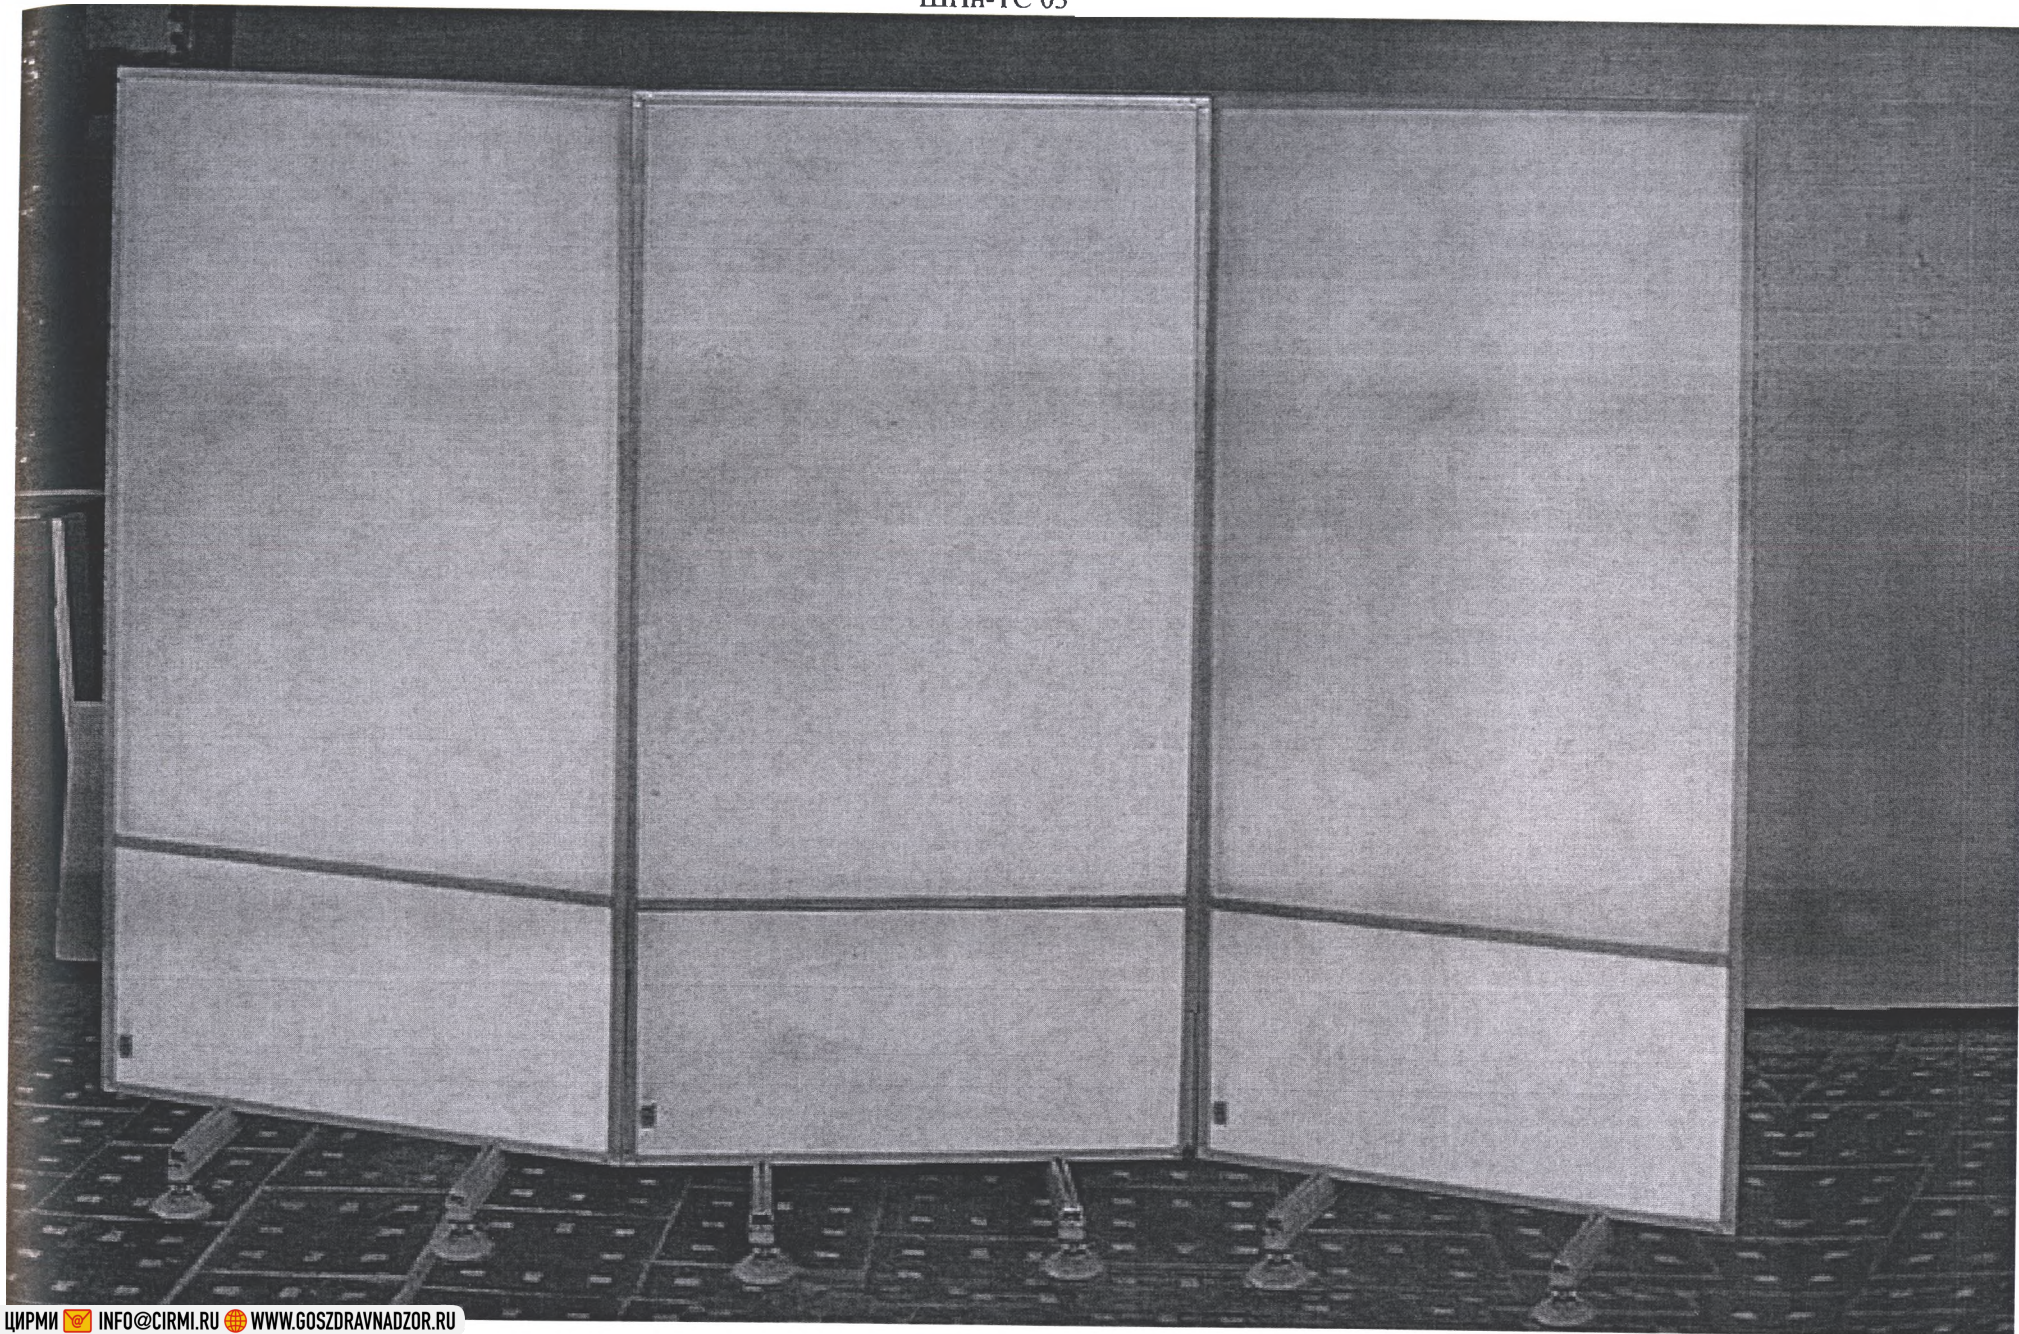

Ширма-перегородка медицинская для клинико-диагностических лабораторий по ТУ 32.50.30-002-14692415-2017 в следующих исполнениях:
ШПк-ТС 03

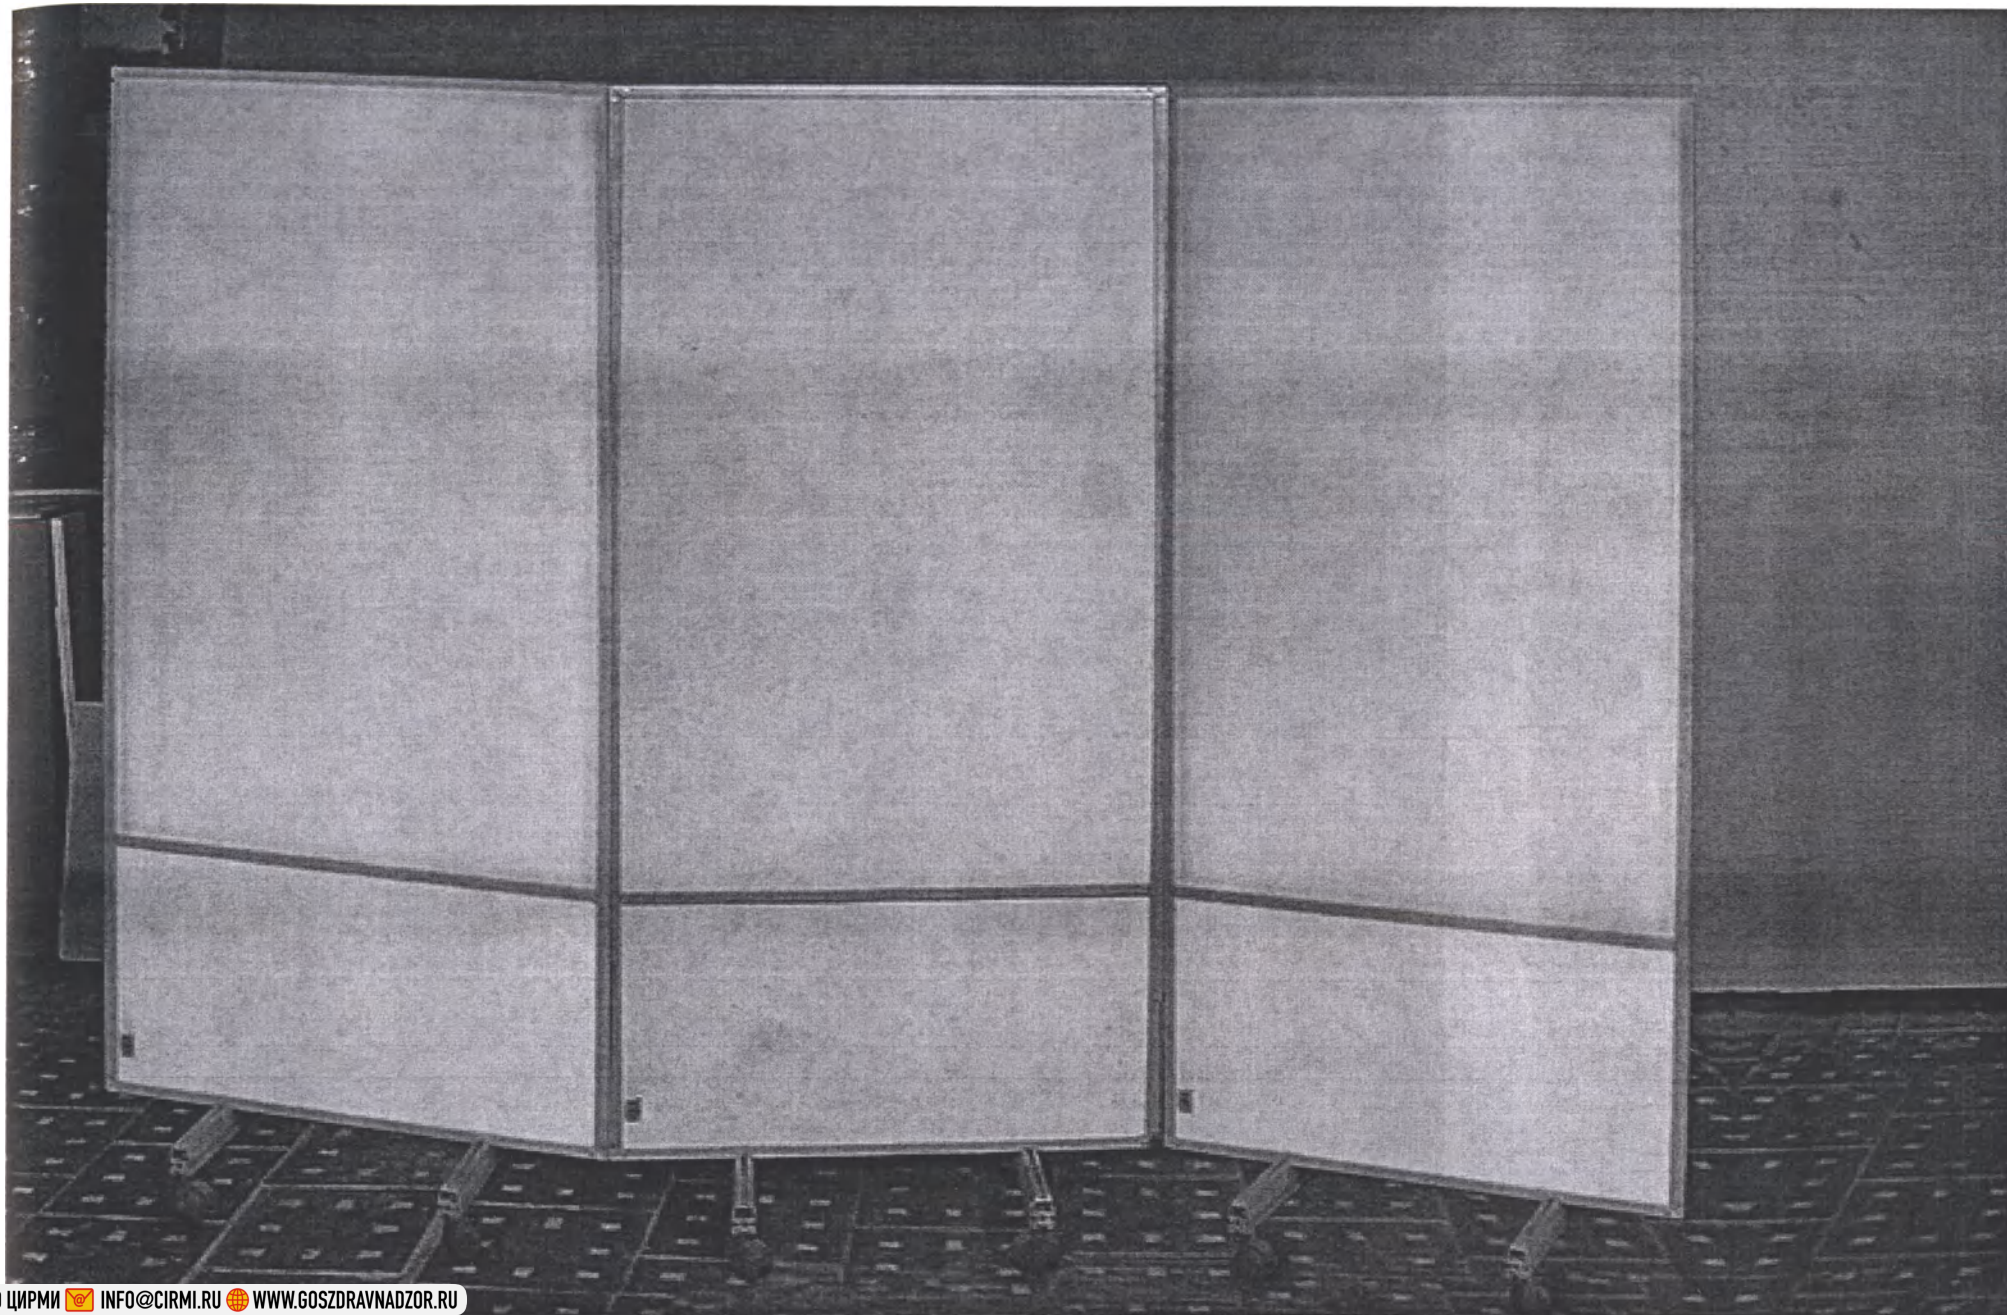

Ширма-перегородка медицинская для клинико-диагностических лабораторий по ТУ 32.50.30-002-14692415-2017 в следующих исполнениях:
ШПк-ТС 04

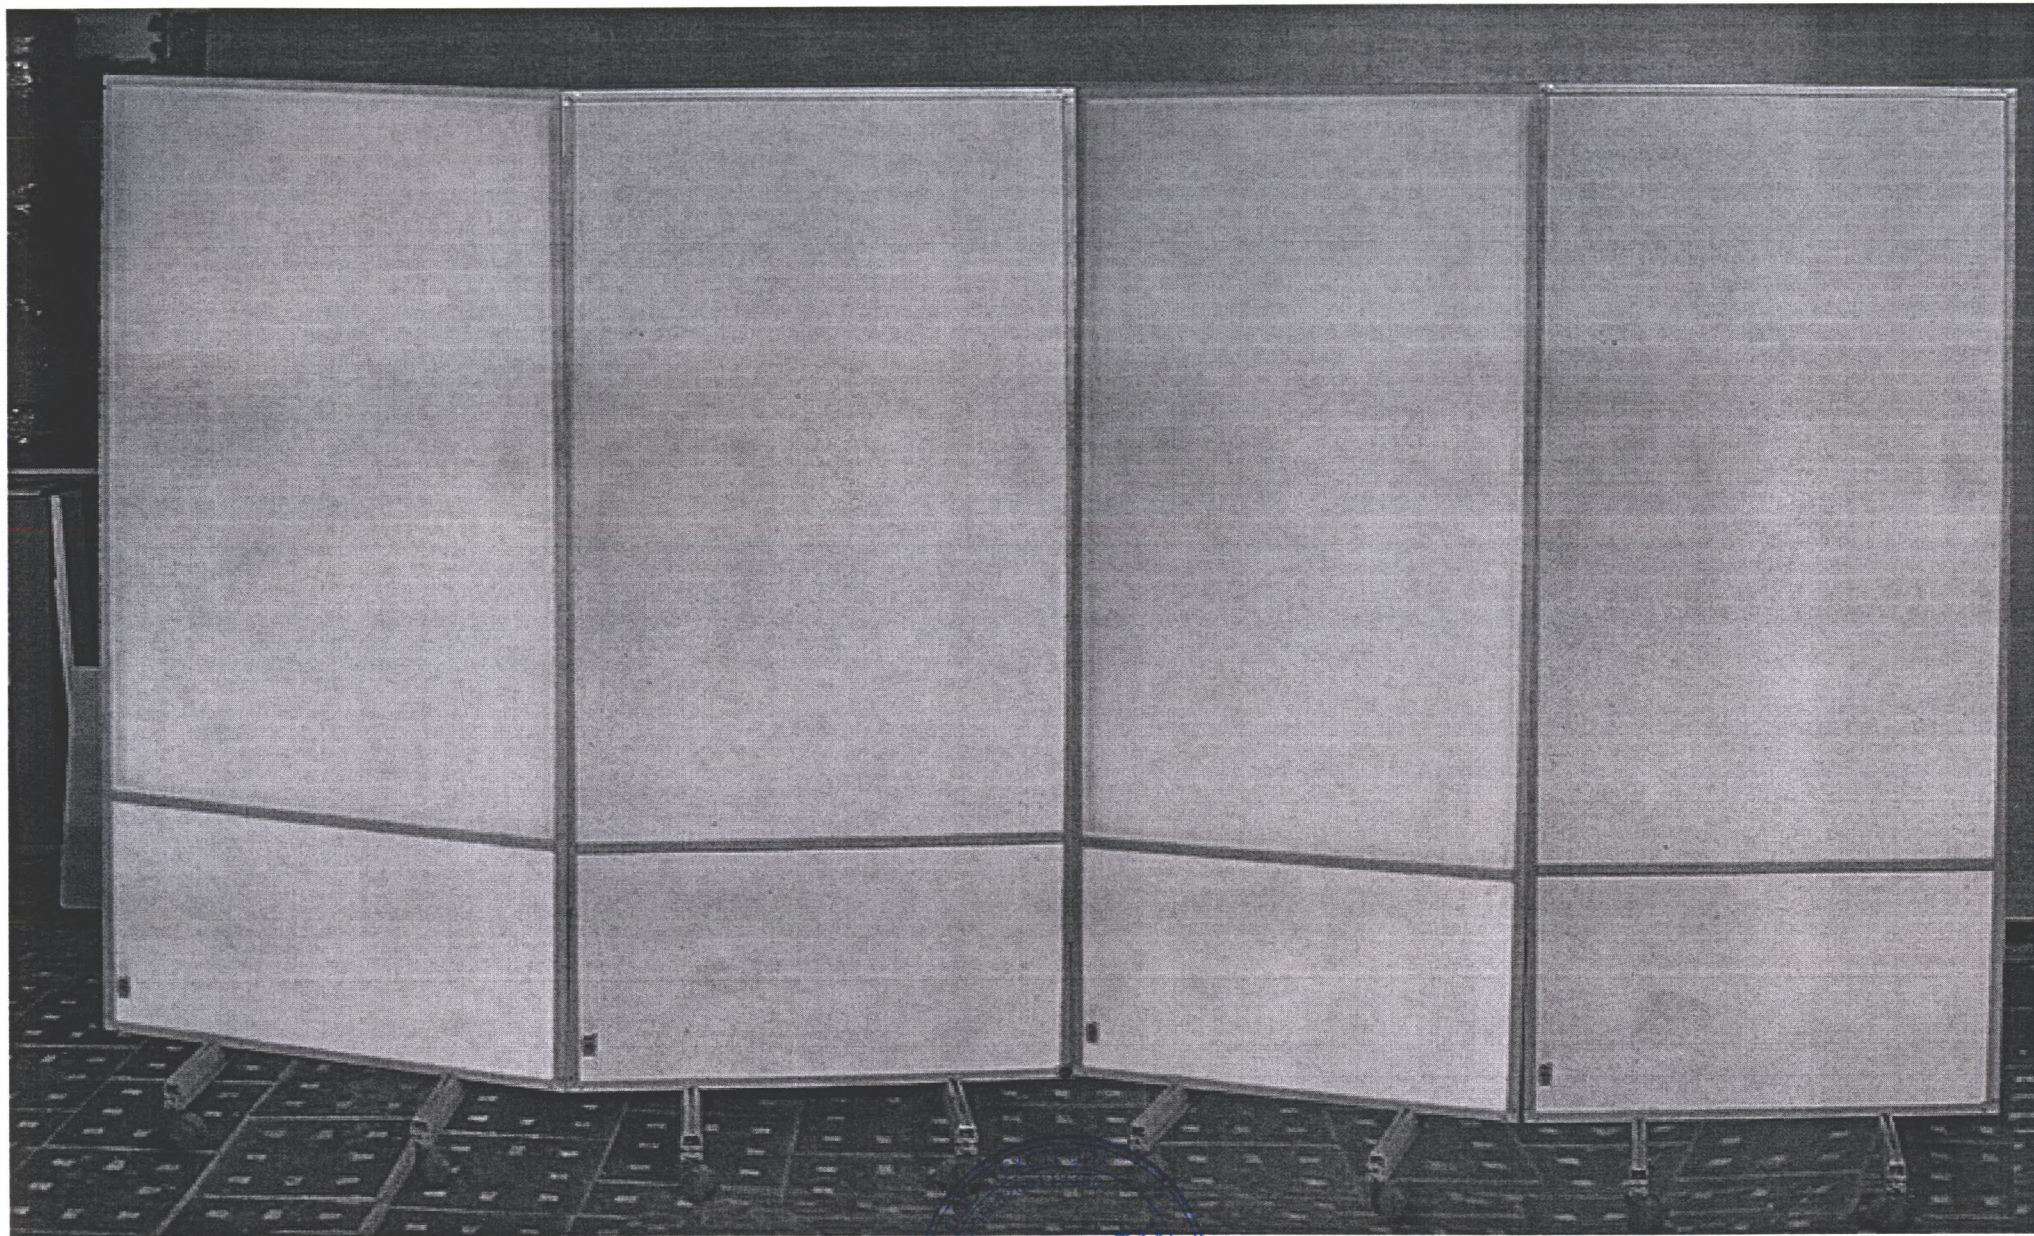

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью ООО «Техстрой»

л.

Директор ООО «Техстрой»

А.Н. Кабикин



Макет этикетки, прикрепляемой непосредственно к поверхности медицинского изделия на видном месте и/или к упаковке.



Производитель: ООО «Техстрой»
Адрес производства: 603163, г. Нижний
Новгород, ул. Родионова, 193 П10
Телефон/факс: (883159) 2-11-71, 2-20-36
www.tehstroj-nn.ru

Наименование: Ширма-перегородка медицинская для клиничко-
диагностических лабораторий по ТУ 32.50.30-002-14692415-2017

Исполнение:

Ширма перегородка: ШП-ТС

Наименование	Артикул
Ширма перегородка медицинская	ШПн-ТС 01
Ширма перегородка медицинская	ШПк-ТС 01
Ширма перегородка медицинская	ШПн-ТС 02
Ширма перегородка медицинская	ШПк-ТС 02
Ширма перегородка медицинская	ШПн-ТС 03
Ширма перегородка медицинская	ШПк-ТС 03
Ширма перегородка медицинская	ШПн-ТС 04
Ширма перегородка медицинская	ШПк-ТС 04

Назначение:

Мебель предназначенные для оснащения медицинских учреждений,
занимающихся проведением стандартных клинических, а также
гематологических, иммунологических, цитологических, биохимических,
микробиологических и других исследований.

Хранение: в сухих закрытых помещениях с относительной влажностью
воздуха не более 75%. Условия хранения мебели должны соответствовать
группе хранения 2 по ГОСТ 15150.

Утилизация: в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10, класс А.

Дата производства 01.2017

Срок годности 18 месяцев

Серийный номер 012017/0098/1

Номер партии 98/012017

Р/У №

Директор ООО «Техстрой»

А.Н. Кабкин

