





Блок регистрации «Нейрон-Спектр-СМ», NS053201.004

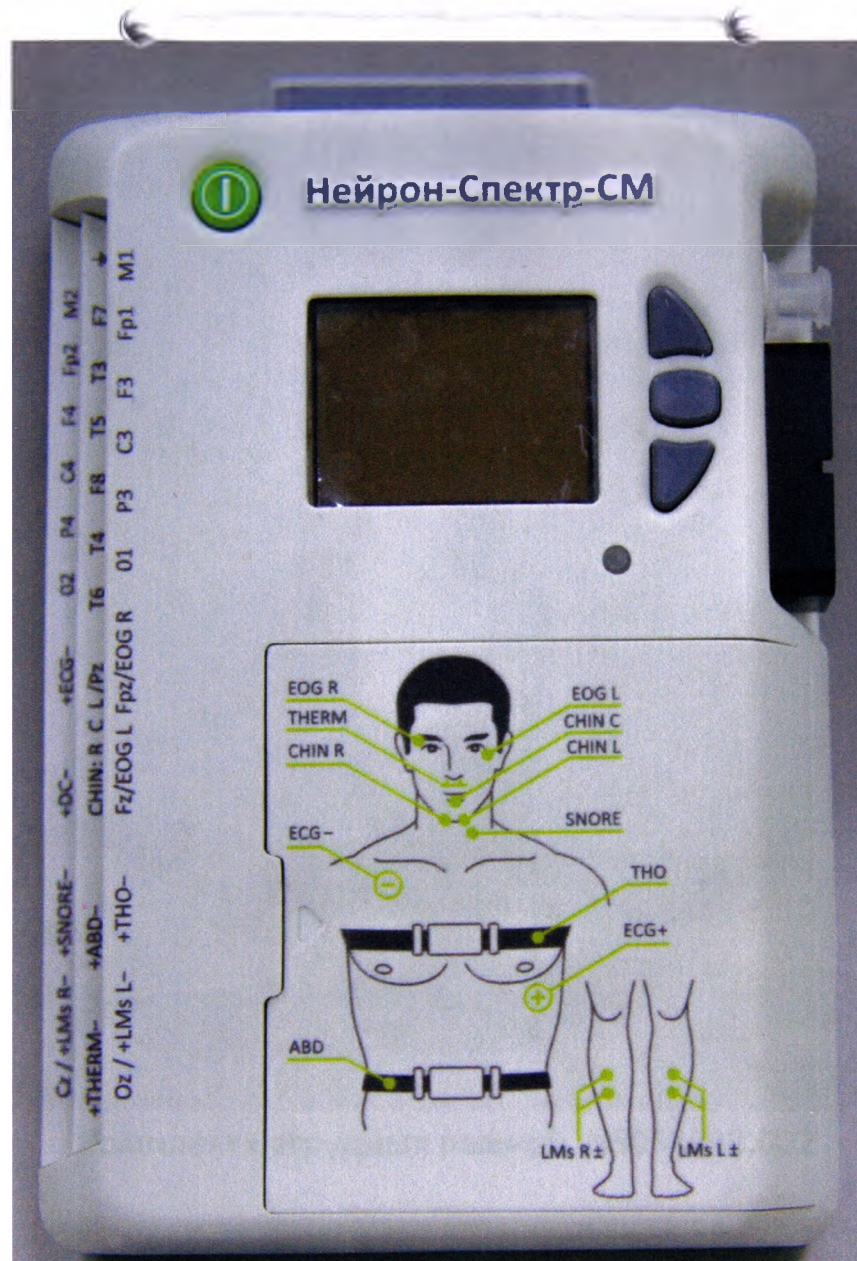

Комплект нагрудных ремней, NS053998.002

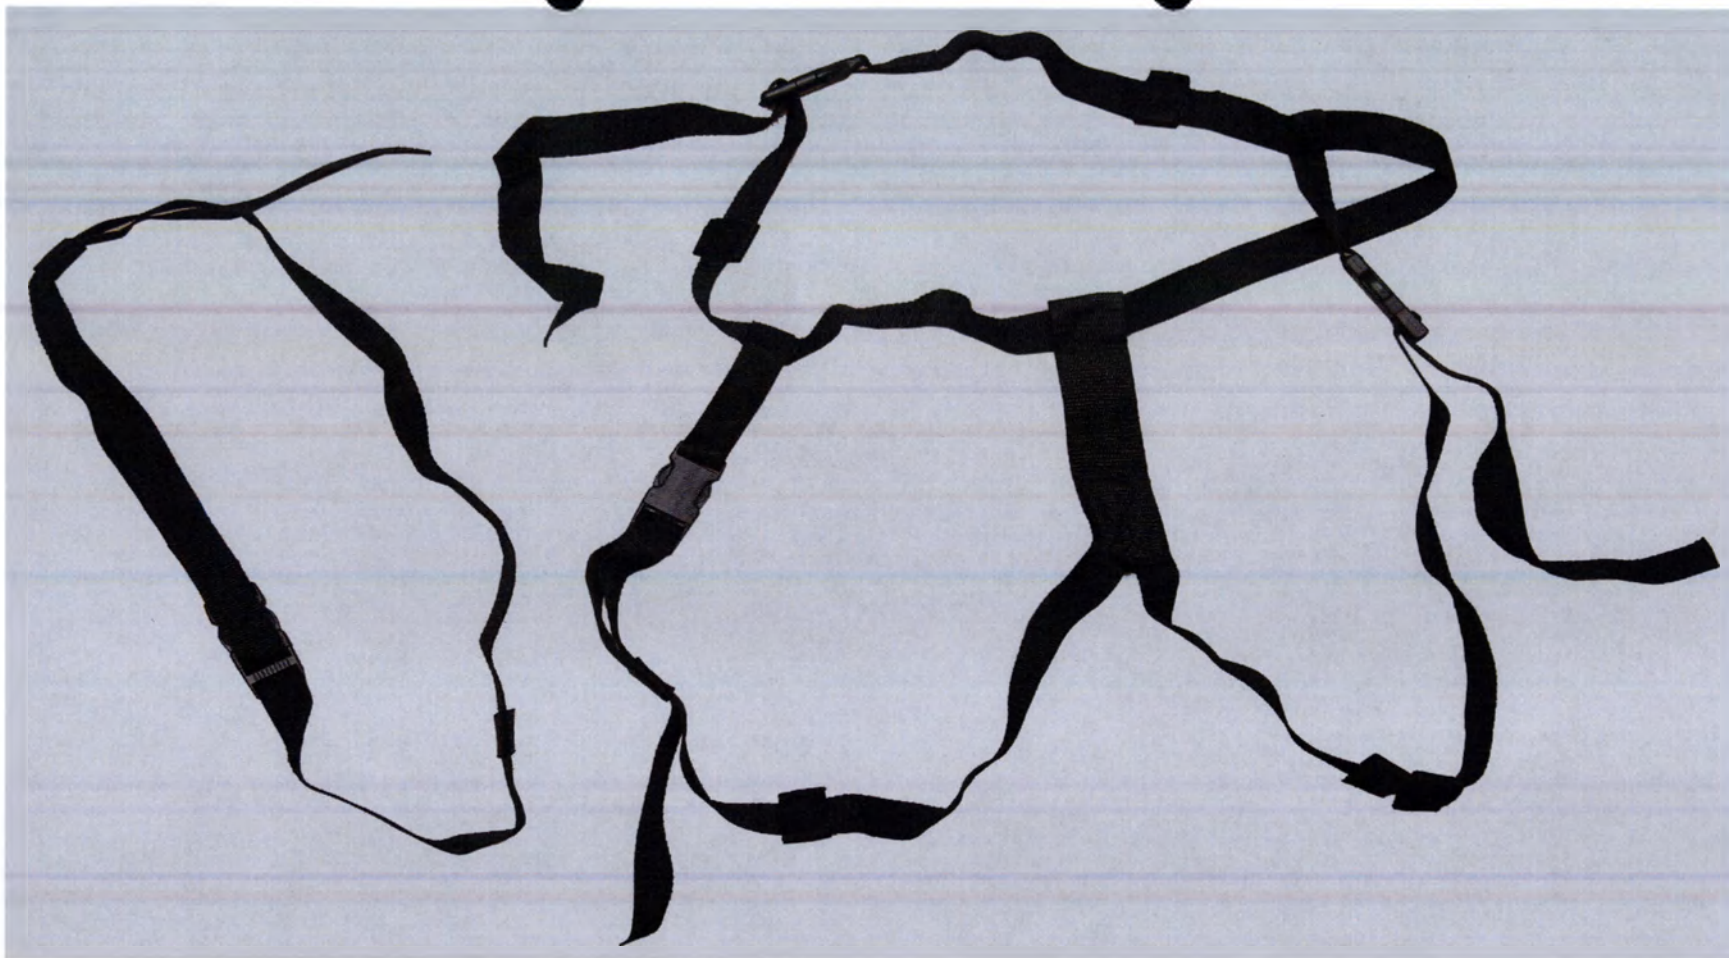

Система ремней крепления блока на теле NS053211.004, NS053211.004-01



**Ремень неопреновый для крепления блока регистрации
на груди NS053211.005, NS053211.005-01**



Зарядное устройство в комплекте с 4 аккумуляторами типоразмера AA(R6) емкостью не менее 2000 мАч

GP PowerBank Smart 2 (model GP PB14)

 **Transcend®**

REF 220051 LOT 05920.17 1 шт/ПЧЕ


Карта памяти Micro SD (8Gb)

Micro SD memory card (8Gb)



DHC™ UHS-I 

8GB

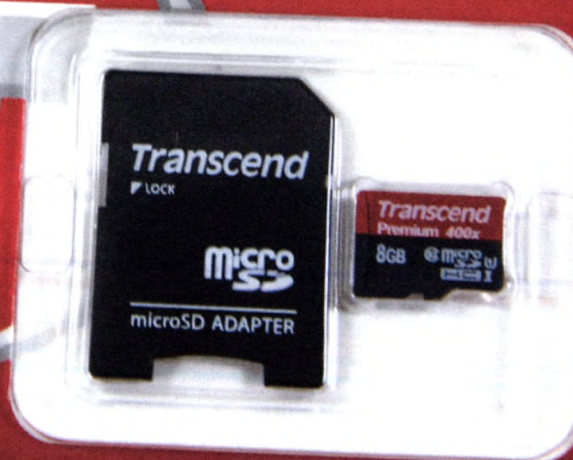

60 Up to
MB/s

Great for
FULL HD
Recording

micro
SD UHS-I
CLASS **10**




For SDHC devices only. Maximum transfer speed requires UHS-I compatible device.


Карта памяти SDHC, не менее 4Gb



Электрод ВП чашечковый с кабелем отведения «ЭВП» (для регистрации ЭМГ), NS990106.027-01.10

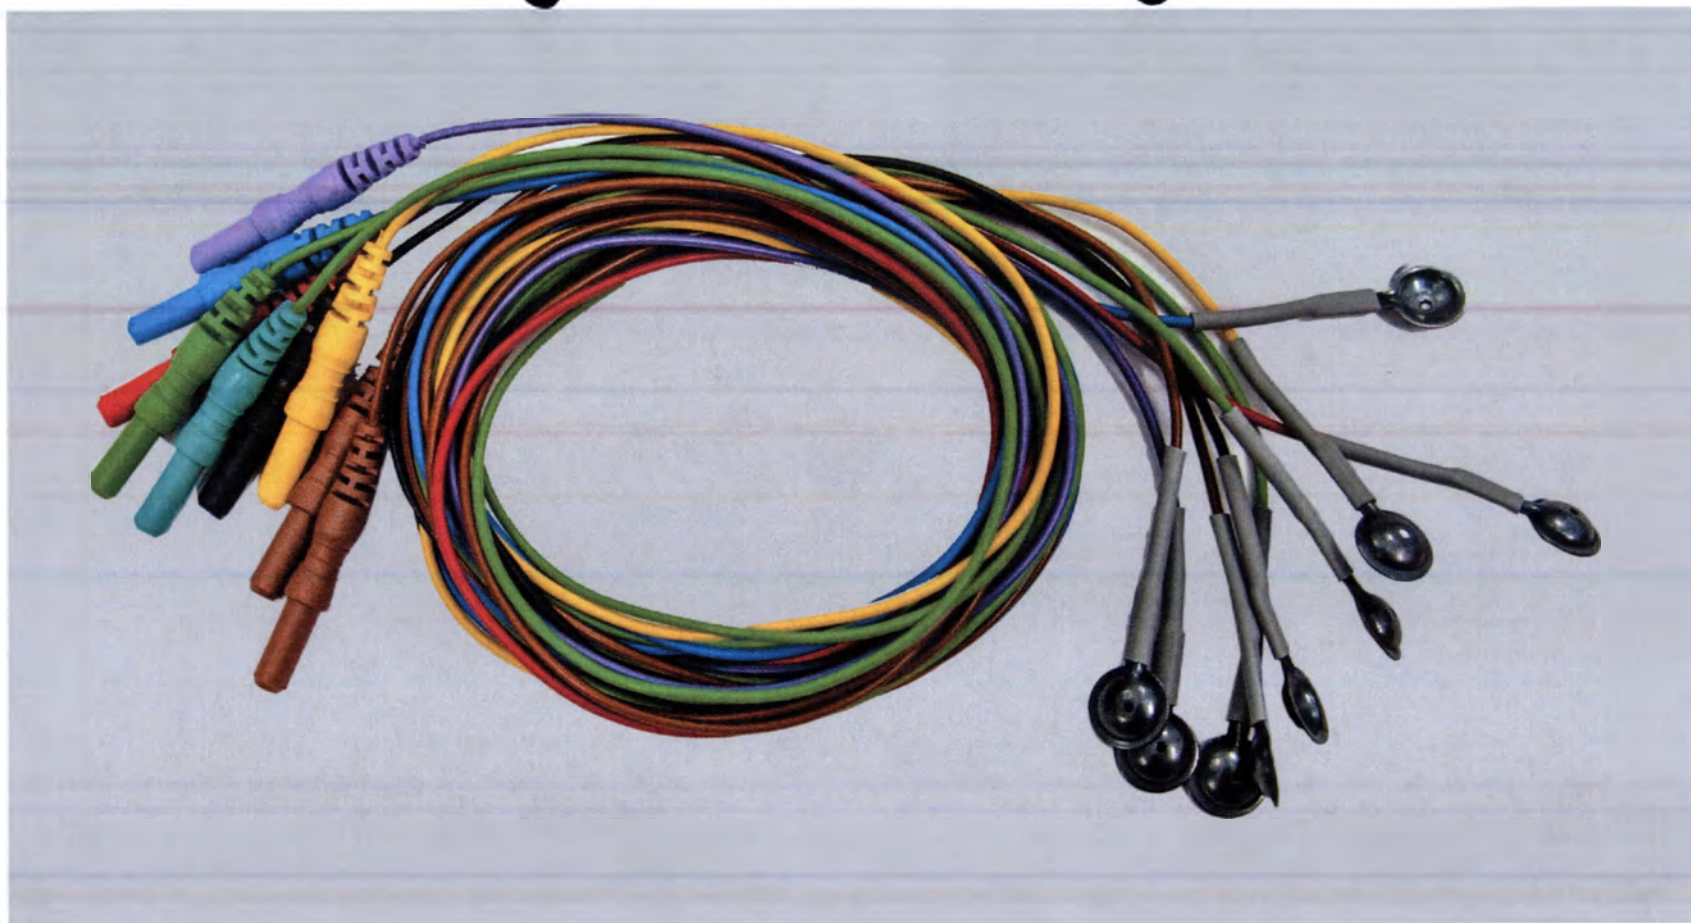

Электрод ВП чашечковый с кабелем отведения «ЭВП» (для регистрации ЭЭГ), NS990106.027-01.10

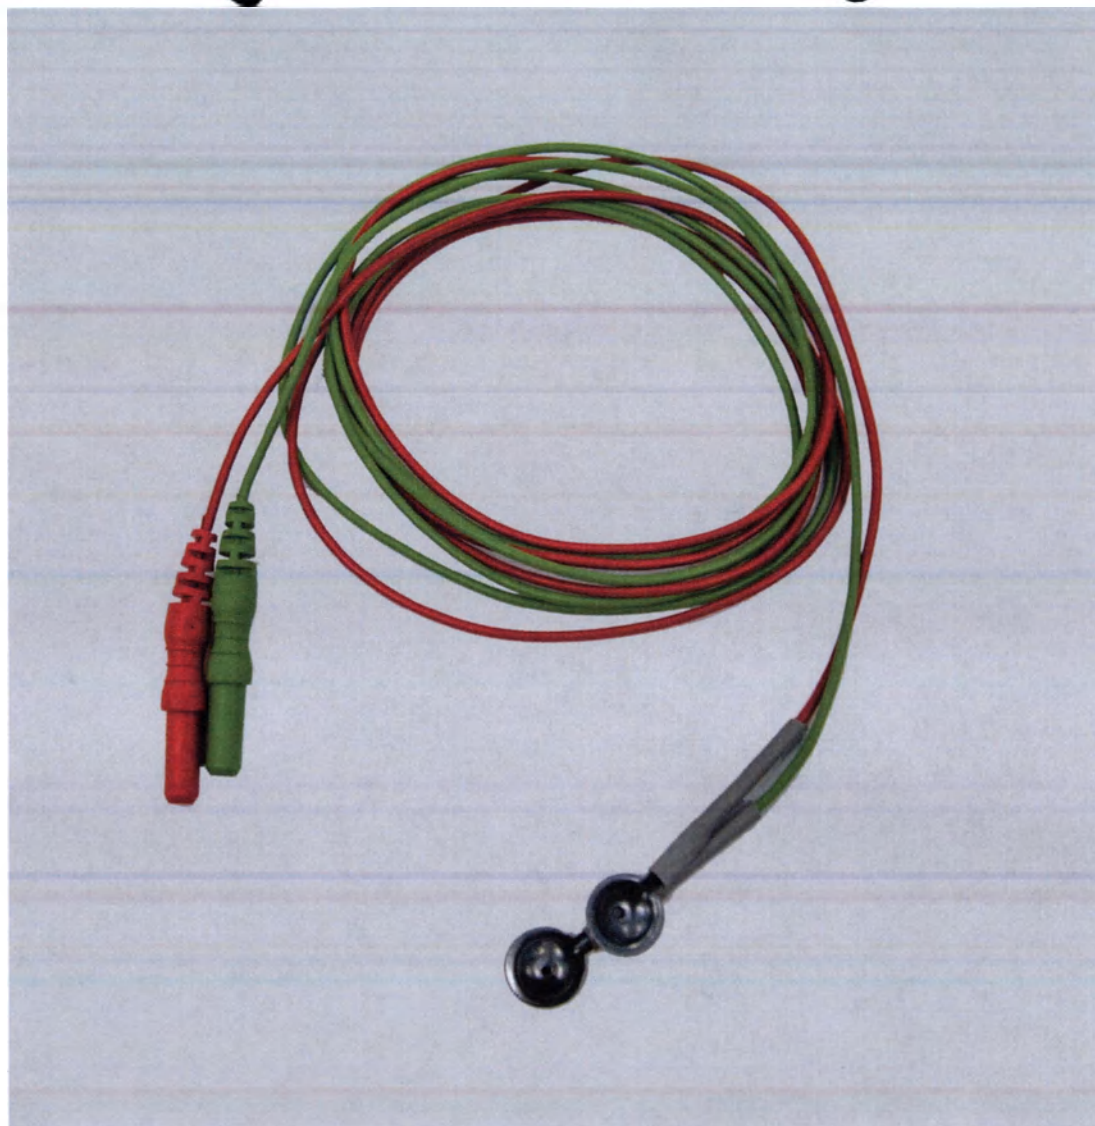

Электрод ВП чашечковый с кабелем отведения «ЭВП» (для регистрации ЭОГ), NS990106.027-01.10



Система электродная электроэнцефалографическая MCSCap-NC21 в составе:

шлем MCSCap-EC21 с предустановленными тонкими электродами и общим разъемом, система отведений 10-20 (1 шт.); ушной адаптер MCSCap-A для крепления электродов (2 шт.); гель электродный контактный высокопроводящий «Унимакс», 250 мл (1 уп.); шприц, 20 мл (1 шт.); игла с тупым наконечником, 1,5×20 мм (1 шт.), руководство по эксплуатации «Шлем электроэнцефалографический MCSCap-EC21» (1 шт.) (ООО «Медицинские компьютерные системы», Россия)




Блок питания




Моторизованная поворотная сетевая IP-видеокамера с руководством по эксплуатации производителя



Фоностимулятор, гарнитура компьютерная (Defender, Китай)

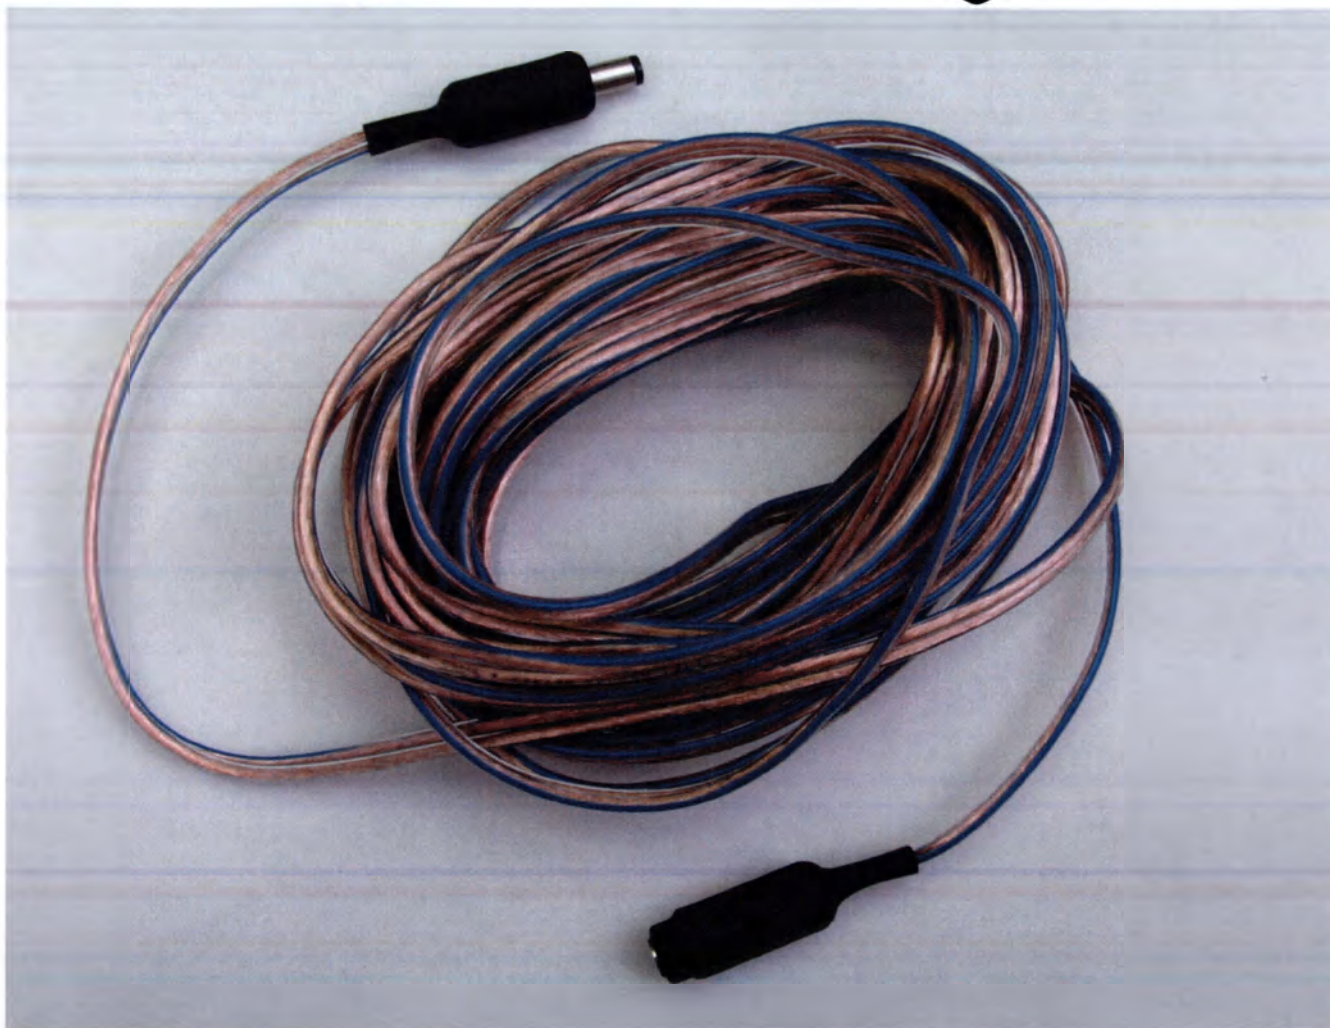


Удлинитель, NS015103.035

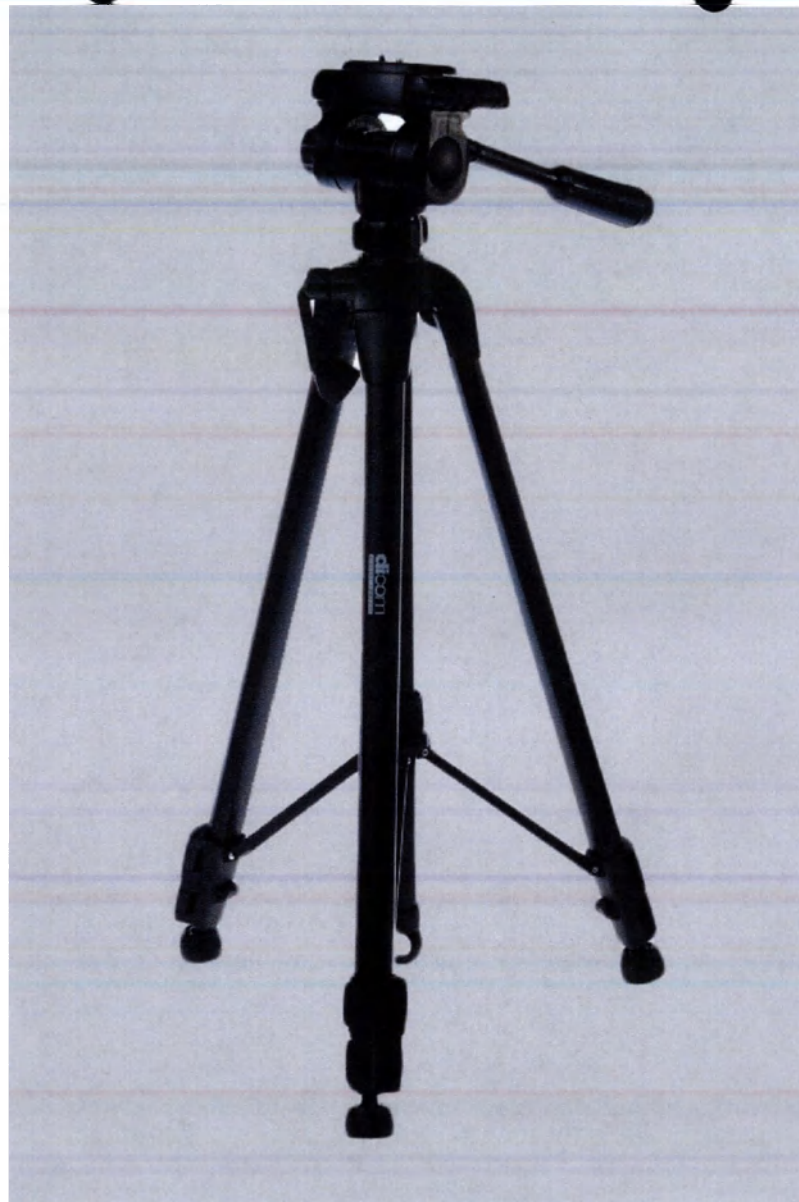

Штатив для видеокамеры



**Паста электродная контактная высокопроводящая адгезивная для ЭЭГ и ЭМГ исследований «Унипаста»
(ООО «Гельтек-Медика», Россия)**

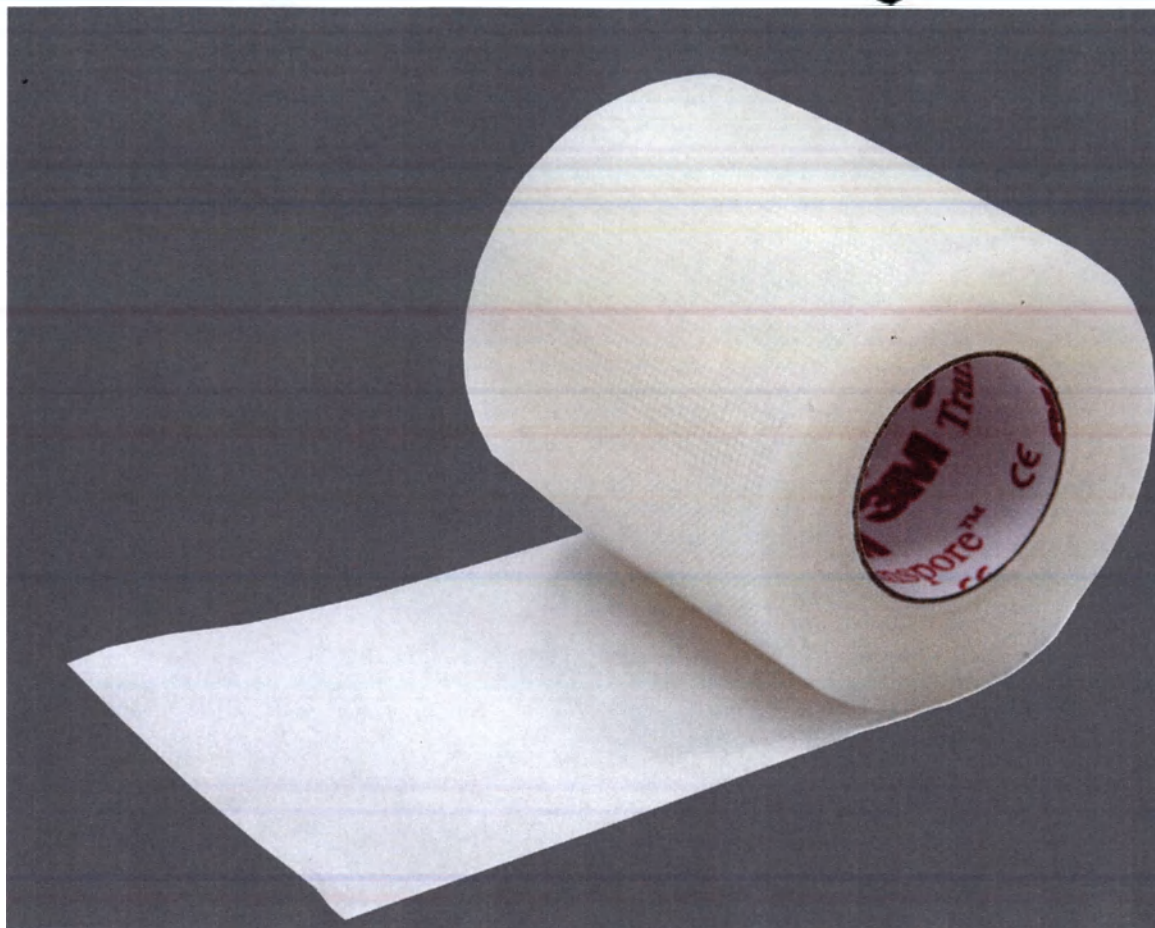

Медицинский пластырь «Транспор» (3M Company, 3M Health Care, США)




**Канюля назальная кислородная APEXMED с трубкой 2 м
(Zhejiang Baite Medical Appliances Co, Ltd., Китай)**




Датчик пульсоксиметрический SpO₂ взрослый (ООО «Микролюкс», Россия)




Датчик пульсоксиметрический SpO_2 детский (ООО «Микролюкс», Россия)

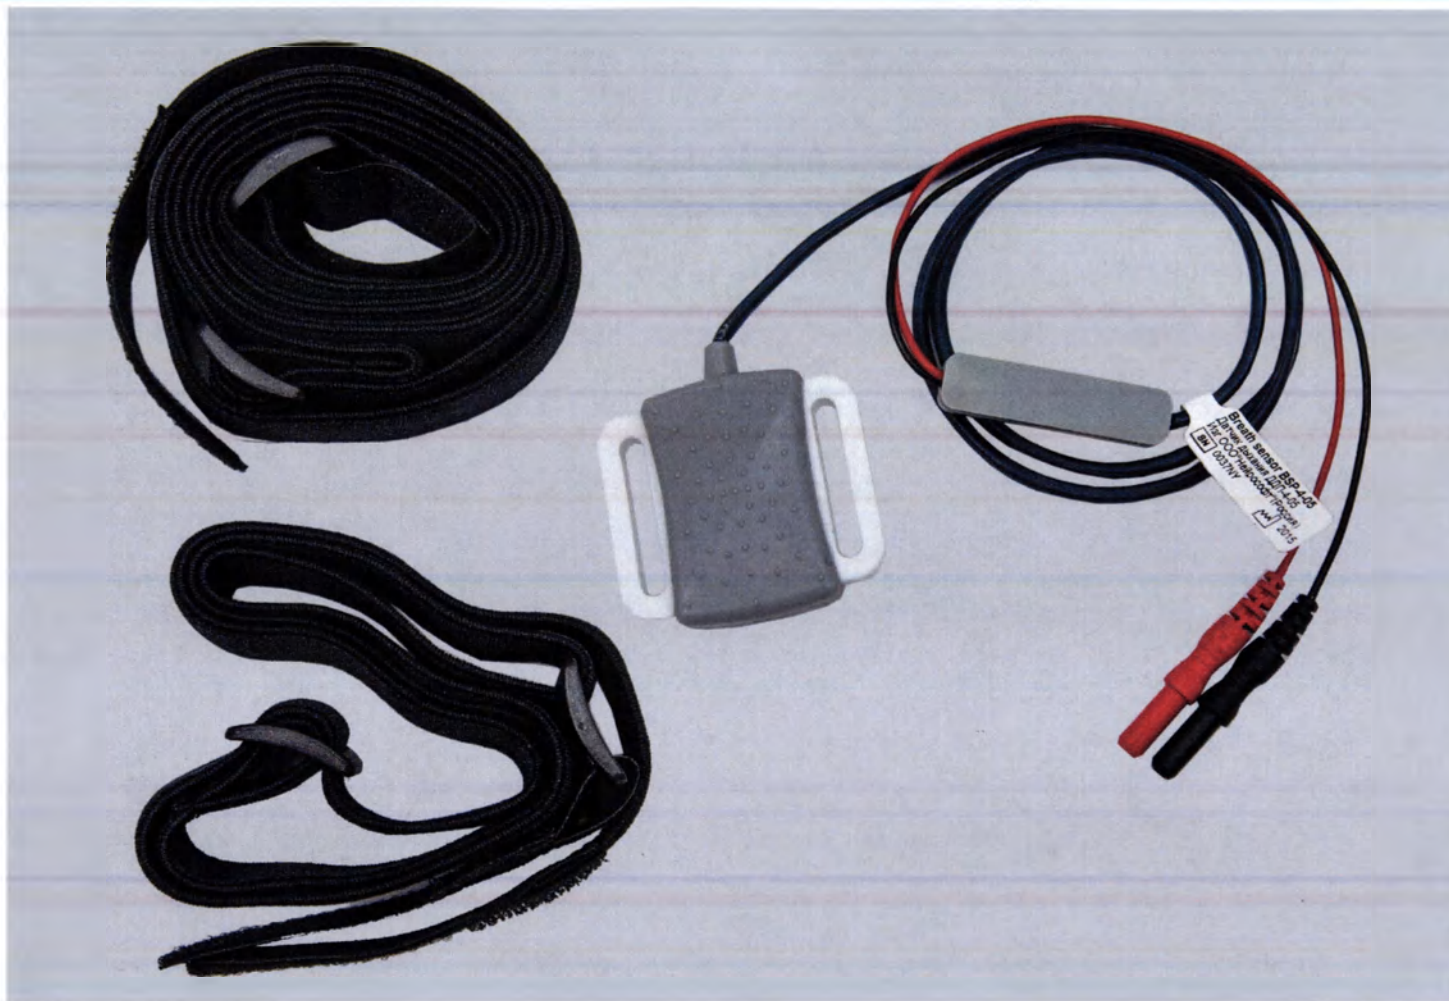


**Датчик экскурсии грудной клетки и брюшной полости NS990998.020-02 в составе:
датчик дыхания пьезокерамический «ДДП-4-05» с комплектом ремней**

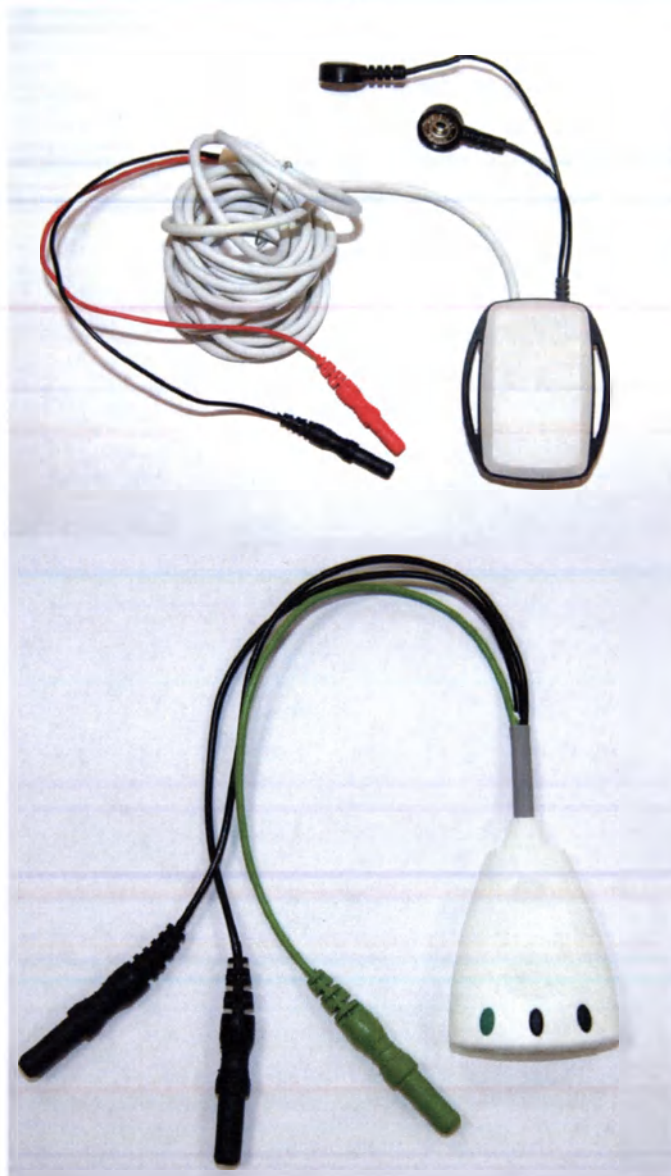

Датчик индукционной экскурсии грудной клетки и брюшной стенки «ДИ-1-05» NS990998.036 в составе:
объединитель NS990103.062, лента фиксирующая NS990211.008, фиксатор NS990213.001, индукционный ремень
(производитель China Qingdao Bright Medical Manufacturing Co., Ltd., Китай), блок электронного датчика NS990356.009

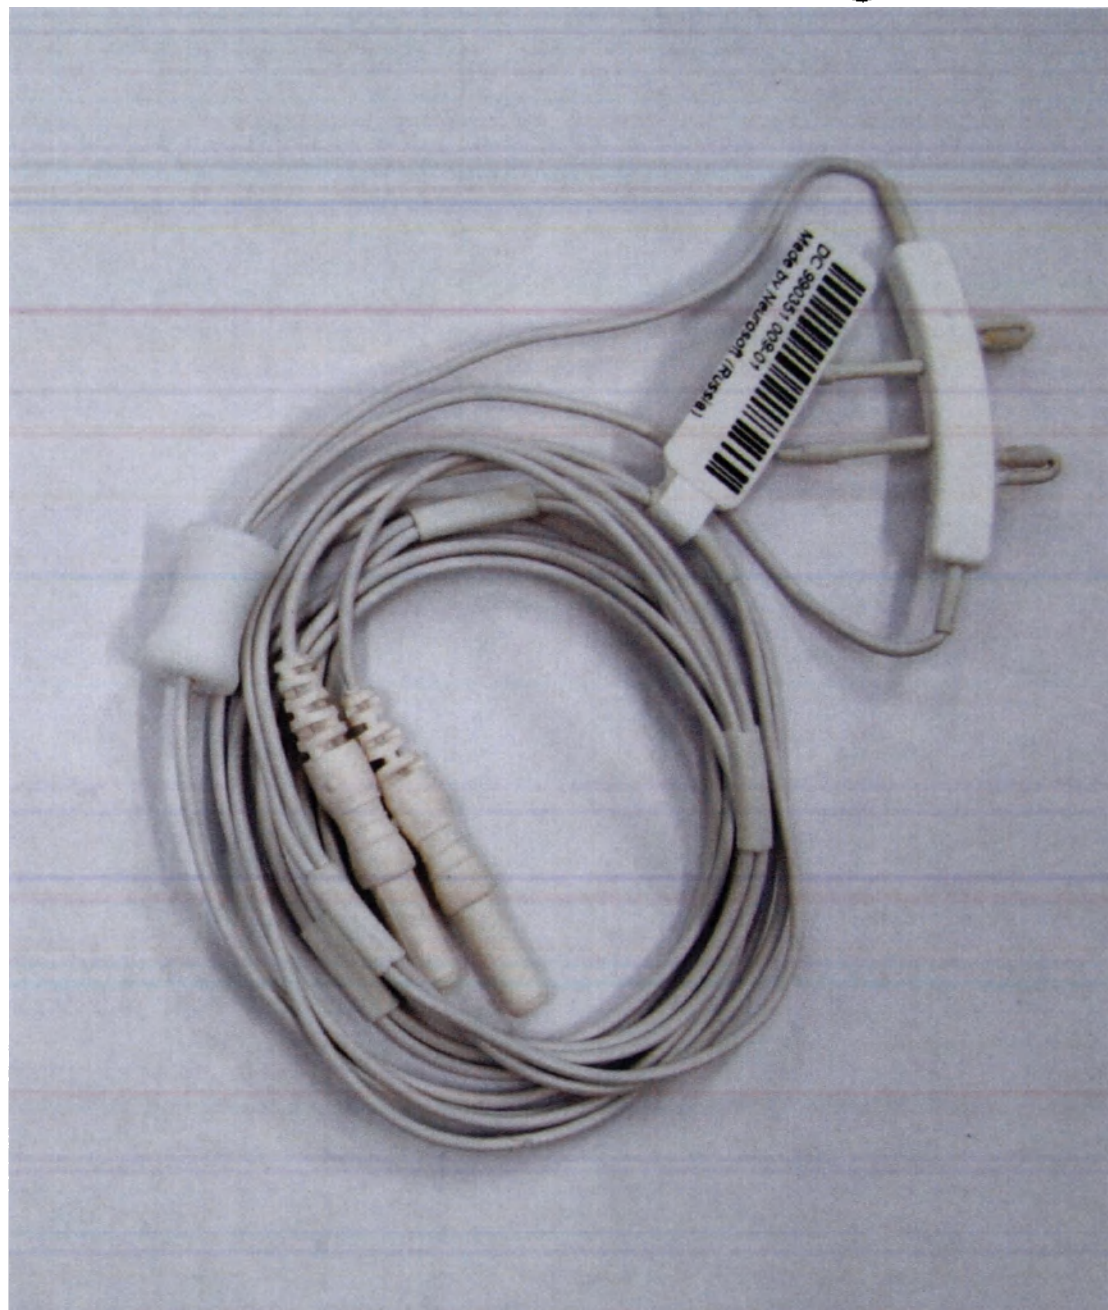

Датчик дыхания ДДТ-8/В-10 (детский) NS990351.009-01

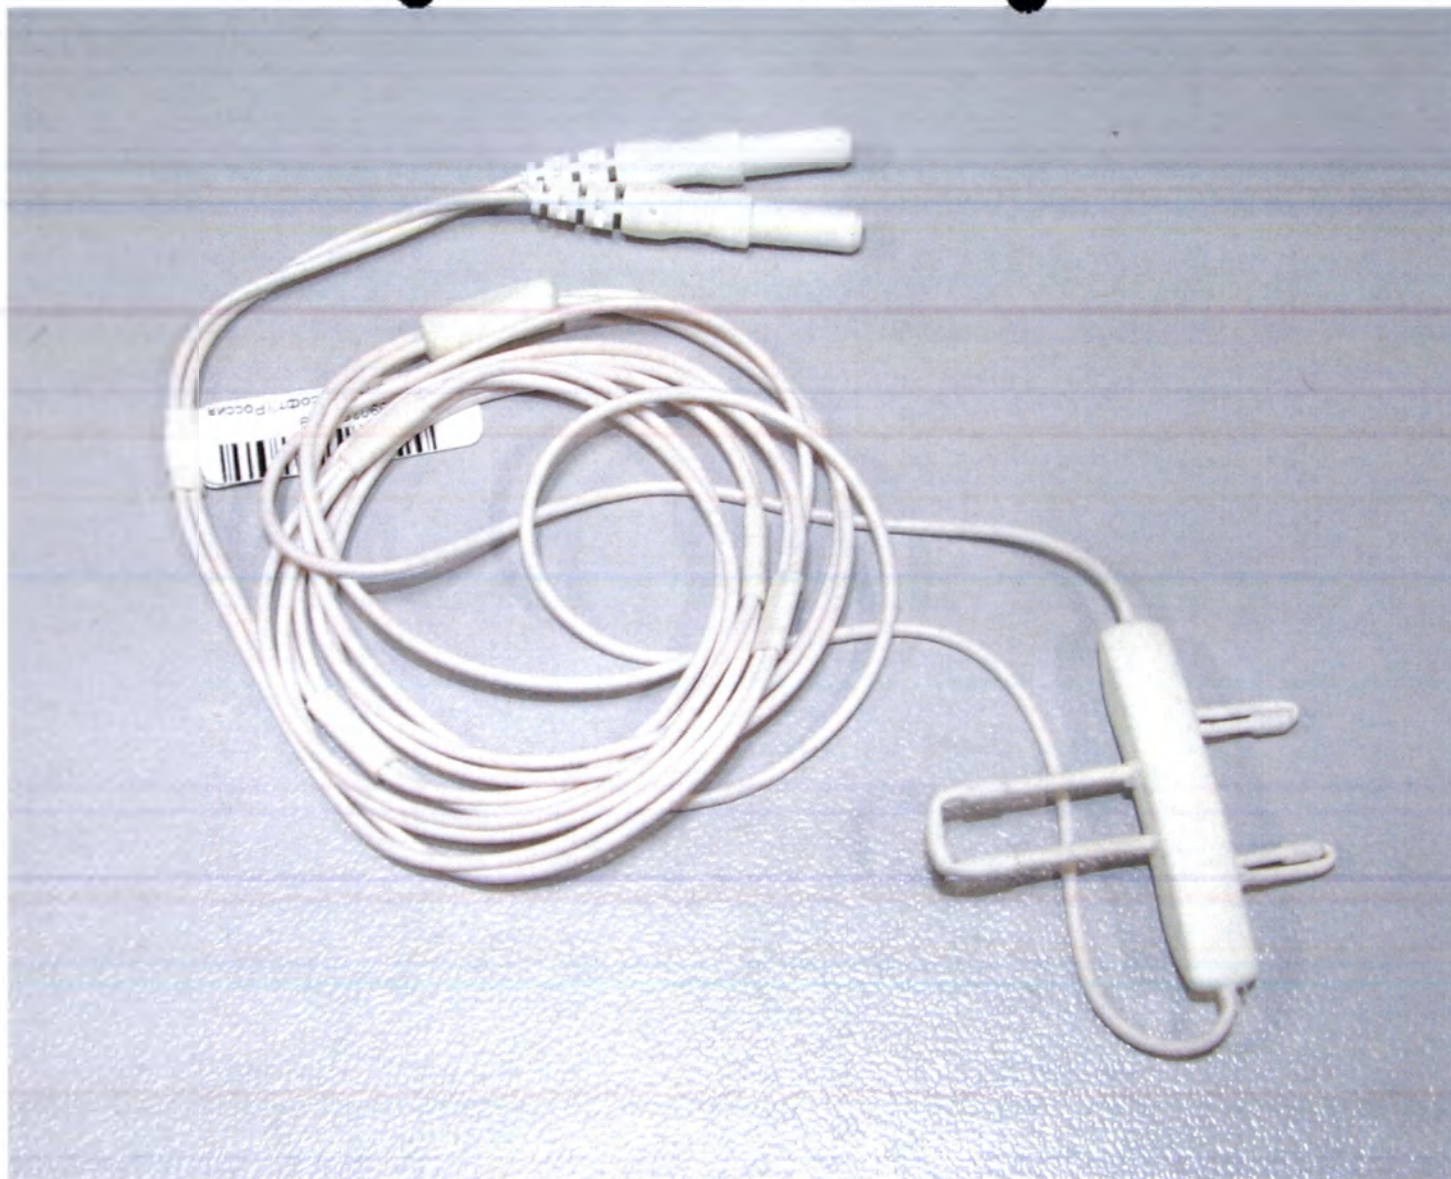


Датчик дыхания ДДТ-8/В-10 (взрослый) NS990351.009



Датчик пульсоксиметрический SpO₂ одноразовый Nellcor (Covidien Llc., США)



Датчик храпа «ДХ-1-08», NS990356.006-01

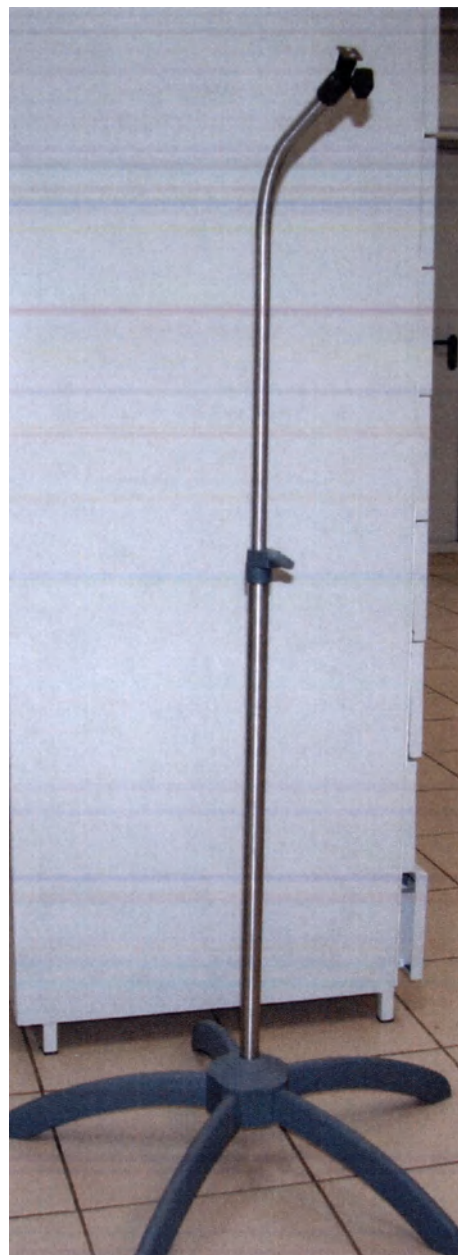

Стойка напольная CH-7 NS016998.013




Кронштейн NS006200.002




Блок светодиодного фотостимулятора USB «ФС-2» NS066201.002




**Маршрутизатор, в комплекте с руководством по эксплуатации изготовления
Keenetic Lite 3,(ZyXEL Communications Corp, Китай)**

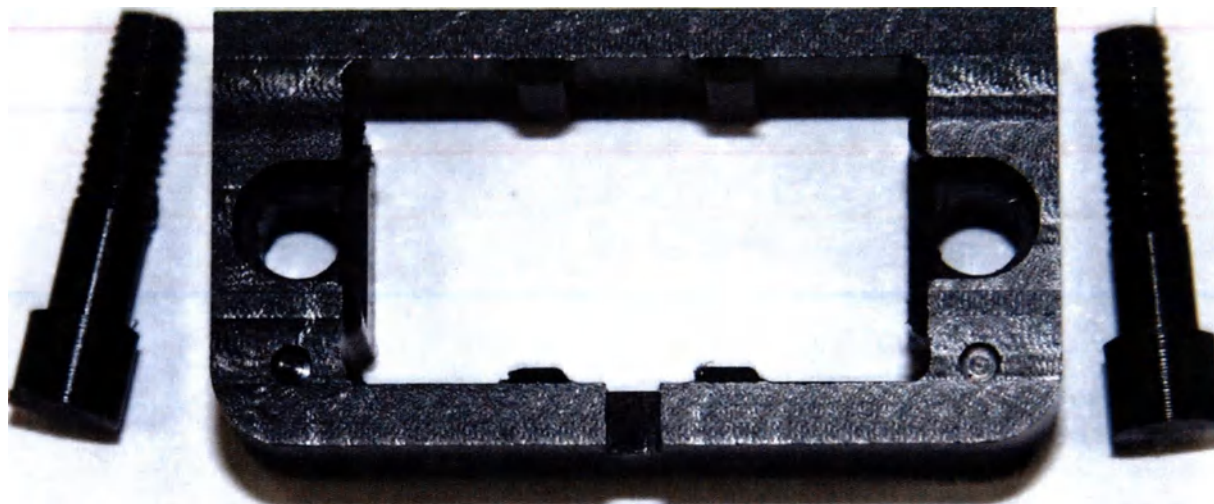

Комплект держателя одноразового датчика NS053998.004

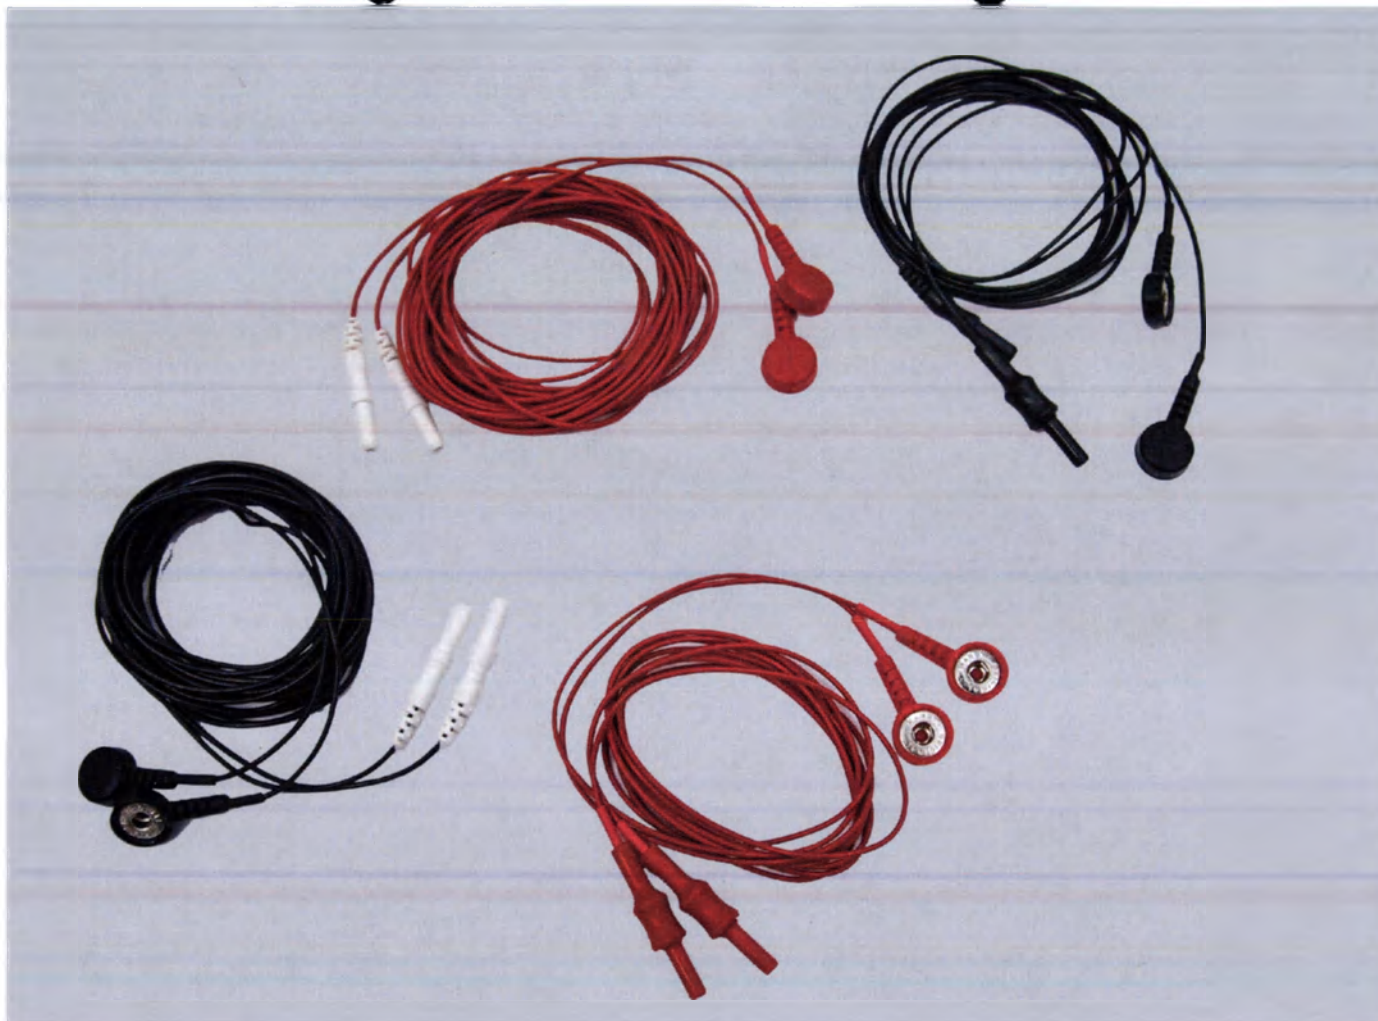

**Кабель для подключения одноразовых электродов с коннектором «кнопка», разъем «touch-proff»:
красный, 1.5 м (NS990103.037-03.15); черный, 1.5 м (NS990103.037-04.15); красный, 1 м (NS990103.037-03.10);
черный, 1 м(NS990103.037-04.10).**

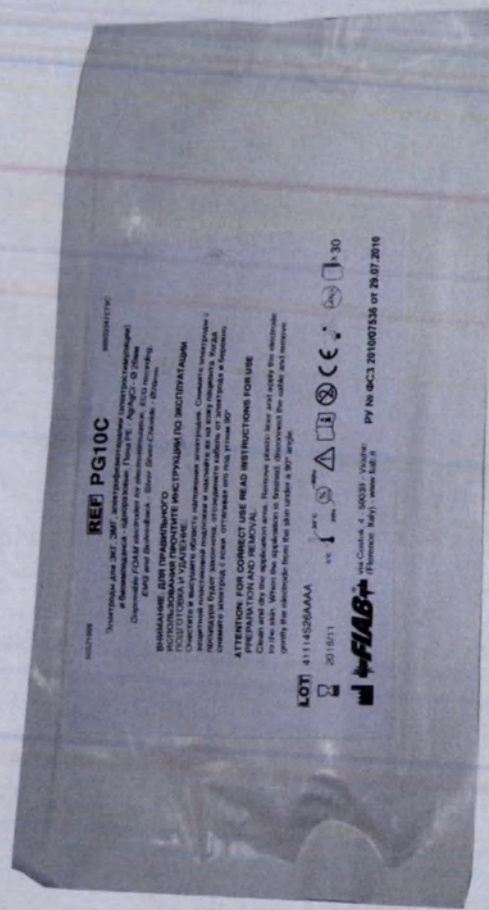

Электрод ЭКГ одноразовый PG 10C (FIAB, Италия)



Кабель сетевой для подключения IP-камеры. Патч-корд UTP (длина не менее 5 м)

ПРОШНУРОВАНО
ПРОНУМЕРОВАНО
ИСКРЕДНО ПЕЧАТЮ
ЛИСТАХ
ПРЕЗИДЕНТ ООО «НЕЙРОСОФТ»
А. Б. ШУБИН

(Handwritten signature)