

КОНТРОЛЬ МОЧИ-ВИТАЛ-**REF B 37.01**
ПАТОЛОГИЯ

КОМПЛЕКТ 1

Набор контрольных катетров (мочевые для биохимического анализа мочи) (патологический уровень)

в упаковке

ТУ 24.30.33-86.5.44444444-2011

RU

LOT серия: 05

Дата выпуска: 01.2017

Годовая: 01.2018

Только для биохимического анализа

UK URINE CONTROL-VITAL

PATHOLOGICAL LEVEL: Path

01.2018

Упаковка: 10 шт.

01

04

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01



01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01


01

01







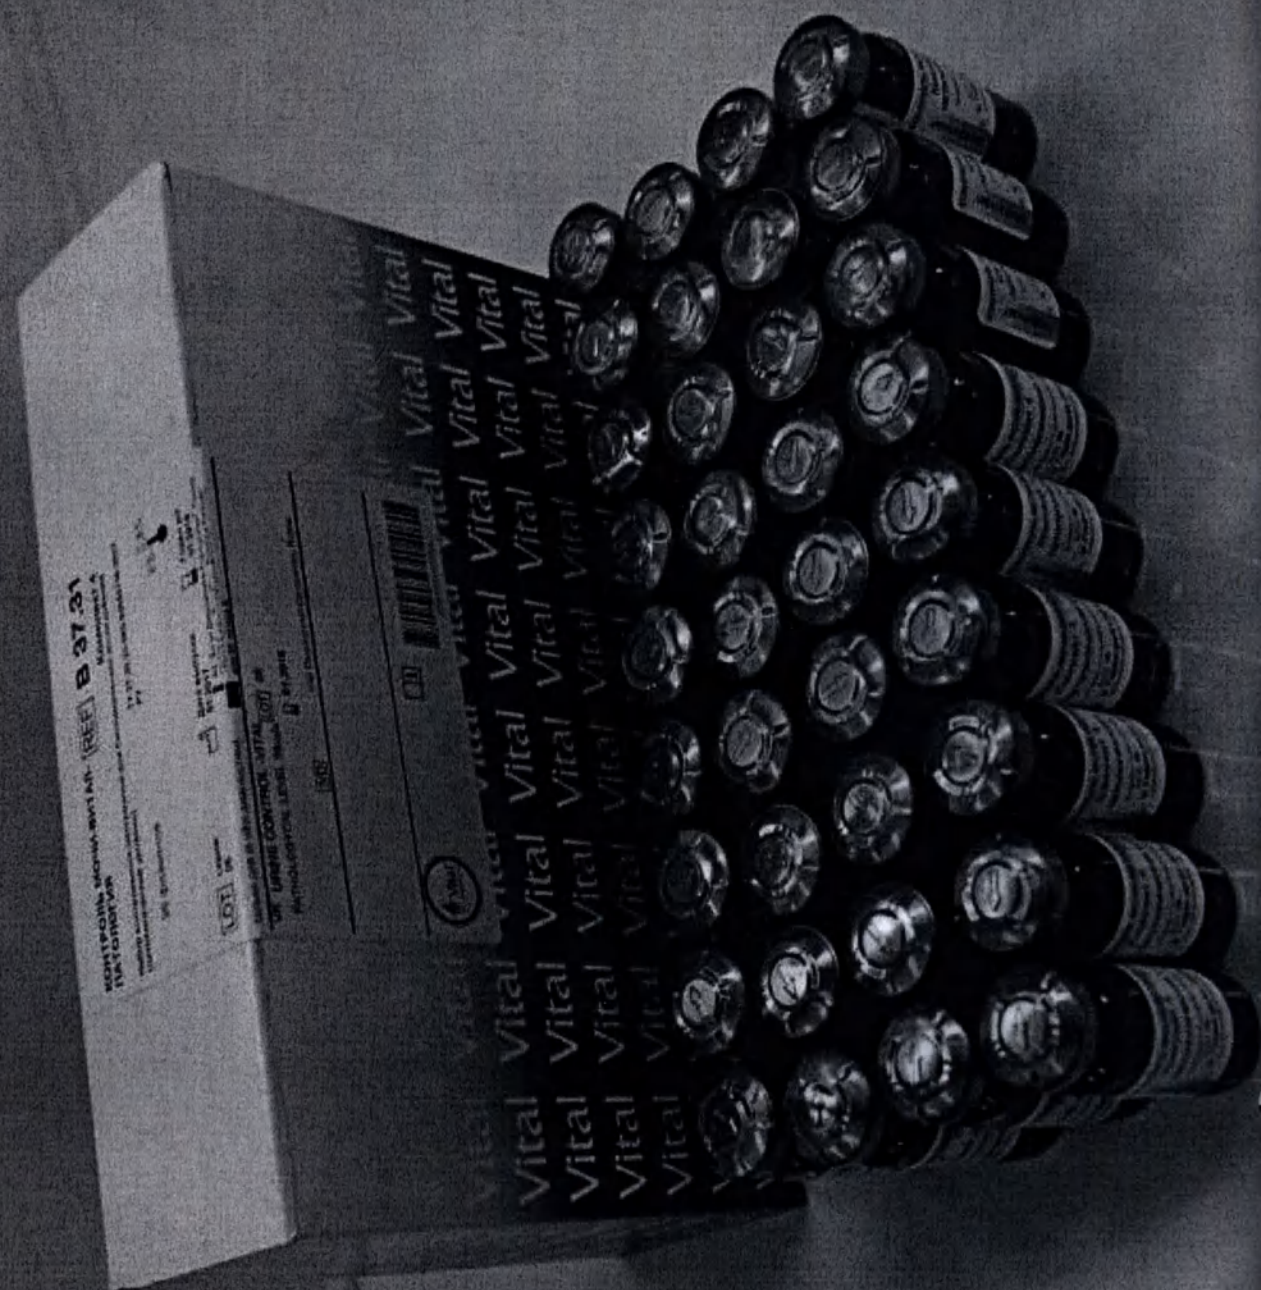

и скреплено печатью

