


КОПИЯ ВЕРНА
Директор
Е.Н.Соловьев - ЭНГБЕРТОВ

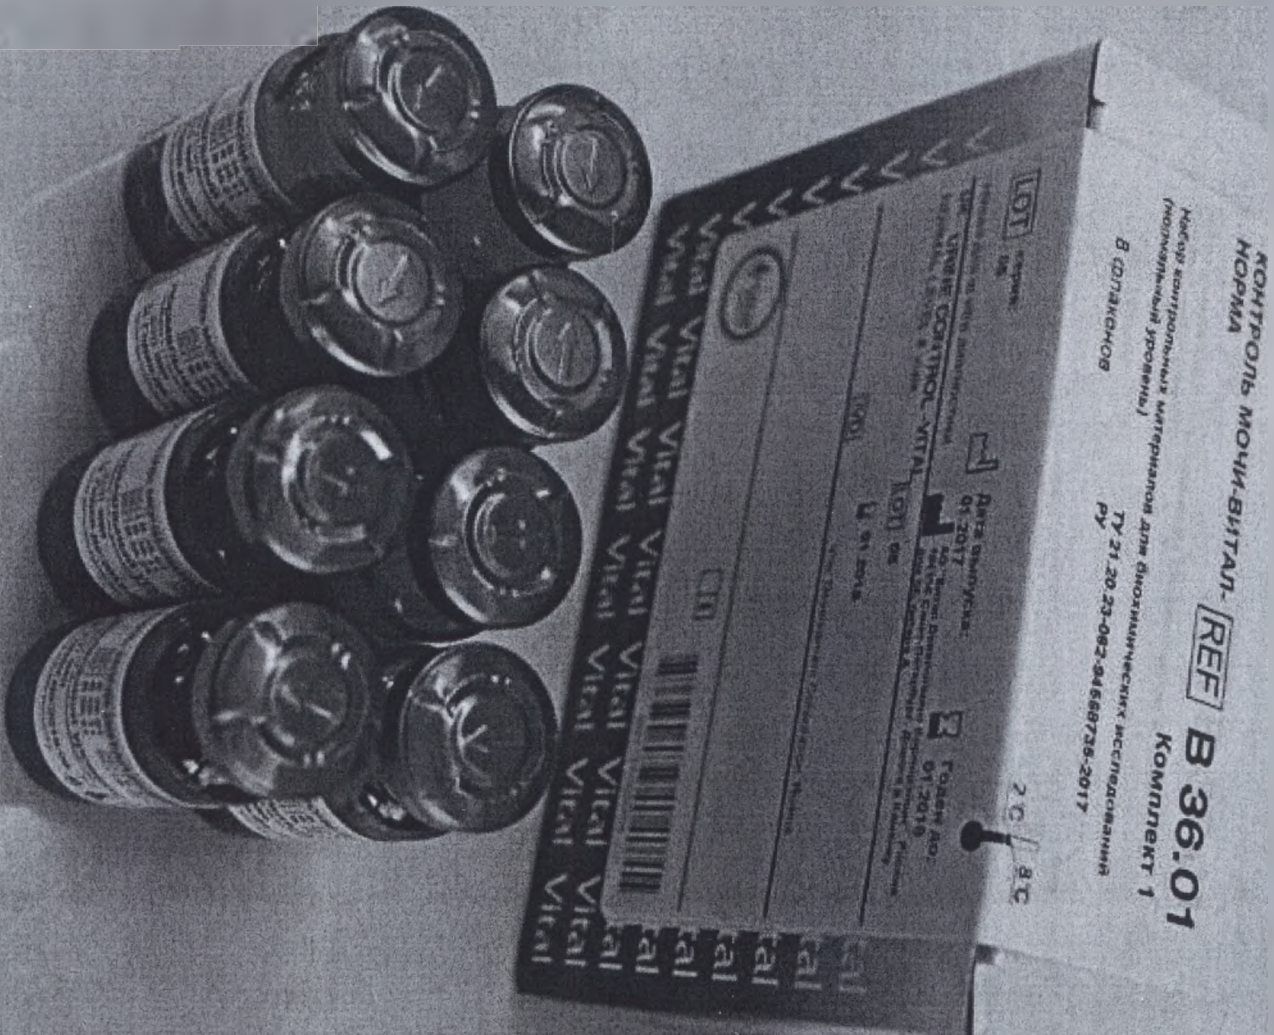

КОМПЛЕКТ МОНИ ВИТАЛ
КОМПА

REF В 36.11

Комплект 2

Набор контрольных материалов для биохимических исследований
(оптимальный уровень)

12 флаконов

ТУ 21.20 23-062-84588735-2017
ру

2°C 8°C

LOT серия: 04



Дата выпуска: 01.2017



Годен до: 01.2018

Витал для биохимических исследований


АО "Витал Дистрибуция Фармацевтика", Россия
125050 Санкт-Петербург, Витал и Компания, ул. 15, корпус 2

TIME CONTROL VITAL
OPTIMAL LEVEL 15 mmol/L

LOT 04

01.2017

Витал Дистрибуция Фармацевтика, Россия

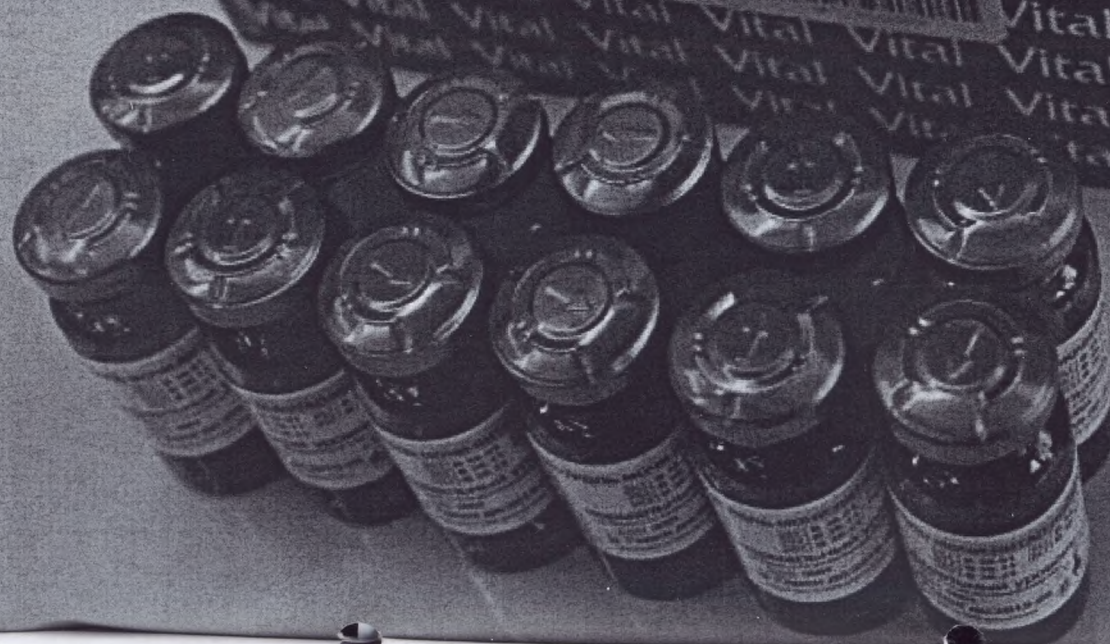

КОНТРОЛЬ МОЧИ-ВИТАЛ-
НОРМА REF В 36.21

Комплект 3
набор стандартных материалов для биохимических исследований
(наименование урины)
24 флакона

ТУ 21.20.23-062-94568735-2017
РУ

LOT серия:
05




Дата выпуска:
01.2017

2°C 8°C



Годен до:
01.2018

АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
184350 Санкт-Петербург, Девята в Кавену
КПП 55, титрук в

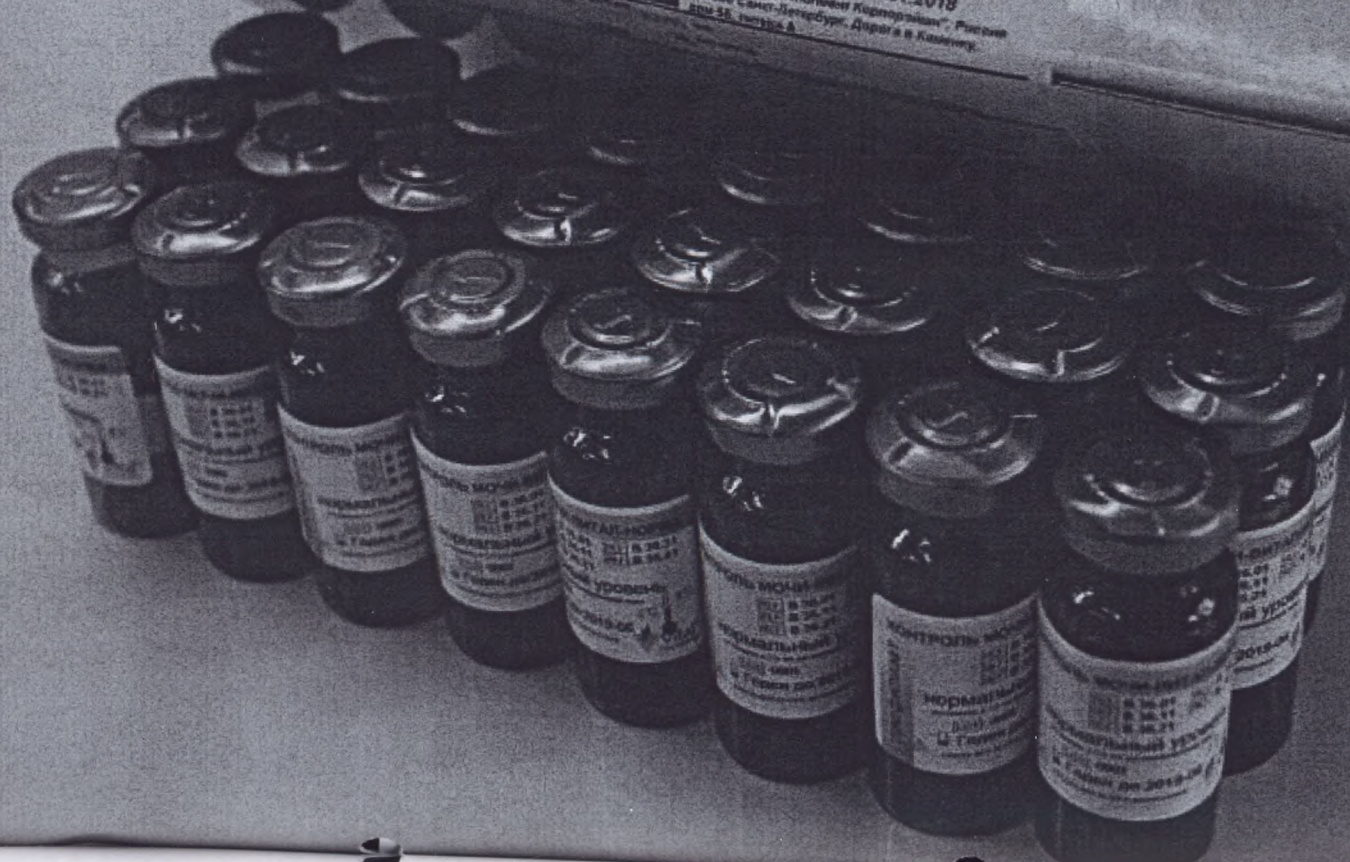

КОНТРОЛЬ МОЧИ-ВИТАЛ-
НОРМА REF В 36.21

Комплект 3
Набор контрольных материалов для биохимических исследований
(искусственный уровень)
24 флакона

ТУ 21.20.23-062-9458735-2017
РУ

20/8C

LOT серия: 05

Дата выпуска: 01.2017

Годен до: 01.2018
АО "Витро Биомедицина Инновации", Россия
184336 Санкт-Петербург, Дегляк в Клинику
Витро-Б

только для in vitro диагностики



-1-

КОНТРОЛЬ МОЧИ-ВИТАЛ-
НОРМА REF В 36.31

Комплект 4

Нисер контрольные материалы для биохимических исследований
(испытательный уровень)
36 флаконов

ТУ 21.20.23-002-9458738-2017
РУ

20 50

LOT серия 08

Дата выпуска:
01.2017

Годен до:
01.2018

АО "Всероссийский центр
качества стандартизации, исследований и
образования"





Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью

Всего 5 листа(ов)



Схолль-Энгберте Е.Н.