






ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, вентилируемая, односекционная, однократного применения, стерильная, тип 1

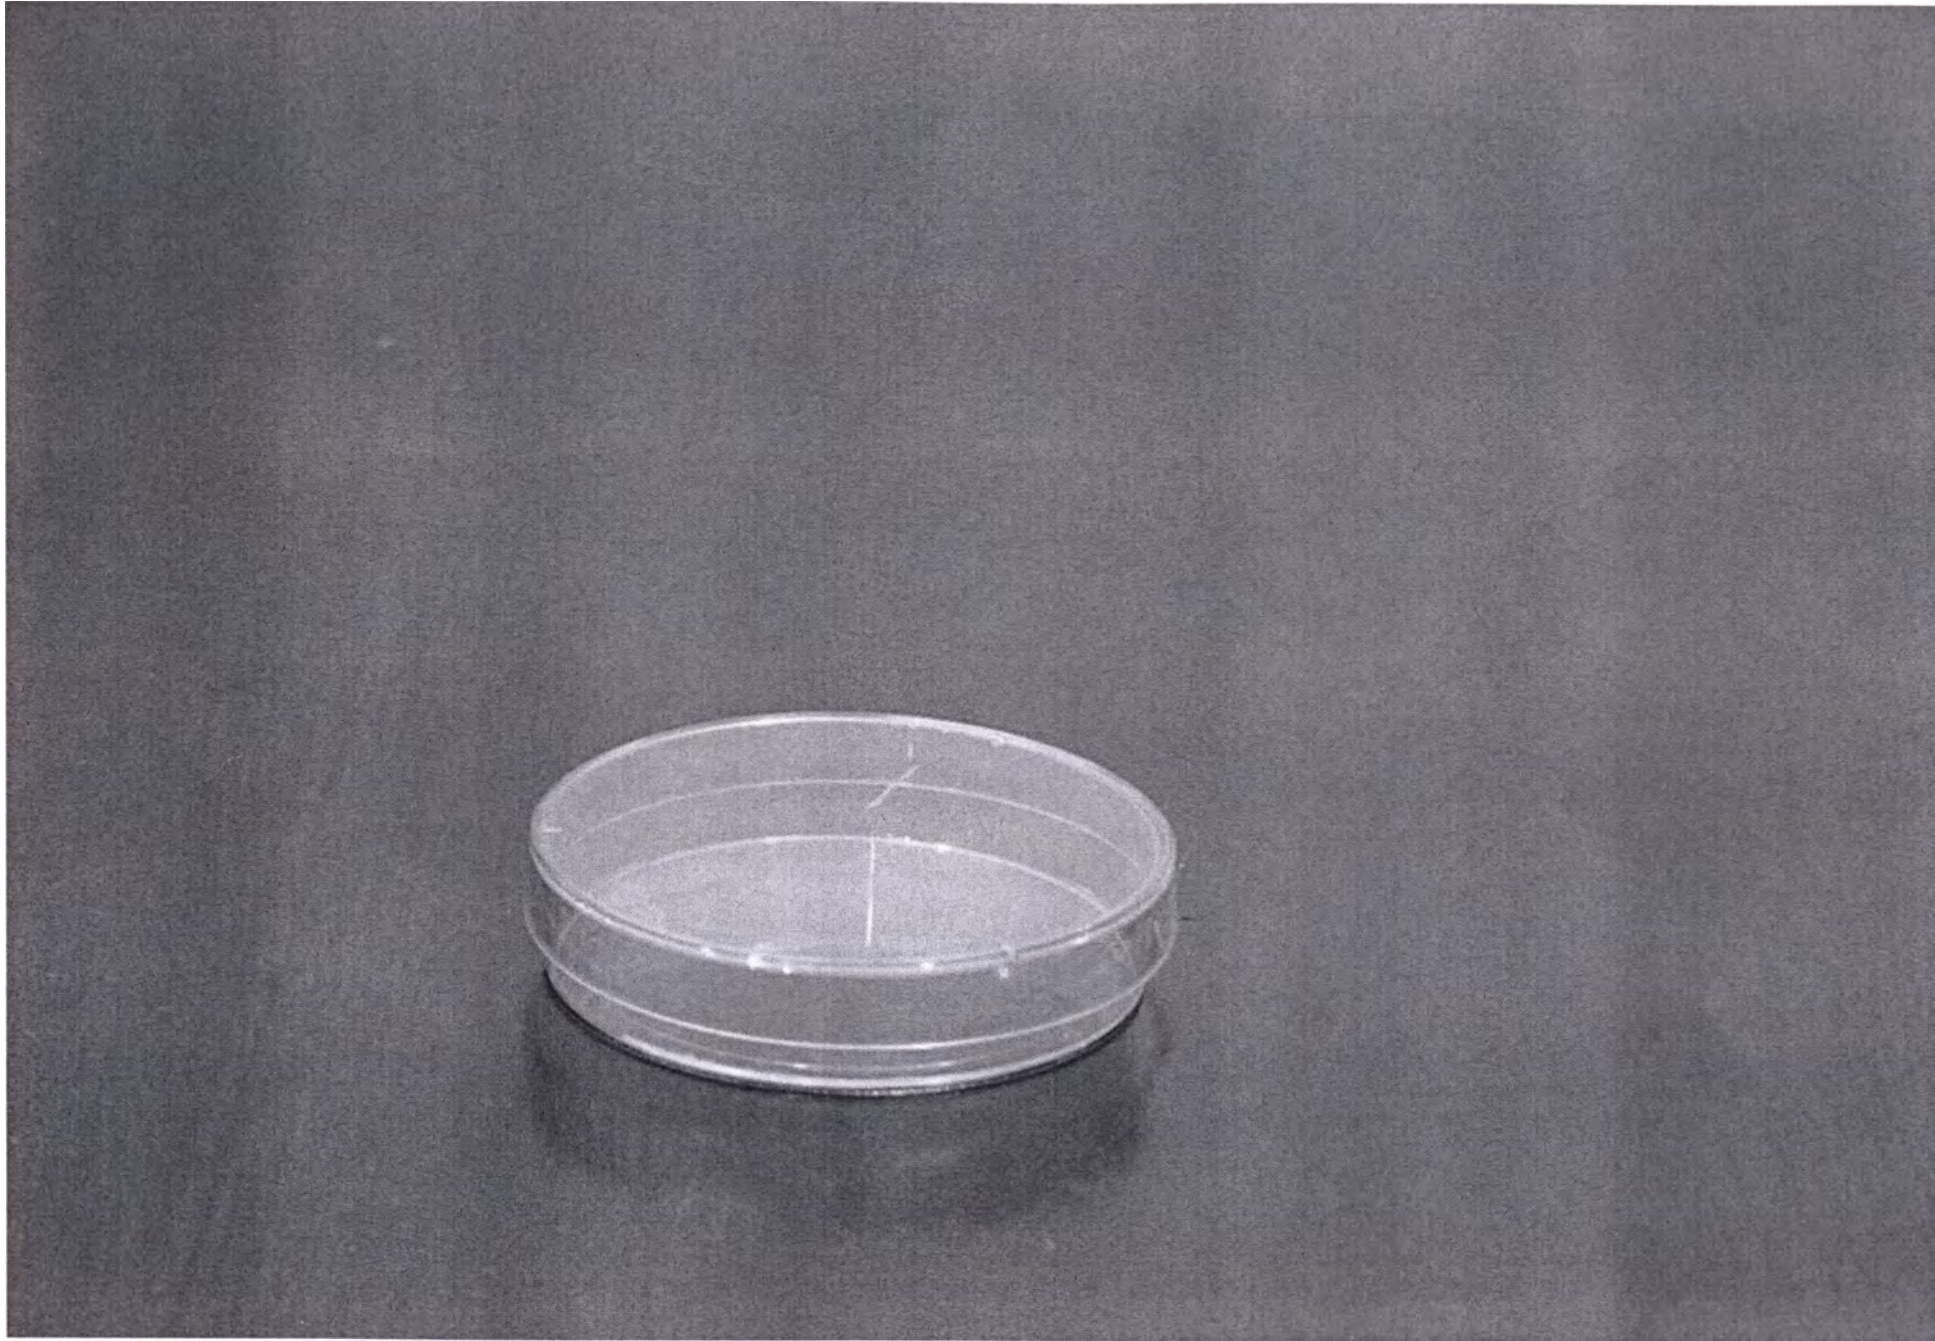

Чашка Петри полимерная 60 x 14,1 неvented, односекционная, однократного применения, стерильная.

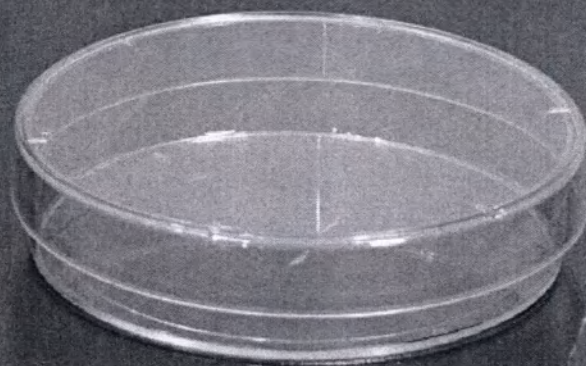



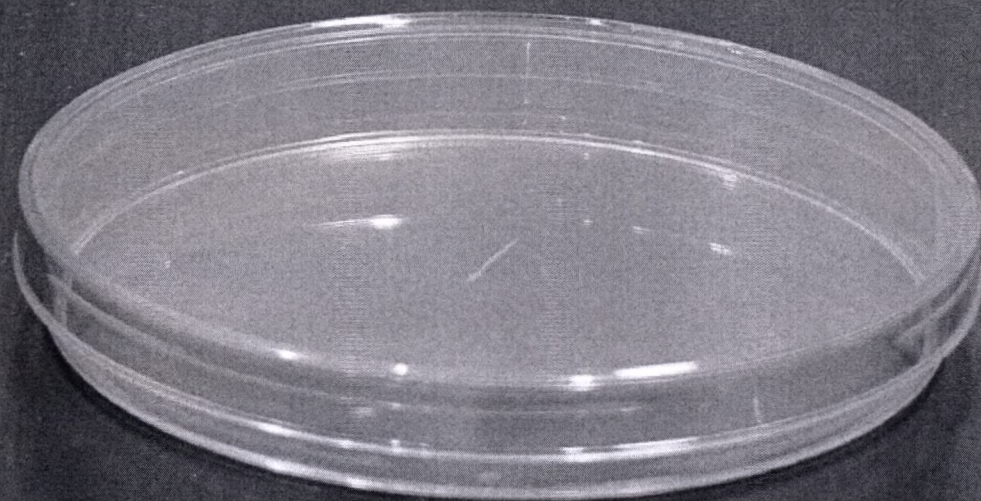


Чашка Петри полимерная 90 x 14 неvented, односторонняя, однократного применения, стерильная.







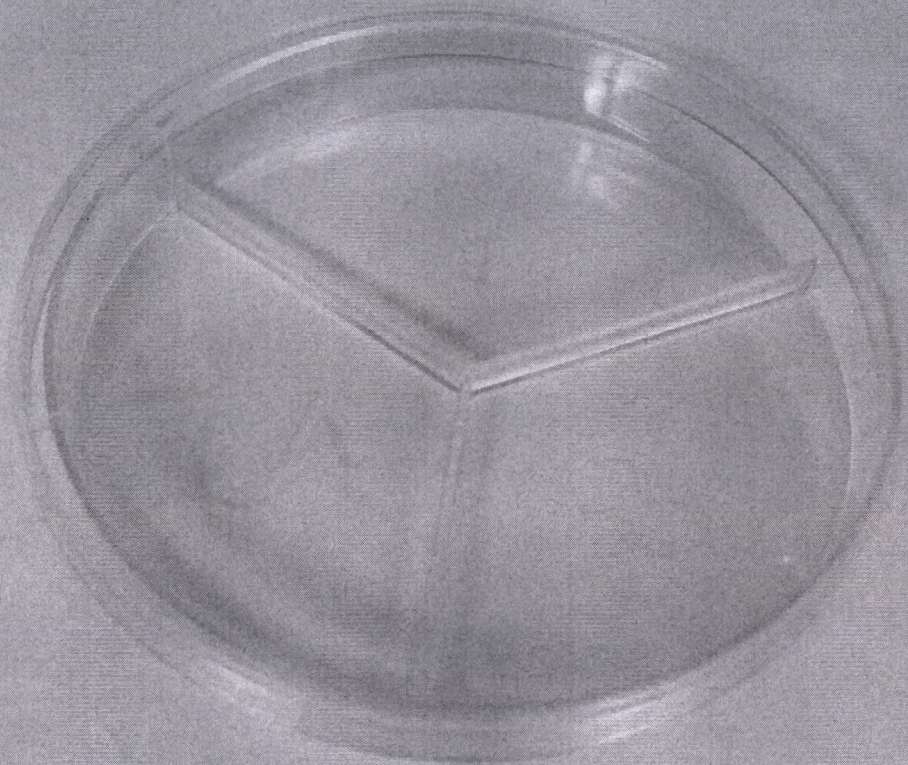

Чашка Петри полимерная 90х16 65 вентилируемая, 3хсекционная, однократного применения, стерильная, тип 1



скреплено печатью - 10 лист(ов)

Руководитель организации



Чашка Петри полимерная 60 x 14,1 неvented, односекционная, однократного применения, стерильная
ТУ 22.29.29-001-00937445-2016
ЧП-603

Комплектация:
- Чашка Петри полимерная 60 x 14,1 неvented, односекционная, однократного применения, стерильная. (см. количество)
- инструкция по применению - 1 шт. на коробку.

Количество: 5 шт. ☐ 10 шт. ☐ 20 шт. ☐

Назначение: см инструкцию

IVD
медицинское изделие для диагностики *in vitro*

Рег. у.д. № _____ от _____

ООО «ПЛАСТИЛАБ ИНДУСТРИЯ»
Адрес: 187021, Ленинградская обл., район Тосненский, д. Федоровское, ул. Малая д. 6А
Тел. 8(812) 640-57-40 доб. 206

Основные размеры чашки Петри: Высота - (13,1±1) мм
Наружный диаметр чашки - D= (54,5±1) мм
Внутренний диаметр чашки (справочный) - 53,2
Цвет: бесцветные.
Коэффициент светопропускания - не менее 90%.
Вместимость, мл - 28. Масса, г - 5,3±0,6
Чашки Петри поставляются стерильными
Чашка Петри стойка к действию растворов кислот.
Чашка Петри выдерживает температуру эксплуатации от минус 10°С до 60°С

Материал: полистирол марки «STYRON 678E» фирмы «STYRON LLC», Швейцария.	№ партии: 17.0081-3.		
Стерильно EO окисью этилена	От 02.2017	Срок годности: Не менее 5 лет	Дата стерилизации: 02.2017

Гарантийный срок годности - 5 лет.

Для однократного использования.
Повторная стерилизация не допускается.

Условия хранения:
условия хранения 2 по ГОСТ 15150-69.
Избегать воздействия прямых солнечных лучей.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ применять ЧАШКИ ПЕТРИ в случае нарушения целостности упаковки и по истечении срока годности.

Утилизация: Использованные изделия утилизируются складирова в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в установленном порядке в соответствии с требованием СанПиН 2.1.7.2790-2010

Инструкция по применению прилагается

Изделие в упаковке. Чашка Петри полимерная 60 x 14,1 неvented, односекционная, однократного применения, стерильная

Чашка Петри полимерная 60 x 14,1 вентилируемая, однократного применения, стерильная, тип 1
 ГОСТ 22.29.29-001-00937445-2016
 ЦП-601

Чашка Петри полимерная 60 x 14,1 вентилируемая, однократного применения, стерильная, тип 1 (см. колонку "назначение по применению") - 1 шт. на коробку

Масса нетто: 5 шт. ☐ 10 шт. ☒ 20 шт. ☐

Медицинское изделие для диагностики in vitro

Результ. № от

ООО «ПЛАСТИЛАБ ИНДУСТРИЯ»
 Адрес: 187021, Ленинградская обл., район Тосненский, д. Федоровское, М-1
 Тел: 8(812) 640-57-40 доб. 206

Характеристики чашки Петри: Высота - (13,1±1) мм
 Наружный диаметр чашки - D - (54,5±1) мм
 Внутренний диаметр чашки (справочный) - 53,2 мм

Цвет: бесцветные

Коэффициент светопропускания - не менее 90%

Вместимость, мл - 28 Масса, г. - 5,3±0,6

Чашки Петри поставляются стерильными

Чашка Петри стойка к действию растворов кислот

Чашка Петри выдерживает температуру эксплуатации от минус 10°С до 60°С

Материал: полистирол марки «STYRON 678E» фирмы «STYRON LLC», Швейцария	№ партии: 001. От 22.06.2016	
Стерильно	Срок годности: Не менее 5 лет	Дата стерилизации: 22.06.2016

Гарантийный срок годности - 5 лет.

Для однократного использования.

Повторная стерилизация не допускается.

Условия хранения:


- Ус. Условия хранения 2 по ГОСТ 15150-69.
- Уд. Избегать воздействия прямых солнечных лучей.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ применять ЧАШКИ ПЕТРИ в случае нарушения целостности упаковки и по истечении срока годности.

Утилизация: Использованные изделия утилизируются складировав в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируются в установленном порядке в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-2010

Инструкция по применению прилагается

Изделие в упаковке. Чашка Петри полимерная 60 x 14,1 вентилируемая, однократного применения, стерильная, тип 1.

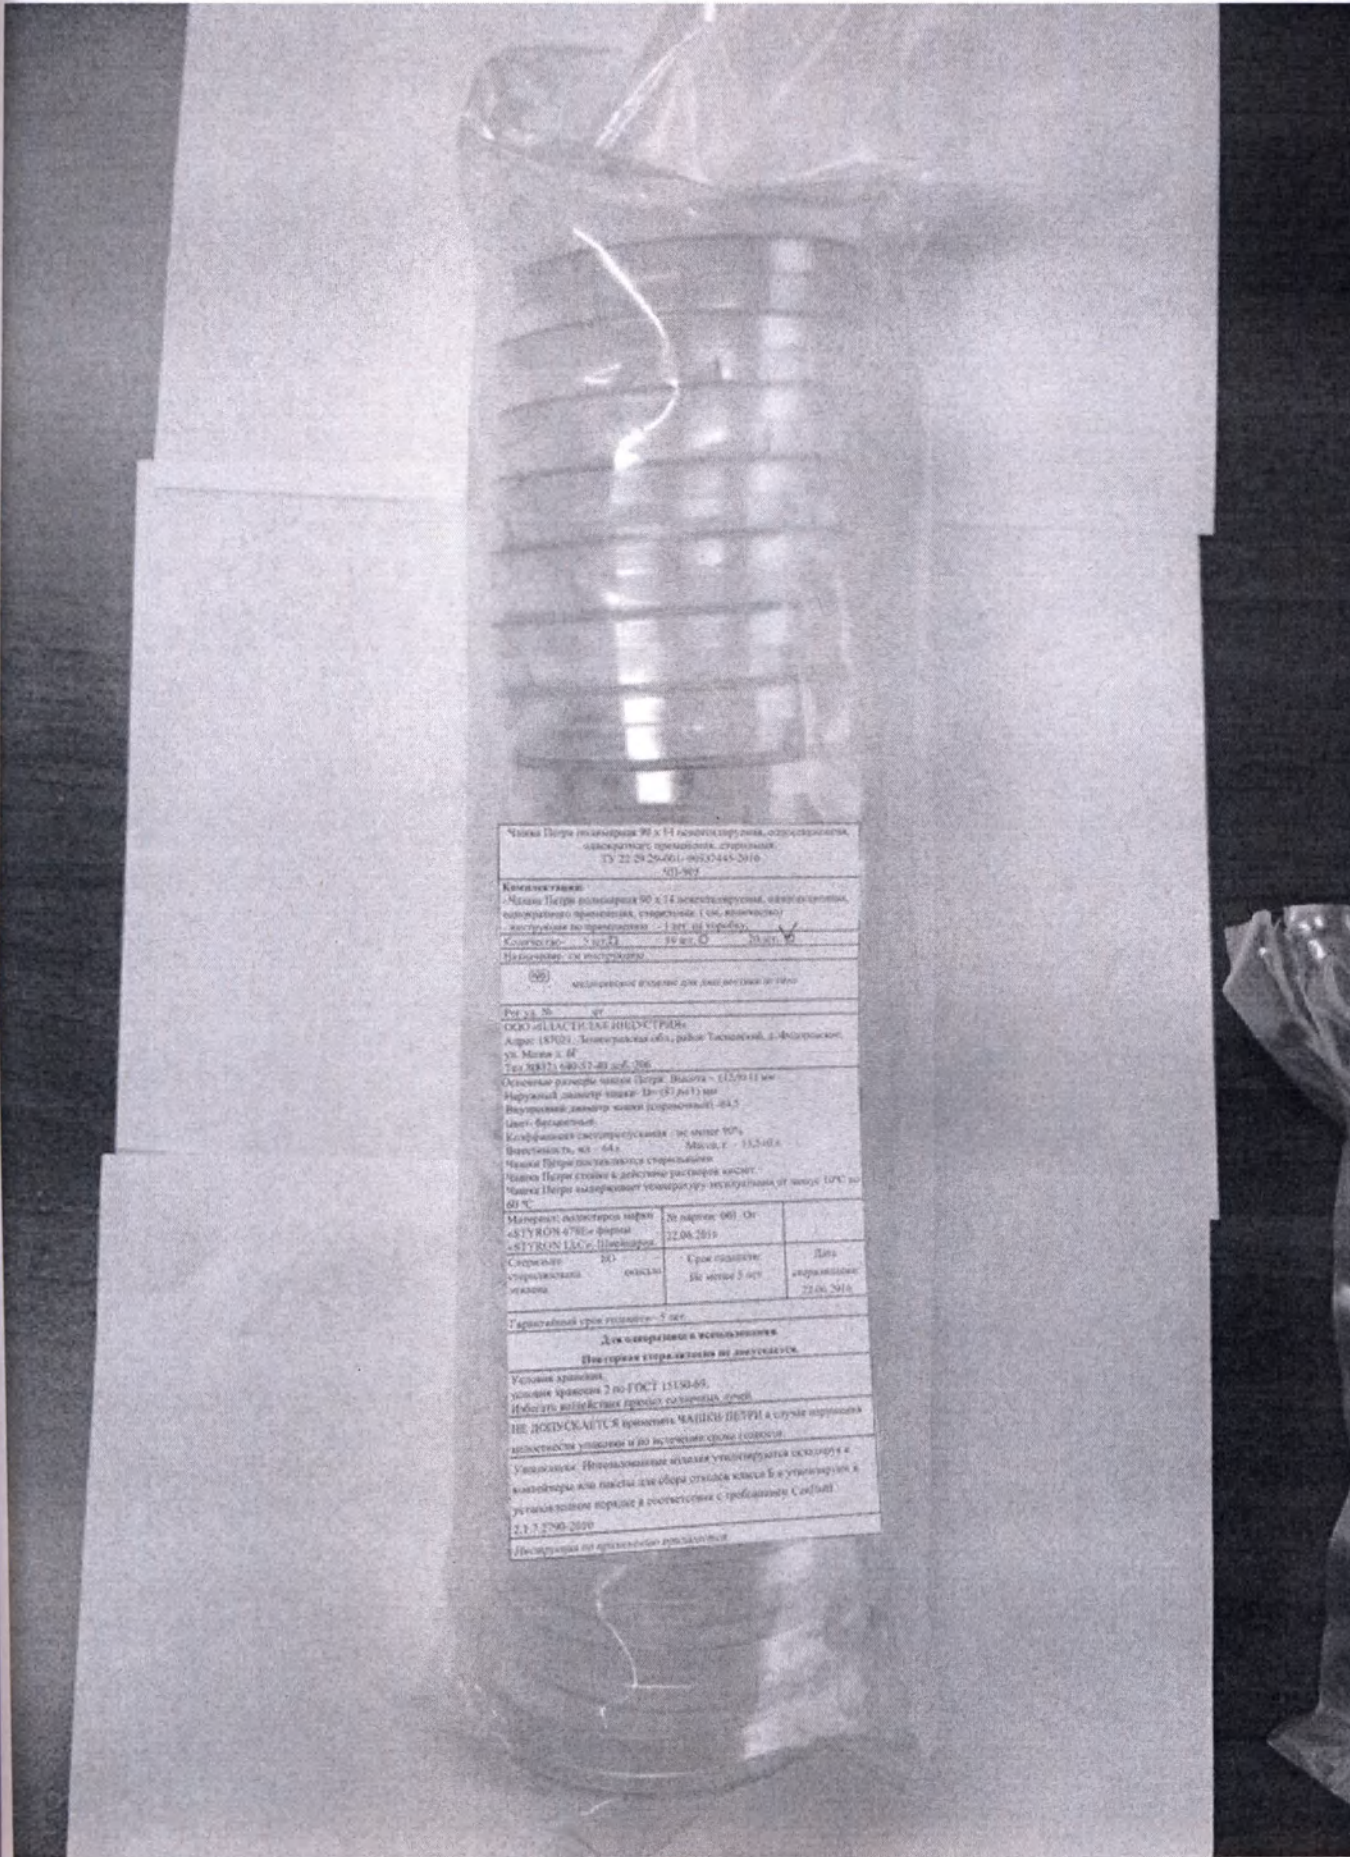

ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Чашка Петри полимерная 90 x 16,65 вентилируемая, 2-х секционная, однократного применения, стерильная, тип 1
ТУ 22.98.23.001-009/1445-2016
918-021

Комплектация:
- Чашка Петри полимерная 90 x 16,65 вентилируемая, 2-х секционная, однократного применения, стерильная, тип 1 (2 шт. количество)
- Инструктаж по применению - 4 шт. в коробку

Кол-во шт.: 5 шт. ☒ 10 шт. ☒ 20 шт. ☒

Наименование, вид конструкции

 МЕДИЦИНСКОЕ ПОСРЕДСТВО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ

Рег.з. № 00

ООО АЛКАС ПИЛЛАРИНДИСТРИБЬУШ
Адрес: 187021, Ленинградская обл., район Тосненский, д. Фидоренское, ул. Малая д. 10
Тел: 8(813) 21 446-57-60 доб. 700

Активные размеры: чашка Петри: Высота - (15,2±1)мм
Внутренний диаметр чашки: 16-(16,7±1)мм
Внутренний диаметр чашки (снаружи): 94,5
Цвета: бесцветные

Классификация стерилизуемости: - не менее 99%
Всплываемость: 30 - 81% Масса, г: - 15,2±0,2

Чашка Петри поставляется стерильными.
Чашка Петри готова к действию после розливов жидкой.
Чашка Петри выдерживает температуру: замораживание от минус 10°С до 60°С

Материал: полистирол марки: «STYRON 6780» фирмы: «STYRON LLC», Швейцария	№ партии: 001.07	22.06.2016
Стерильность: ВО	Срок годности: На месяц 3 лет	Дата отгрузки: 22.06.2016

Гарантийный срок годности: 5 лет.

Для однократного использования.
Повторная стерилизация не допускается.

Условия хранения:
условия хранения 2 по ГОСТ 15150-09.
Избегать воздействия прямых солнечных лучей.
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ применение ЧАШКА ПЕТРИ в случае нарушения целостности упаковки и по истечении срока годности.

Упаковка: Всплываемые изделия укладываются складывая в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируются в установленном порядке в соответствии с требованиями SanPiN 2.1.7.2796-2016

Инструктаж по применению прилагается

Изделие в упаковке. Чашка Петри полимерная 90 x 16,65 вентилируемая, 2-х секционная, однократного применения, стерильная, тип 1

Чашка Петри полимерная 90 x 16,65 вентилируемая, 3-х секционная
однократного применения, стерильная, тип 1.
ТУ 32.29.29-001-0003445-2016
ШП-531

Классификация:
- Чашка Петри полимерная 90 x 16,65 вентилируемая, 3-х секционная,
однократного применения, стерильная, тип 1, см. в таблице 1
- материал по применению - 1 шт. по маркировке

Количество: 3 шт. ☐ 10 шт. ☐ 20 шт. ☒

Назначение: см. в инструкции

☒ медицинское изделие для диагностики и лечения

Рис. 3. 3б
ООО «ПЛАСТИКАЛЬ ИНДУСТРИ»
Адрес: 187021, Ленинградская обл., район Тосненский, д. Фосфорное, ул.
Мисава д. 68
Тел: 8(813) 540-57-40 доб. 290

Основные размеры чашки Петри: Высота - 115,24 (мм)
Внутренний диаметр чашки: D= 90 (мм) (внутр.)
Внутренний диаметр чашки (внутренний) - 88,5
Цвет: бесцветный
Коэффициент светопропускания - по ГОСТ 9959
Вязкость, мПа·с: 15,810,2
Чашка Петри высвечивается стерильная
Чашка Петри готова к действию после вскрытия
Чашка Петри выдерживает температуру эксплуатации от минуса 10°C до 60
°C

Материал: полимерный пластик	№ партии: 001_01	
«ПЛАСТИКАЛЬ ИНДУСТРИ»	22.06.2016	
Стерильность: по	Срок годности:	Дата:
испытания	Не менее 5 лет	стерилизации:
тисления		22.06.2016

Гарантийный срок годности: 5 лет

Для информации и использования:
Повторная стерилизация не допускается.

Условия хранения:
условия хранения 3 по ГОСТ 15150-69
Избегать воздействия прямых солнечных лучей
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ применять ЧАШКИ ПЕТРИ в случае нарушения
целостности упаковки и по истечении срока годности


«Внимание!» Пользовательские изделия должны храниться складировать в
контейнерах или пакетах для сбора отходов класса Б и утилизировать в
установленном порядке в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.290-
2010

Назначение по прямому назначению продукта


Изделие в упаковке. Чашка Петри полимерная 90 x 16,65 вентилируемая, 3-х секционная, однократного применения, стерильная, тип 1



 ООО ЦПМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

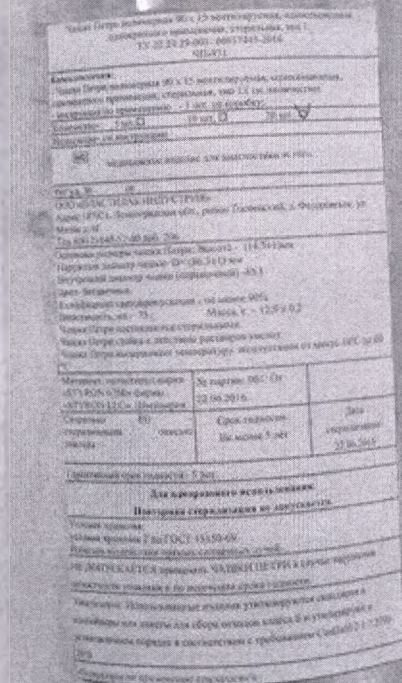

Изделие в упаковке. Чашка Петри полимерная 90 x 15 вентилируемая, односекционная, однократного применения, стерильная, тип 1

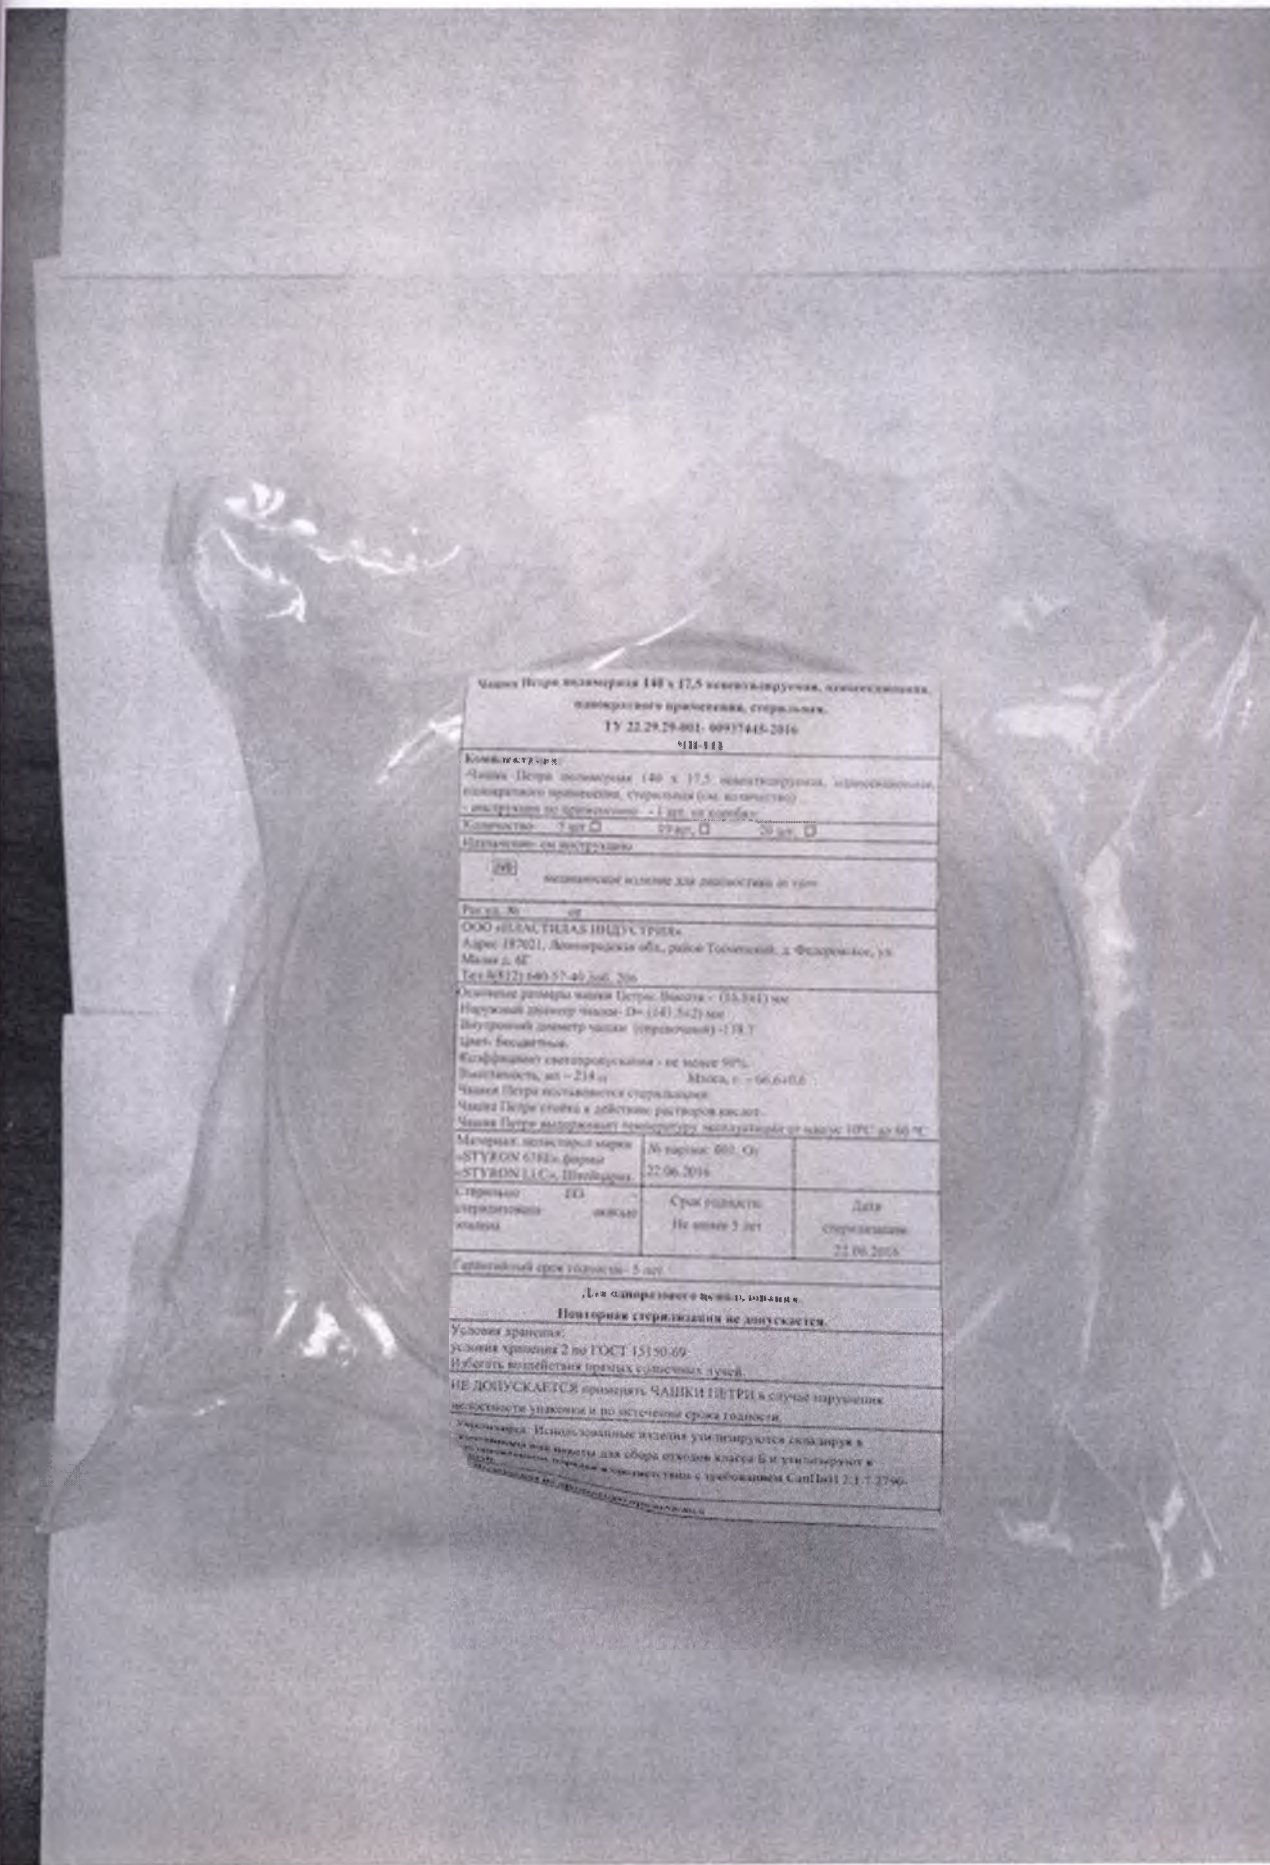

Чашка Петри полимерная 140 x 17,5 неvented, нестерилизованная, однократного применения, стерильная.
17 22.29.29-001, 00917445-2016
910-113

Комплектация:
Чашка Петри полимерная 140 x 17,5 неvented, нестерилизованная, однократного применения, стерильная (см. количество)
- инструкция по применению - 1 шт. на коробке

Количество: 7 шт. ☐ 29 шт. ☐ 50 шт. ☐

Использовать см. инструкцию

☐ Медицинское изделие для диагностики in vitro

Риски: No. 01

ООО «ЦИРМИ»
Адрес: 187021, Ленинградская обл., район Тосненский, д. Федоровское, ул. Малин д. 62
Тел. 8(812) 540 57 40, 540 576

Основные размеры чашки Петри: Высота - (33,3±1) мм
Наружный диаметр чашки: D= (140,5±2) мм
Внутренний диаметр чашки (стерилизованной) - (118,7 ±1) мм
Цилиндр: бесцветный
Кристаллическая прозрачность: не менее 90%
Вязкость, мПа·с - 218 ±10 Масса, г - 66,6±0,6

Чашка Петри поставляется стерилизованная
Чашка Петри стойка к действию растворов кислот
Чашка Петри выдерживает температуру эксплуатации от -10°C до 60 °C

Материал: поликарбонат марки «STYRON 618» фирмы «STYRON LLC», Швейцария	№ партии: 000, 01	22.06.2016
Страна: ГДР	Срок годности: Не более 5 лет	Дата стерилизации: 21.06.2016

Гарантийный срок годности - 5 лет

Для информации о методах хранения
Повторная стерилизация не допускается.

Условия хранения:
Хранить в упаковке 2 по ГОСТ 15150-09.
Избегать воздействия прямых солнечных лучей.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ применять ЧАШКИ ПЕТРИ в случае нарушения целостности упаковки и по истечении срока годности.

Указания: Исходя из данных изделия при нарушении целостности упаковки или истечении срока годности для сбора отливок класса Б и выше следует использовать стерильные инструменты с требованием СанПиН 2.1.7.2790-09.

Изделие в упаковке. Чашка Петри полимерная 140 x 17,5 неvented, нестерилизованная, однократного применения, стерильная.

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 10 лист(ов)

Руководитель организации

