


Ирригатор эндоскопический - clean«O»max 3






220

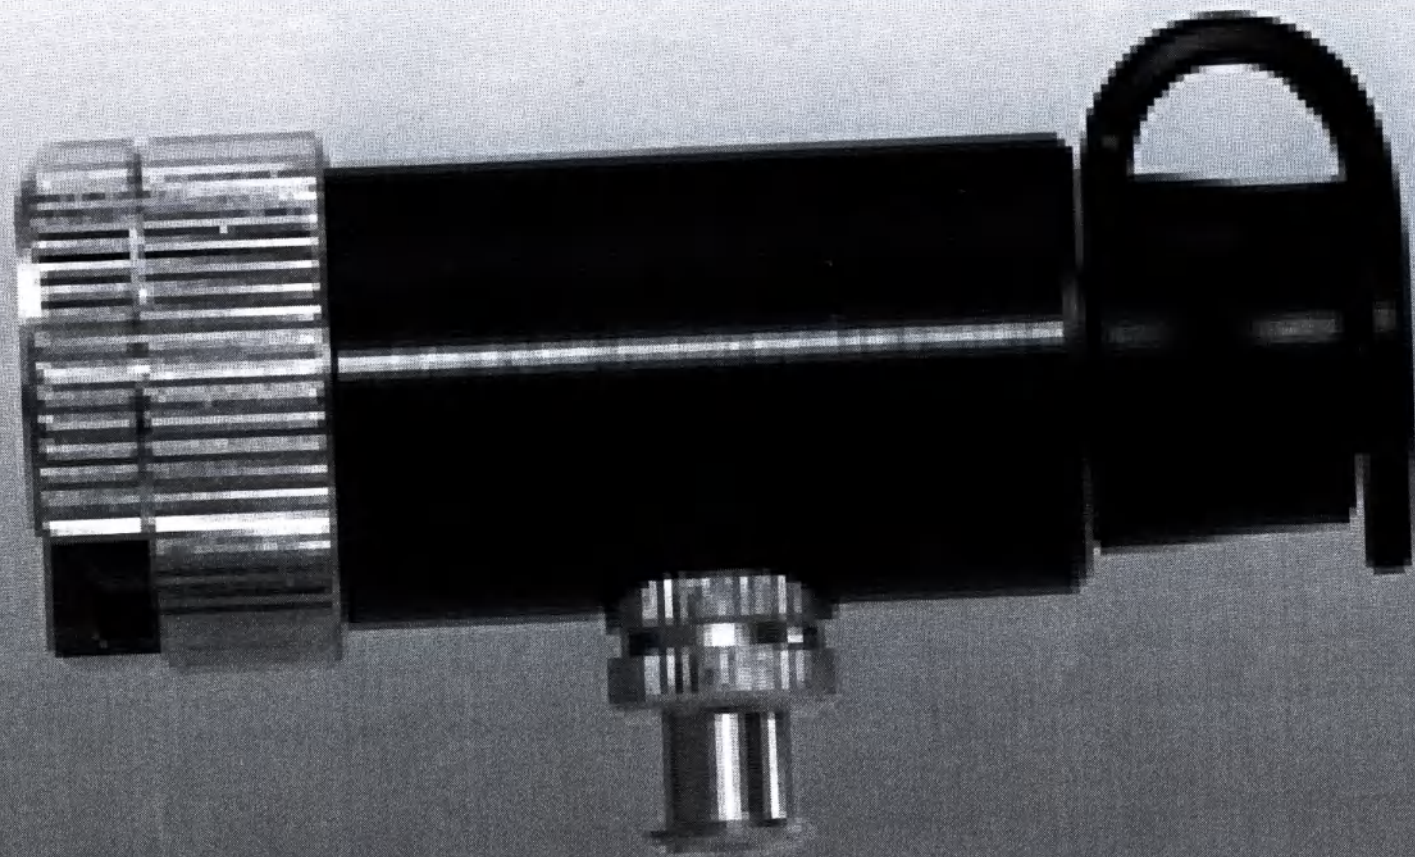



10 01 006

Instrumentier-und Spüladapter
Pentax

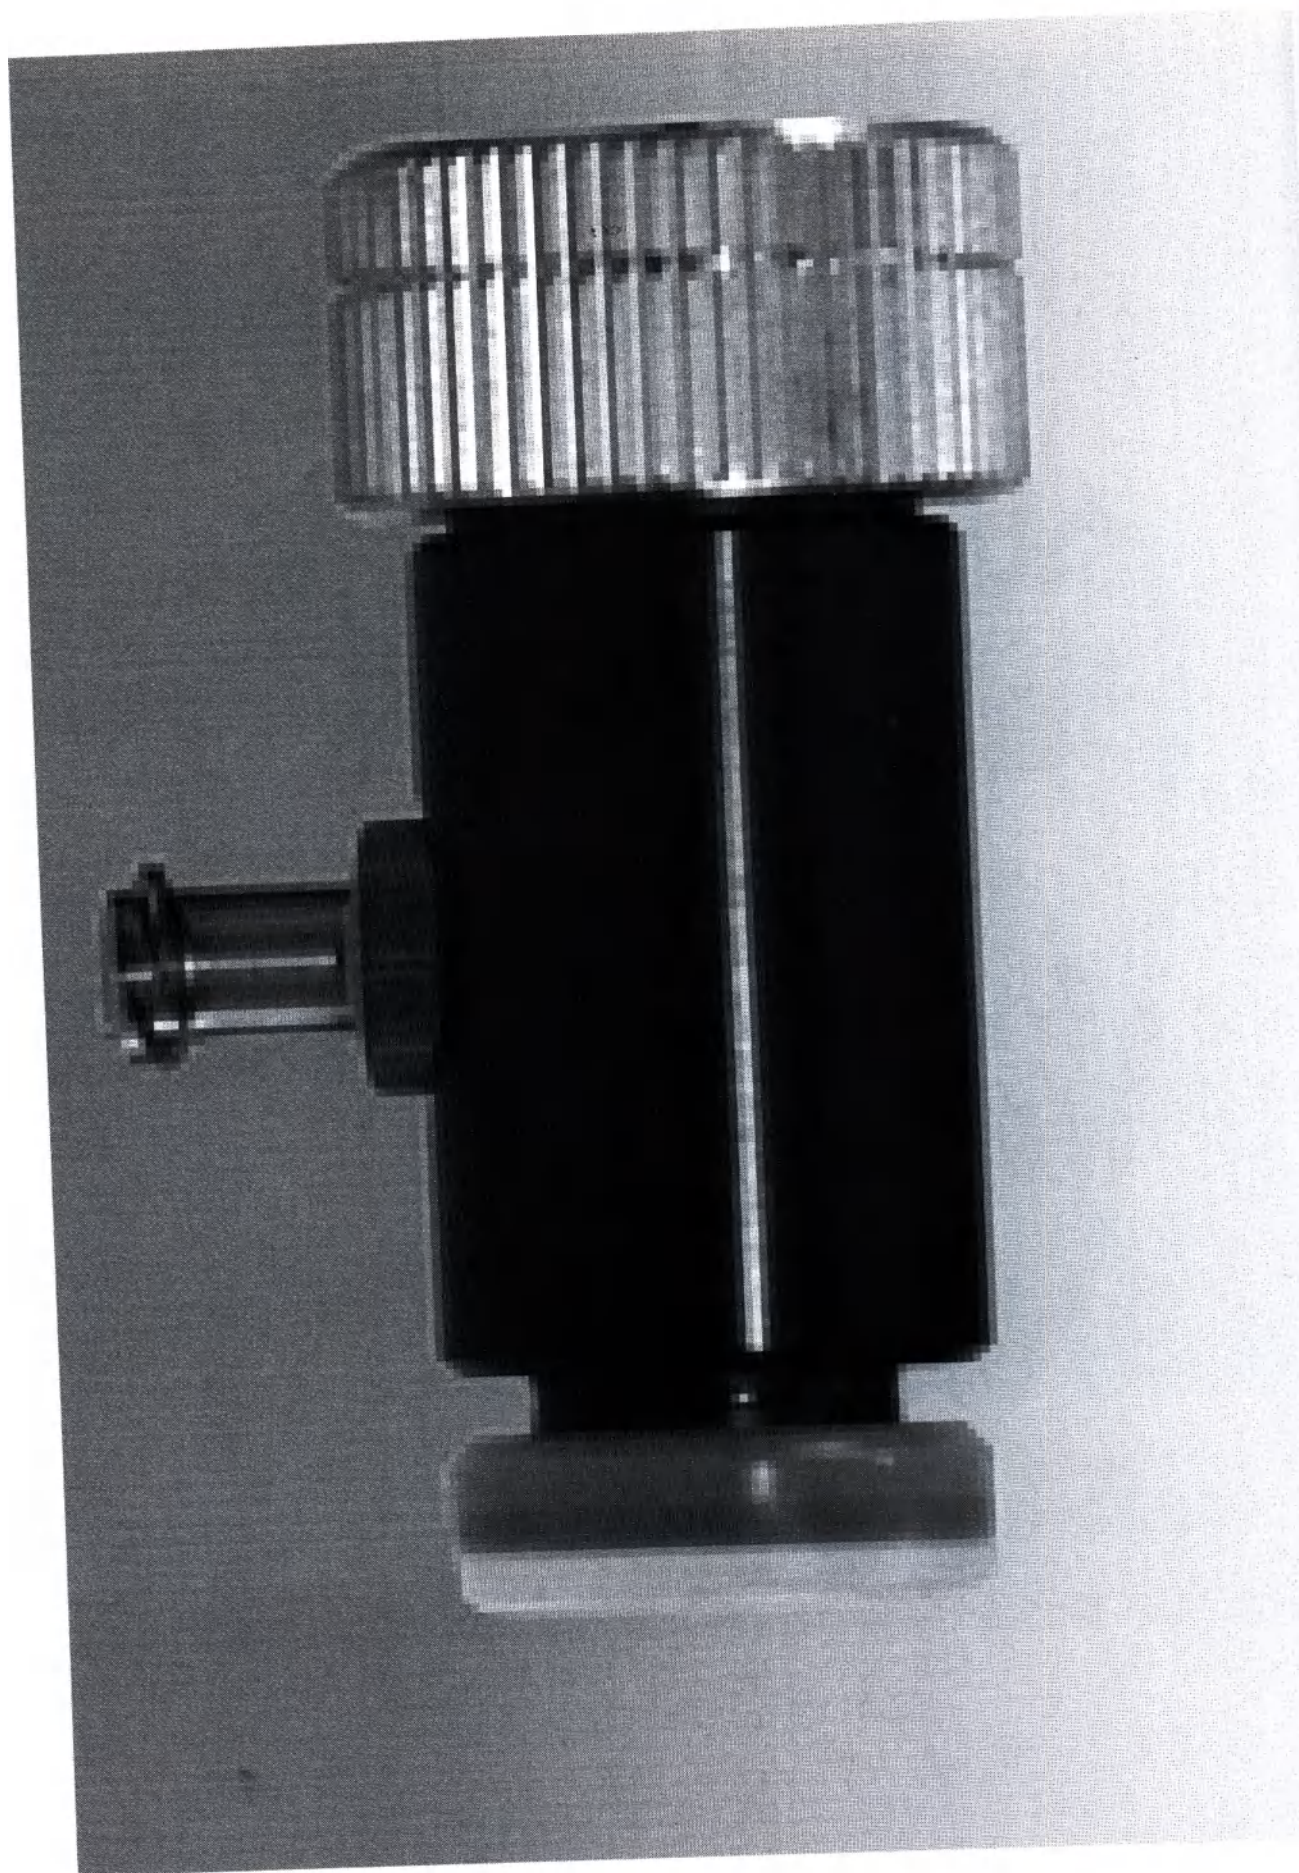





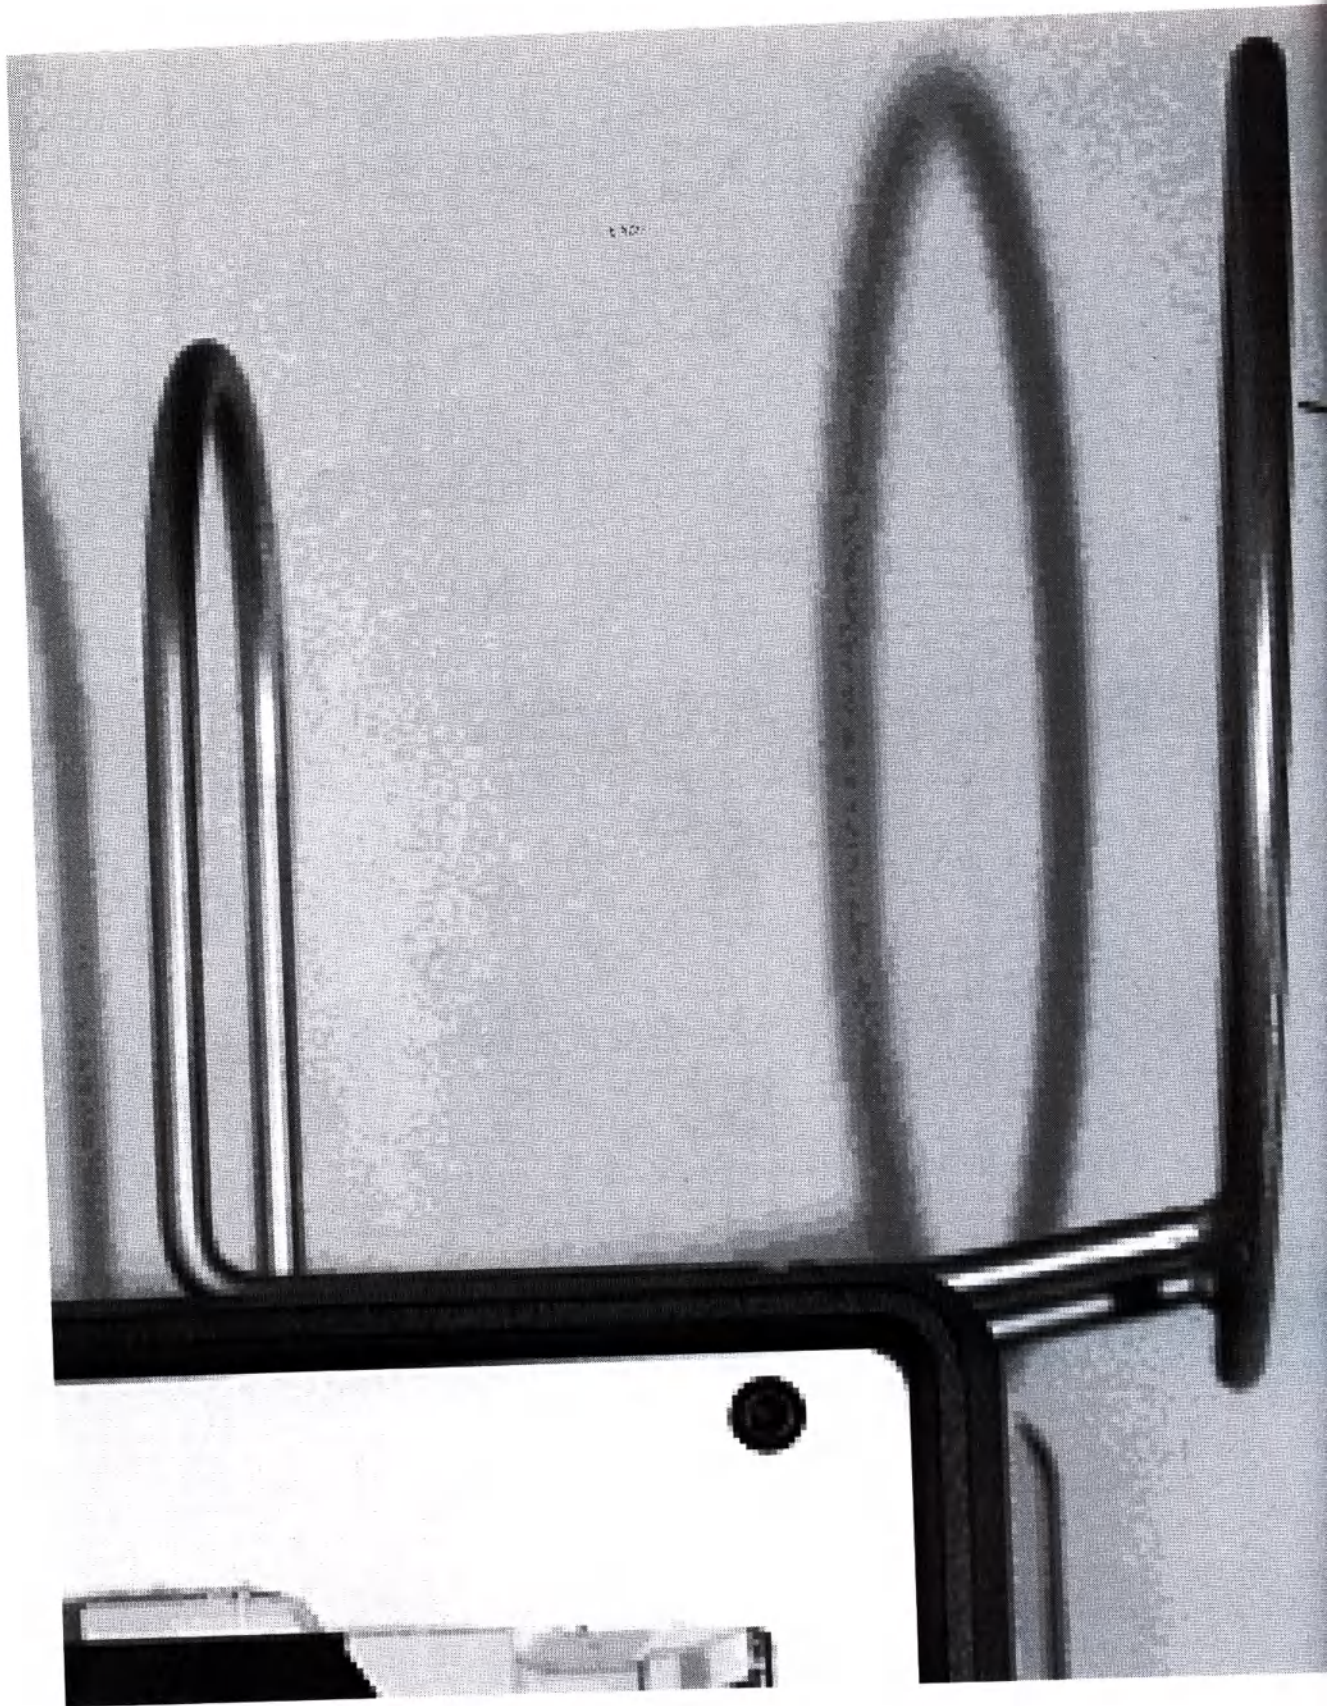

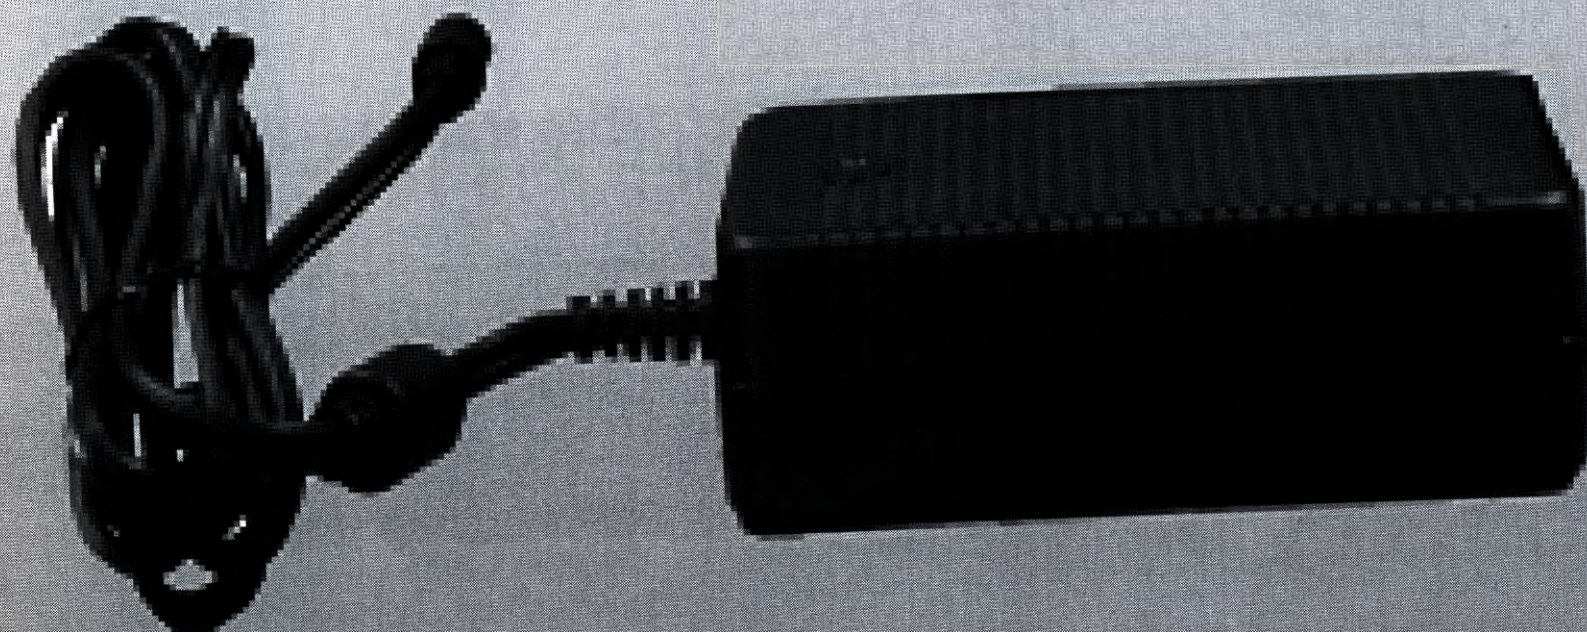



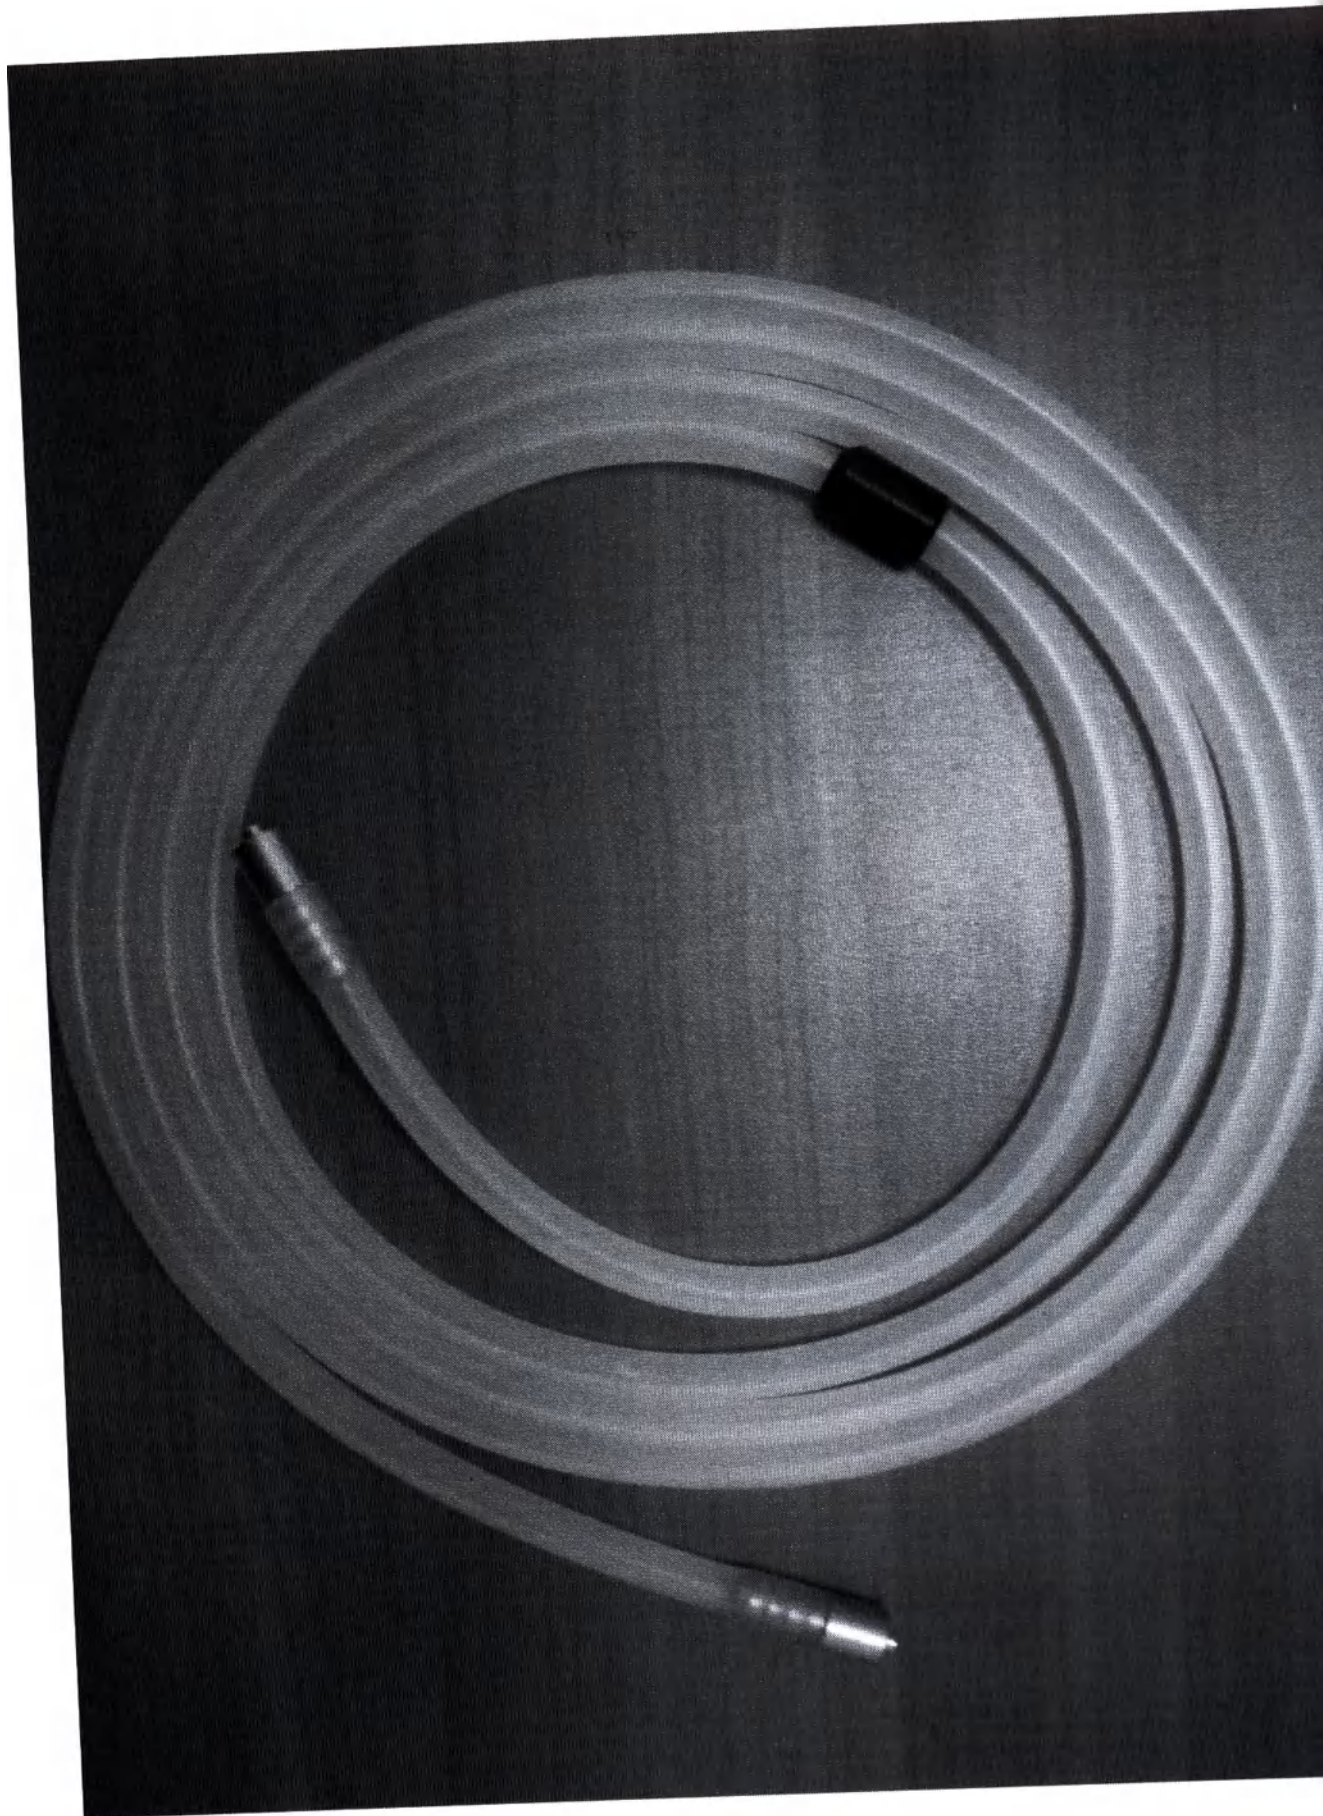

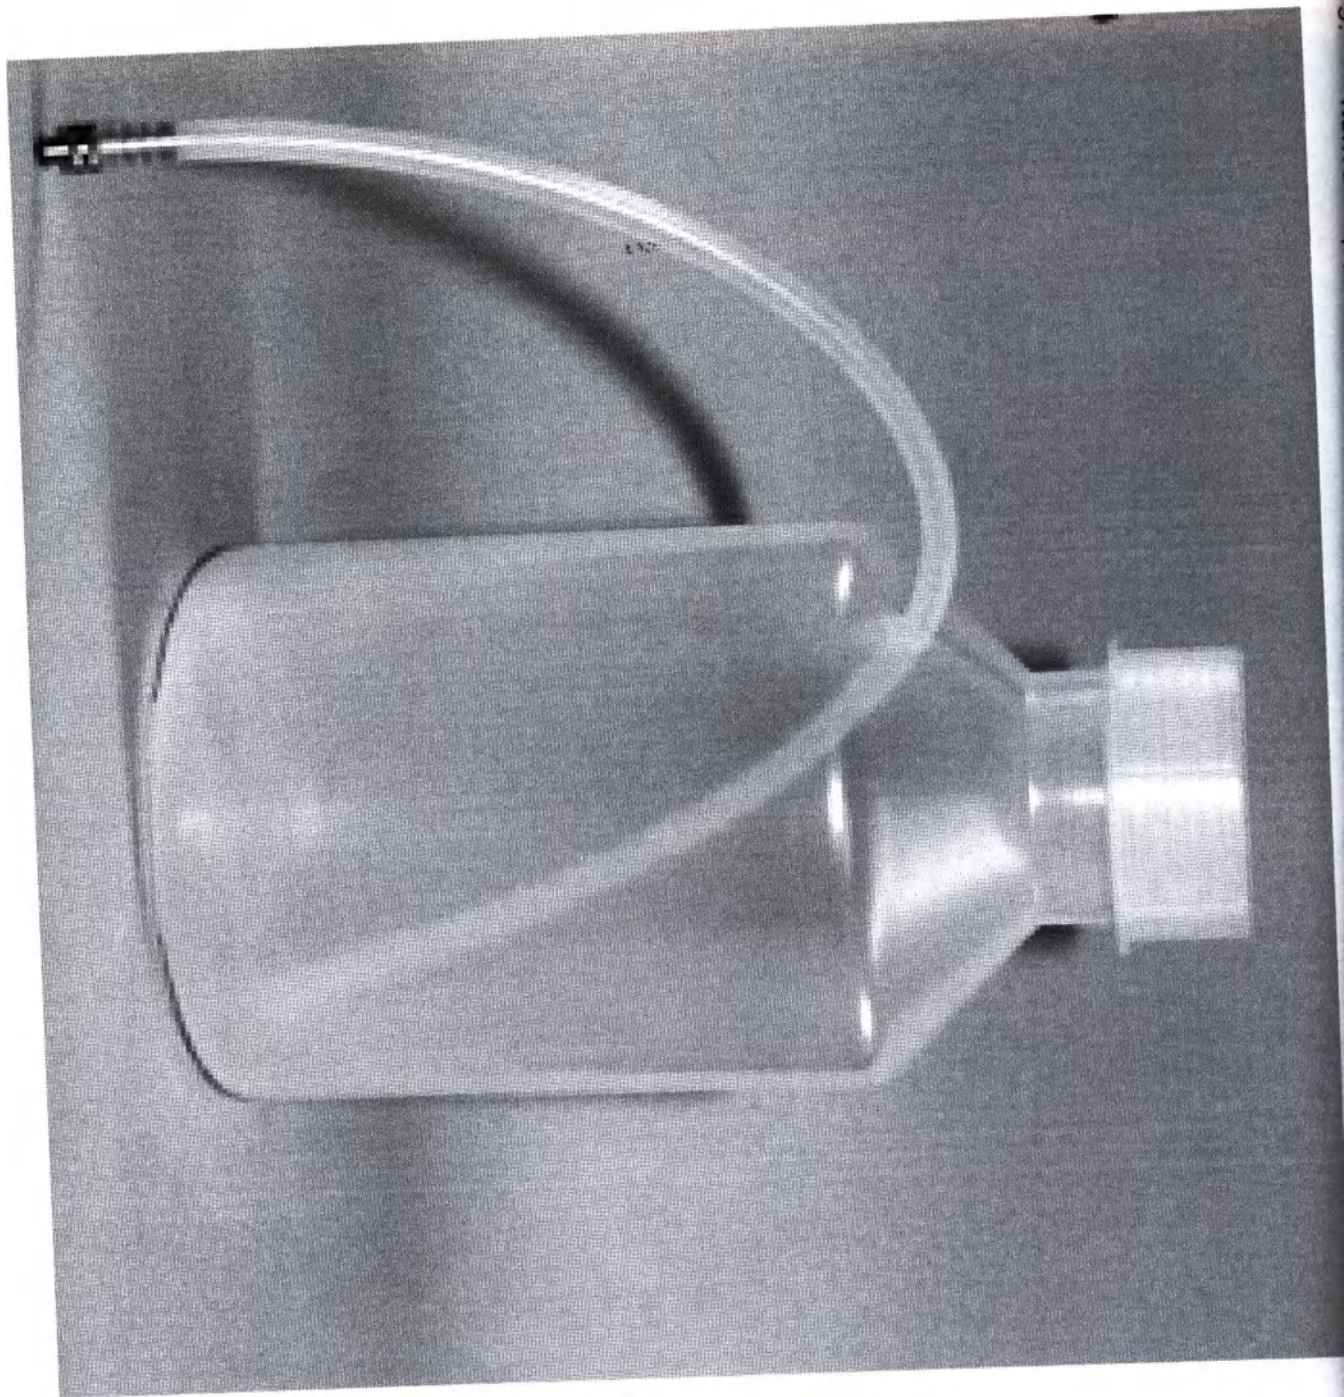




10 01 01 5

Dichtung für Spüladapter
Olympus

60-00-21-SP
Dichtung für Spüladapter
Pentax

60-00-31-SP
Dichtung für Spüladapter
Fujinon

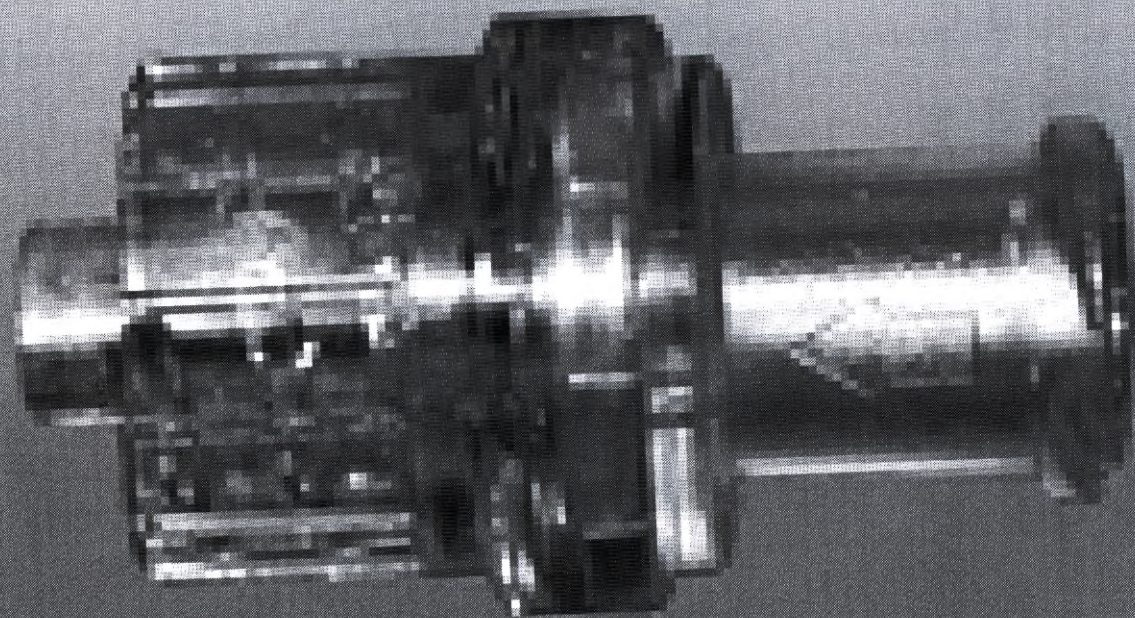

Директор

В.В. Шалаев

Всего прошито
14 (четырнадцать)
листов
Директор Шашин



8.82