



ПРИЛОЖЕНИЕ А
Фотографические изображения общего вида медицинского изделия



Видеокамера эндоскопическая (Gastro Pack – вид спереди)

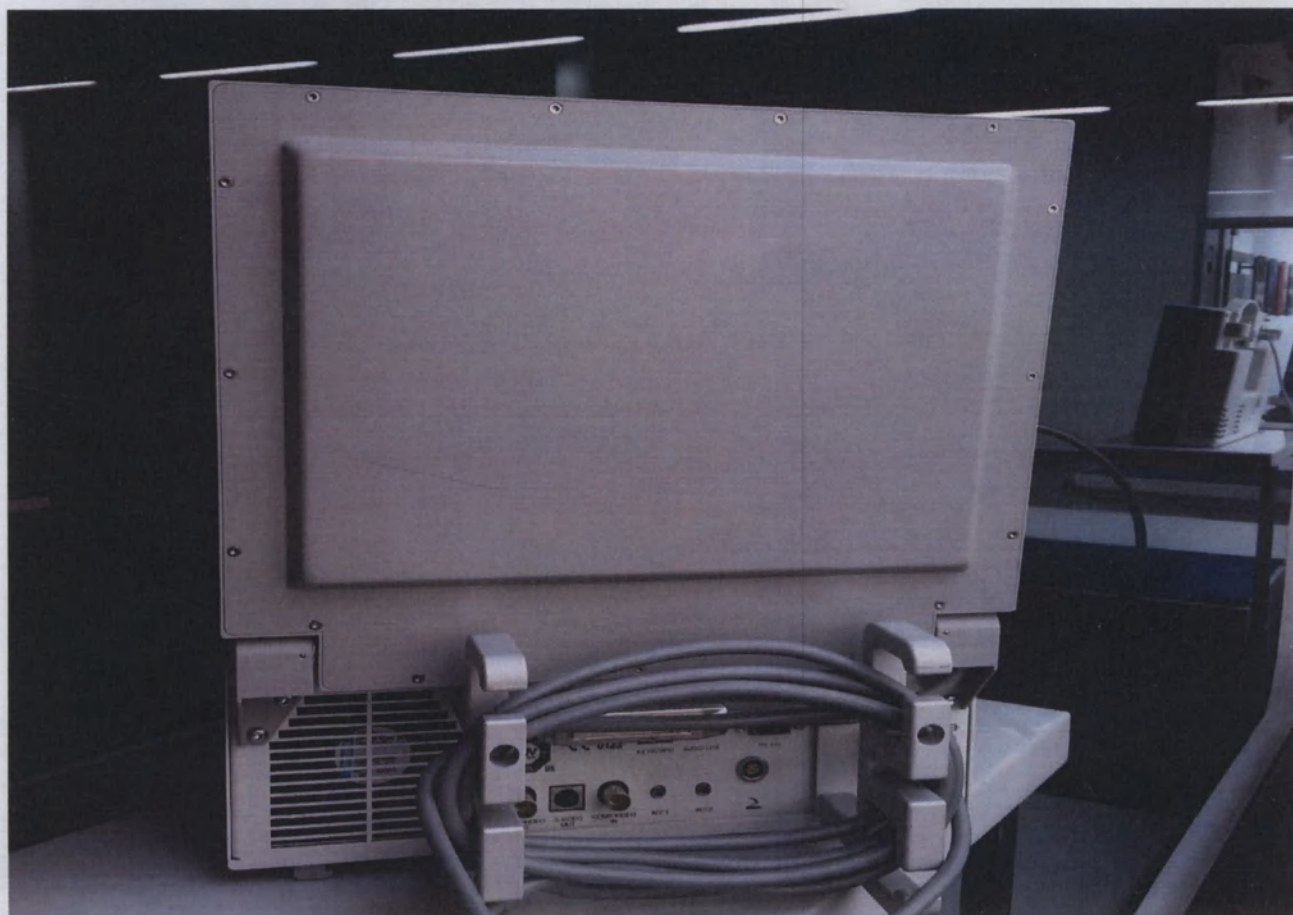

Видеокамера эндоскопическая (Gastro Pack – вид сзади)

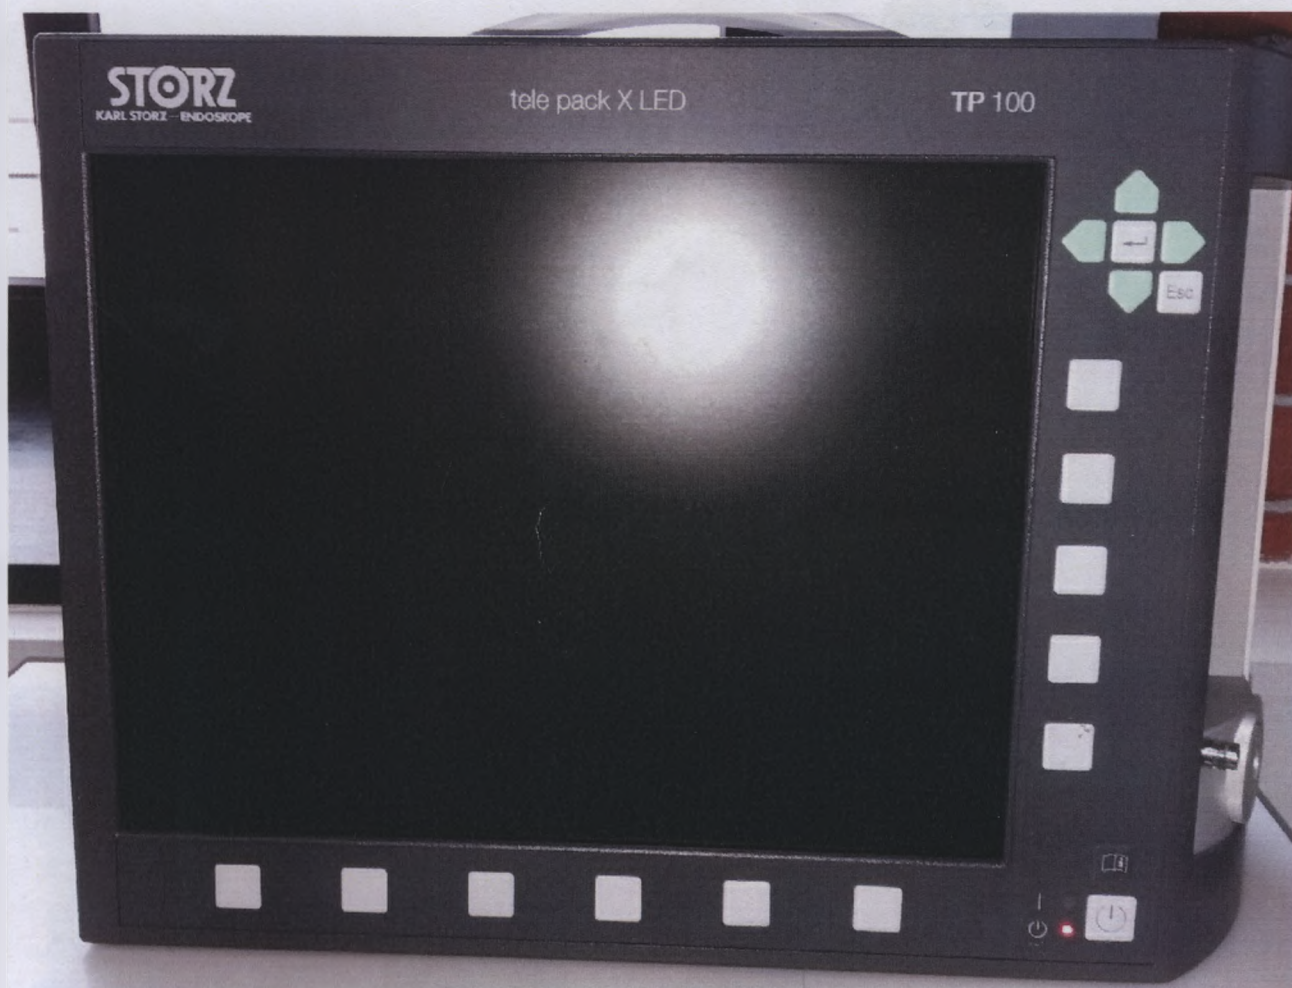

Видеокамера эндоскопическая (TELE PACK X LED – вид спереди)



Видеокамера эндоскопическая (TELE PACK X LED – вид сзади)

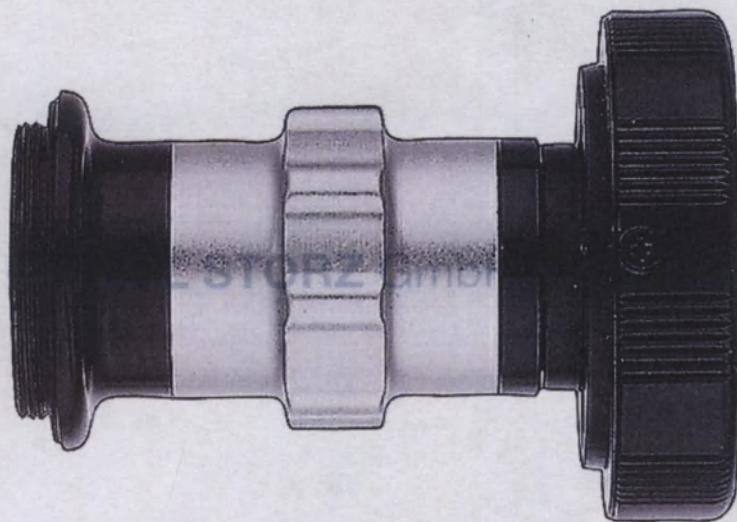


Рис. 3. Объектив

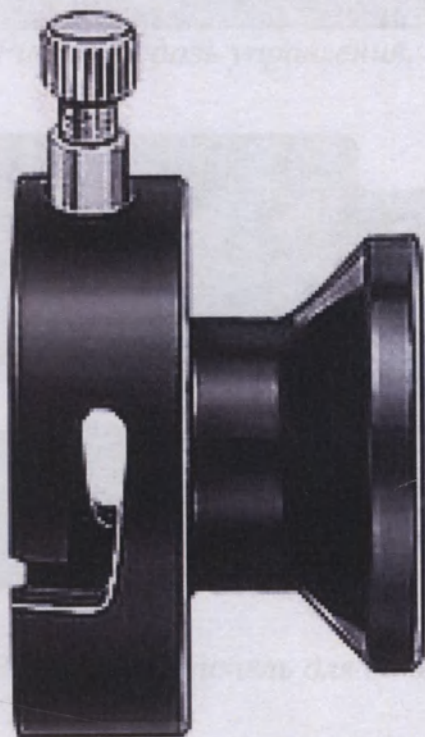


Рис. 4. Адаптор



Рис. 5. Педаль управления, ножная.



Рис. 6. Удлинитель для видеокабеля.

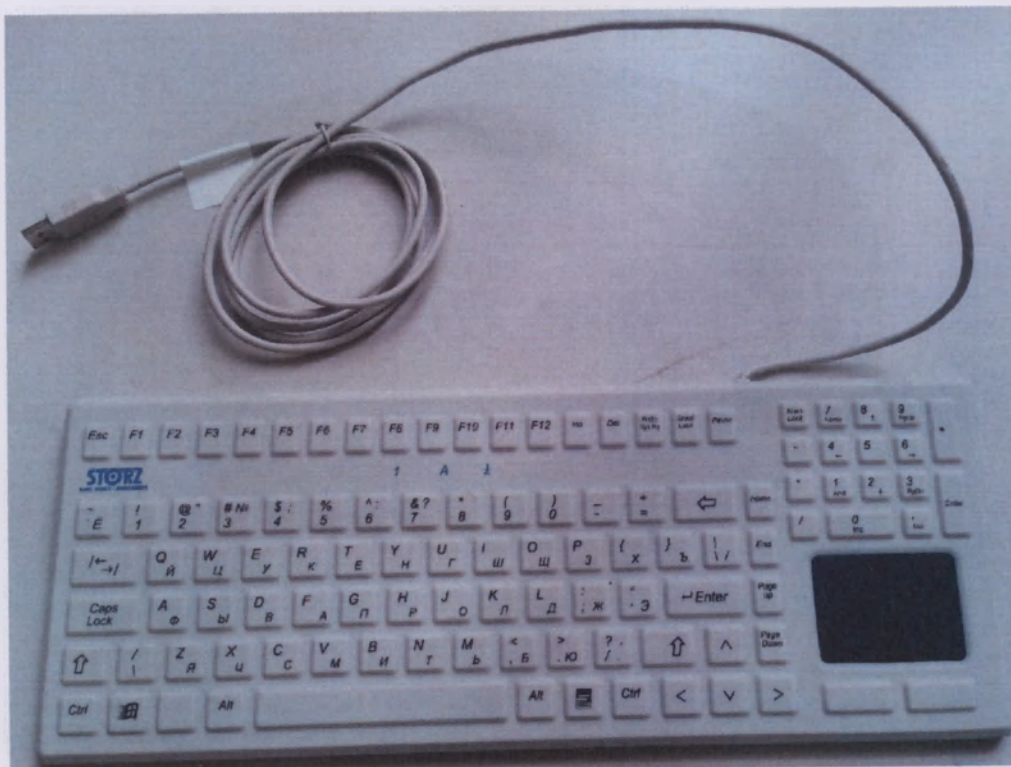


Рис. 7. Клавиатура.



Рис. 8. Контейнер для объектива.



Рис. 9. Видеокабель



Рис. 10. Карта памяти.

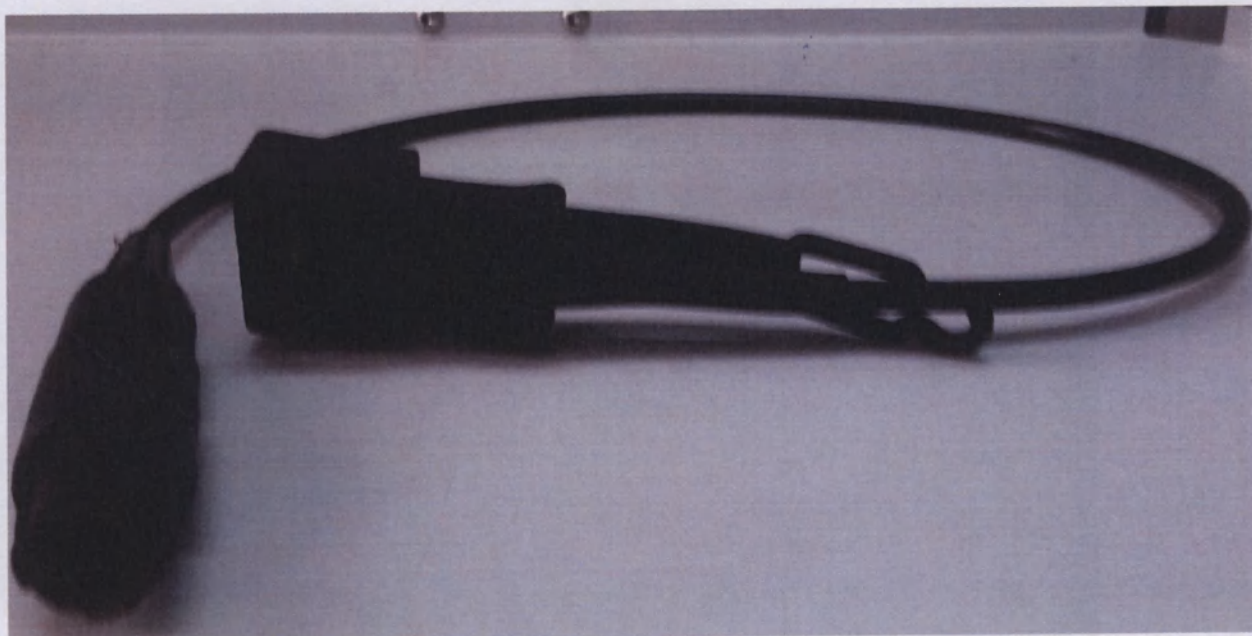


Рис. 11. Кабель для видеоэндоскопа.



Рис. 12. Лампа, тип HiLux, для освещения объекта изображения.



Рис. 13. Гарнитура головная для записи аудио комментариев к записанным кадрам.



Рис. 14. Разделитель луча изображения (бимсплитер).

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Программа технических испытаний медицинского изделия

Всего прошито и скреплено
печатью 14 лист(ов)
Руководитель И.И.





Рис. 1.1 Видеокамера эндоскопическая (Gastro Pack – вид спереди)

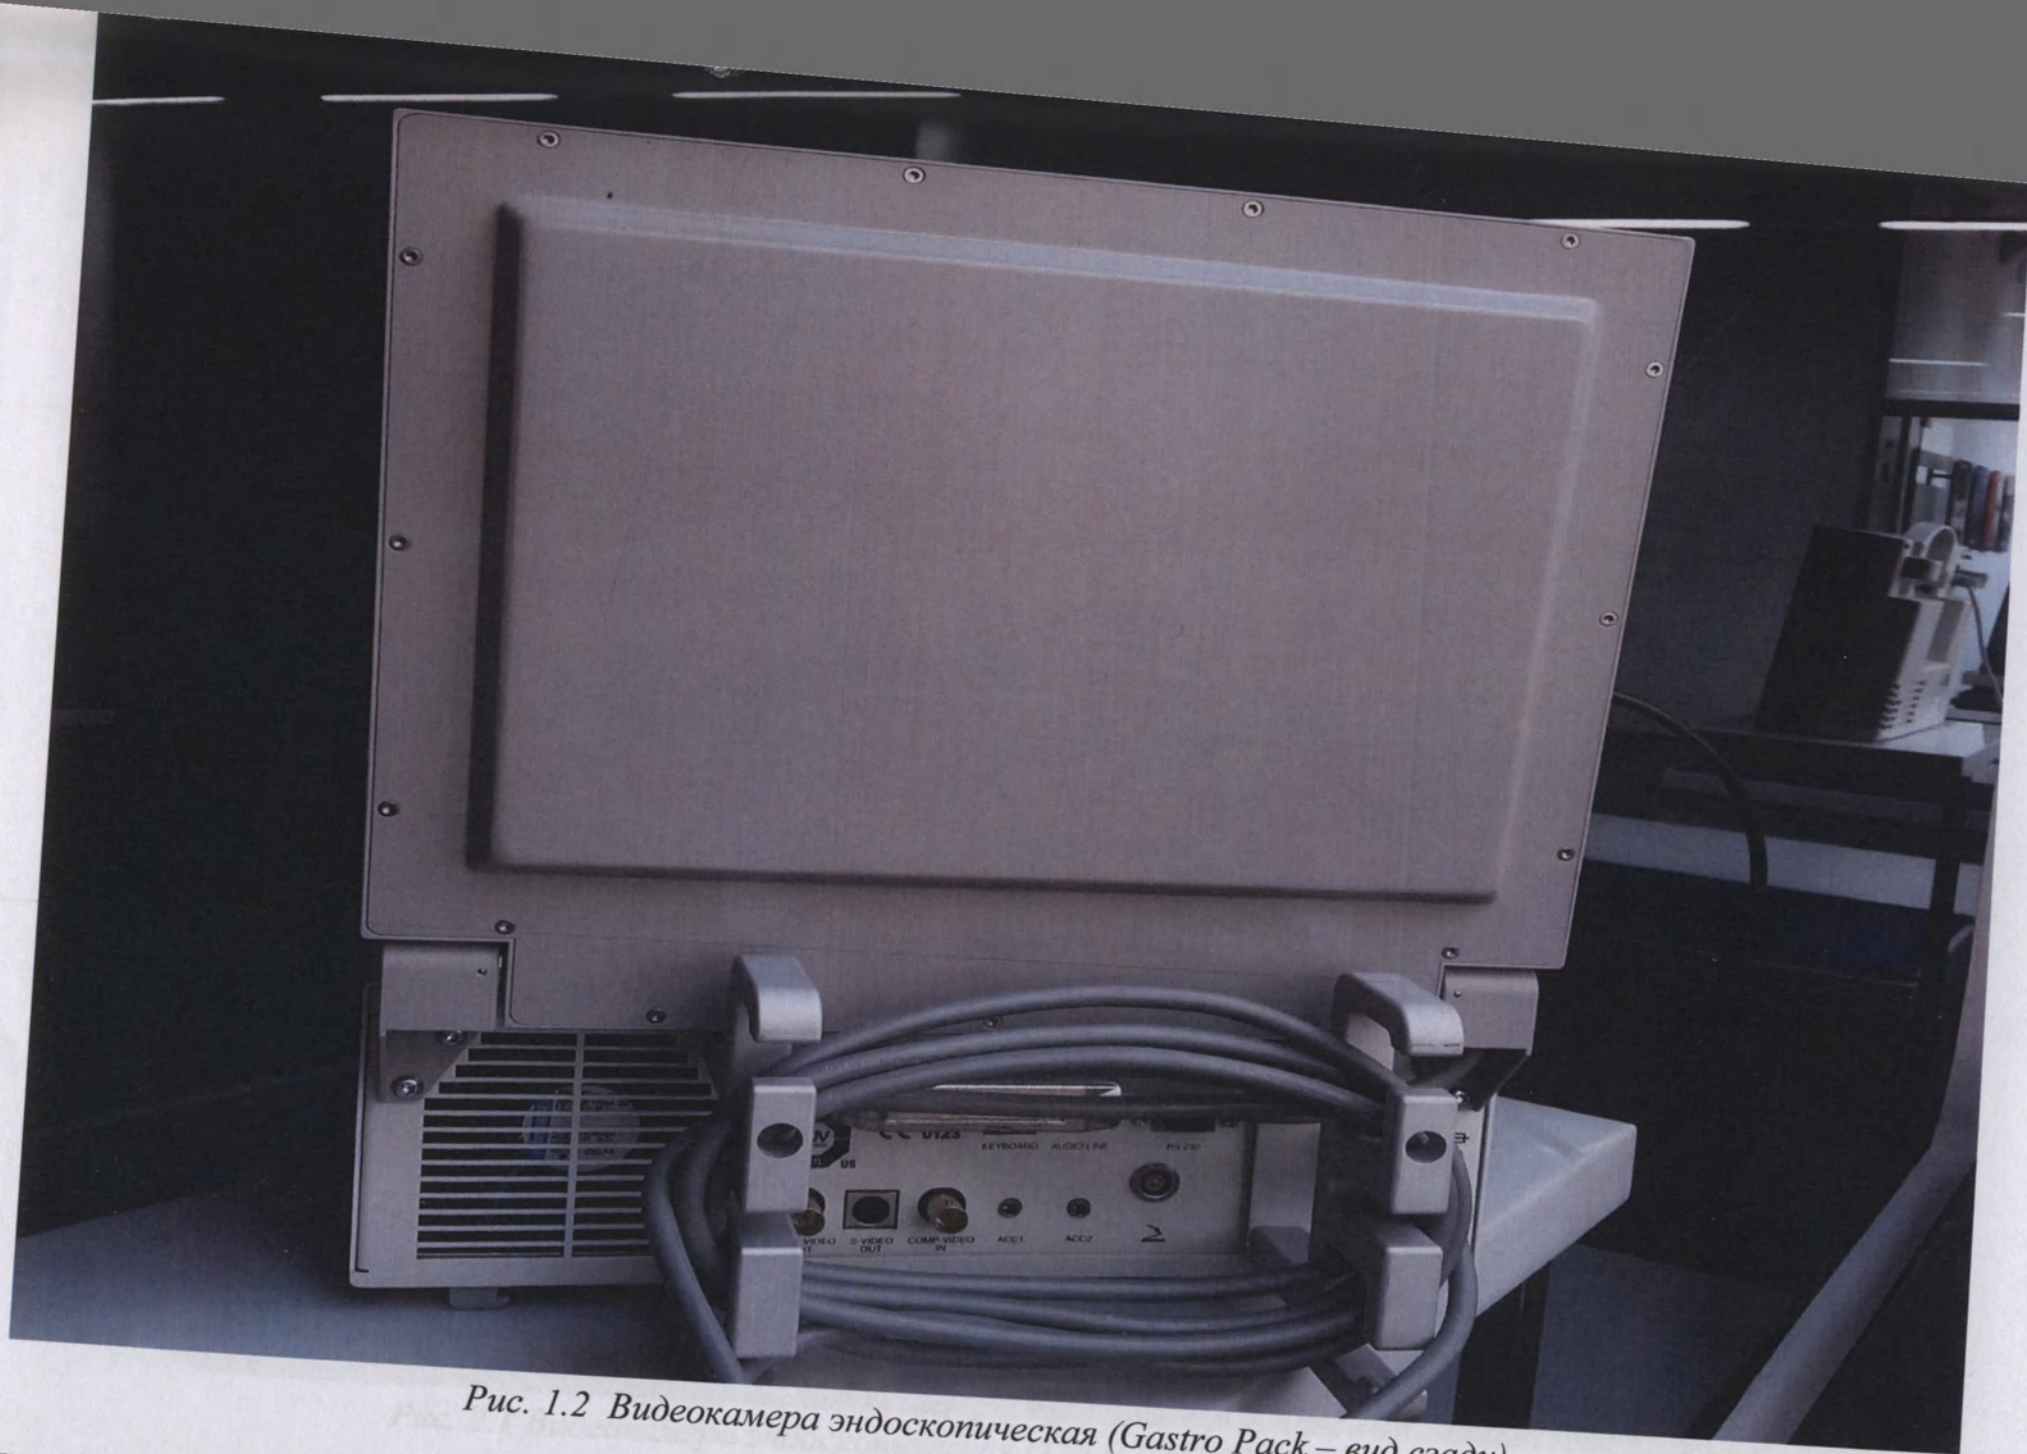


Рис. 1.2 Видеокамера эндоскопическая (Gastro Pack – вид сзади)

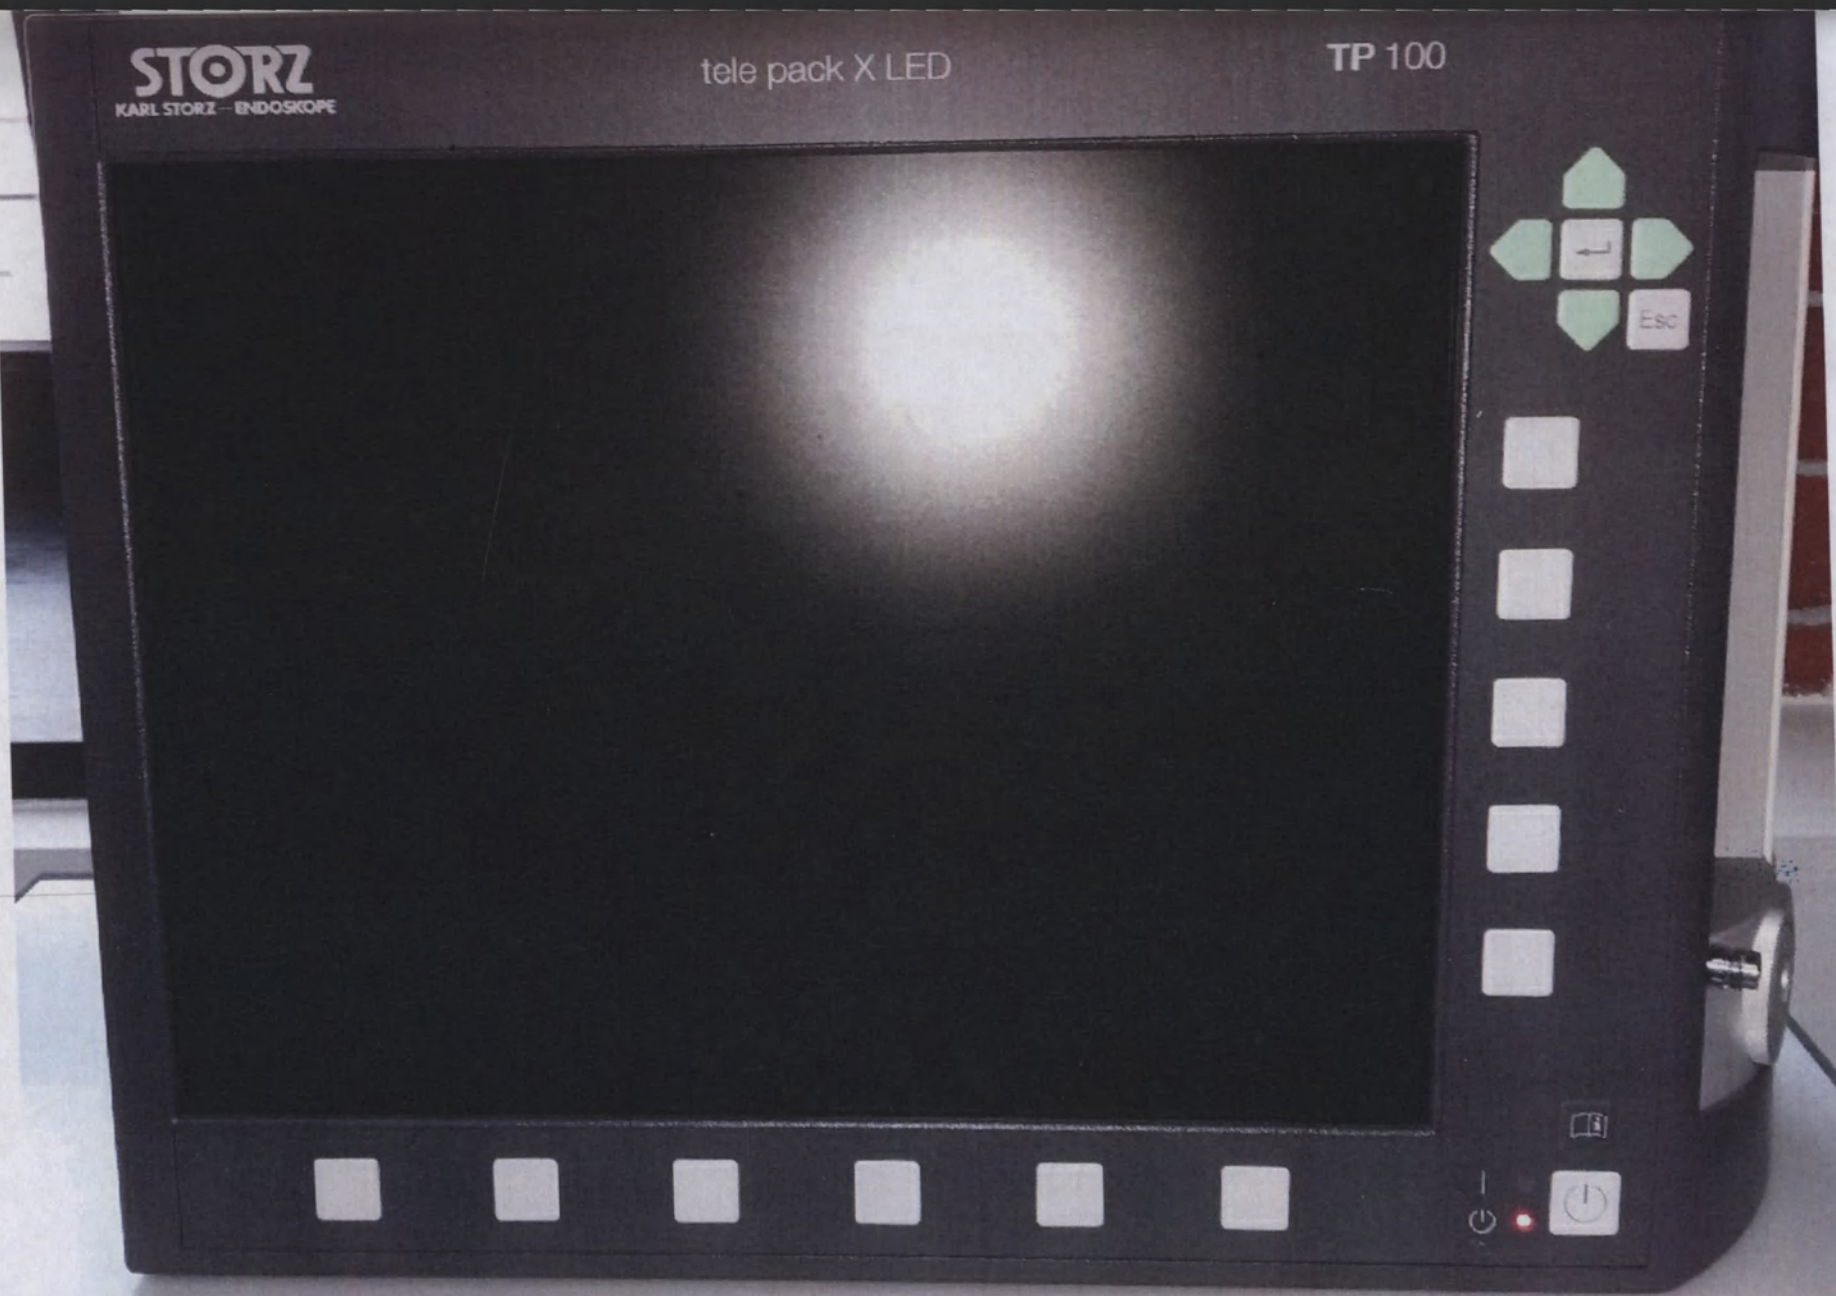


Рис. 2.1 Видеокамера эндоскопическая (TELE PACK X LED – вид спереди)



Рис. 2.2 Видеокамера эндоскопическая (TELE PACK X LED – вид сзади)

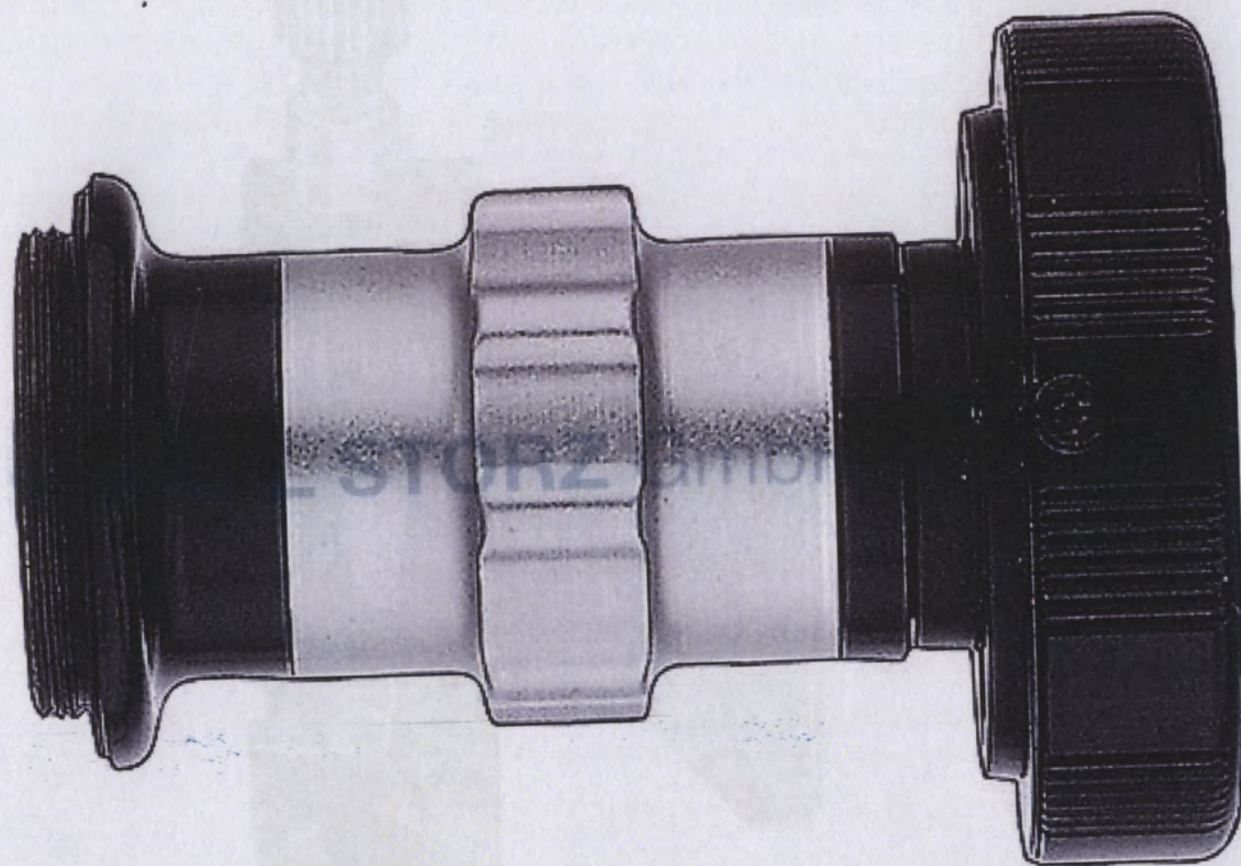


Рис. 3. Объектив

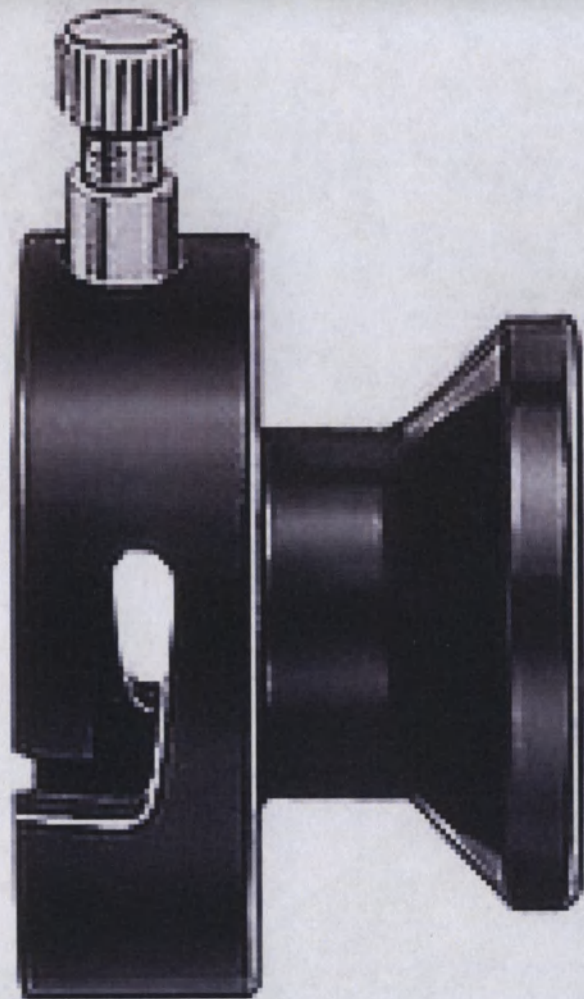


Рис. 4. Адаптор



Рис. 5. Педаль управления, ножная.



Рис. 6. Удлинитель для видеокабеля.



Рис. 7. Клавиатура.



Рис. 8. Контейнер для объектива.



Рис. 9. Видеокабель.



Рис. 10. Карта памяти.



Рис. 11. Кабель для видеозендоскопа.



Рис. 12. Лампа, тип HiLux, для освещения объекта изображения.

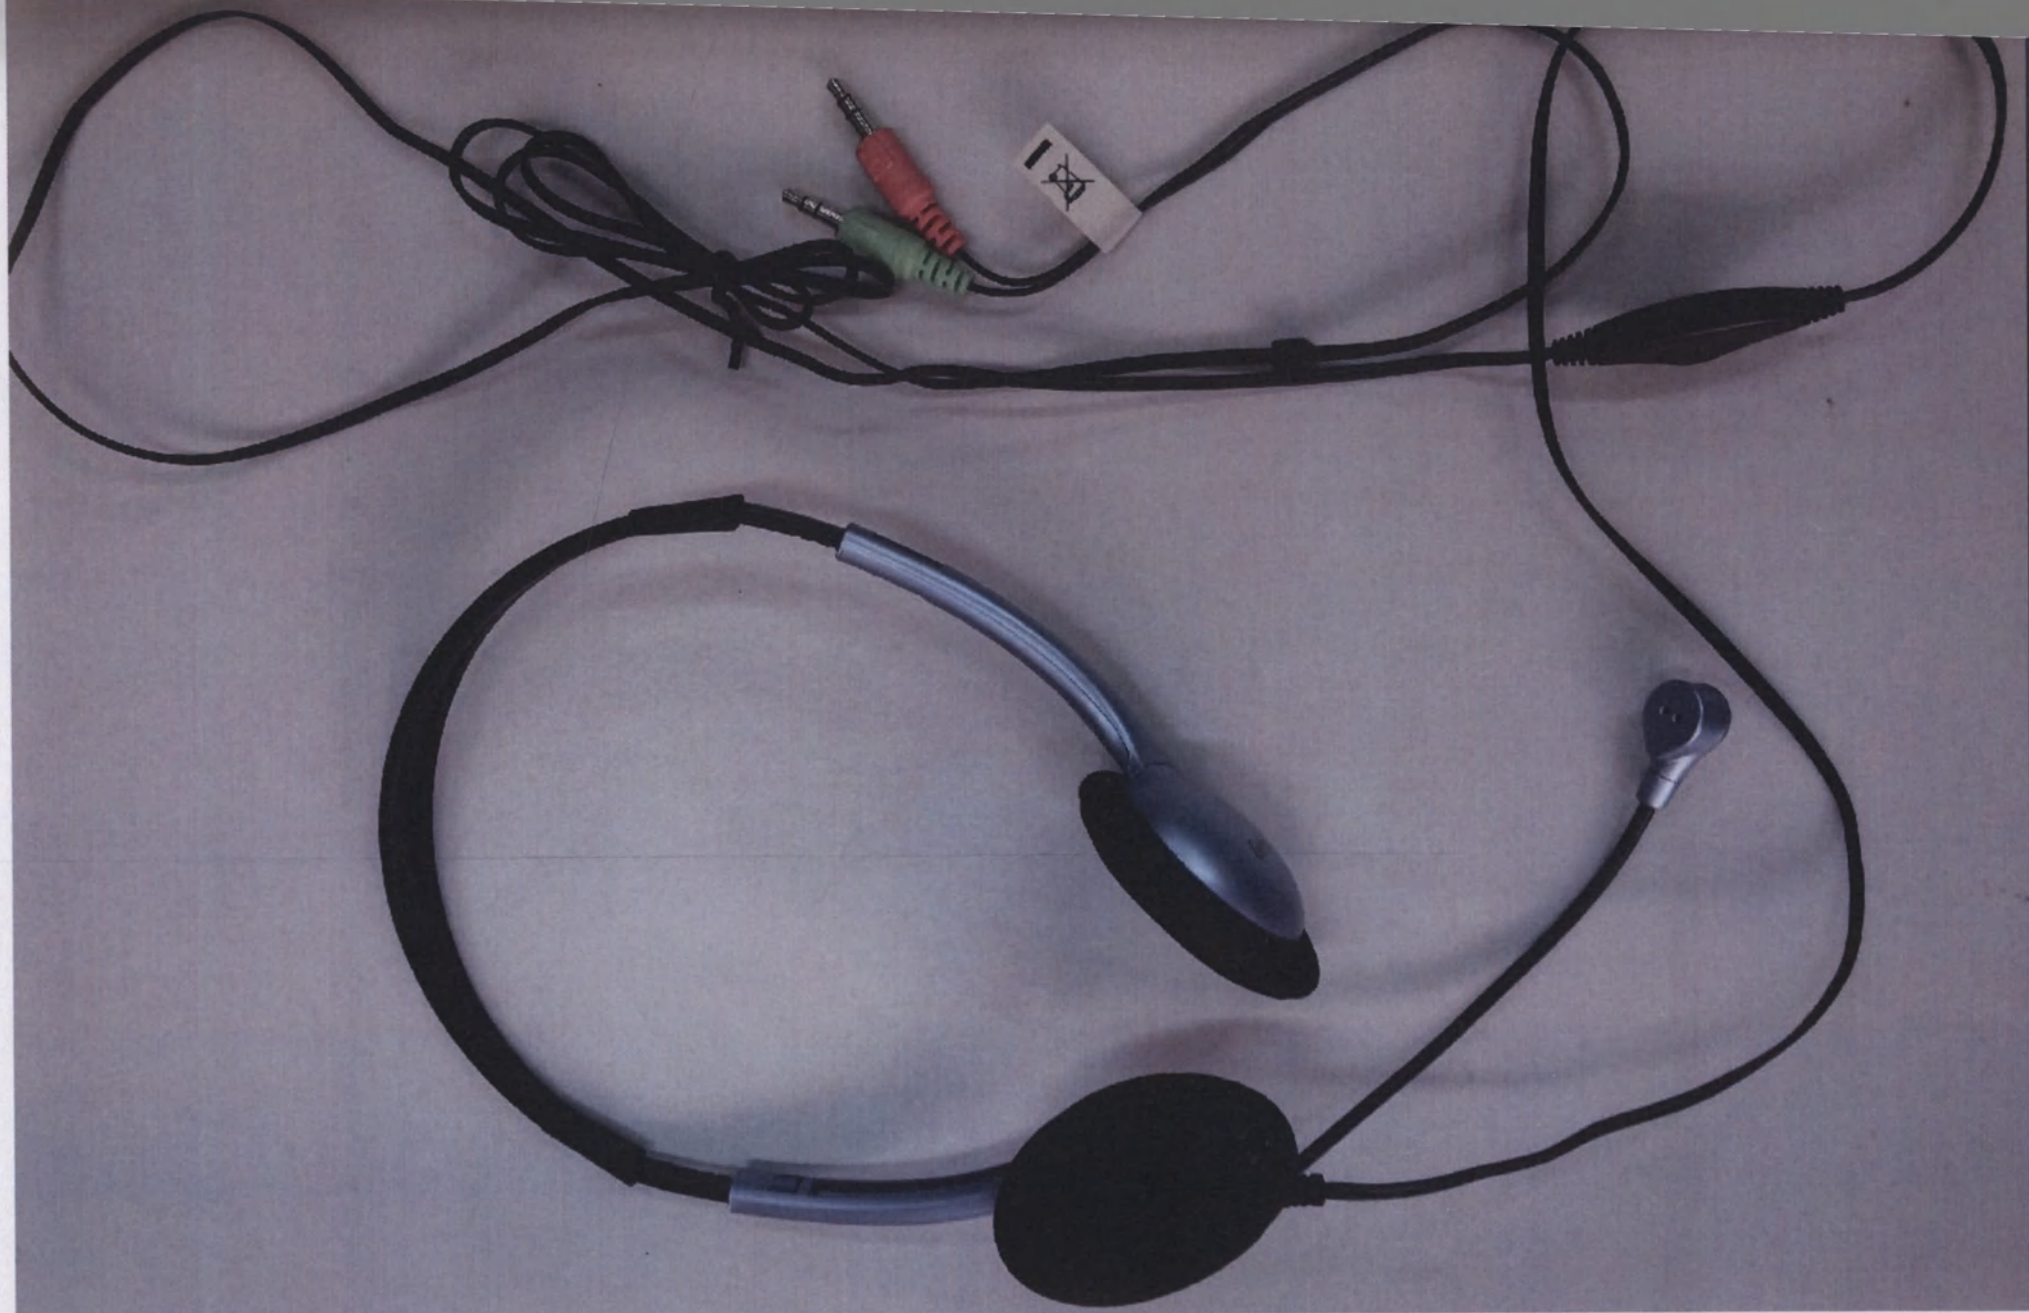


Рис. 13. Гарнитура головная для записи аудио комментариев к записанным кадрам.



Рис. 14. Разделитель луча изображения (бимсплитер).