

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор

ООО «МЕДИКОМ»



О.Ю. Голубинский

июль 2018 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

Пульсоксиметры ТОРМЕД, варианты исполнения:

FP-10, FP-20, FP-30, FP-31, HP-10, HP-20 с принадлежностями

1.Пульсоксиметр TOPMED, вариант исполнения FP-10



2. Пульсоксиметр ТОРМЕД, вариант исполнения FP-20



3.Пульсоксиметр ТОРМЕД, вариант исполнения FP-30



4.Пульсоксиметр TOPMED, вариант исполнения FP-31



Комплектация:
1.Основной блок



2. Батарейки тип «ААА» (не более 2 шт.).



Руководство по эксплуатации
Пульсоксиметр
ТОРМЕТ FP-10/FP-20/ FP-30/ FP-31



5. Руководство по эксплуатации.

Принадлежности для пульсоксиметров TOPMED,
варианты исполнения: FP-10, FP-20, FP-30, FP-31:

1. Шнурок



2. Чехол тканевый



1.Пульсоксиметр TOPMED, вариант исполнения: HP-10



2.Пульсоксиметр ТОРМЕТ, вариант исполнения: НР-20:



Комплектация:
1.Основной блок




2. Датчик SpO₂



3. Датчик SpO₂ многоразовый для взрослых, тип «прищепка»




4. Датчик SpO₂ многоразовый для детей, тип «прищепка»

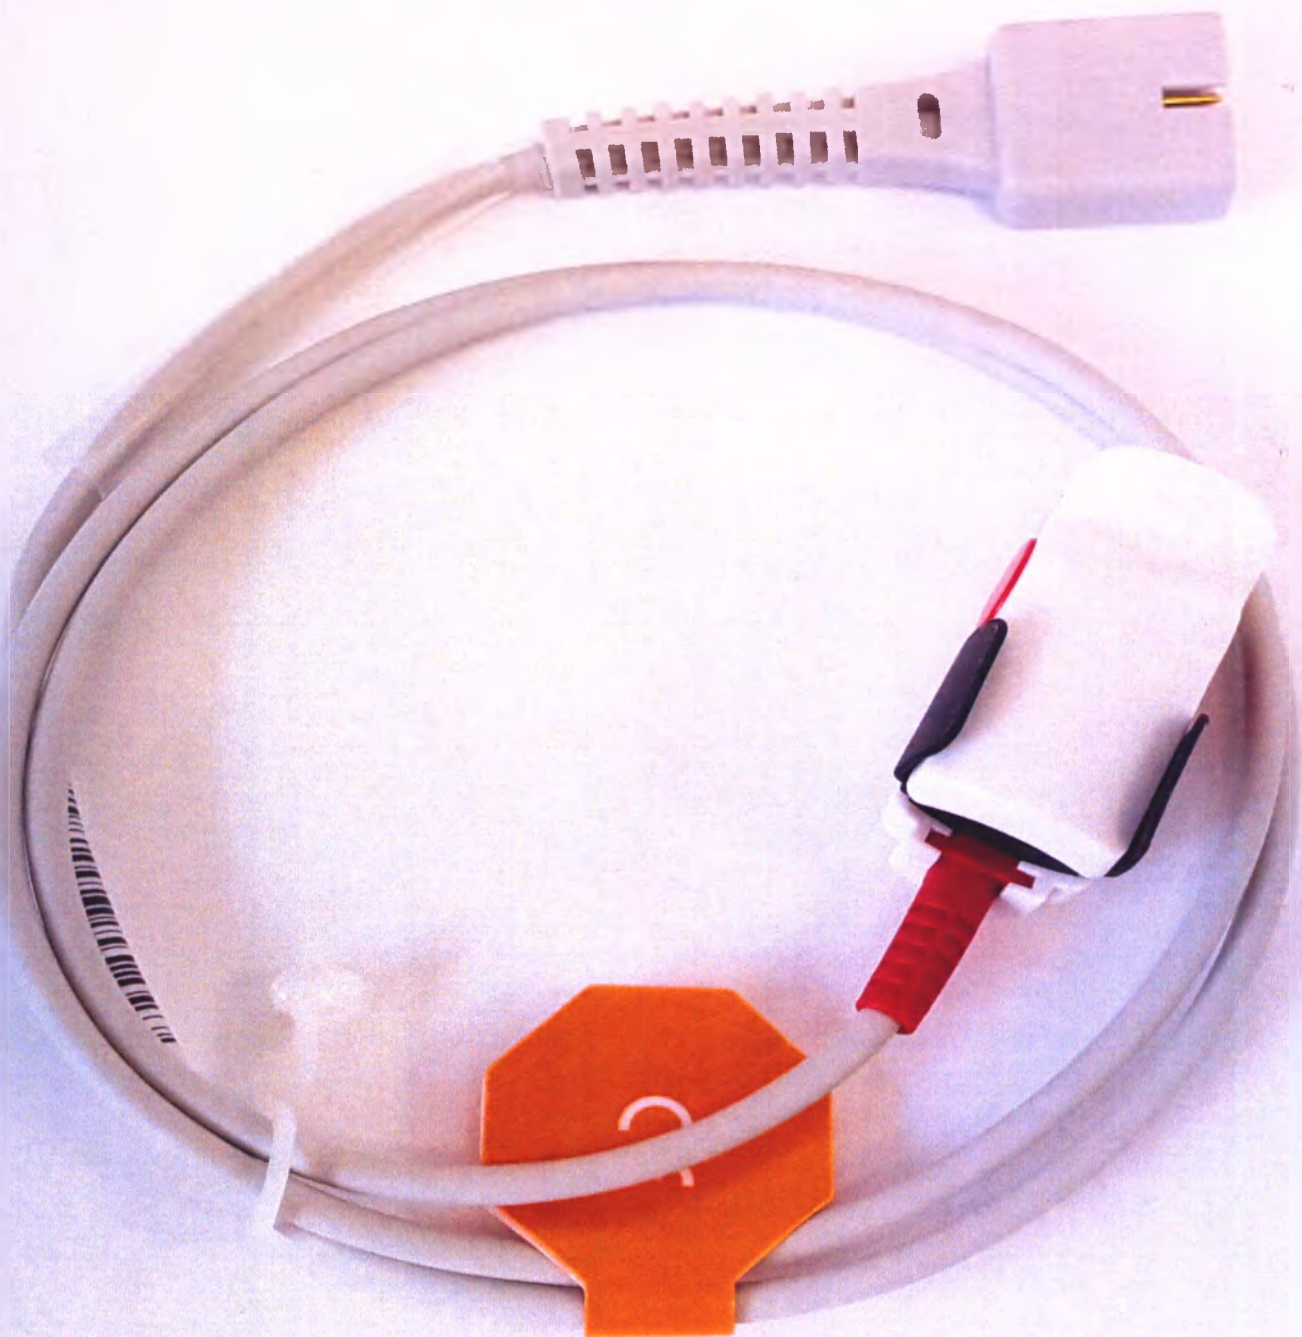

5. Датчик SpO₂ многоразовый для взрослых мягкий



6. Датчик SpO₂ многоразовый для детей мягкий

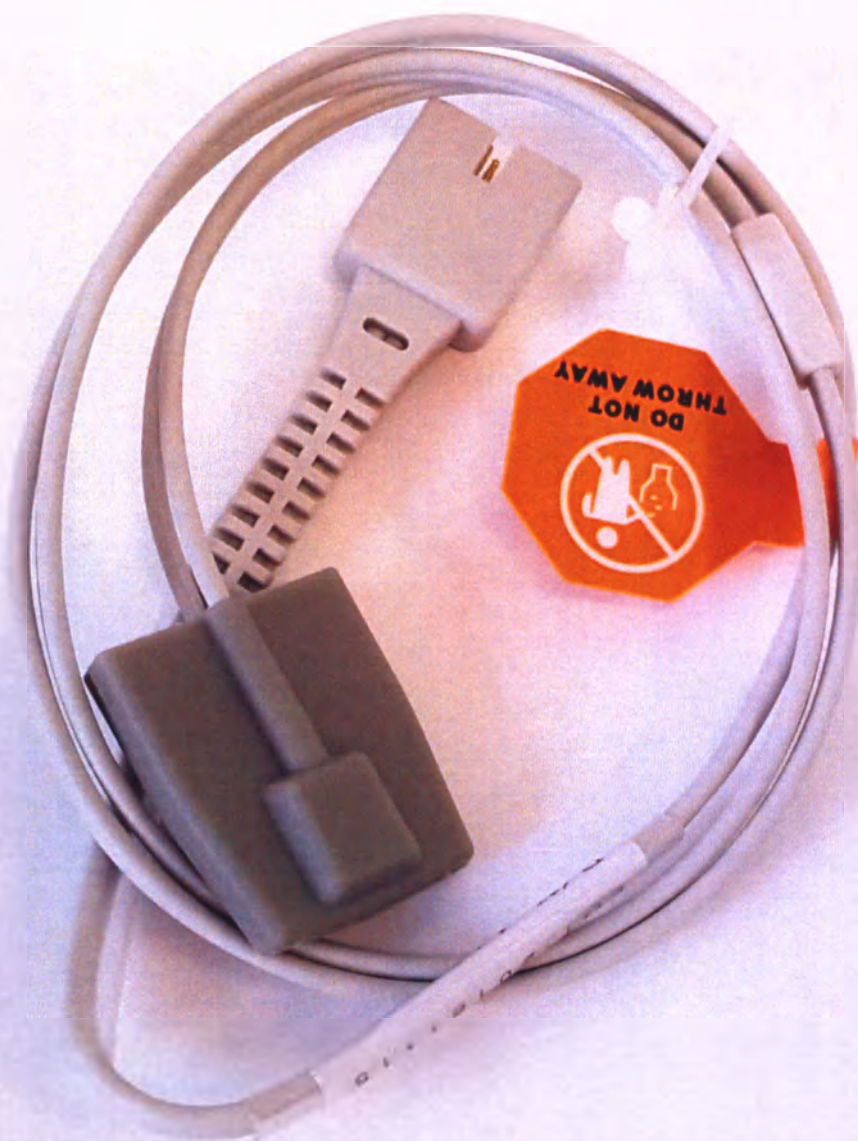


7. Датчик SpO₂ многоразовый для младенцев мягкий




8. Датчик SpO₂ многоразовый неонатальный



9. Датчик SpO_2 многоразовый универсальный

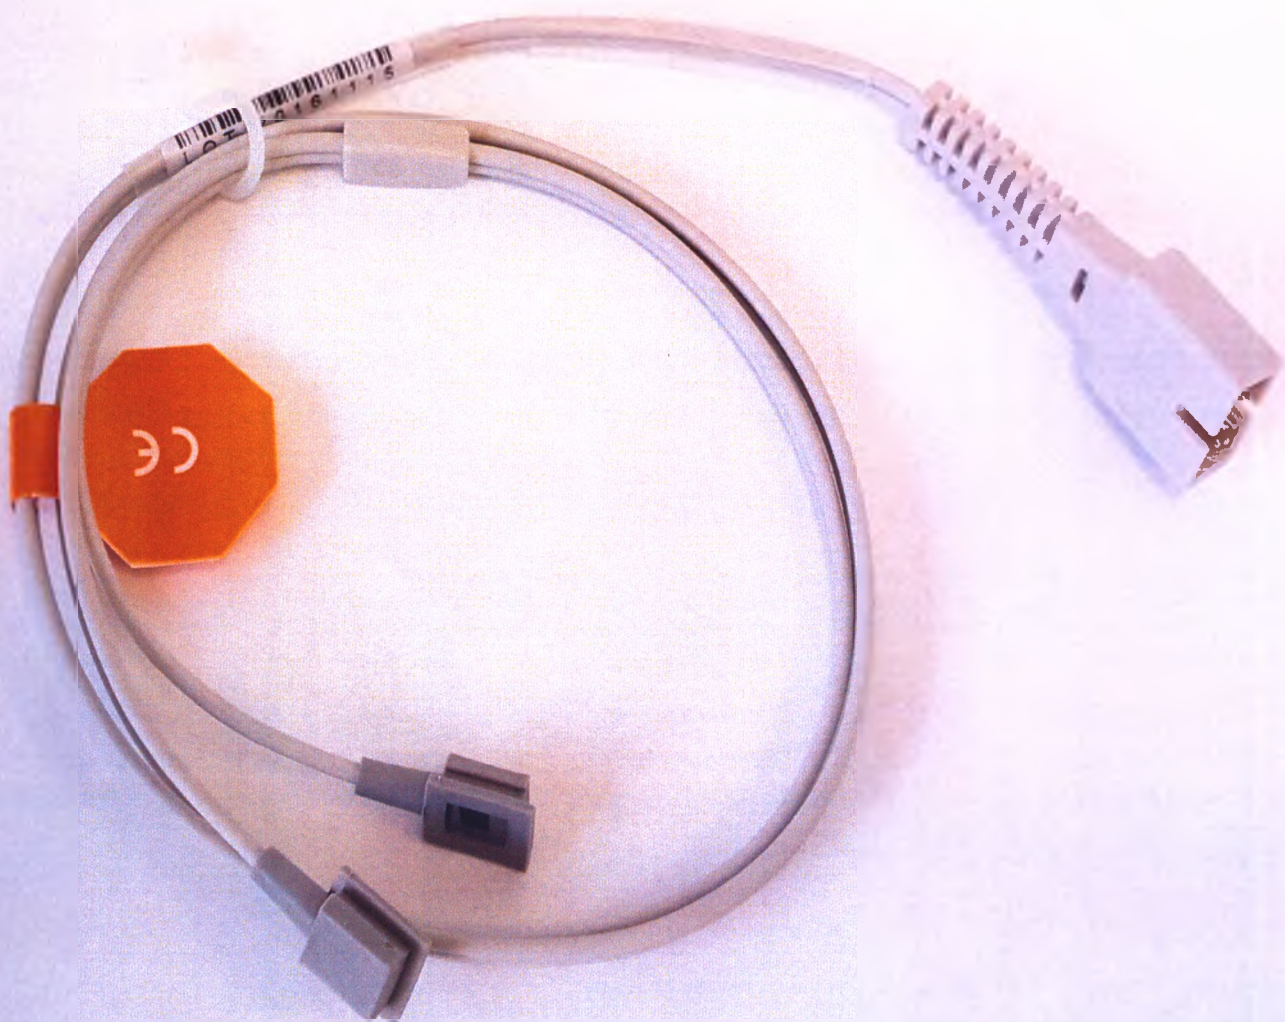


10. Датчик SpO₂ для одного пациента для взрослых

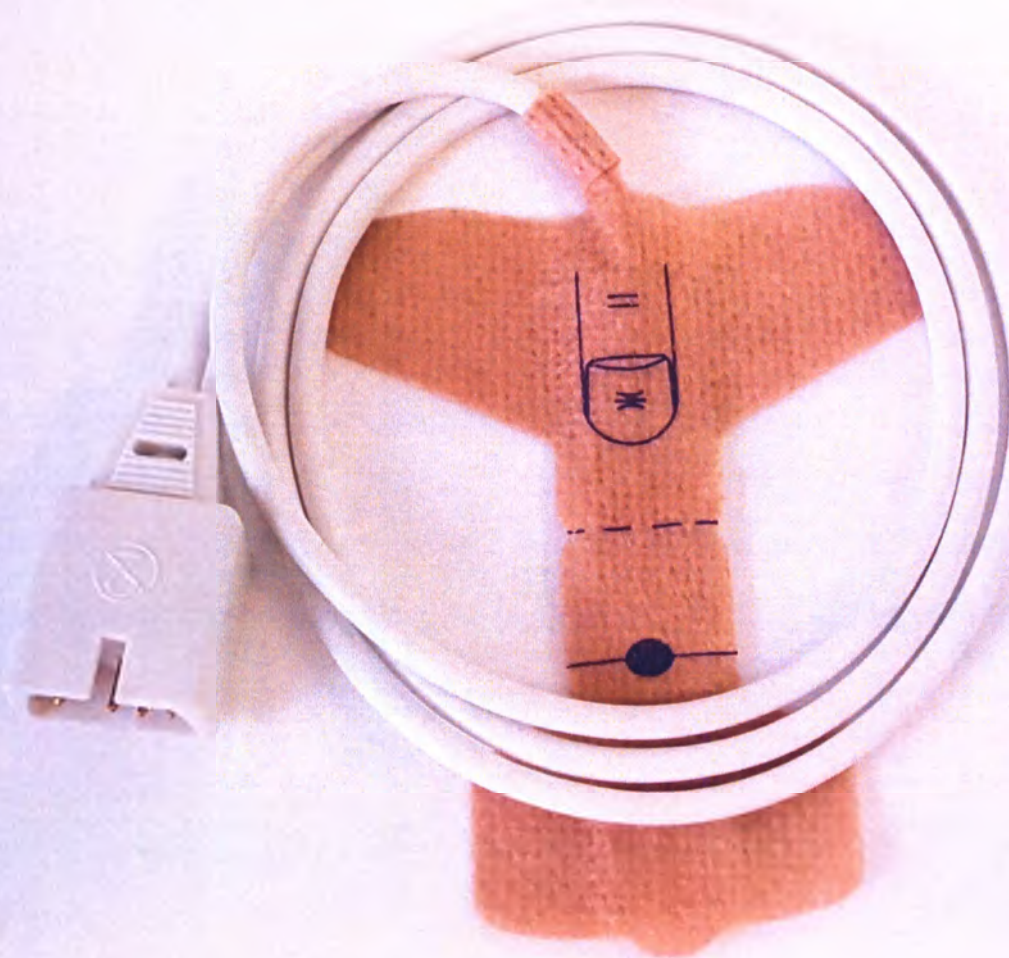


11. Датчик SpO₂ для одного пациента для детей




12. Датчик SpO₂ для одного пациента для младенцев

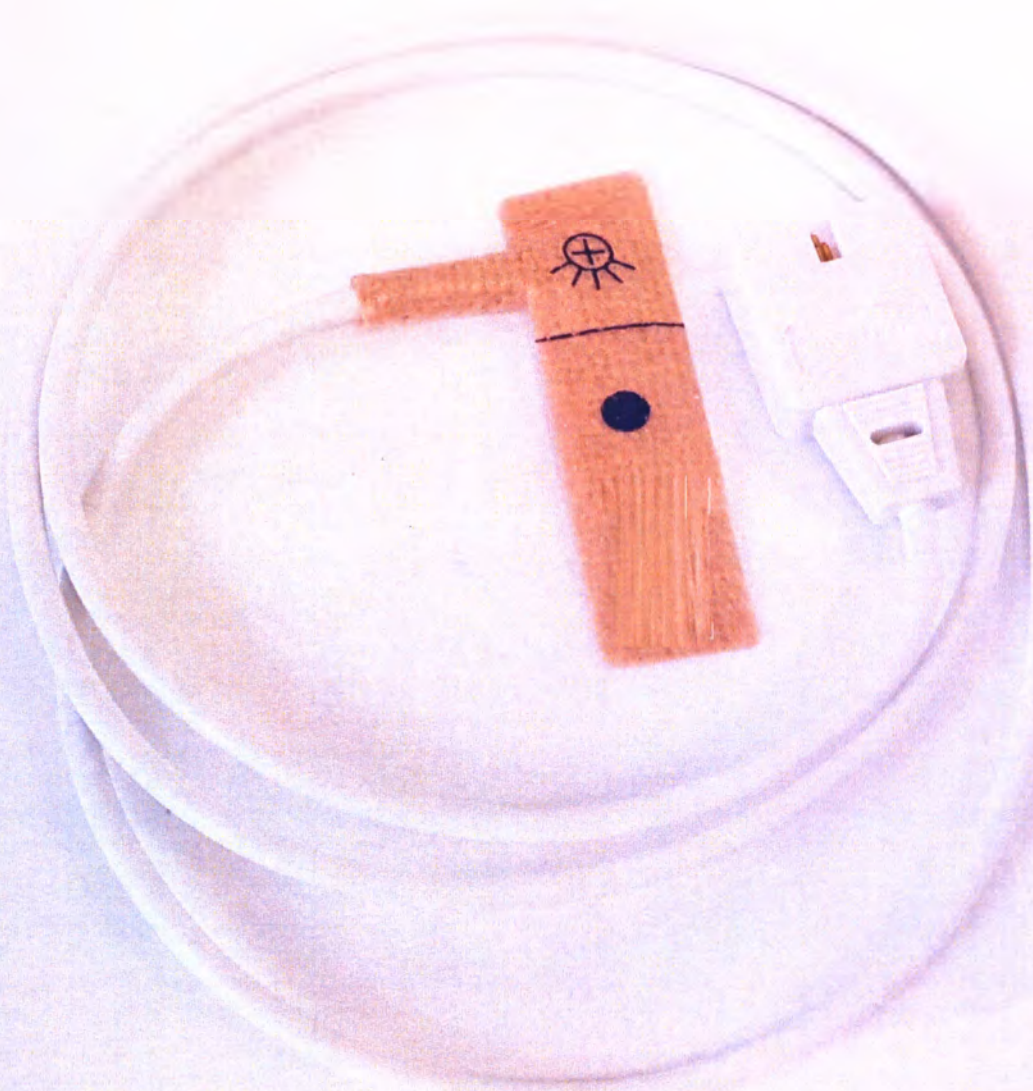

13. Датчик SpO₂ для одного пациента неонатальный

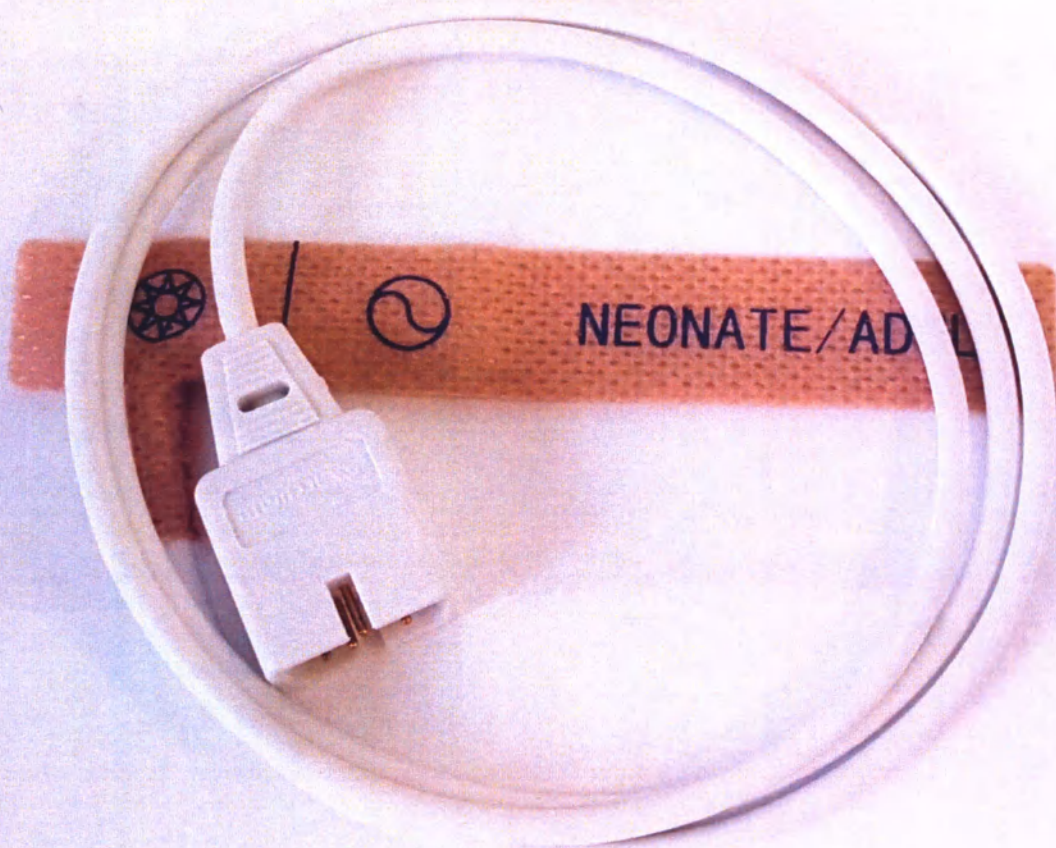

14. Литий-ионная аккумуляторная батарея

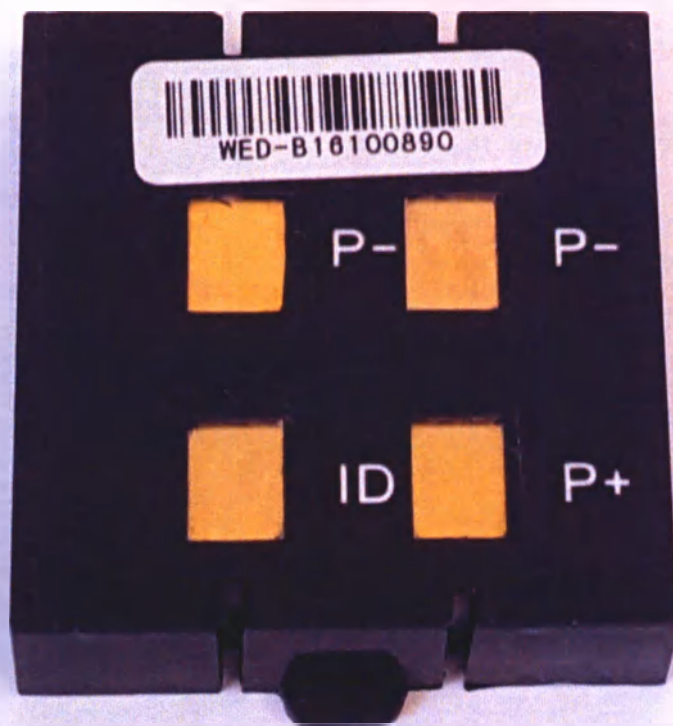

15. Зарядное устройство



Руководство по эксплуатации

**Пульсоксиметр
ТОРМЕД НР-10/НР-20**



Принадлежности для пульсоксиметров TOPMED, варианты исполнения: НР-10 и НР-20:
1. Чехол резиновый защитный.



Прошнуровано и скреплено
печатью 29 листов

Генеральный директор
ООО «МЕДИКОМ»
Голубинский О. Ю.

