

**Фотографические изображения изделия «Радиочастотного устройства EVA для
лечения послеродового растяжения мышц влагалища».**

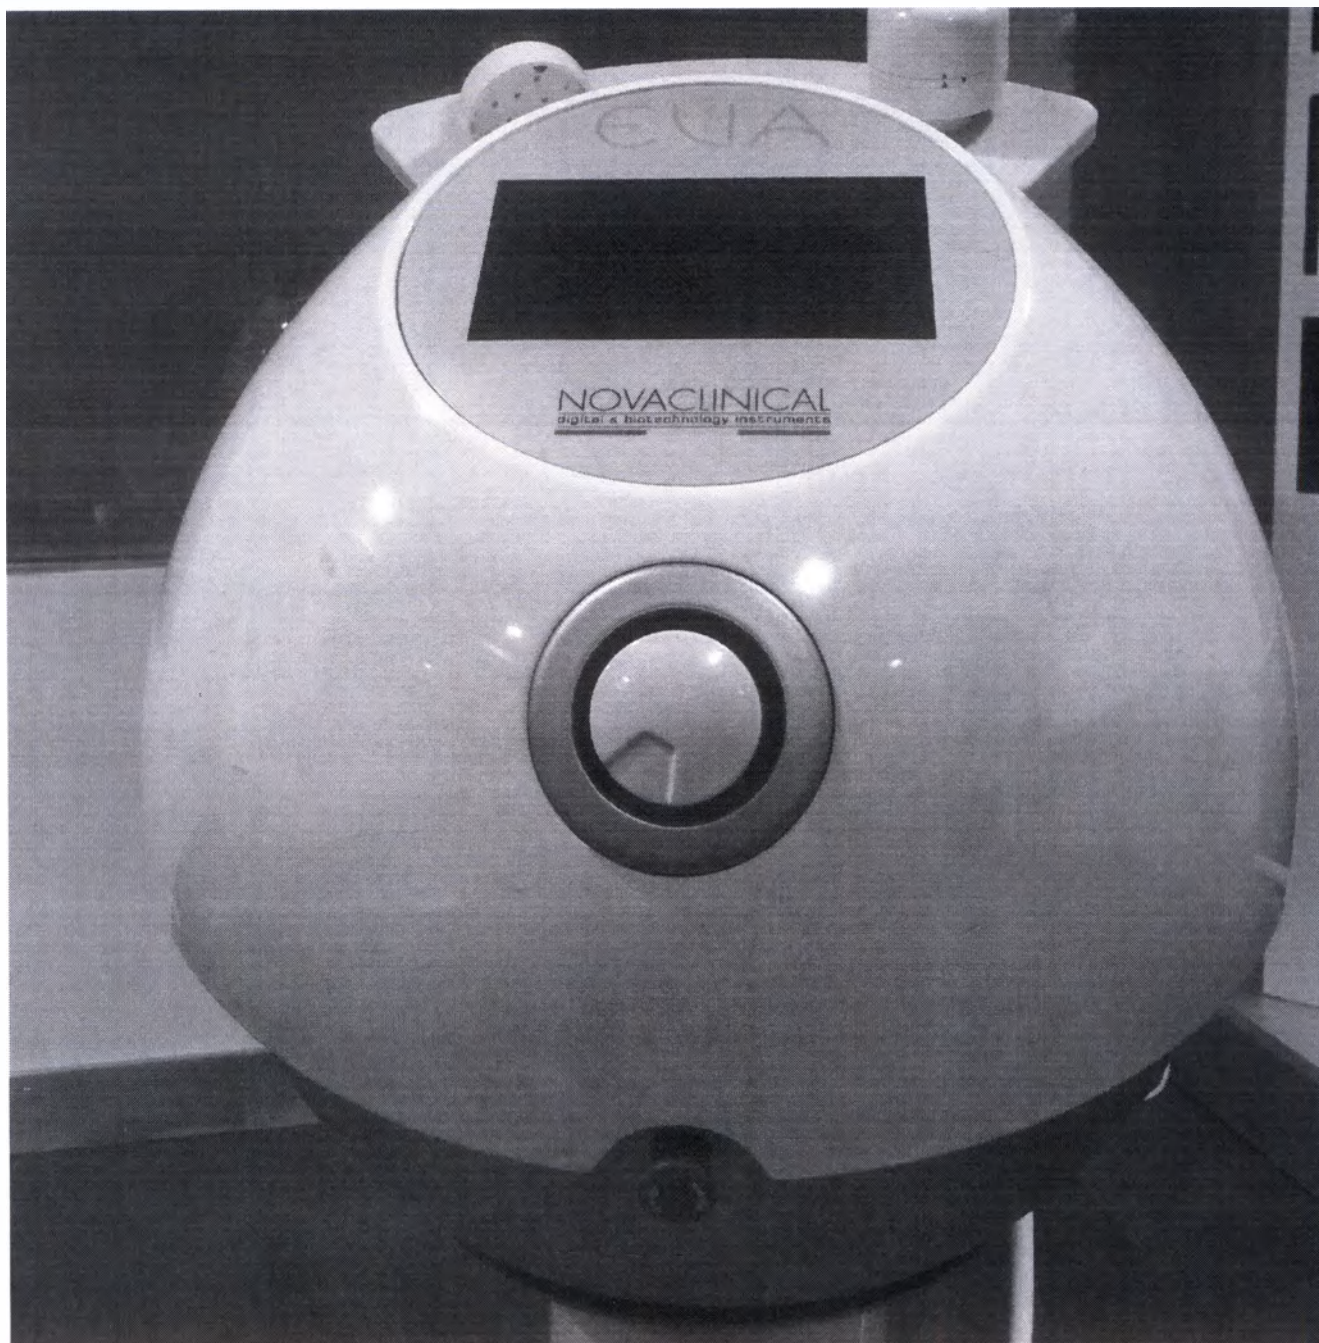


Рис. 1. Основное устройство.

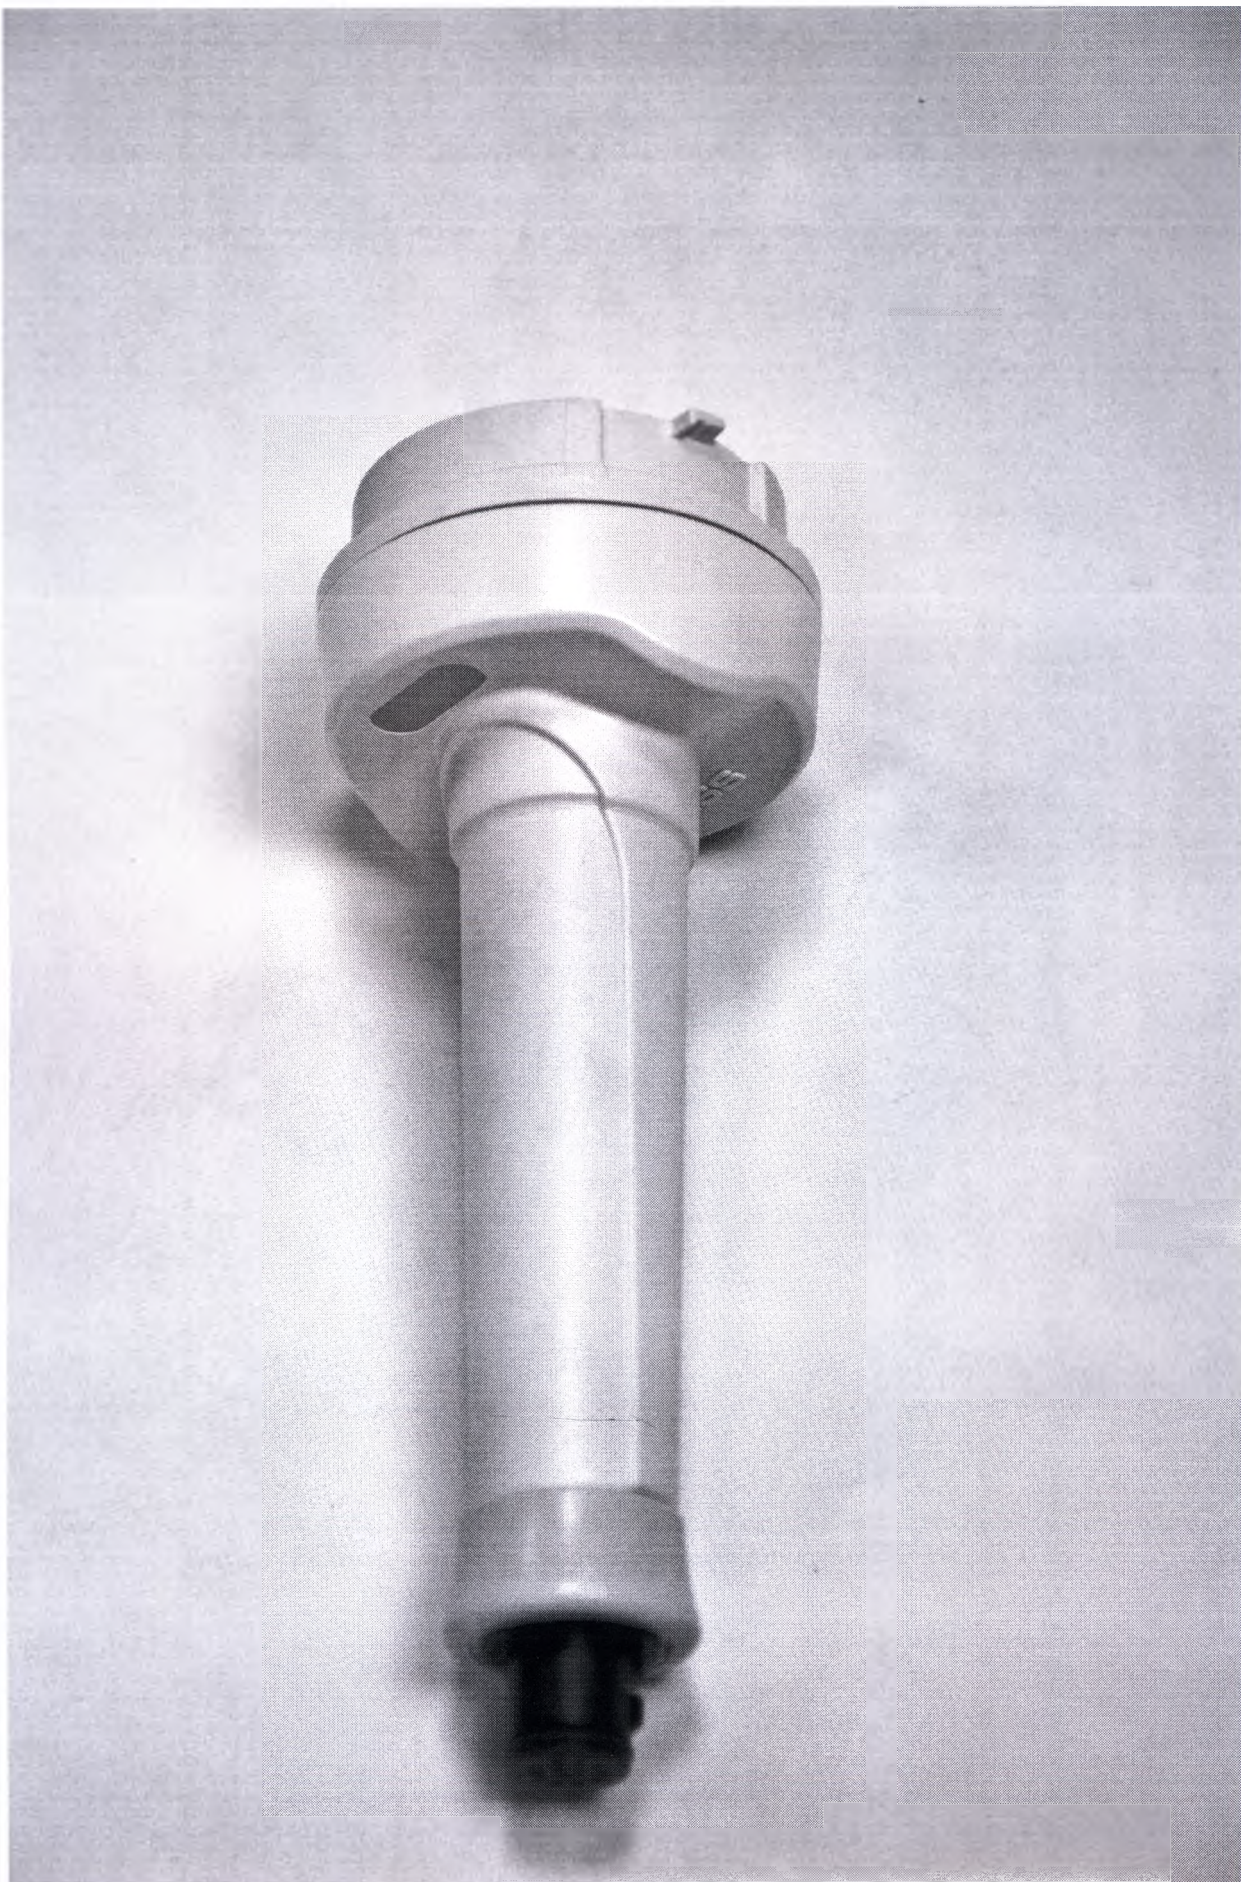


Рис. 2. Рукоятка.

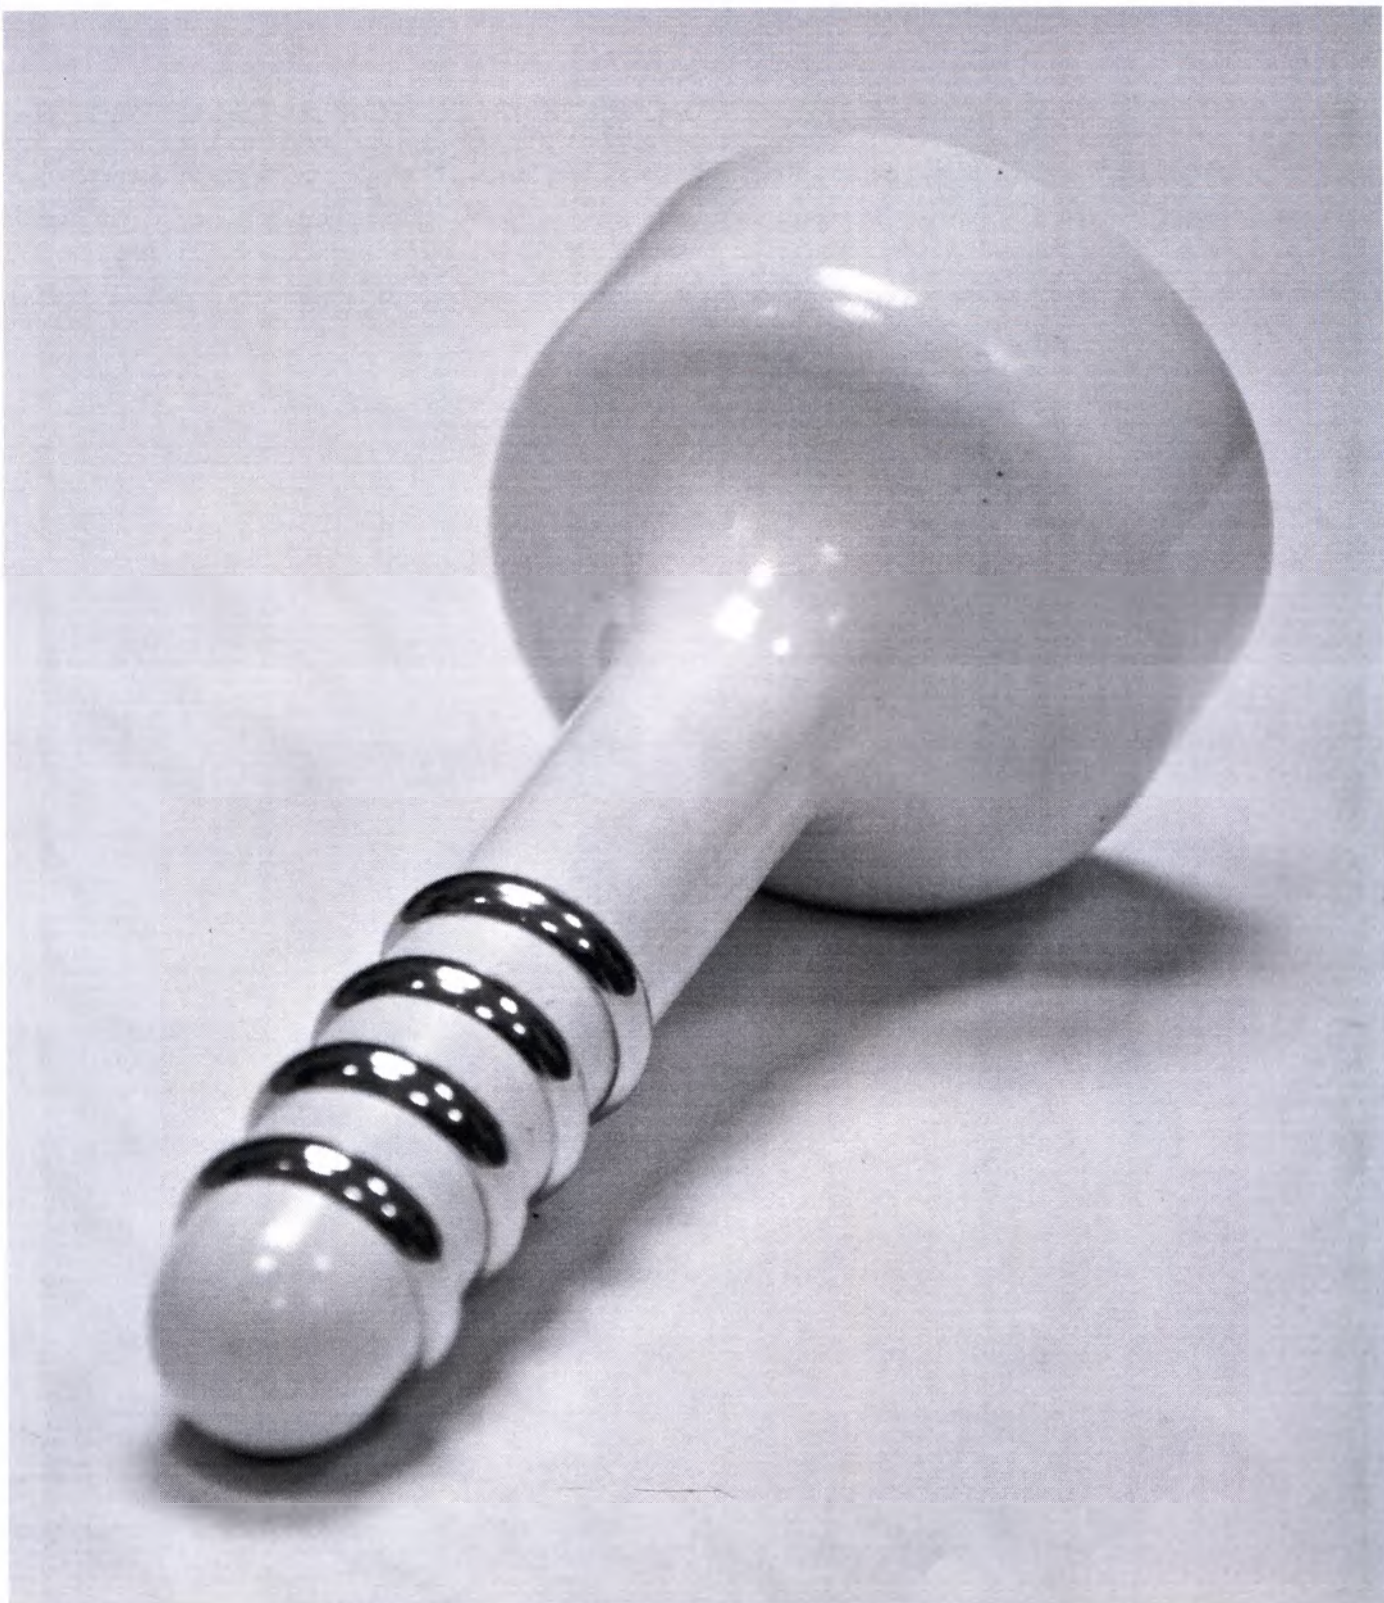


Рис. 3. Наконечник с 4 кольцами для внутренней терапии (VTR 1).

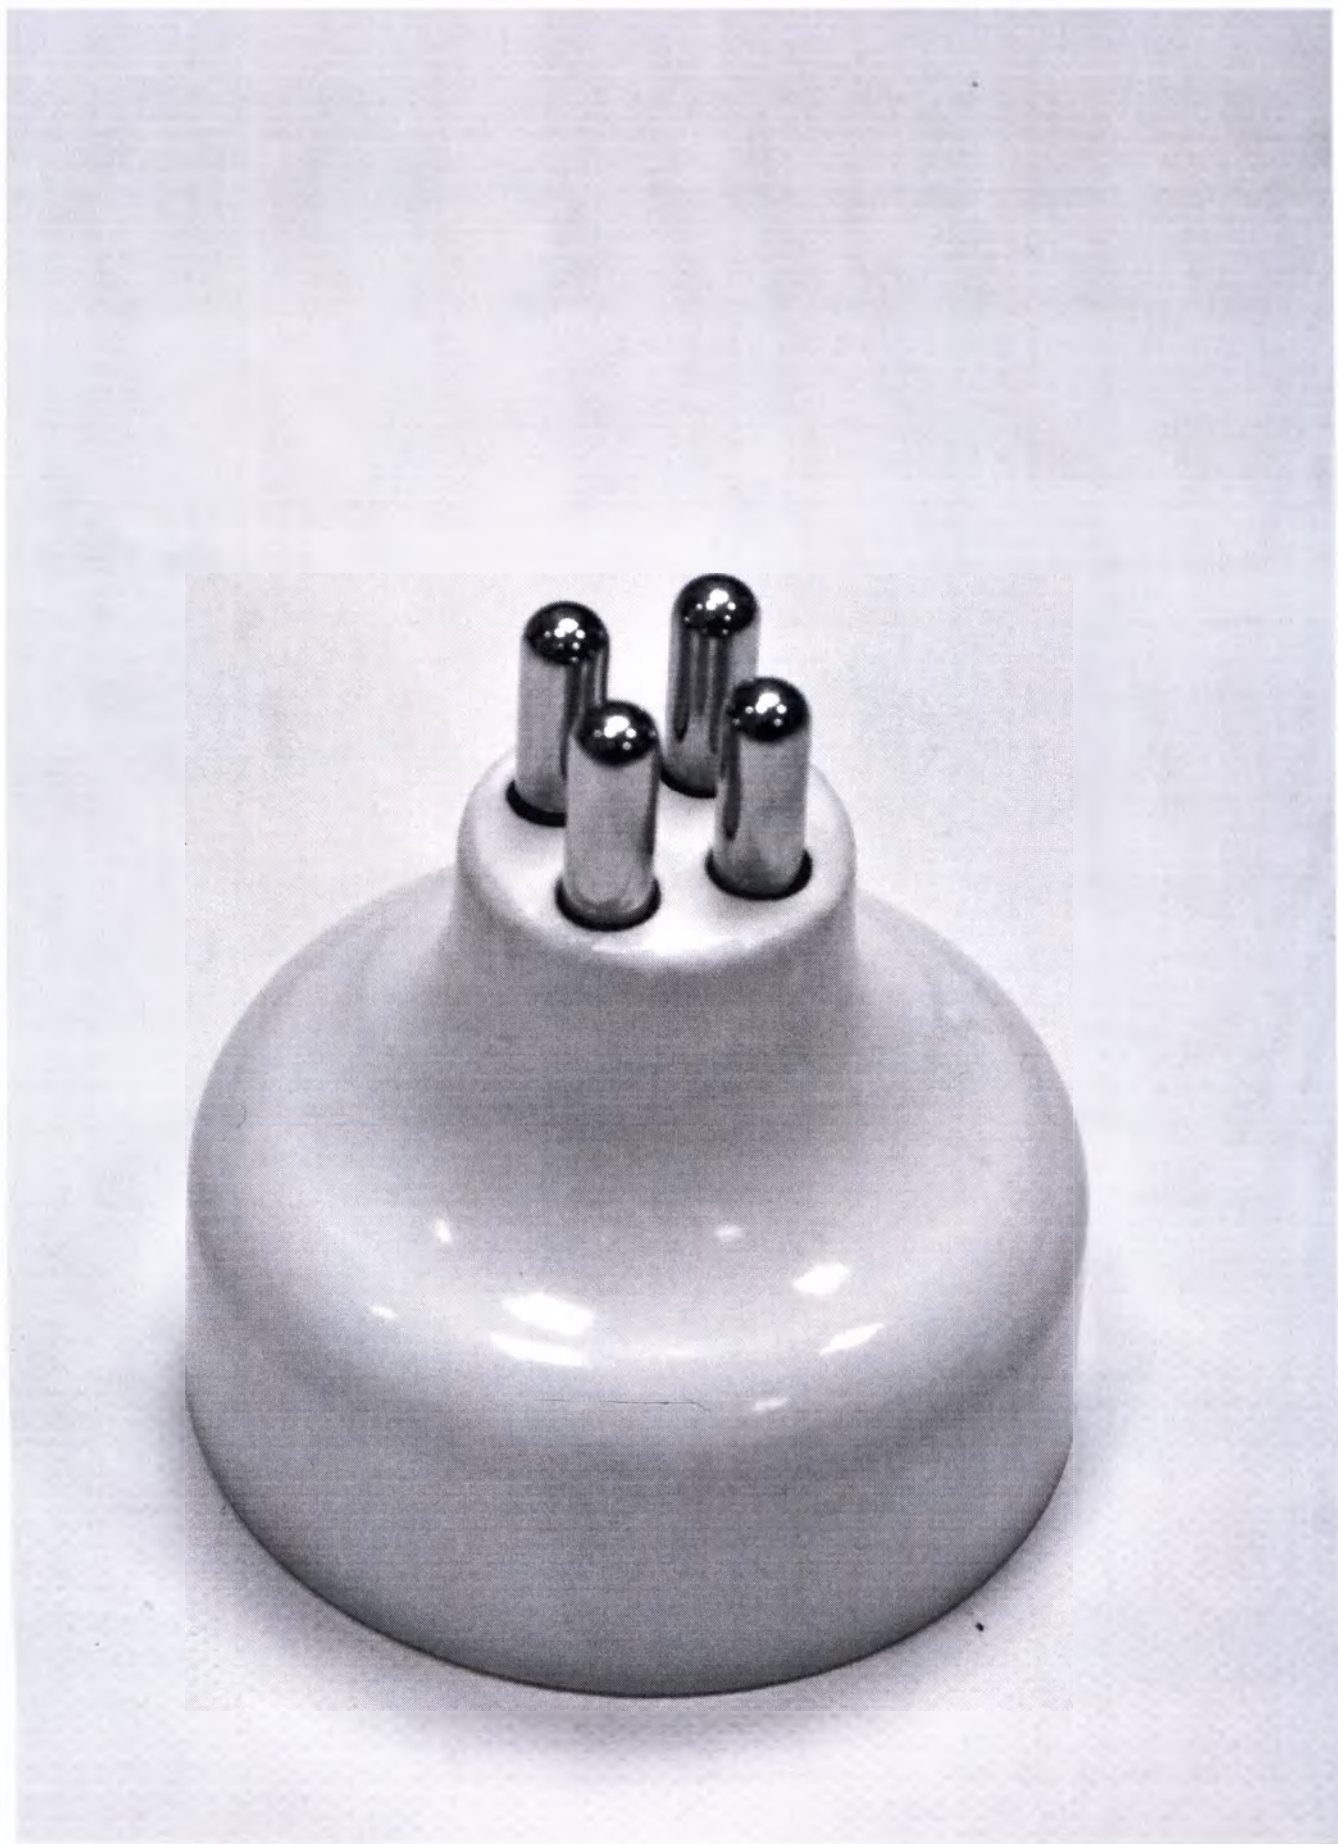


Рис. 4. Наконечник с 4 электродами для наружной терапии (VTR2).



Рис. 5. Кнопка биологической обратной связи.



Рис. 6. Кабель для подключения рукоятки.

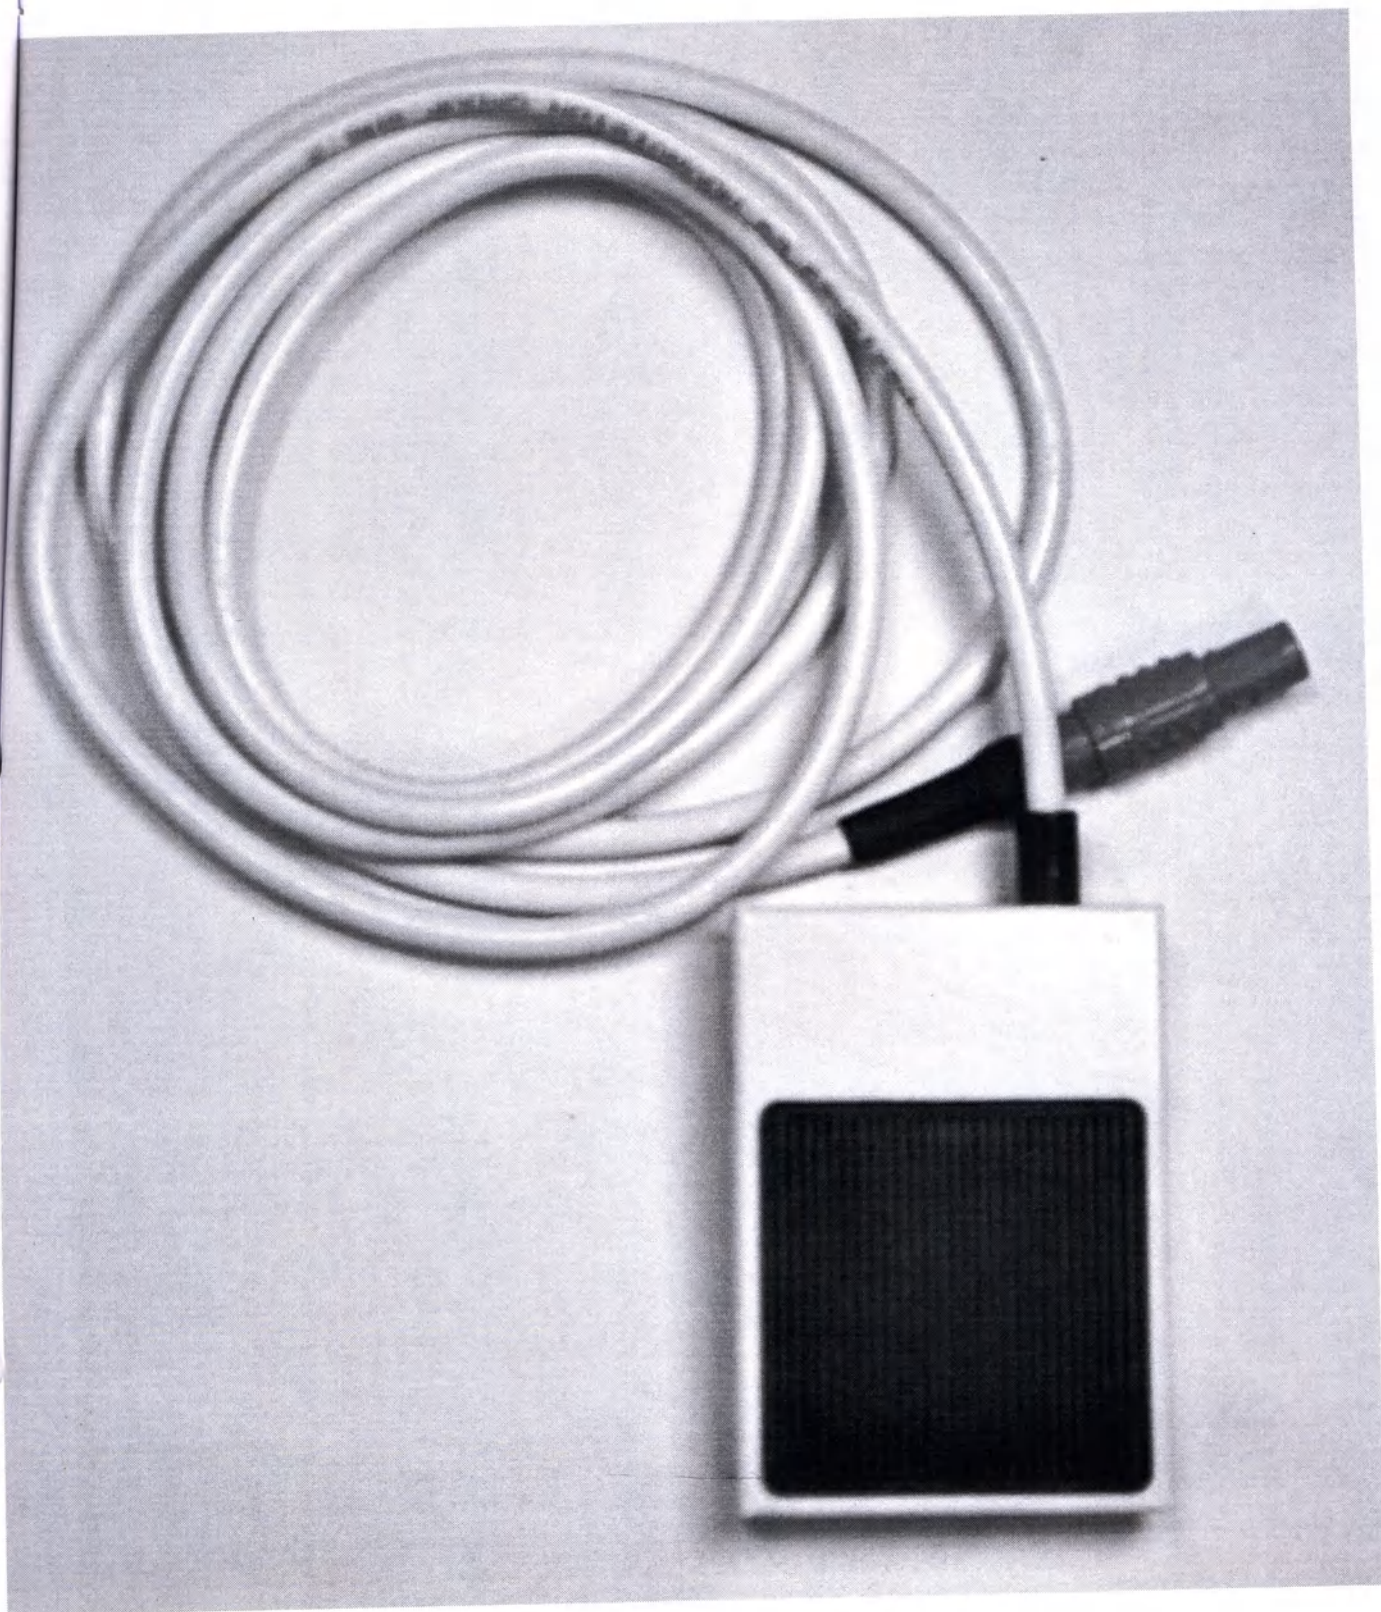


Рис. 7. Педаль.



Рис. 8. Ключ выключения питания, 2 шт.



Novavision Group
20826 Misinto (MB) - Italy




2016

EVA




100-240Vac 50-60Hz Max 100 W



F2 x T1,6A



3.80.800.000282



EVA1000



0476

Сделано в Италии



Рис. 9. Макет маркировки радиочастотного устройства EVA для лечения послеродового растяжения мышц влагалища.

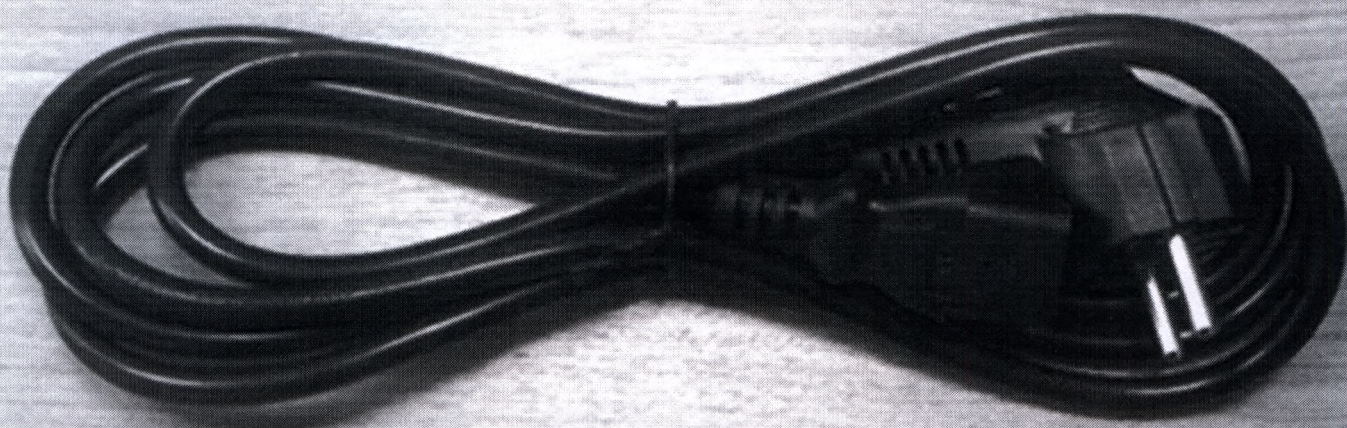


Рис. 10. Сетевой кабель с заземлением.

Всего прошито, проклеено и скреплено печатью и
подписью 10 листов (-а)

Директор
ООО «Элмас»



Фадеев О.Г.