

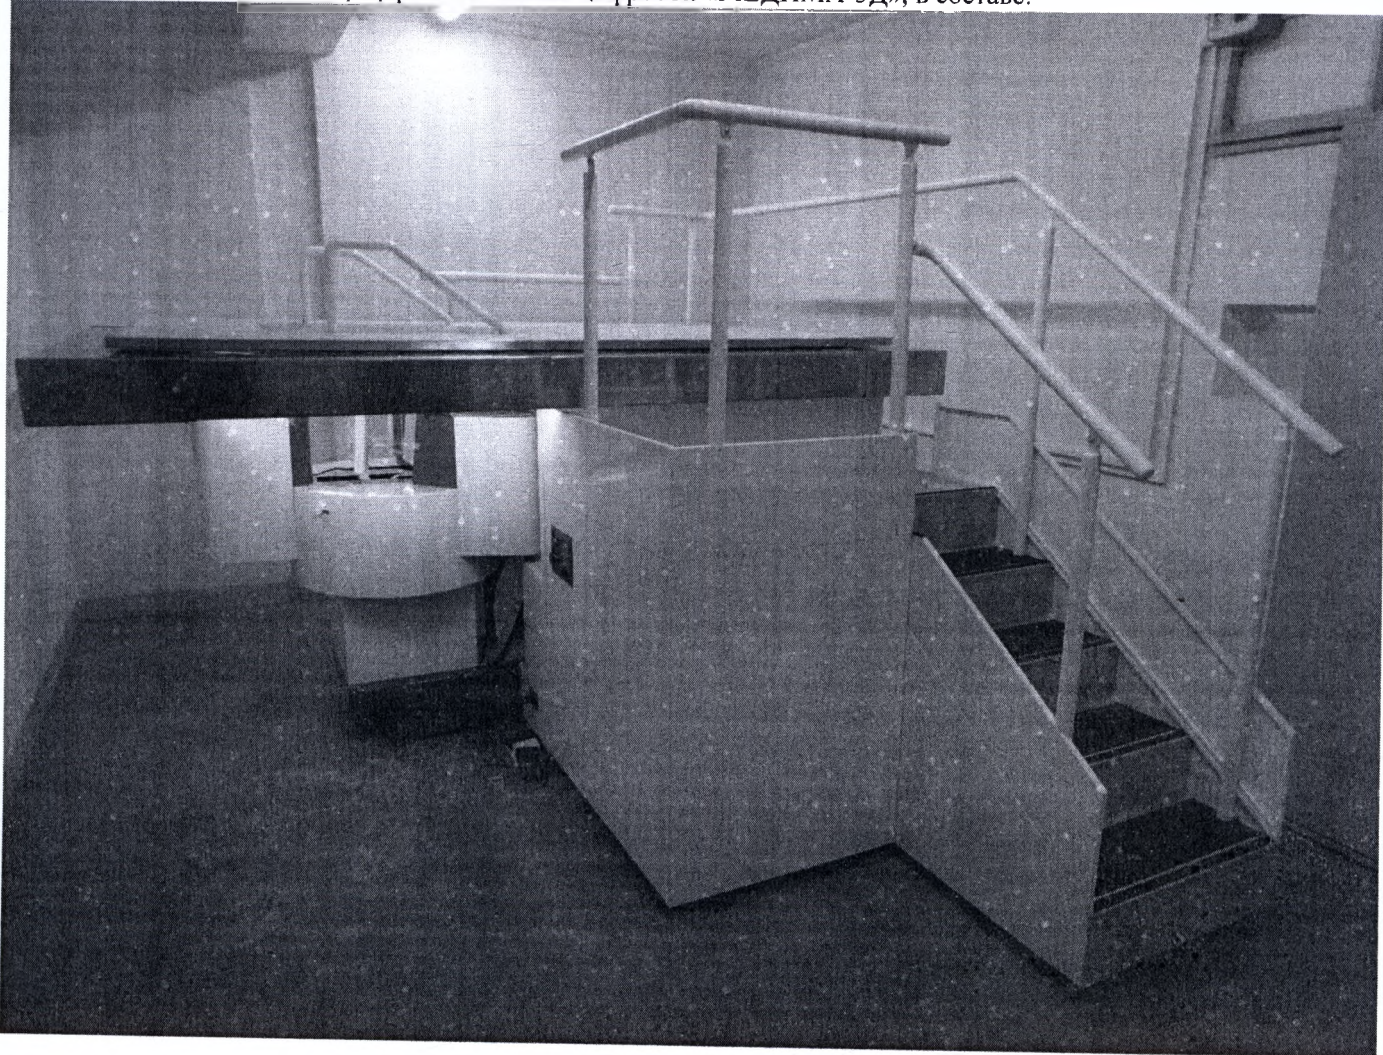


**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ**  
Маммограф рентгеновский цифровой «МЕДИМА-3Д»  
по ТУ 26.60.11.113- 004-71327975-2017


I. Маммограф рентгеновский цифровой «МЕДИМА-3Д», в составе:

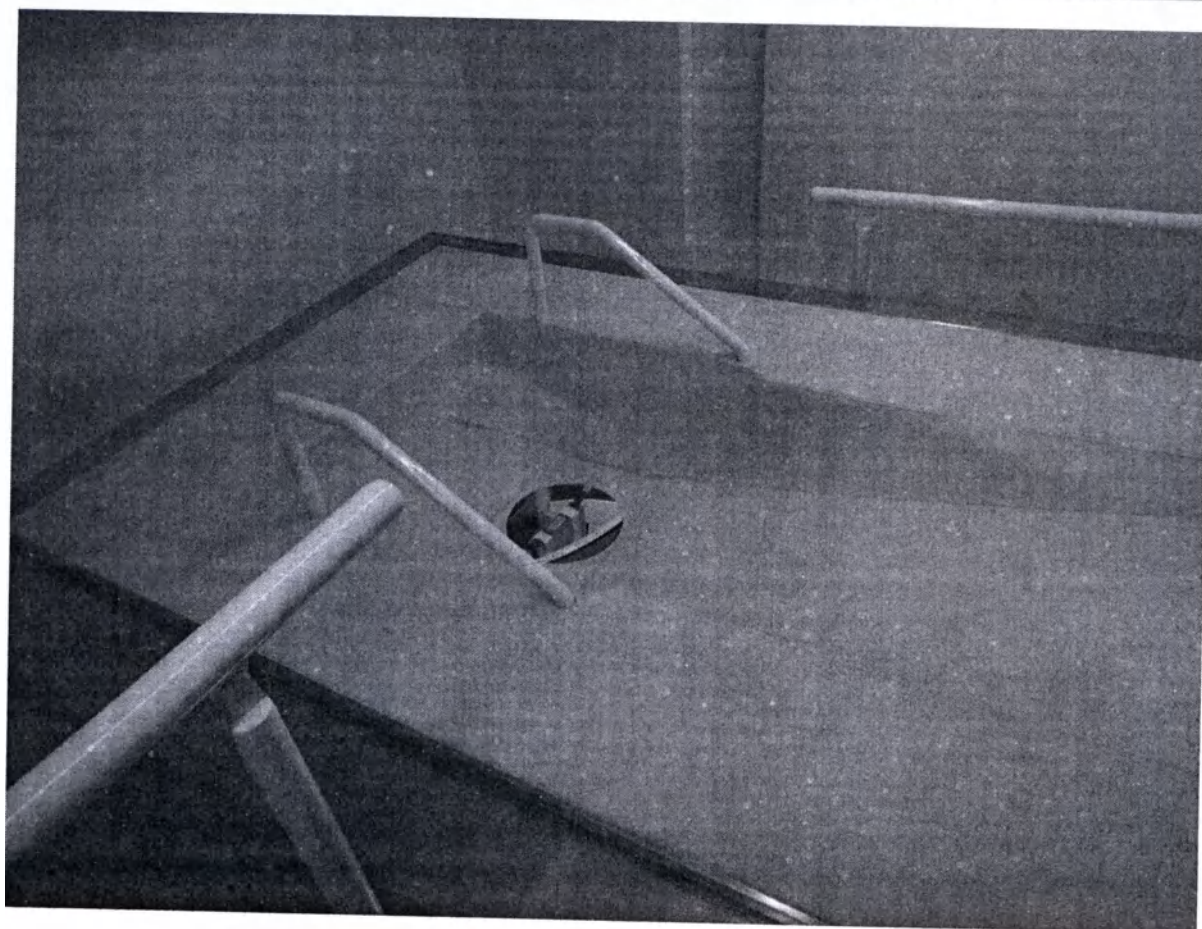

1. Штатив для укладки пациентов.

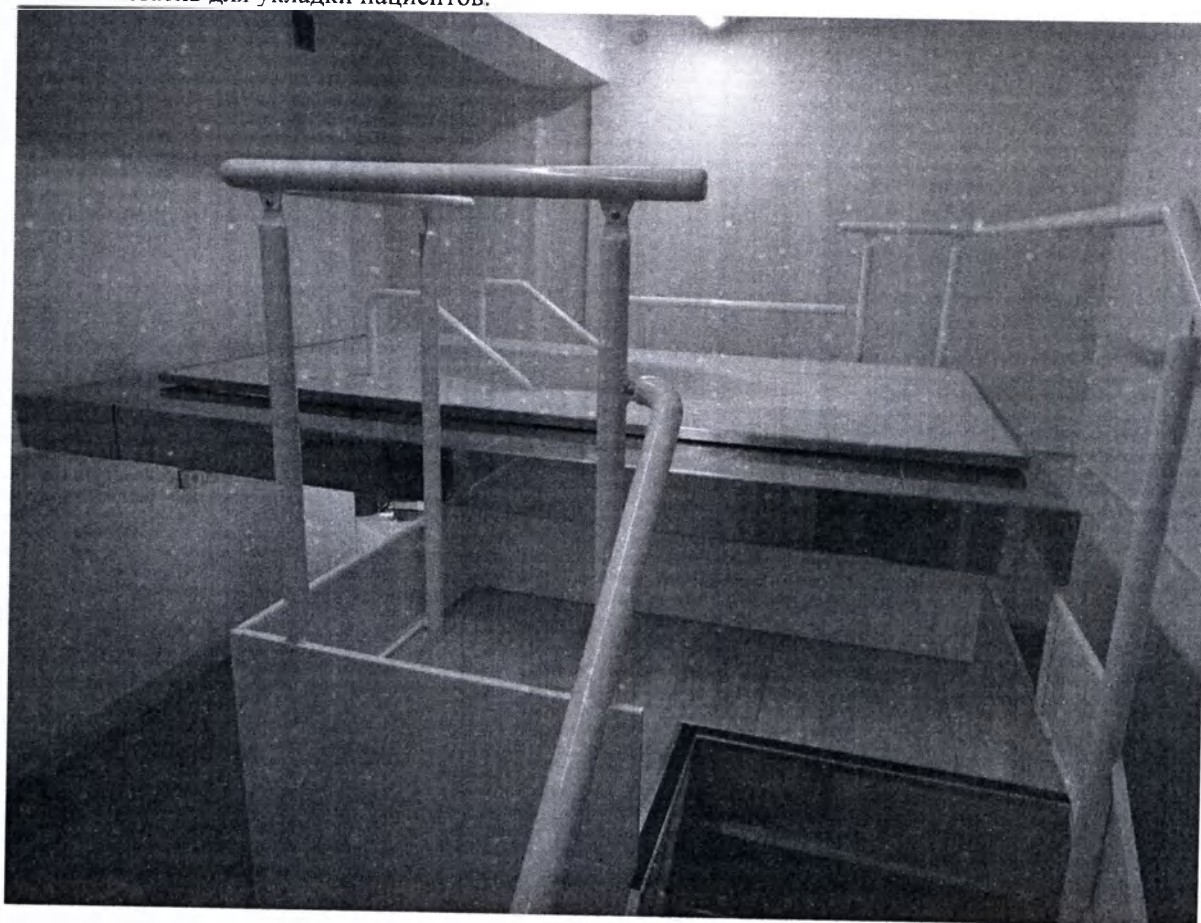


2. Блок рентгено-оптический.

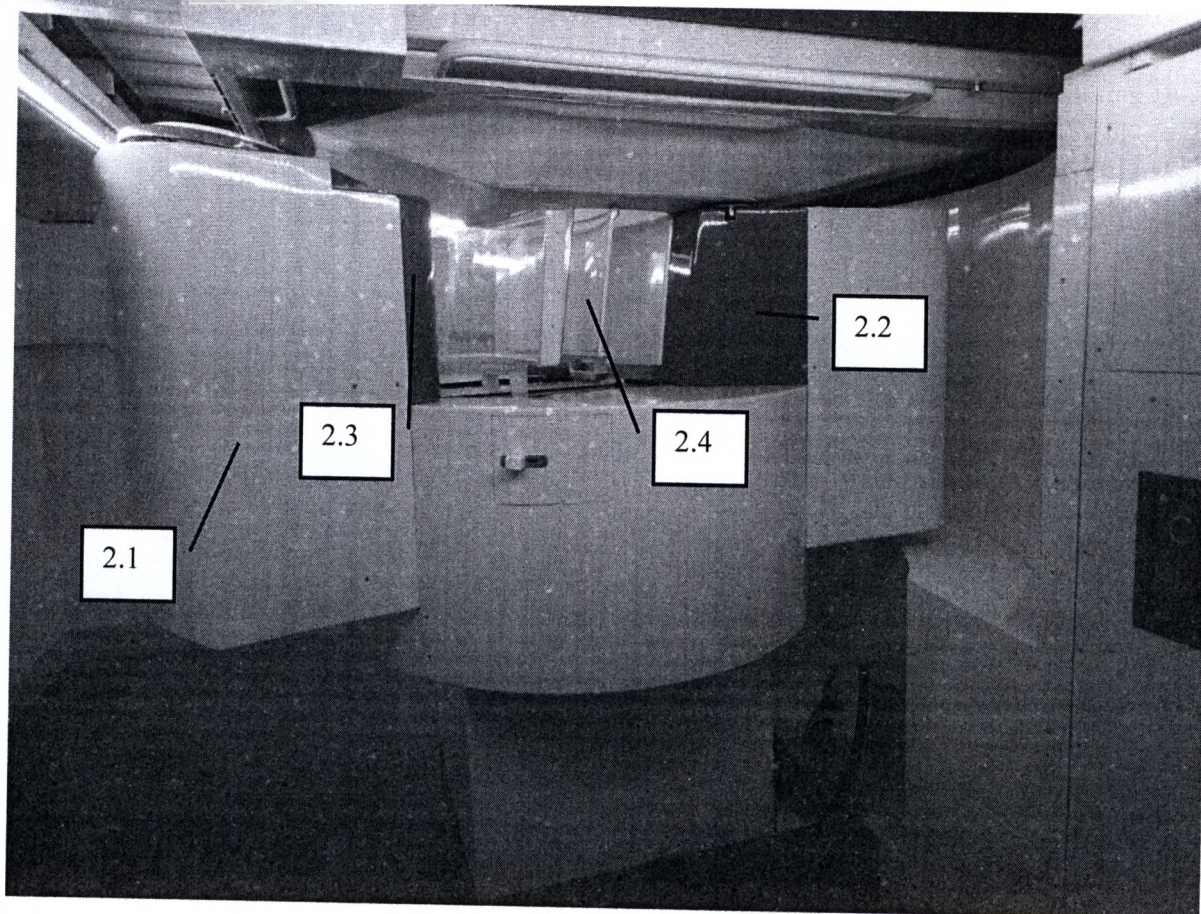


- 2.1 Излучатель рентгеновский.
- 2.2 Детектор.
- 2.3 Коллиматор.


#### 2.4 Устройство для фиксации и компрессии.

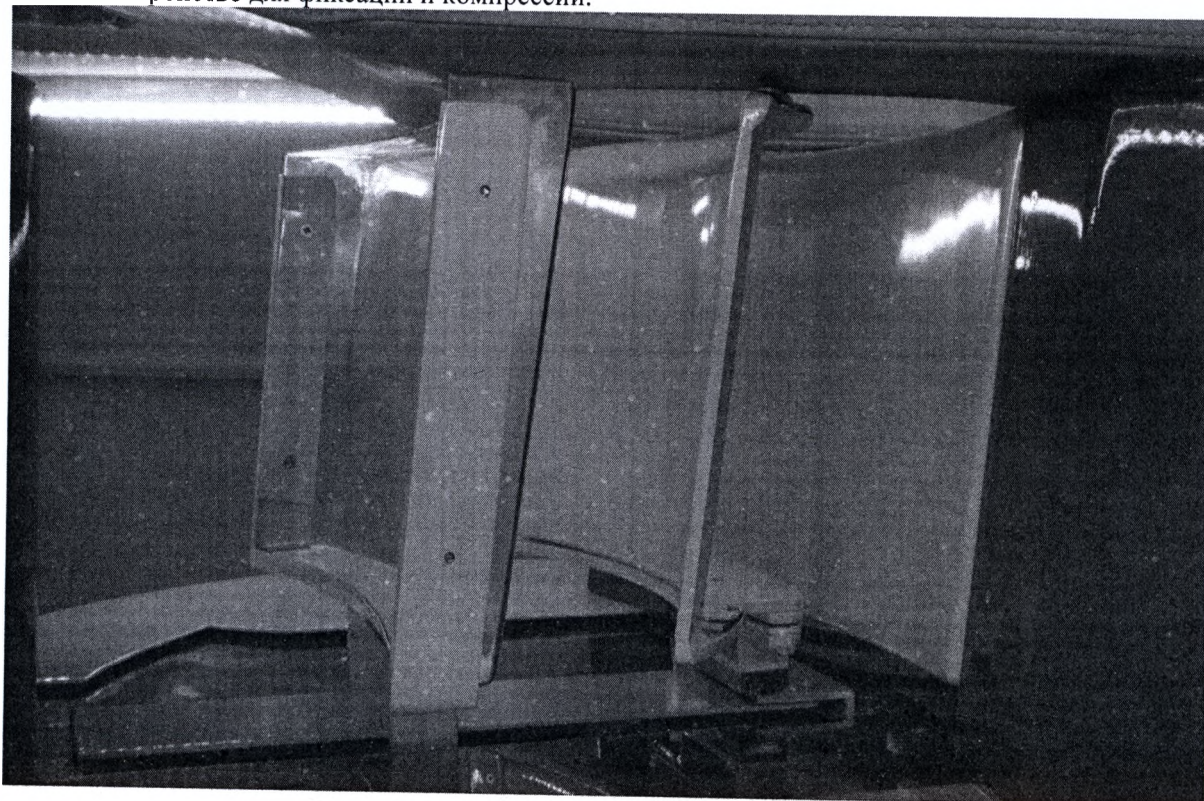


### 3. Устройство рентгеновское питающее.

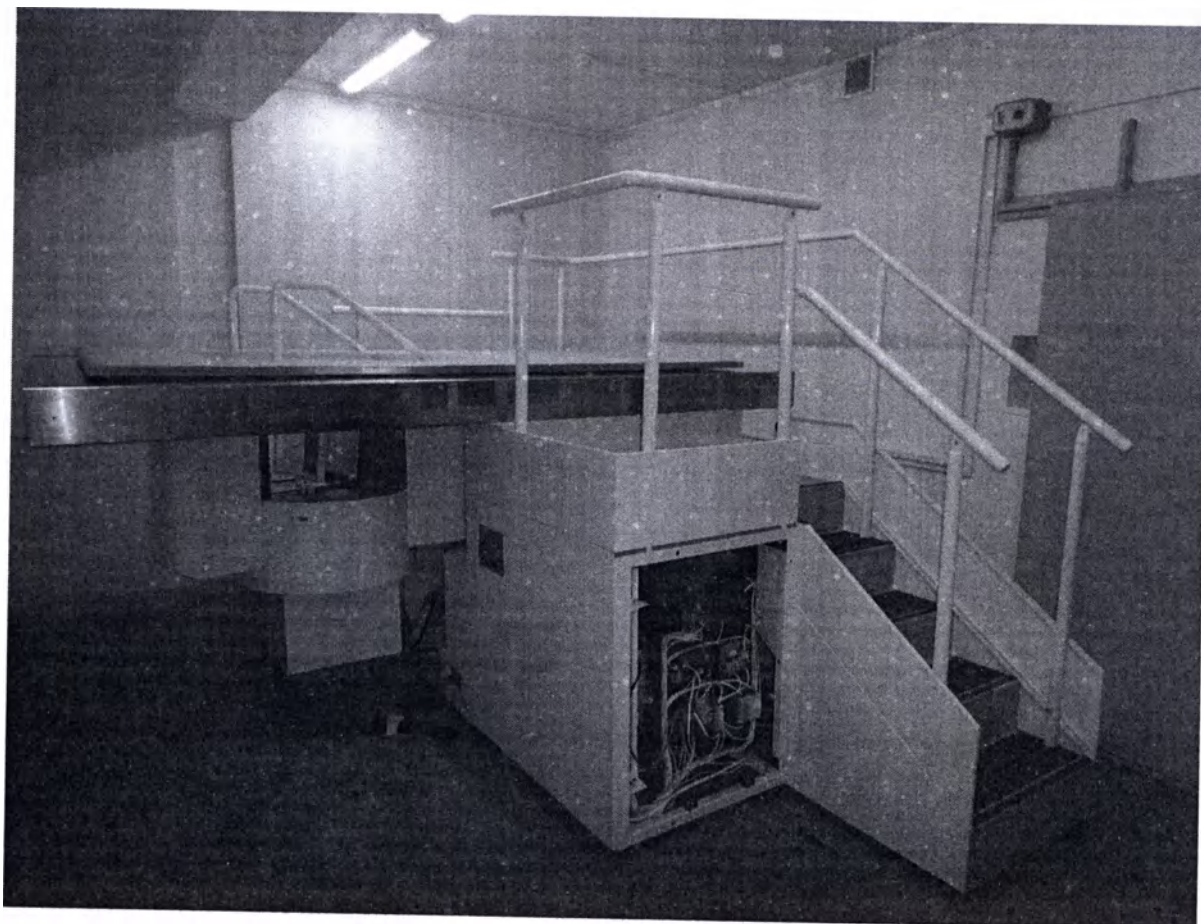


4. Пластина компрессионная.

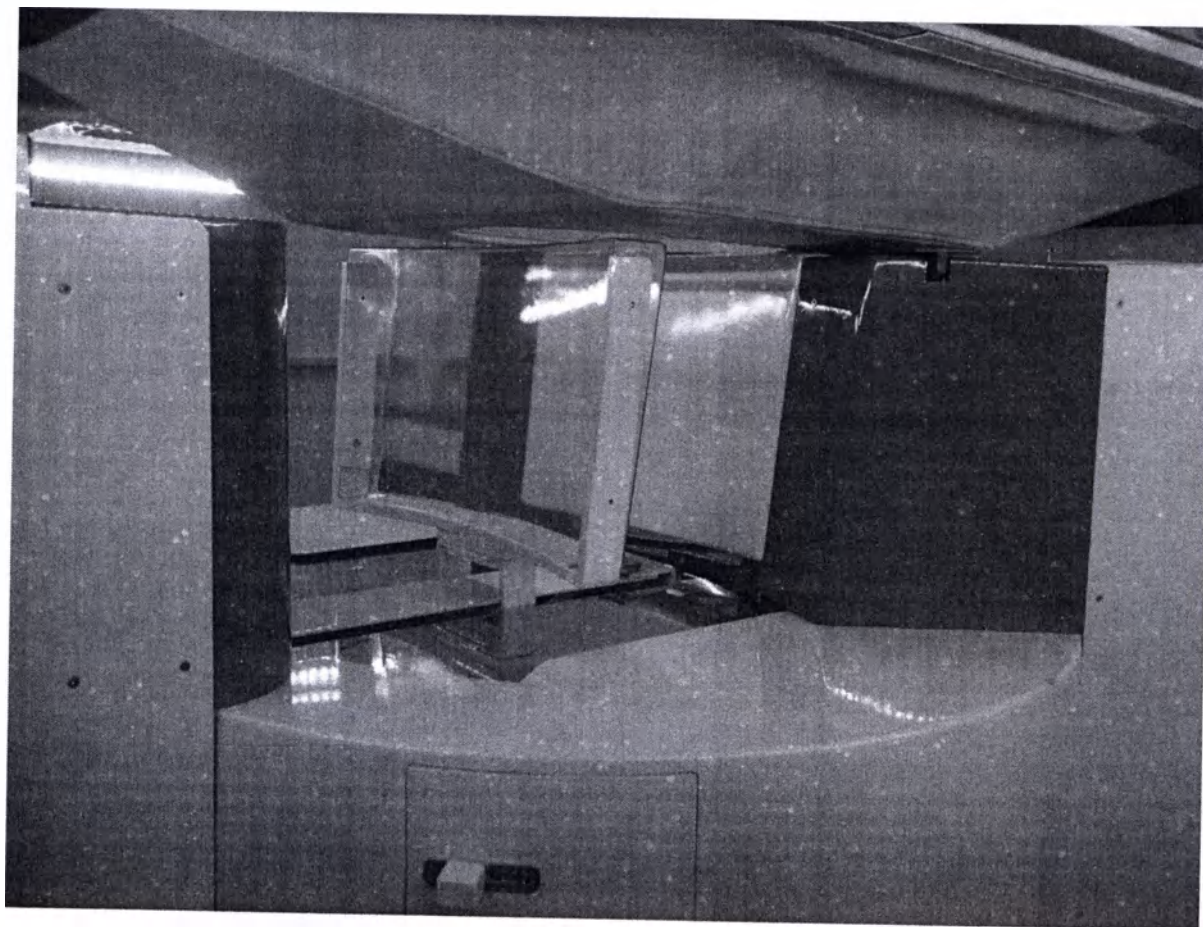


5. Пластина компрессионная для томосинтеза.

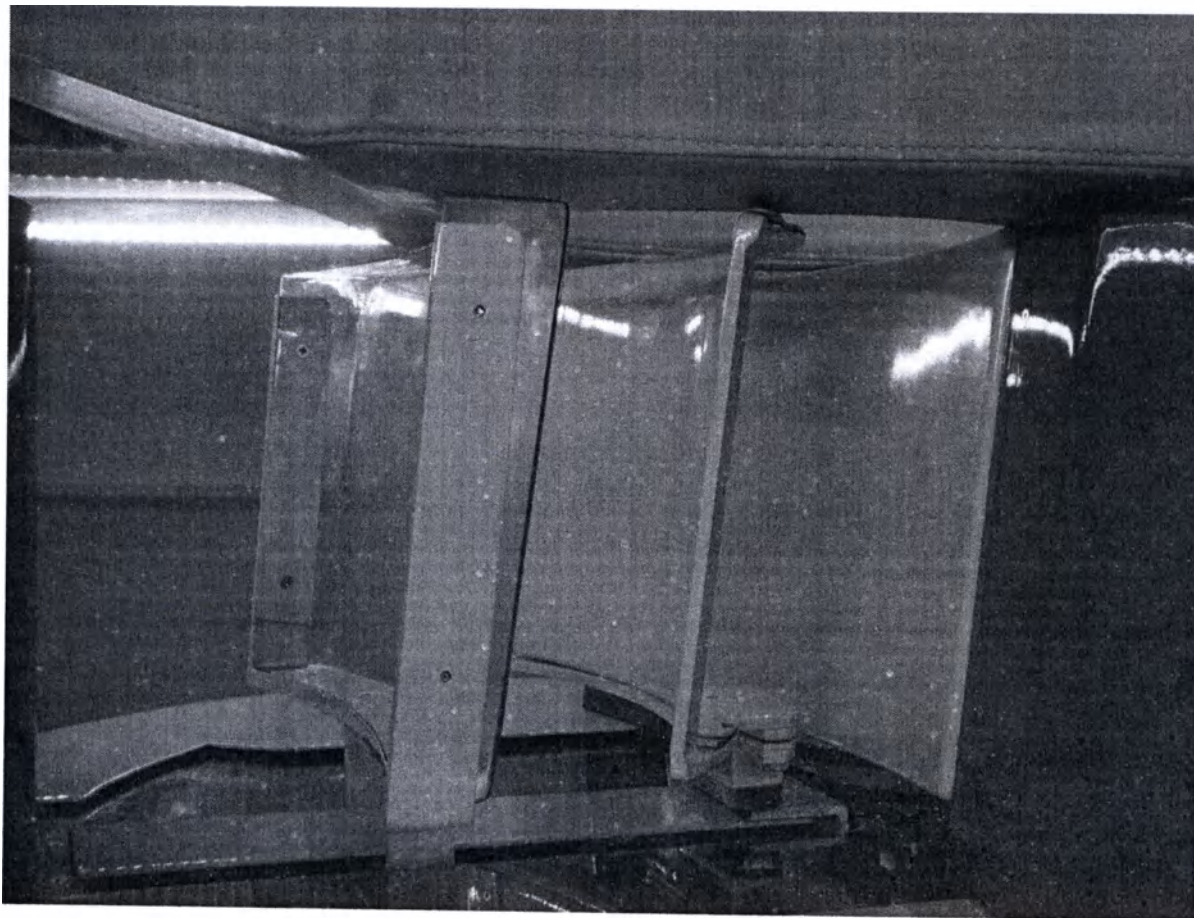


6. Блок педалей компрессия/декомпрессия.

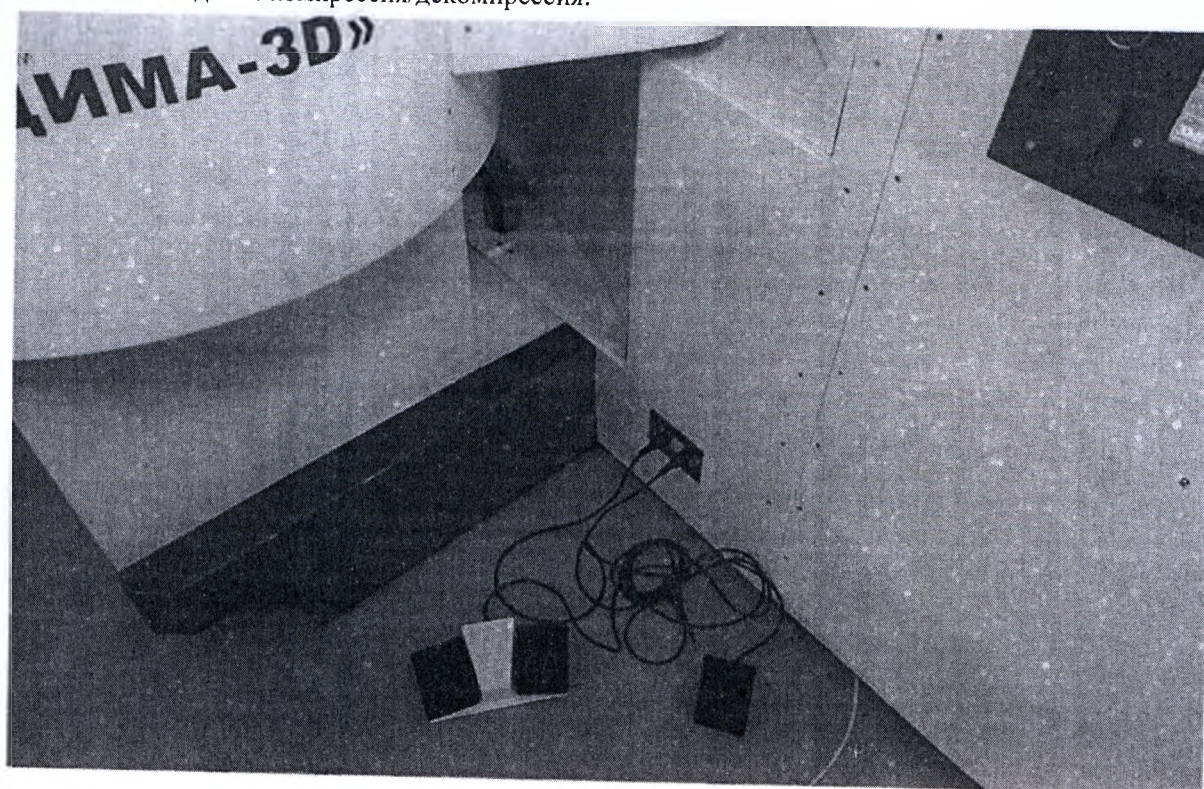


7. Педаль тормоз деки штатива.

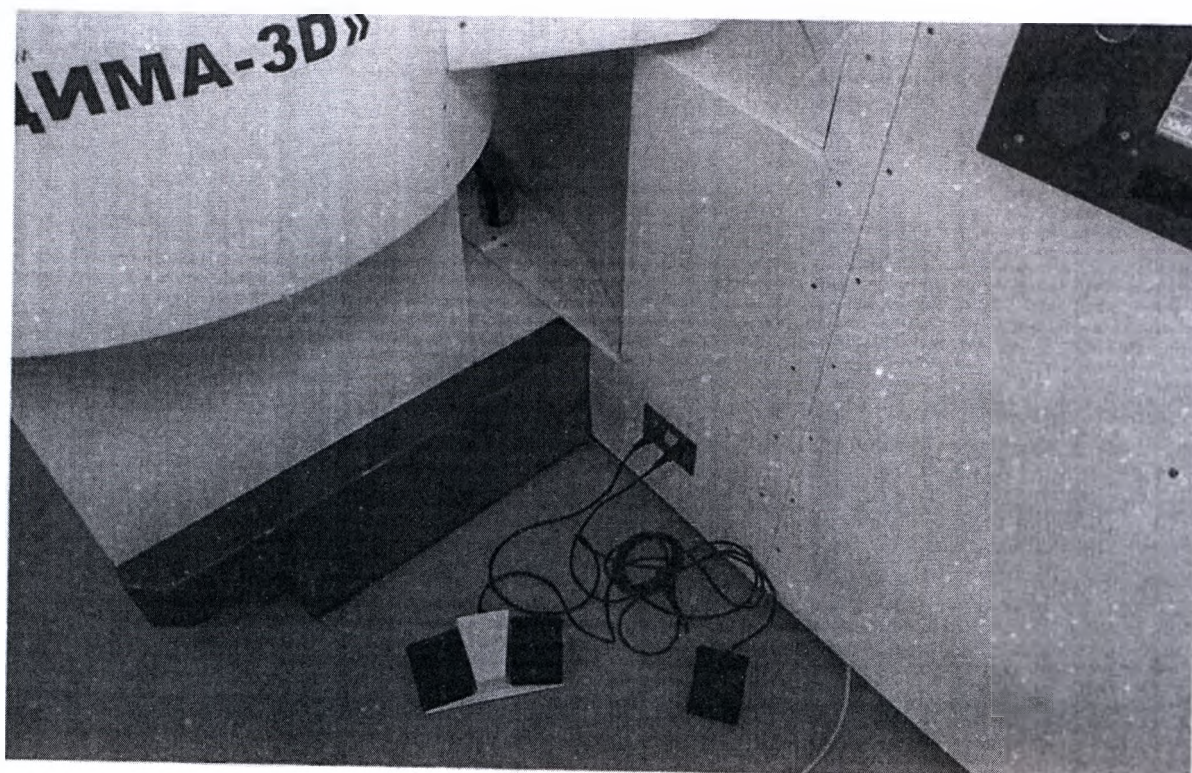


8. Устройство для биопсии стереотактическое.

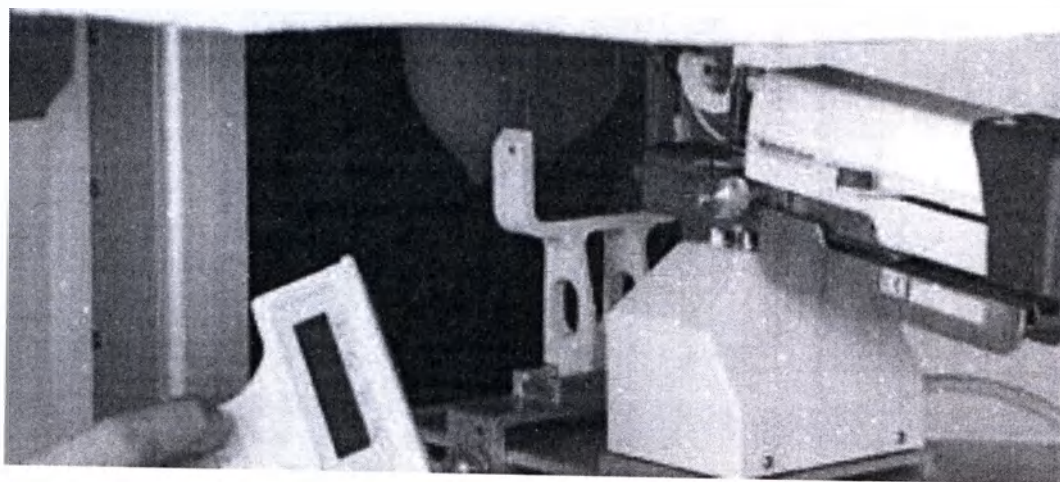

9. Компрессионная пластина для биопсии.

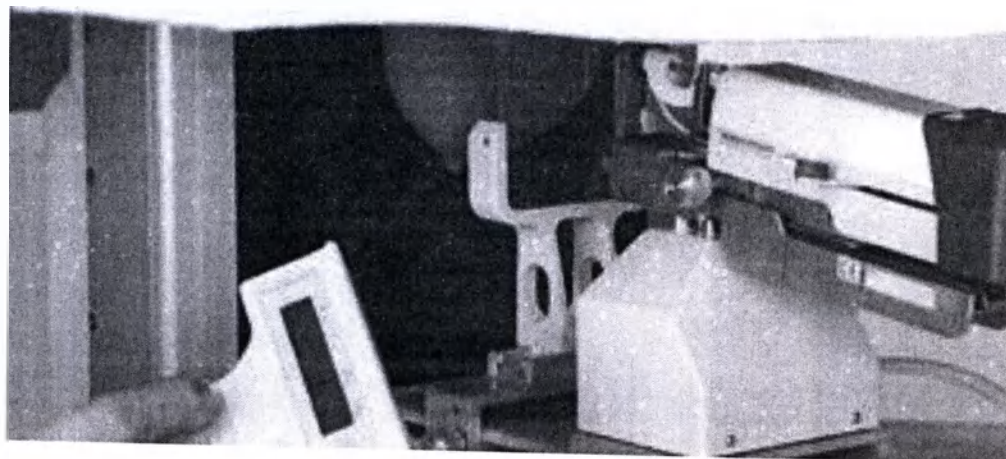

10. Устройство для диффузионно-оптической томографии.

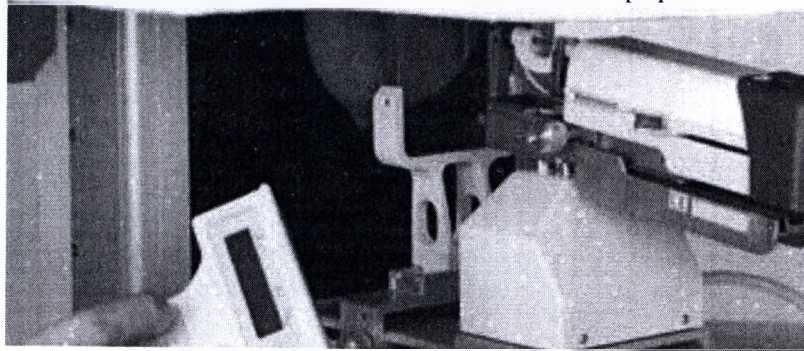

11. Комплекс средств управления маммографом и получения маммограмм, регистрации, базы данных, обработки, печати, хранения и т.д. (рабочее место лаборанта/оператора на базе компьютера с предустановленным СПО).



13. Комплекс средств для визуализации, обработки, документирования, отчетности, хранения, экспорта/импорта, печати и т.д. (рабочее место врача-рентгенолога на базе компьютера с предустановленным СПО).



14. Эксплуатационная документация:  
- руководство по эксплуатации;

**ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  
МАММОГРАФ РЕНТГЕНОВСКИЙ ЦИФРОВОЙ  
«МЕДИМА-3Д»**

**Руководство по эксплуатации**



|                                                                                                  |              |           |                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Маммограф рентгеновский цифровой</b><br><b>МРЦ «Медима-3Д»</b><br>ТУ 9442-004-71327975 – 2016 |              |           |                                                                                                             |
|                 | Изделие №    | 001       | <br>ИСО 9001<br>ИСО 13485 |
|                                                                                                  | Дата выпуска | 05.2015г. |                                                                                                             |
| Напряжение питания:                                                                              |              | ~220В±10% |                                                                                                             |
| Потребляемая мощность:                                                                           |              | 8 кВт     |                                                                                                             |
| Класс:                                                                                           |              | I         |                                                                                                             |
| Способ защиты:                                                                                   |              | B         |                                                                                                             |
| <b>ООО «МОСРЕНТГЕНПРОМ»</b><br>г.Москва, ул. М. Пироговская, д. 21                               |              |           |                                                                                                             |

Генеральный директор  
 ООО «Мосрентгенпром»



А.С. Ширина

Всего прошнуровано  
пронумеровано скреплено  
печатью \_\_\_\_\_ листов

ОБЛ. С. МОСКВА \* 656886439 \* МОСКОВСКОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УНИВЕРСИТЕТУ ИМЕНИ МОСКОВСКОГО КНЯЗЯ ДМИТРИЯ ПРИДВОРНОМУ