



ФОТО и Маркировка

«Калибратор серии DxH 500 (DxH 500 Series Calibrator)»

2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Бекмен Культер»


109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 21, стр. 3
тел.: (495) 228-67-00, факс: (495) 228-67-01

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

E-mail: beckman.ru@beckman.com
www.beckmancoulter.com

Rx Only in the U.S.A.

Contents: 2 x 2 ml



DxH 500 Series Calibrator is designed for the determination of calibration factors for the DxH 500 Series Systems in conjunction with specific DxH 500 Series reagents. Refer to the Table of Expected Results for specific instrument models. / El calibrador de la serie DxH 500 se ha diseñado para la determinación de los factores de calibración para los sistemas de la serie DxH 500 junto con los reactivos de la serie DxH 500 específicos. Consulte los modelos de instrumentos específicos en la tabla de resultados esperados. / DxH 500 Serisi Kalibratör DxH 500 Serisi Sistemlerinin spesifik DxH 500 Serisi reaktifleriyle birlikte kalibrasyon faktörlerini tespit edilmesi için tasarlanmıştır. Belirli cihaz modelleri için Beklenen Sonuçlar Tablosuna bakın.

[illegible]

Don't miss the new book, *Don't Miss the New Book*, by *Don't Miss the New Book*.

Statistical Services Division 102 222 St. J. Rd. NW

Protect workers' biologically sourced material
Human, Divine and Divine





WARNING
IT IS NOT HOT

Discussion: Hydrolysis = 15

DxH 500 Series Calibrator



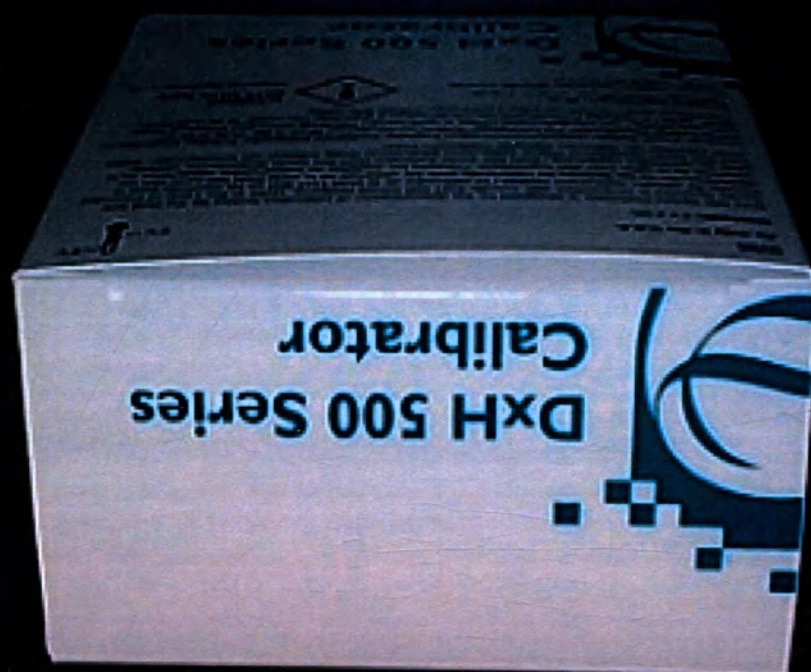


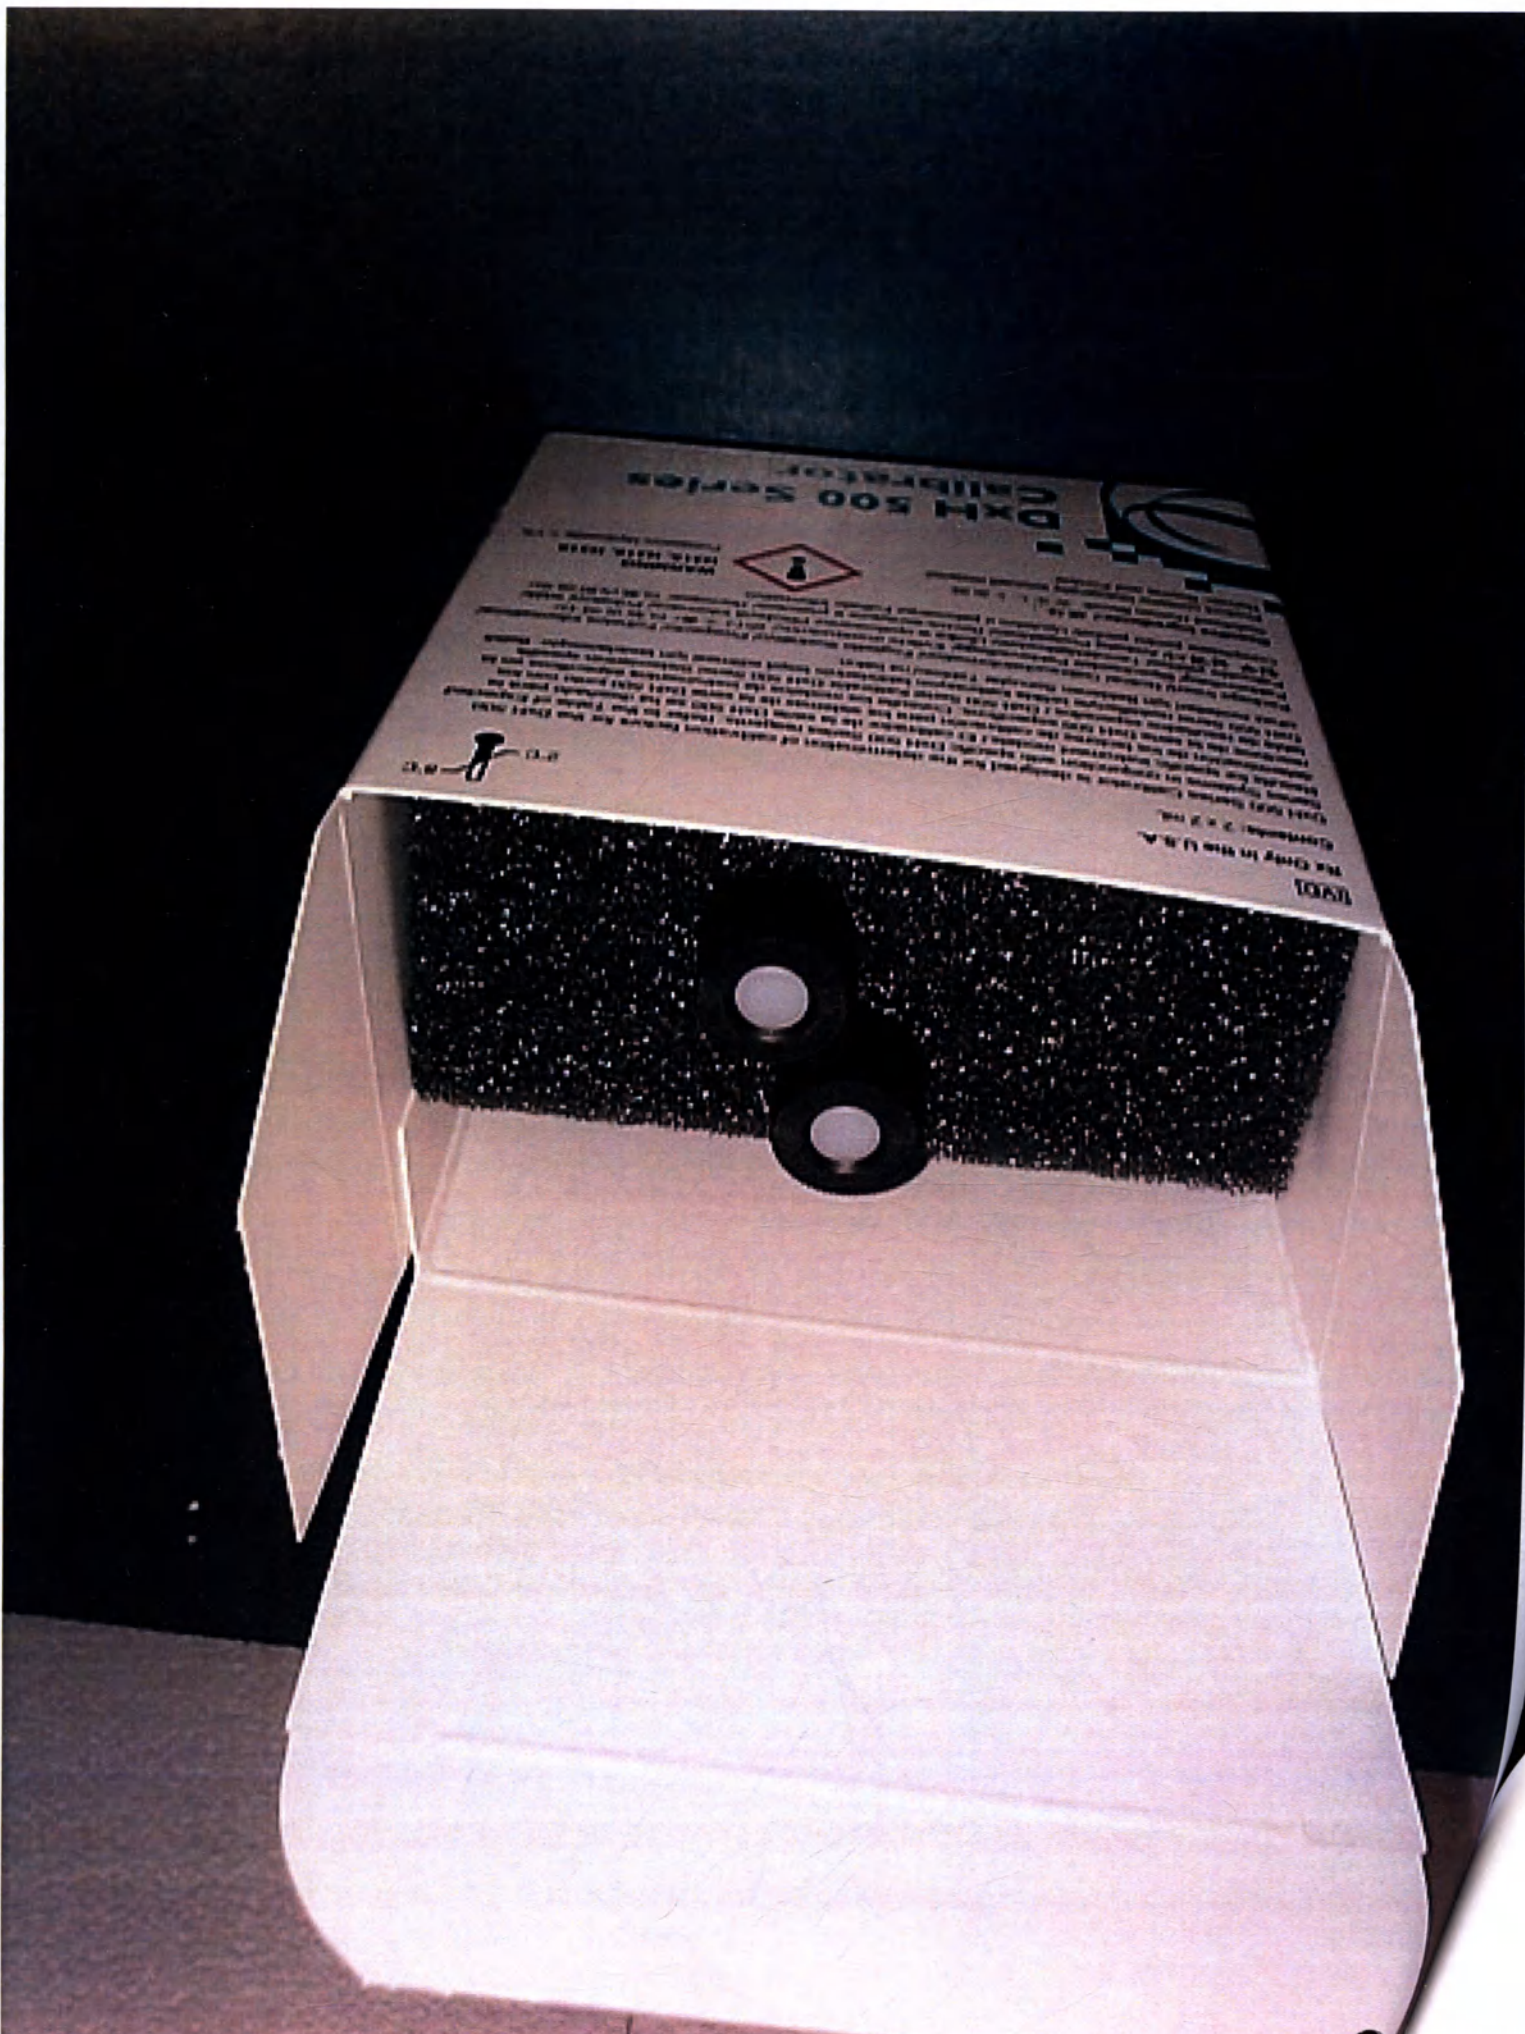

IVD

Rx Only In the U.S.A.

Contents: 2 x 2 mL



DxH 500 Series Calibrator is designed for the determination of calibration factors for the DxH 500 Series Systems in conjunction with specific DxH 500 Series reagents. Refer to the Table of Expected Results for specific instrument models. / El calibrador de la serie DxH 500 se ha diseñado para la determinación de los factores de calibración para los sistemas de la serie DxH 500 junto con los reactivos de la serie DxH 500 específicos. Consulte los modelos de instrumentos específicos en la tabla de resultados esperados. / DxH 500 Serisi Kalibratör DxH 500 Serisi Sistemlerinin spesifik cihaz modelleri için Beklenen Sonuçlar Tablosu'na bakın.

Package Insert/ Notice/ Gebrauchsinformation/ Foglietto illustrativo/ Prospecto/ Folheto informativo/ Pakkeindlæg/ Bipaaksedel/ Pakkevedlegg/ Evērtis anskaidrošs/ 添付文書/ 包装说明书/ Pakuotės įdėjimas/ Terméktájékoztató/ Ulotka w opakowaniu/ Příložená informace/ Příbalový leták/ 첨부 설명서/ Ambalaj Prospektüsü/ Листок-вкладыш в упаковке/ Листовка/ 包装内附說明/ Completare pentru pachet/ Uputstvo u pakovanju/ Folhelo informativo

Reactive Ingredients/ 成分 :

Stabilized Human Blood/ 安定ヒト血液

Product contains biologically sourced material:
Human, Bovine and Porcine



WARNING

H315, H316, H319

Potassium Hydroxide < 1%

DxH 500 Series Calibrator

Manufactured for:
Beckman Coulter Ireland Inc.
Lismochan
O'Callaghan's Mills
Co. Clare, Ireland



SDS



製造販売元: ベックマン・コールター株式会社
東京都江東区有明三丁目5番7号
TOC有明ウエストタワー

www.beckmancoulter.com/jp

LOT

491608600

(01)1509530071000



2017-01-05

(17)170105

(10)491608600




+H6280368801P





+553170105491608600PN

REF B30880



Printed in USA Made in USA
© 2016 Beckman Coulter, Inc.
B30870-AB

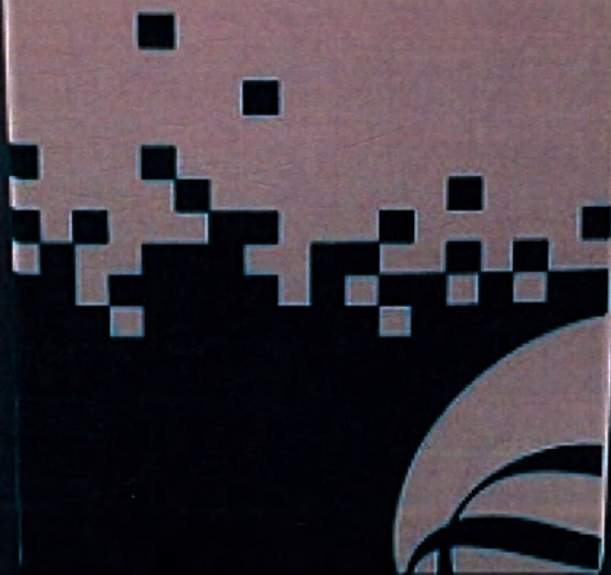

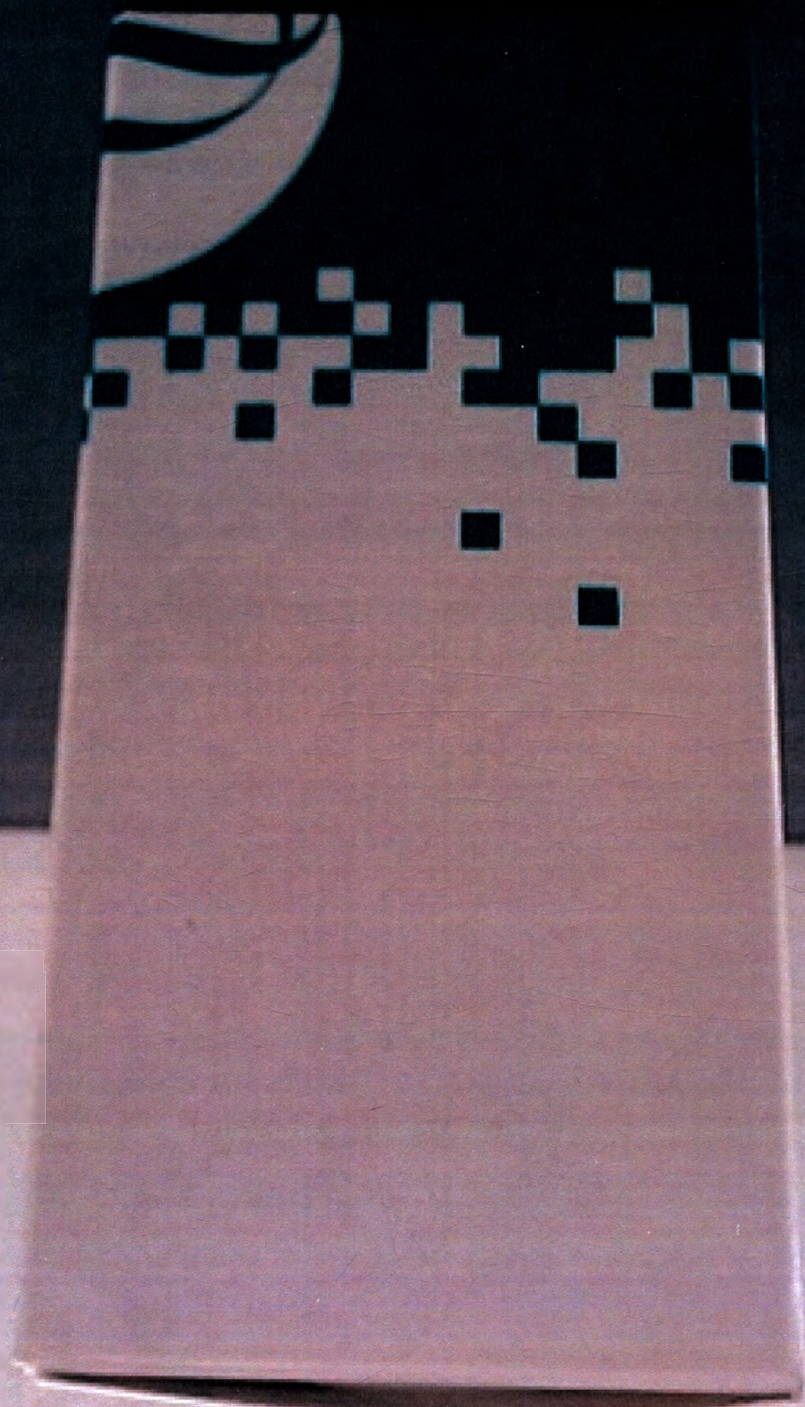

DxH 500 Series Calibrator

Manufactured for:
Beckman Coulter Ireland Inc.
Lismeehan
O'Callaghan's Mills
Co. Clare, Ireland

製造販売元: ベクマン・コールター株式会社
東京都江東区有明二丁目5番7号
TQC有明ウェストタワー

www.beckmancoulter.com/ifu

IVD

Rx Only in the U.S.A.

Contents: 2 x 2 mL

DxH 500 Series Calibrator is designed for the determination of calibration factors for the DxH 500 Series Systems in conjunction with specific DxH 500 Series reagents. Refer to the Table of Expected Results for specific instrument models / El calibrador de la serie DxH 500 se ha diseñado para la determinación de los factores de calibración para los sistemas de la serie DxH 500 junto con los reactivos de la serie DxH 500 específicos. Consulte los modelos de instrumentos específicos en la table de resultados esperados / DxH 500 Series Kalibrator DxH 500 Serisi Sistemlerinin spesifik DxH 500 Serisi reaktifleriyle birlikte kalibrasyon faktörlerinin tespit edilmesi için tasarlanmıştır. Belirli cihaz modelleri için Beklenen Sonuçlar Tablosu'na bakın.

Package Insert/ Notice/ Gebrauchsinformation/ Foglietto illustrativo/ Prospecto/ Folhetos informativos/ Pakkeindlæg/ Bipskedel/ Pakkevedlegg/ Evénro szvszudoct/ 添付文書/ 包裝說明書/ Pakuotės pildas/ Termékajánlatok/ Uputstvo u pakovanju/ Příložená informace/ Příbalový leták/ 型半 설명서/ Ambalaj Prospektüsü/ Листок-вкладыш с информацией/ 包裝内附說明/ Completare pentru pachet/ Uputstvo u pakovanju/ Folheto informativo

Reactive Ingredients/ 成分:
Stabilized Human Blood/ 安定ヒト血液
Product contains biologically sourced material:
Human, Bovine and Porcine



WARNING
H315, H316, H319
Potassium Hydroxide < 1%



REF B36880

CE

Printed in USA Made in USA
© 2016 Beckman Coulter, Inc.
B36870-AB



HOLD AREA
3-7/8" x 1-3/8"

DxH 500 Series Calibrator

THIS BOX IS FOR TECH COMMUNICATIONAL USE ONLY. Refer to 4print zip file for all printing specifications

Special Instructions: N/A

Description: CTN; DXH 500 SERIES CALIBRATOR


Ink Color(s): 100% Black, PMS 321C, PMS 186C

Part Number: B36870

Revision: AB

Label Size: 3-7/8" x 2-1/4" x 4-1/2"

Scale: 1 : 1

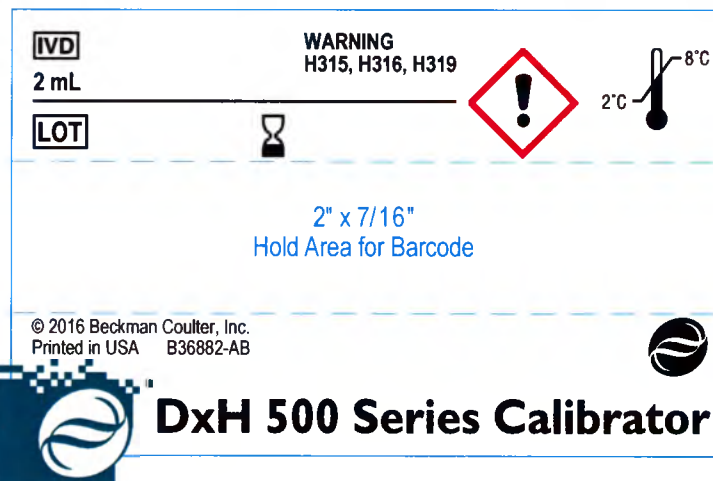

THIS BOX IS FOR TECH COMM INFORMATIONAL USE ONLY. Refer to "4print.zip" file for all printing specifications.			
Special Instructions: Reduce 50%			
Description: LBL; PRI, DXH 500 SERIES CALIBRATOR		Ink Color(s): 100% Black, PMS 321C, PMS 186C	
Part Number: B36882	Revision: AB	Label Size: 2" x 1-1/4"	Scale: 2 : 1



ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

10

лист

листов

Семиндов И. А.