






Блок управления (для всех исполнений одинаков)

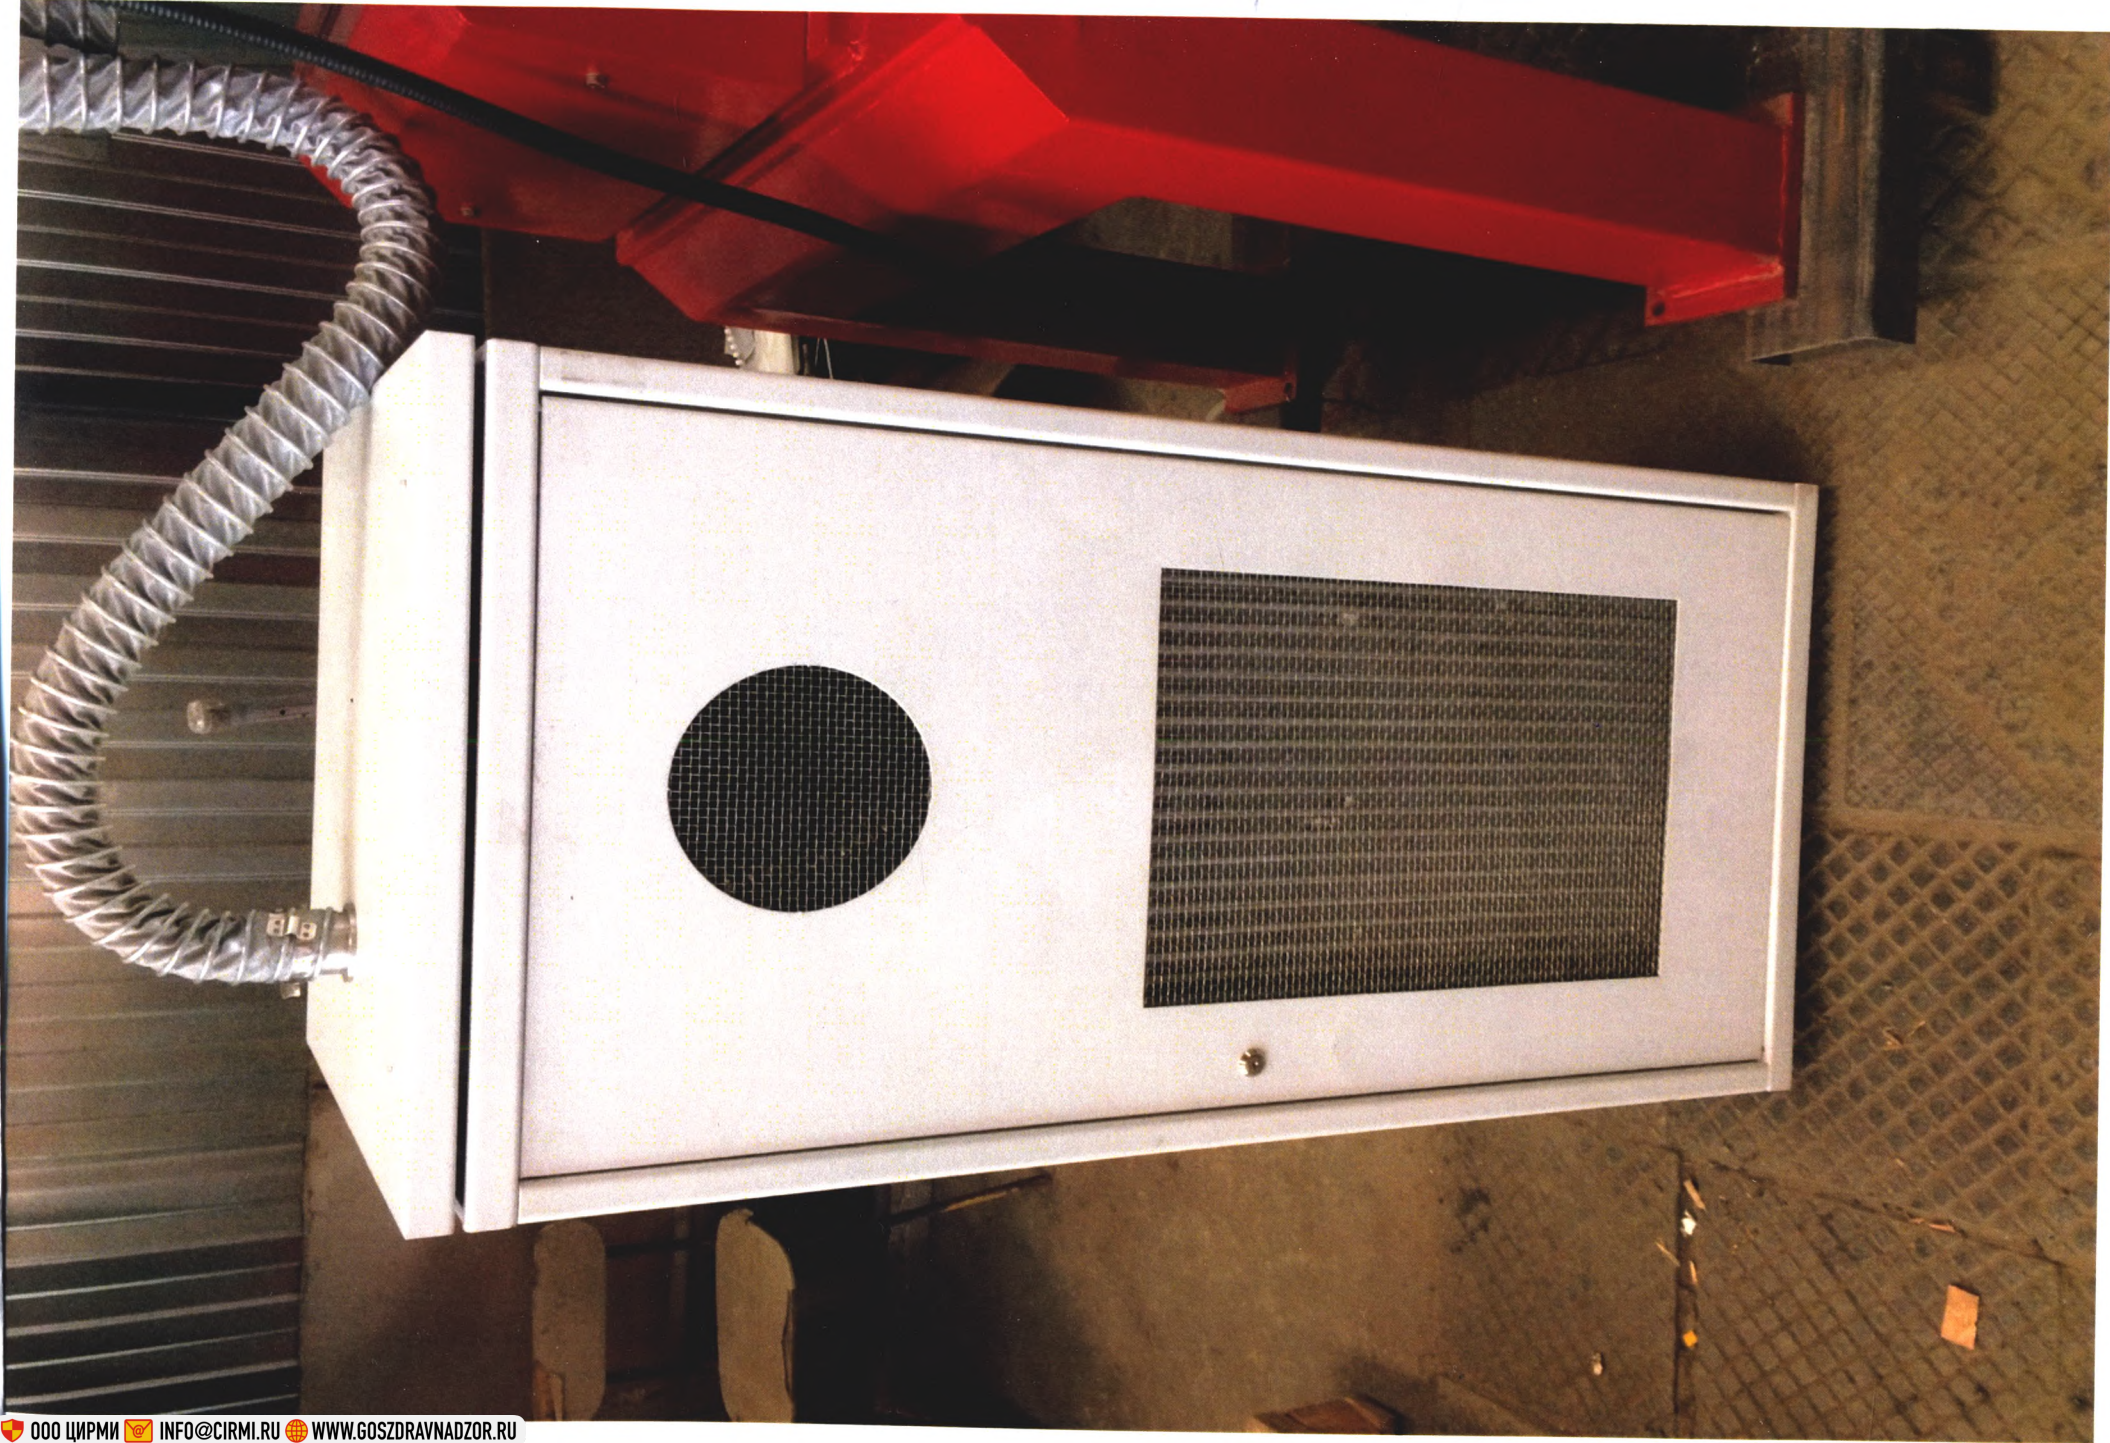

УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ
МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ
"ТЕРМОЭЛИМИНАТОР"

Исполнение: 1000

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

Напряжение питания и частота: ~380В, 50Гц

Потребляемая мощность: 7500 В·А

Масса: 35 кг

Зав. номер: 000001 Дата: 05-2017

ТУ 32 50.50-003-24485155-2017

Изготовитель ООО "НПО ПЗМО"



В настоящем докумен
те прошито и скреплен
о печатью
листом № 1